



Фотографические изображения

**Набор контрольных сывороток для контроля качества определения общих антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (PreciControl Anti-SARS-CoV-2 S cobas e analyzers).
Серия: LOT 51336401.**


Набор контрольных сывороток для контроля качества определения общих антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (PreciControl Anti-SARS-CoV-2 S cobas e analyzers).
Серия: LOT 51336401.

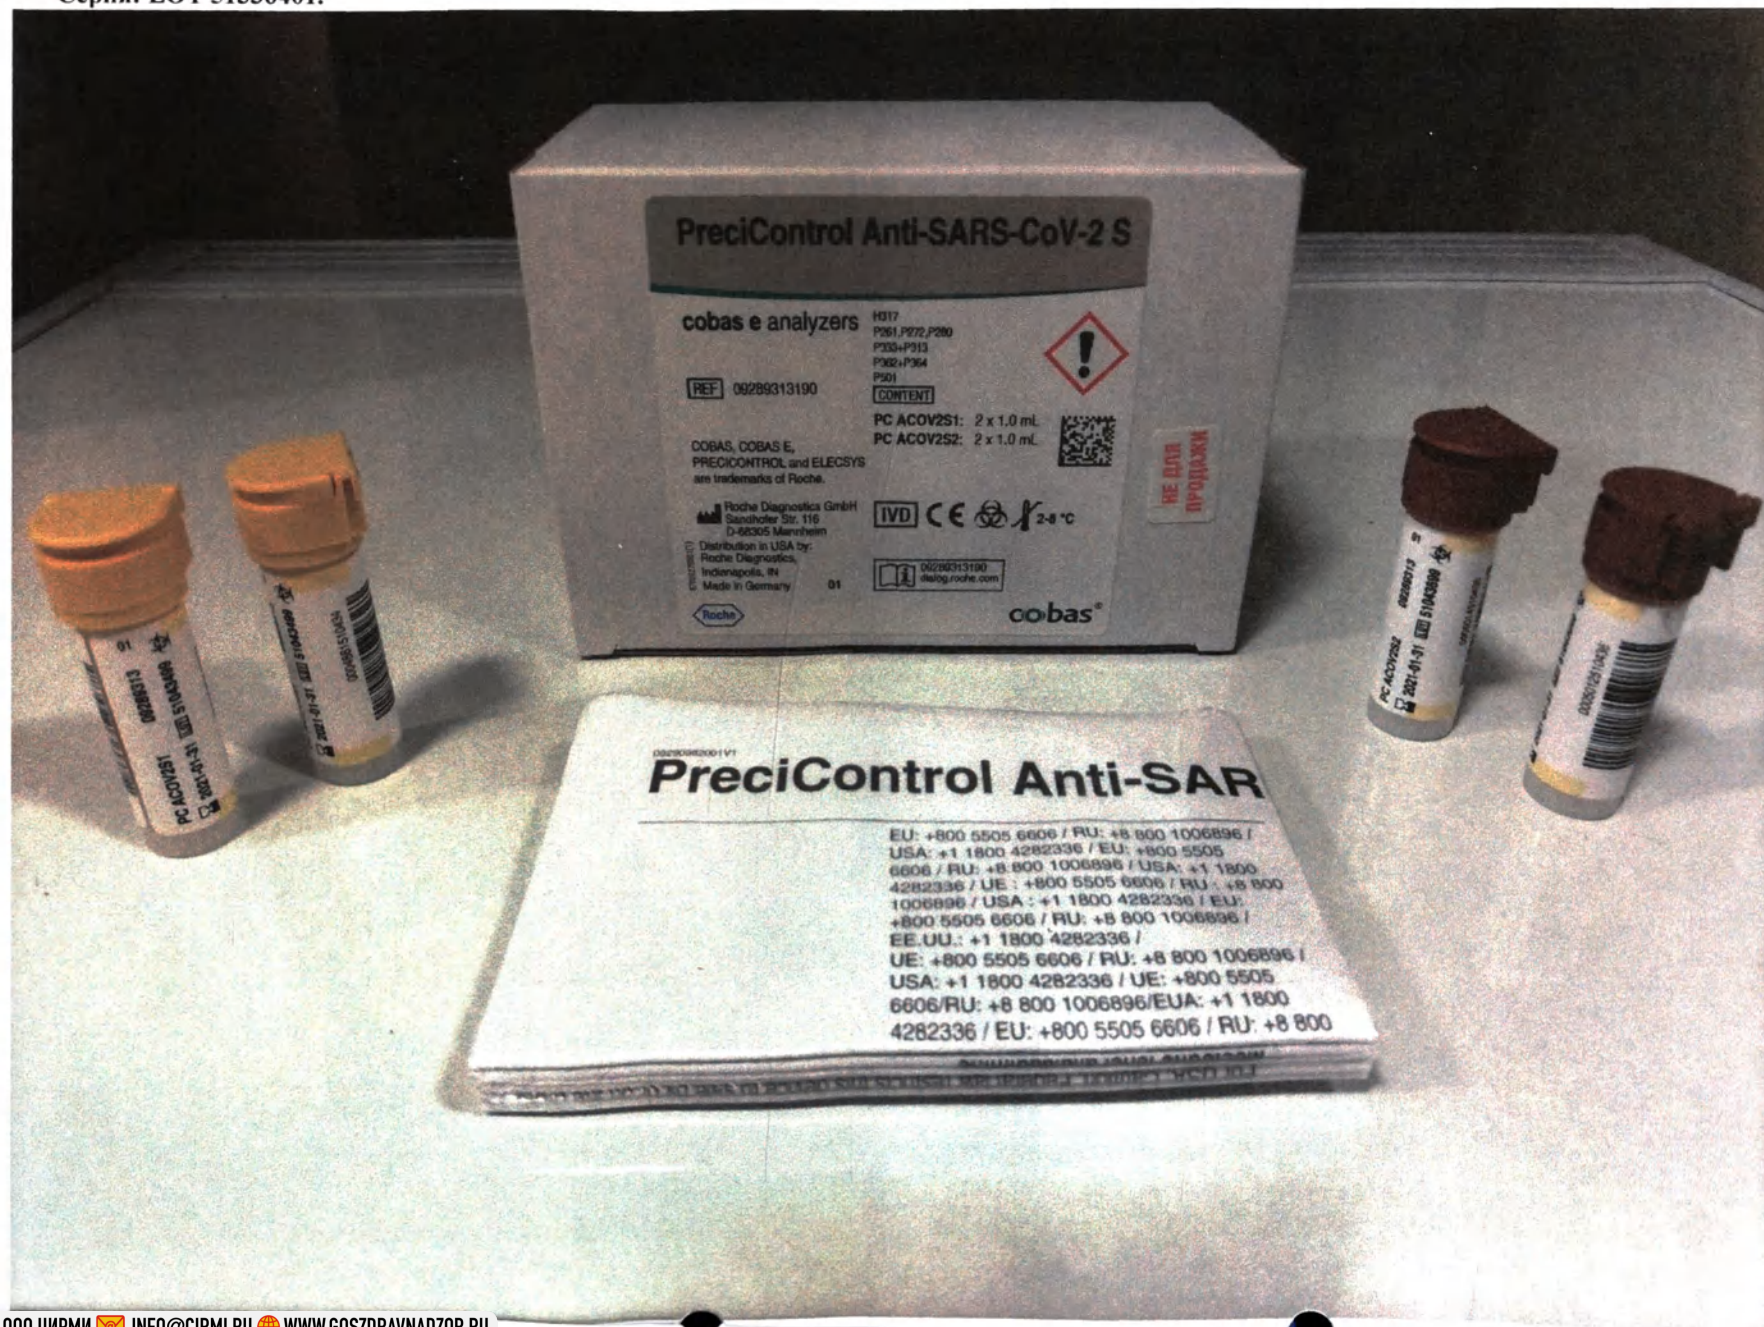


Набор контрольных сывороток для контроля качества определения общих антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (PreciControl Anti-SARS-CoV-2 S cobas e analyzers). Серия: LOT 51336401

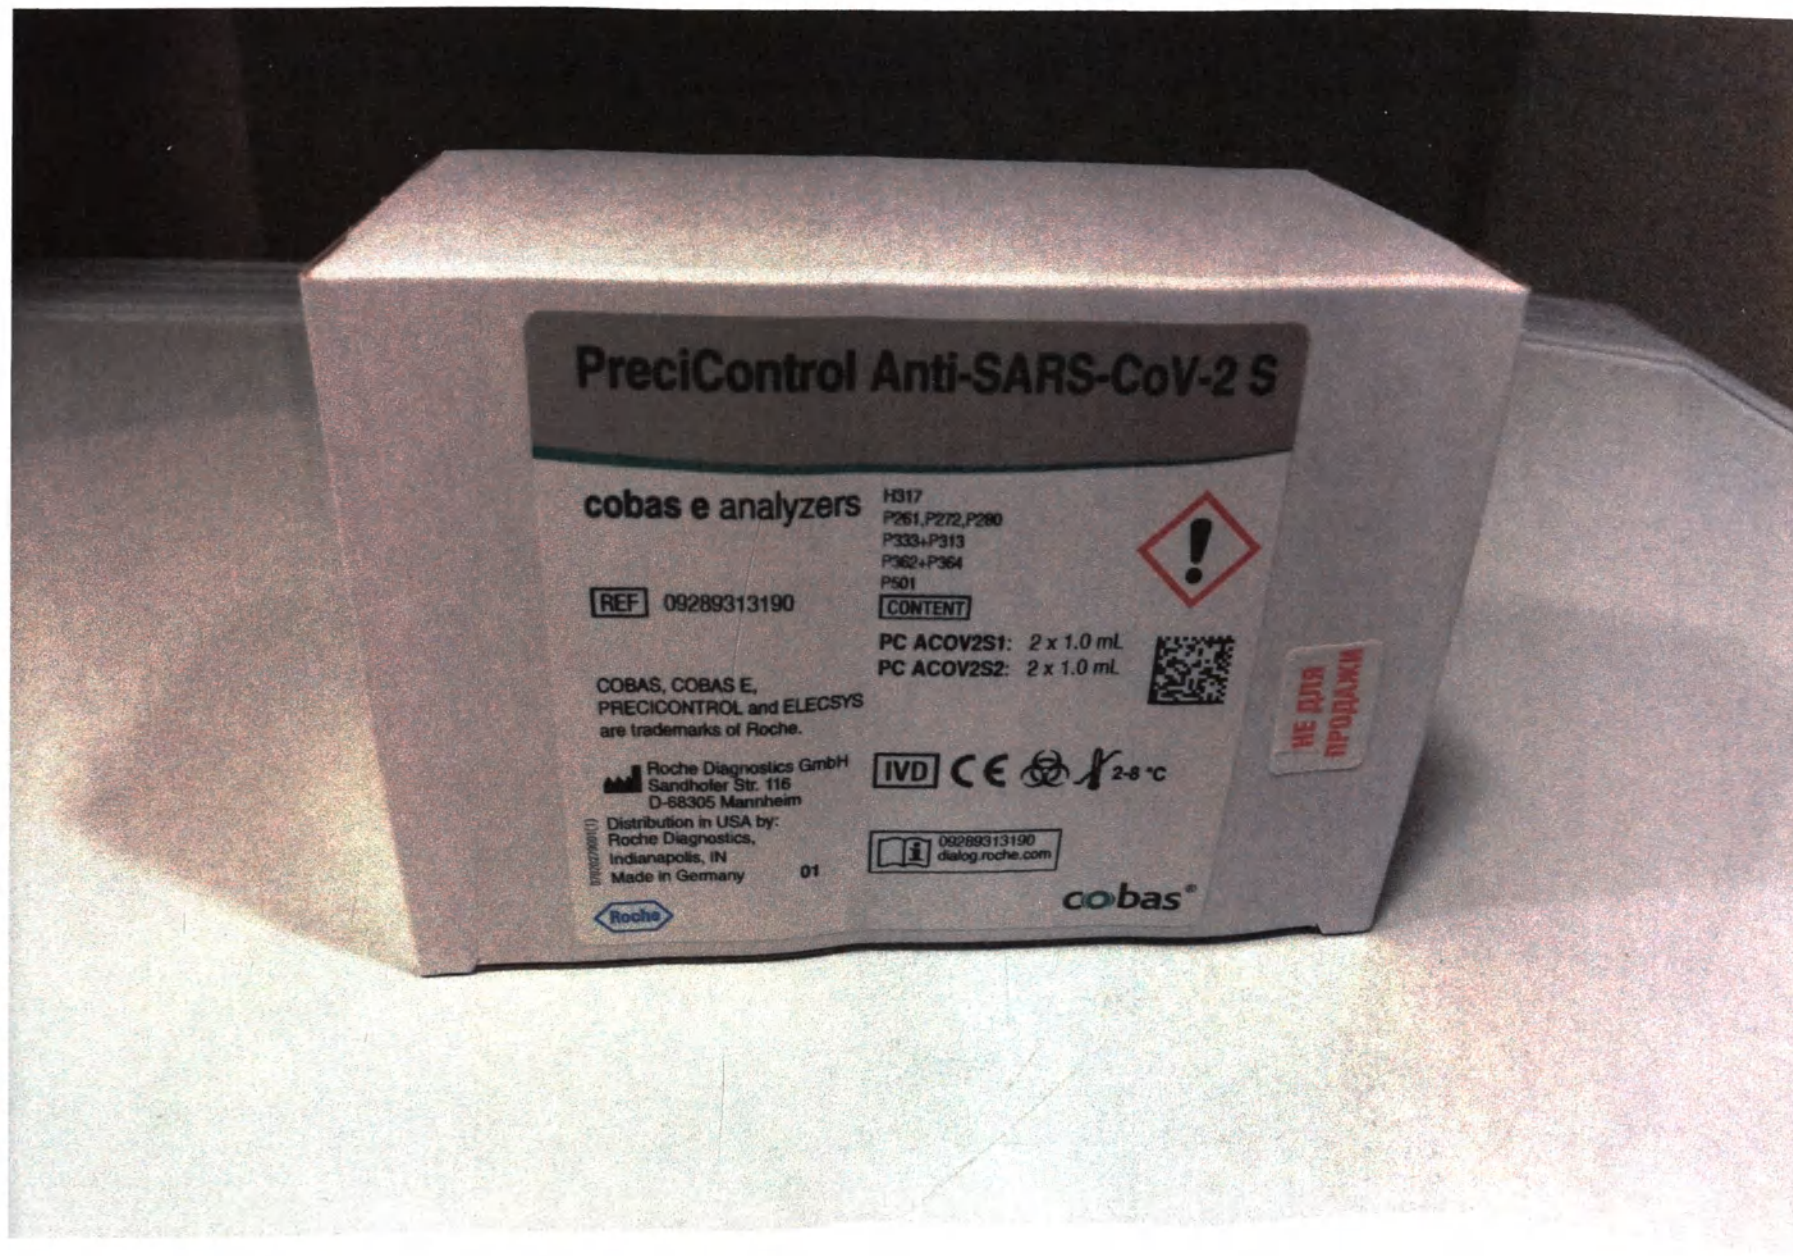

Набор контрольных сывороток для контроля качества определения общих антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (PreciControl Anti-SARS-CoV-2 S cobas e analyzers). Серия: LOT 51336401

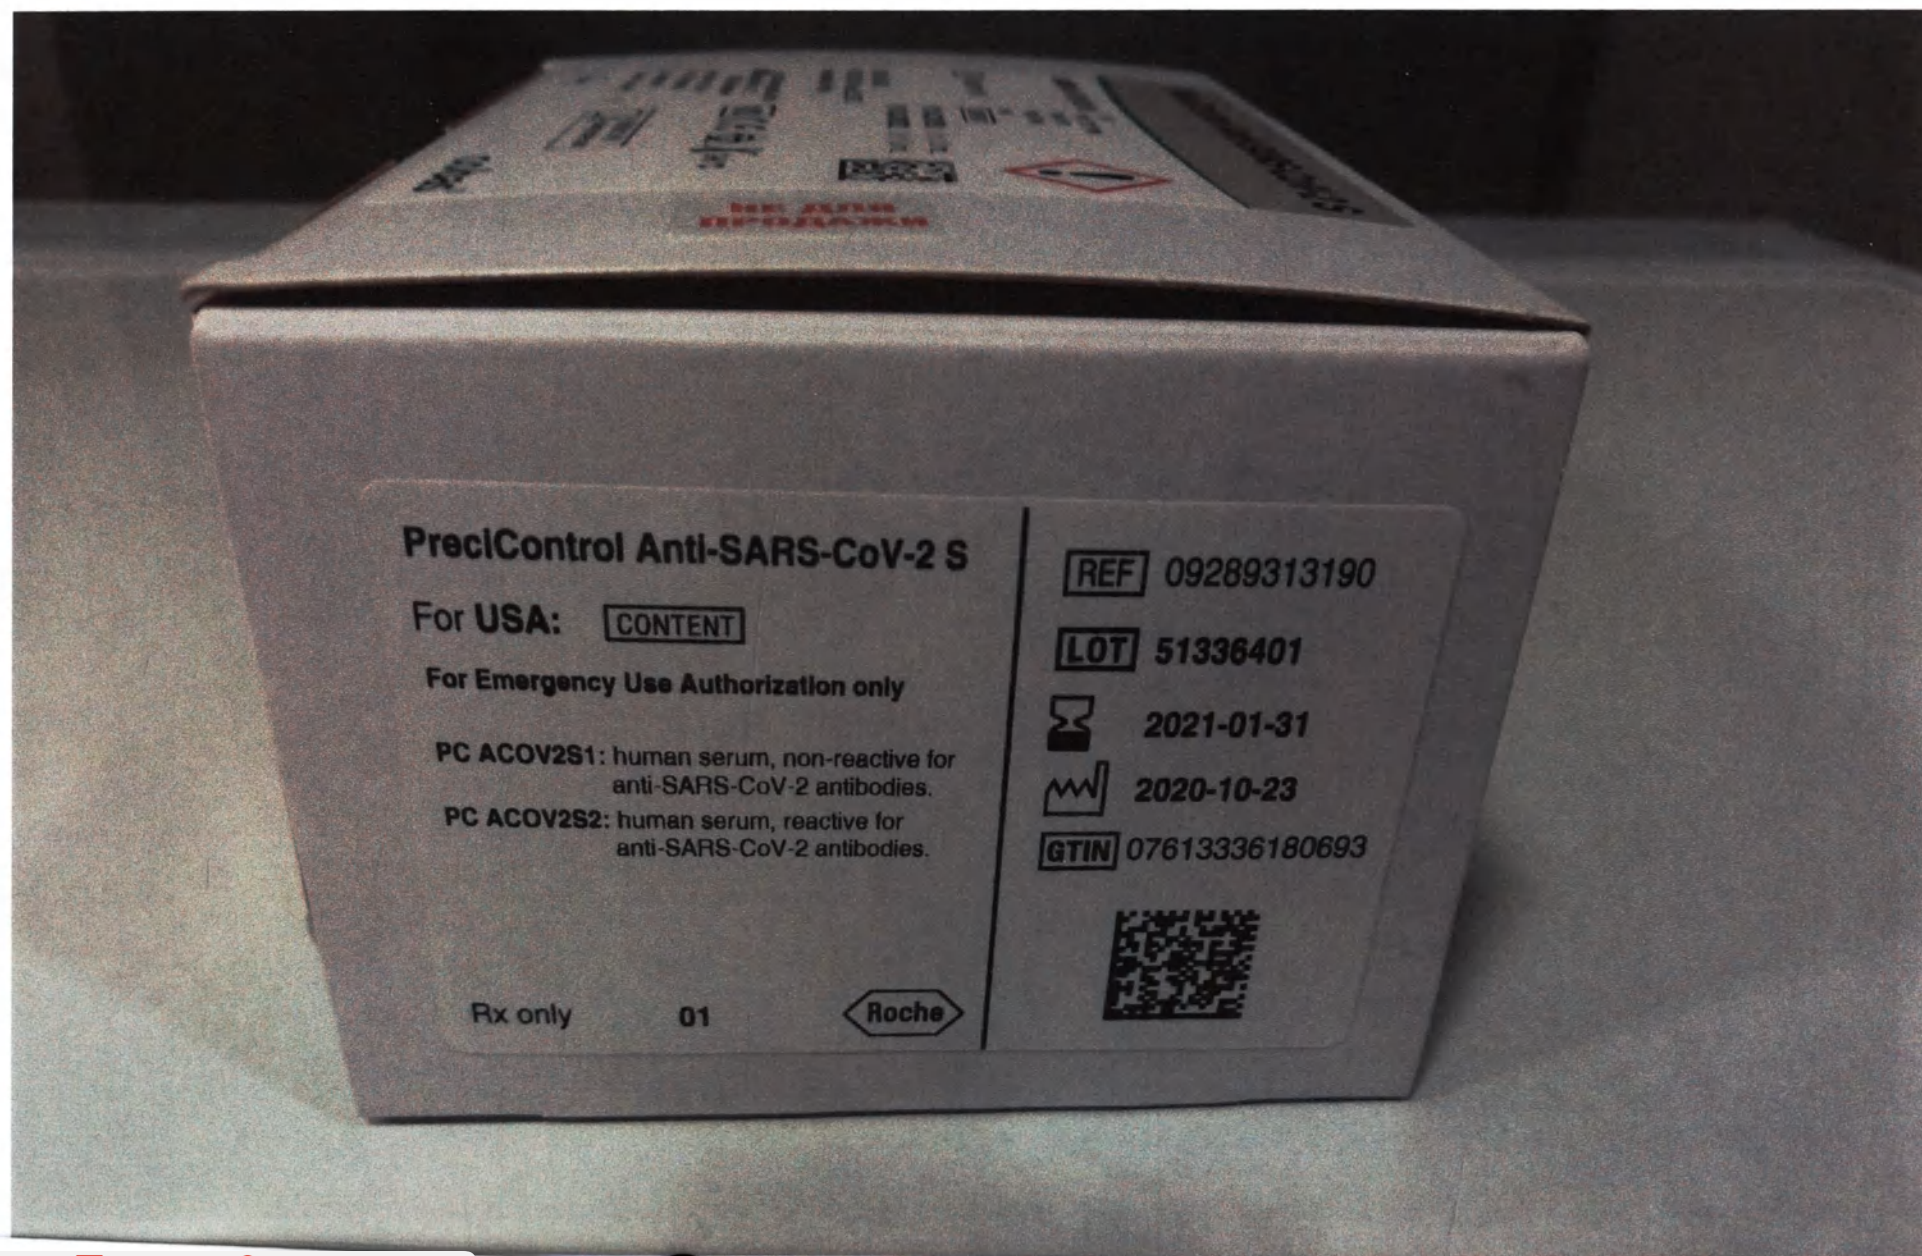


Набор контрольных сывороток для контроля качества определения общих антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (PreciControl Anti-SARS-CoV-2 S cobas e analyzers). Серия: LOT 51336401

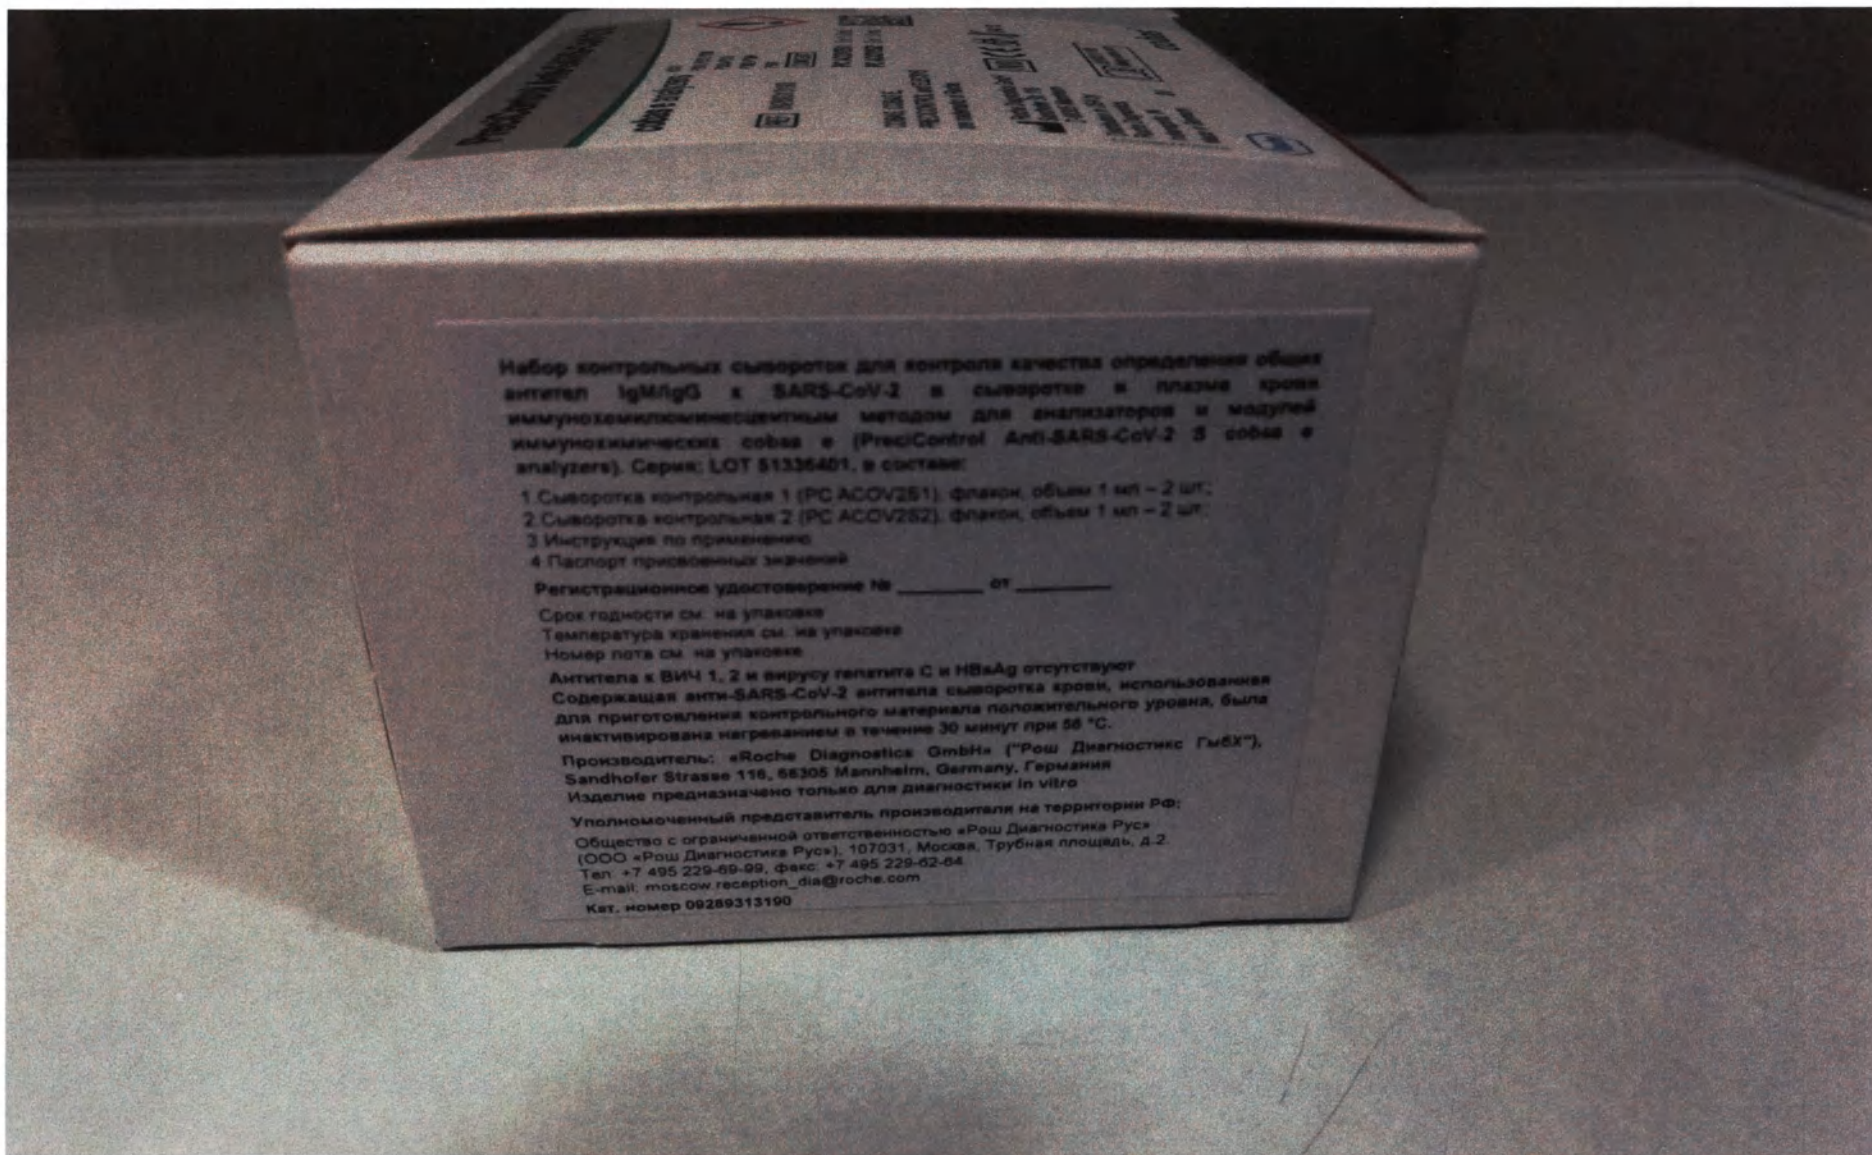


Набор контрольных сывороток для контроля качества определения общих антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (PreciControl Anti-SARS-CoV-2 S cobas e analyzers). Серия: LOT 51336401

1. Сыворотка контрольная 1(PC ACOV2S1), флакон, объем 1 мл – 2 шт.;

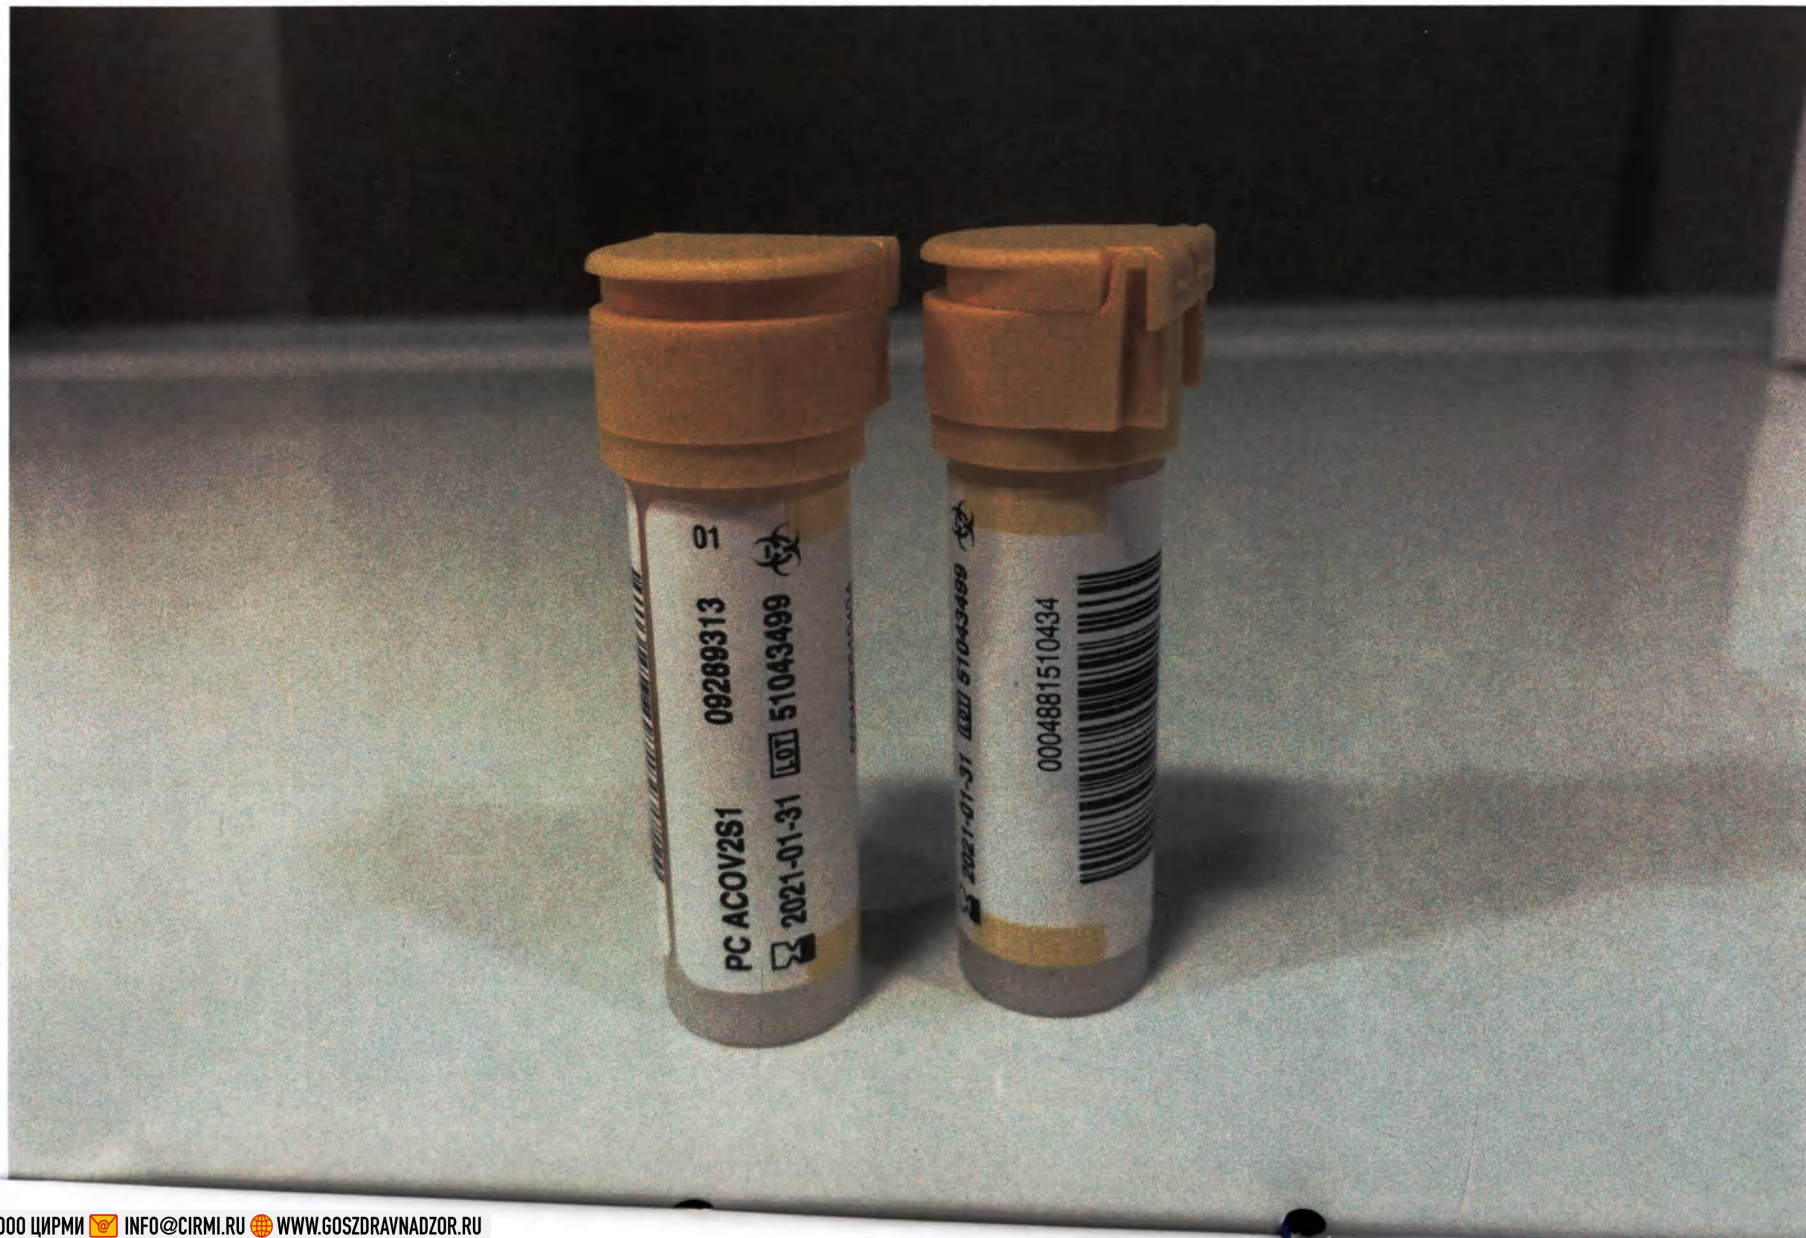

Набор контрольных сывороток для контроля качества определения общих антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (PreciControl Anti-SARS-CoV-2 S cobas e analyzers).
Серия: LOT 51336401

2. Сыворотка контрольная 2(PC ACOV2S2), флакон, объем 1 мл – 2 шт.;

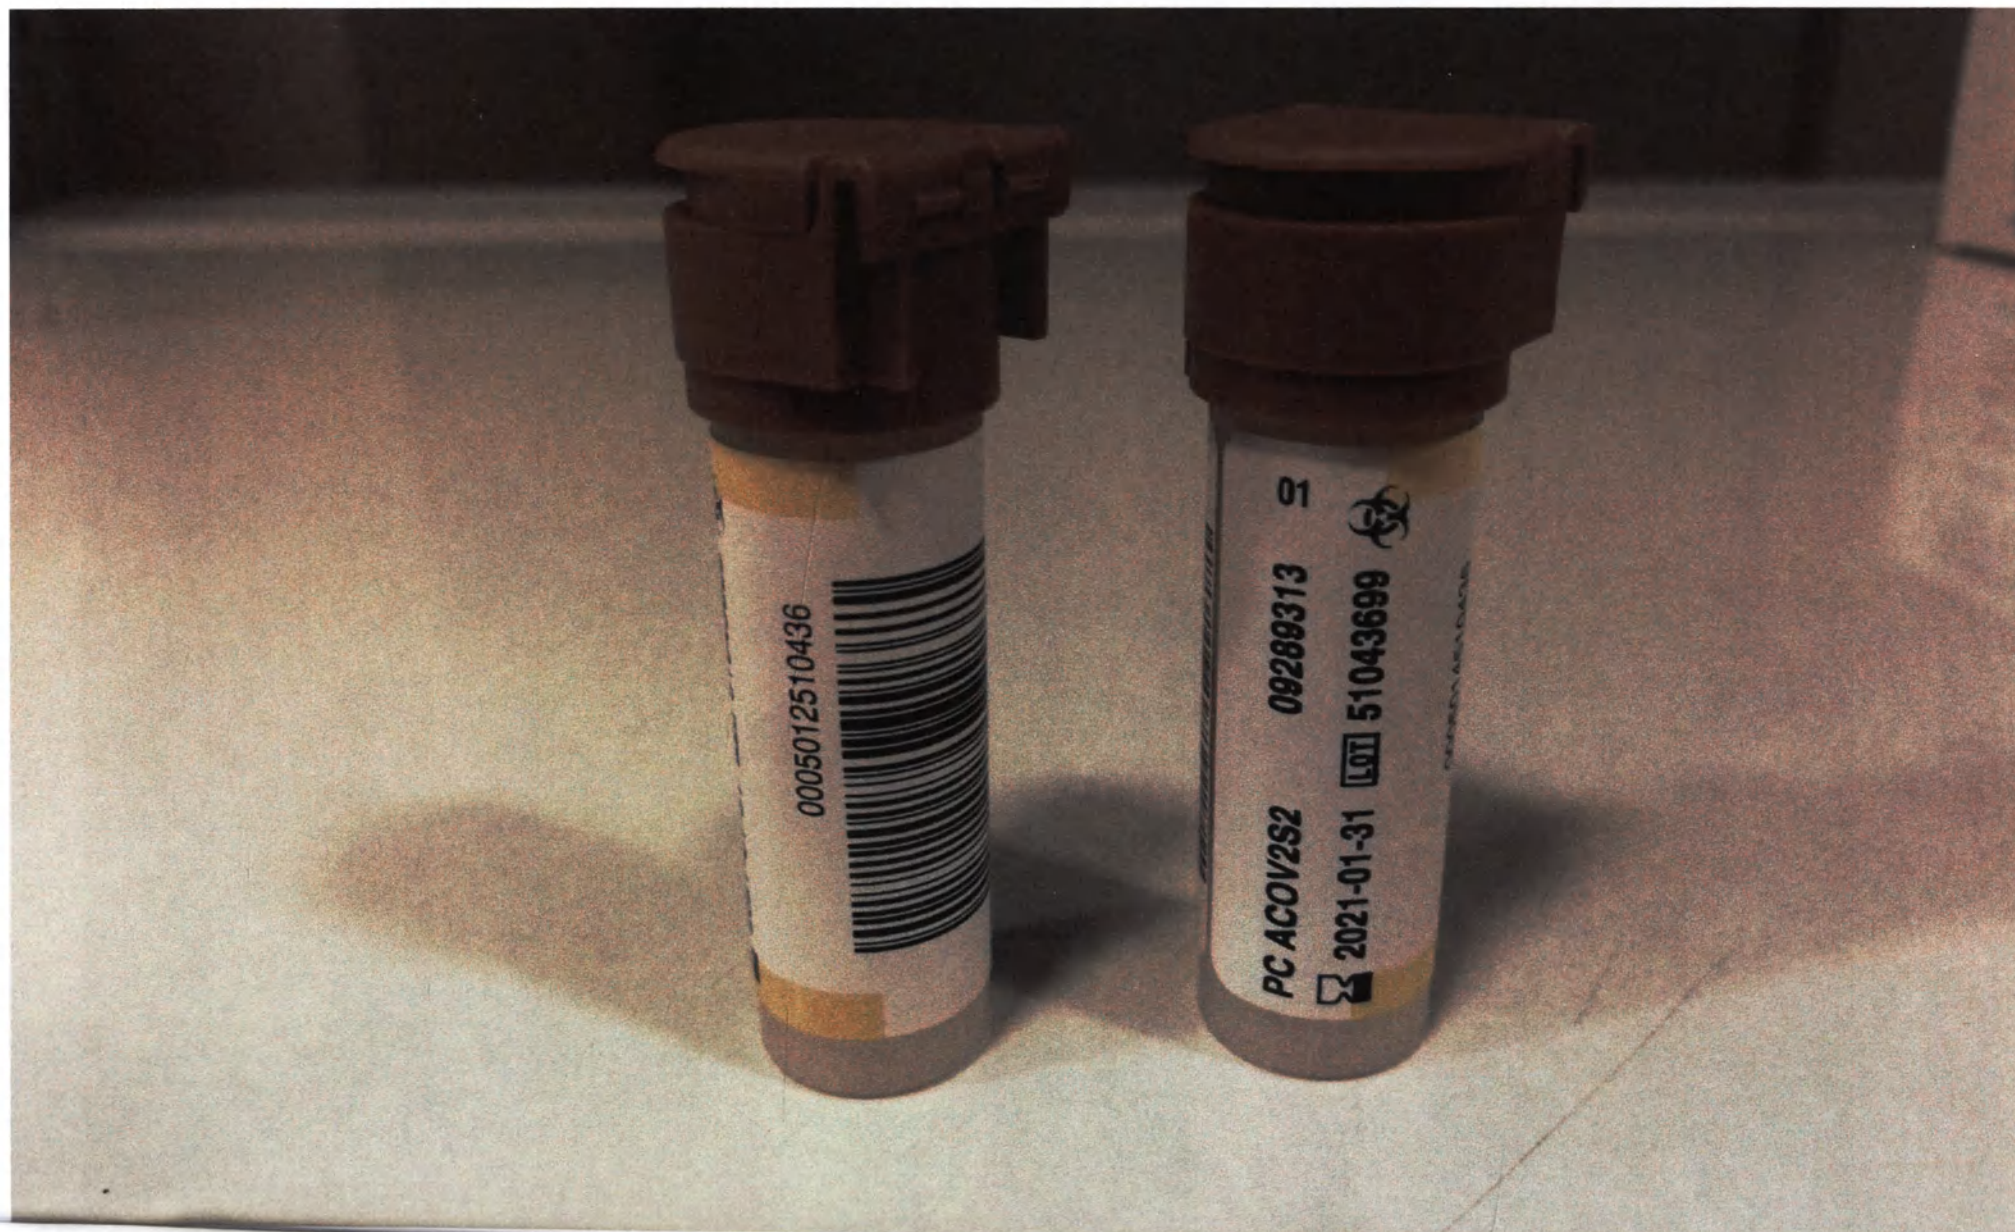

4 x 1.0 mm

Pyrenous

Назначение
Набор компонентов Интерактив ProControl Anti-SARS-CoV-2 S (интерактив для контроля качества лабораторных исследований Anti-SARS-CoV-2 S на иммунофлуоресцентном анализе).

Терпелмечное общество

Содержание: антитела Precodant Anti-SARS-CoV-2 S (реактиватор)
 (код 10705) и прекодонированного образца на основе
 прекодонированного образца. Контрагент антитела, идентифицирова
 ный под названием Precodant Anti-SARS-CoV-2 S.

- PC-AQV0251: 2 фторола, в количестве 1,0 мм композитного материала на основе дисперсионной смеси наночастиц, гиперпротектирующей адгезивной к SRS-001-2; TPOC 6/9/99, композит.
- PC-AQV0252: 2 фторола, в количестве 1,0 мм композитного материала на основе дисперсионной смеси наночастиц, гиперпротектирующей адгезивной к SRS-001-2; TPOC 6/9/99, композит.

Полученные величины должны находиться в определенных пределах. Если существовать тенденции к занижению или завышению результатов, или любая другая тенденция за пределами допустимых значений, следует провести ряд явных выводов.

При необходимости измерения или измеримых объектов биоматериала должны быть приняты.

Каждая лаборатория должна выполнять правила, позволяющие принять достоверные меры в случае, если значения выходят за установленные пределы.

Меры предосторожности и предупреждения

Только для в vitro диагностики.

Содержание образцы мочи предосторожности, необходимые при работе со всеми лабораторными реагентами.

Имплементация всех отводов должна осуществляться в соответствии с местными правилами.

Персонал биологических исследований профессиональному руководству по договору.



Грудыпрежидение

- Н317
Может вызывать аллергическую реакцию кожи.

Меры предосторожности:

- Старайтесь не вдыхать пыль / дым / газ / туман / пары / аэрозоли

P272

- Загрязненную рабочую одежду не следует выносить за пределы рабочего места.

P280

- Носите защитные перчатки.

Ответные действия:

- Р-333 + Р313 При раздражении кожи или слиз. Обратиться за медицинской консультацией / помощью.

меры предосторожности при утилизации:

- Утилизовать содержимое контейнер на соответствующем лаппа по утилизируя отхное

SHS.

- св материалы человеческого происхождения должны

Специализированные тесты потенциально инфицированные. Все лабораторные исследования на крови человека, поступающие комбинату из крови доноров, тестируемых в индивидуальном порядке, у которых не были обнаружены позитивных антиген вирус гепатита В (HbsAg), ипотеза к вирусу гепатита С и в ВИЧ. Методы пересмотра, используемые для проверки выявлять, были одобрены, утвержденными на контроле за поставками продукции и предоставлены (сертификация FDA) или включены в соответствии с Директивой С 98/79 ЕС, Приложение II, Символ А.

Подтвержденный анти-SARS-CoV-2 антигента сыворотка крови, предназначенная для приготовления контрольного материала, соответствующего уровню, была инкапсулирована наравлении в течение инкубационного периода 55 °C.

М не менее, поскольку ни один из методов исследования не позволяет полностью исключить риск инфицирования, обращаться с термалами следует так же аккуратно, как и с образцом.

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
листа (ов)

9



Лучина И. А.
Руководитель отдела Логистики
и качества по доверенности от:

02 июля 2018