


Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

**Реагенты, контрольные материалы, калибраторы и принадлежности к реагентам для
выявления in vitro маркёров сифилиса и ВИЧ - инфекции на иммунохимическом
анализаторе ARCHITECT i**


(размером не менее 18 x 24 сантиметра)



Фотографическое изображение открытой упаковки ARCHITECT ВИЧ Аг/Ат Комбо реагент (ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Reagent), фасовка 1x100.

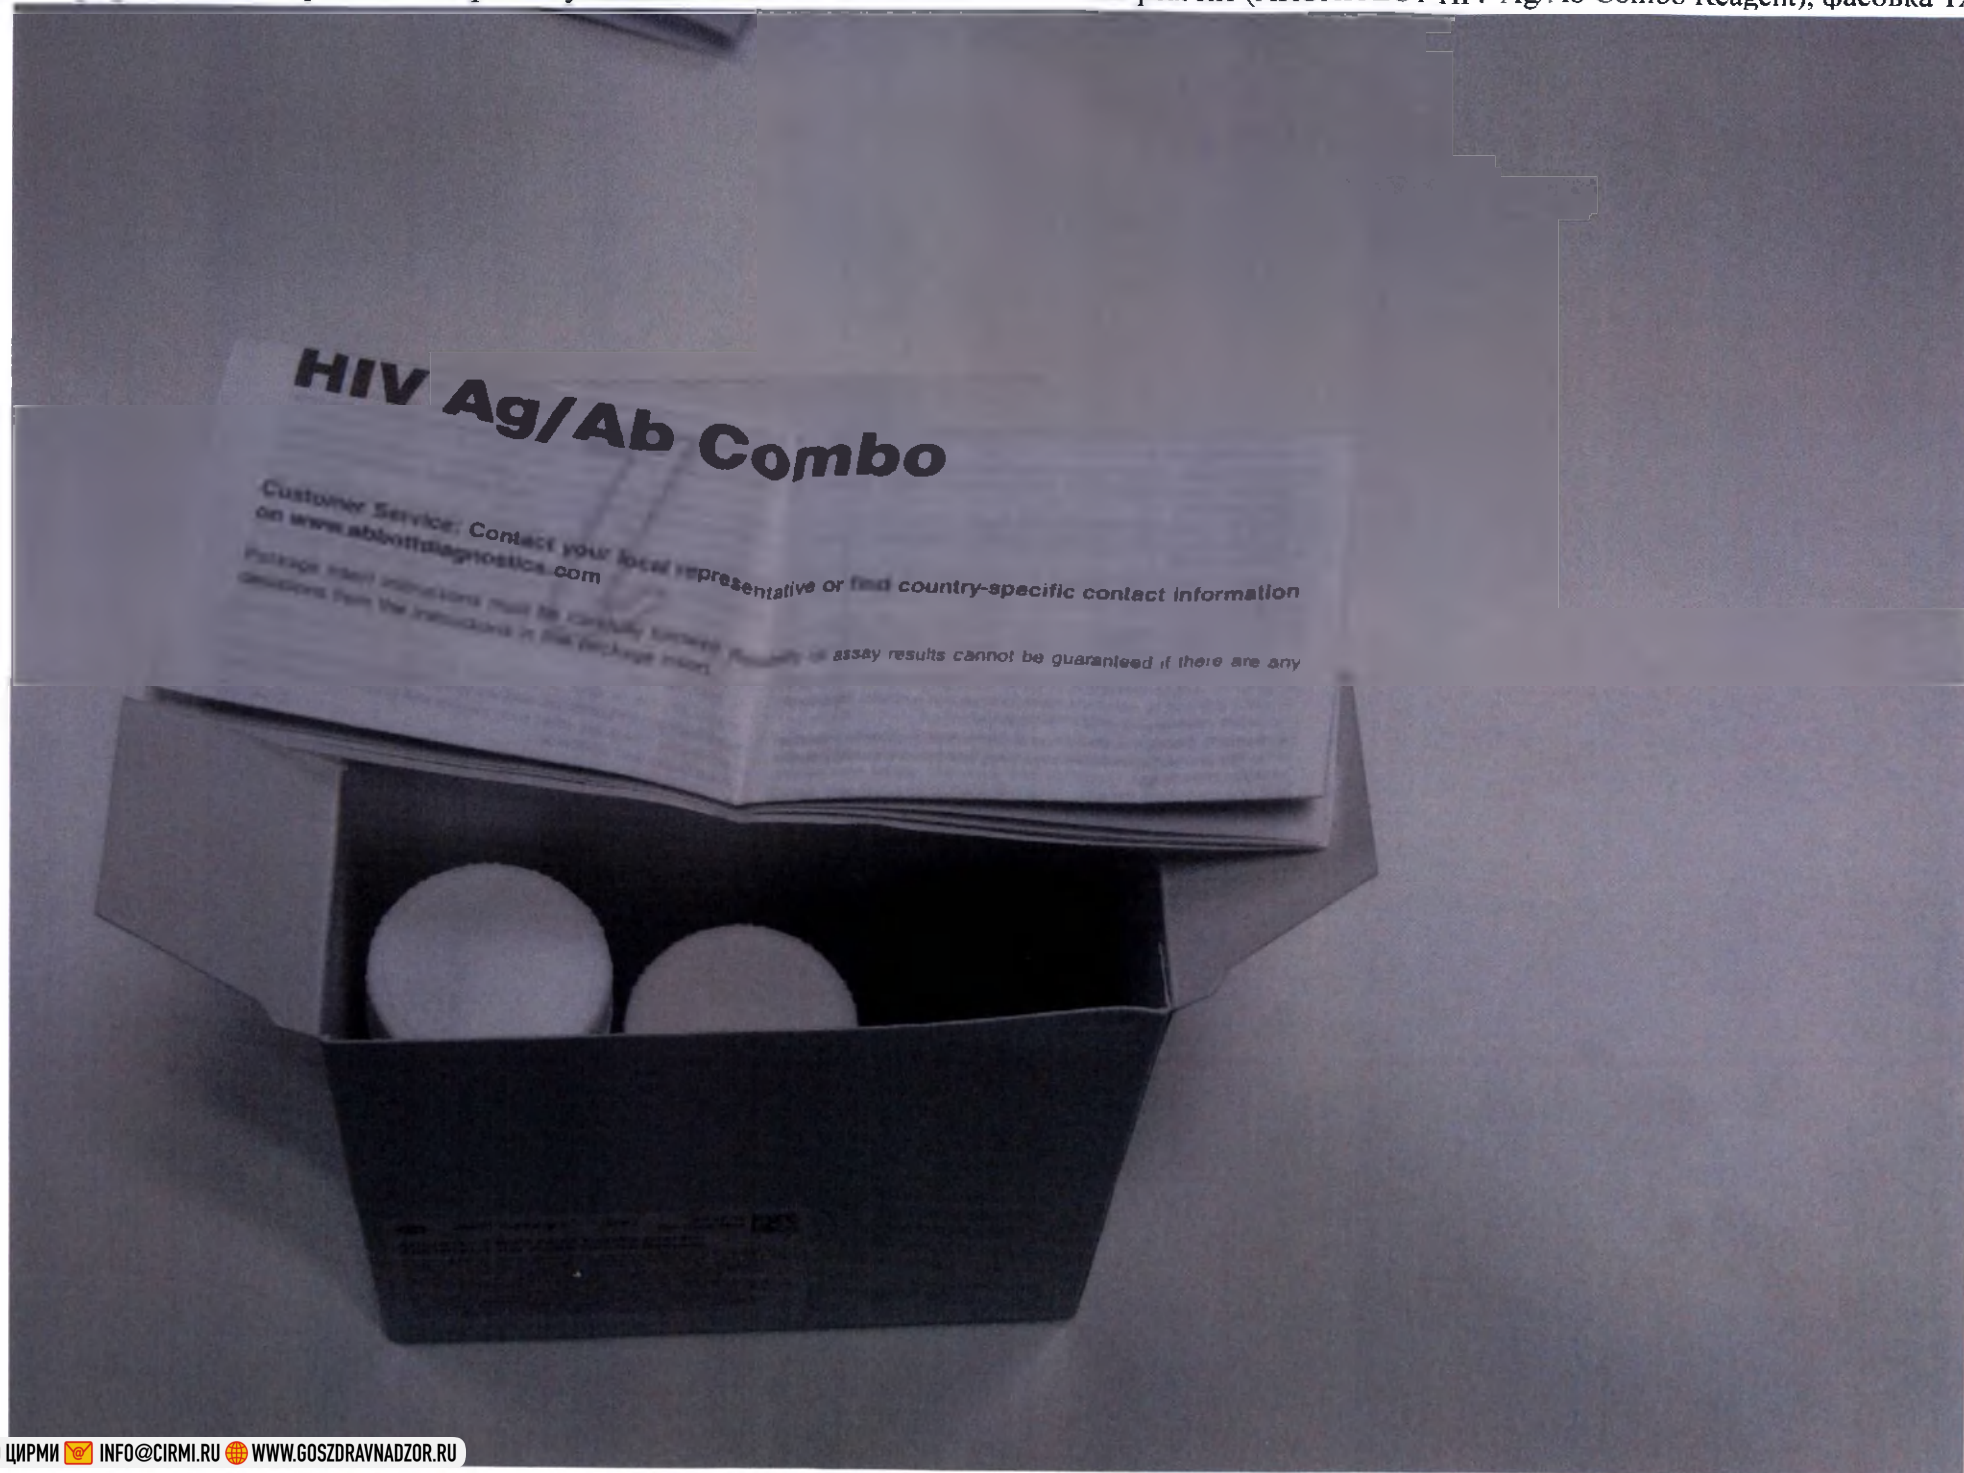

Фотографическое изображение флаконов ARCHITECT ВИЧ Аг/Ат Комбо реагент (ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Reagent), фасовка 1x100.

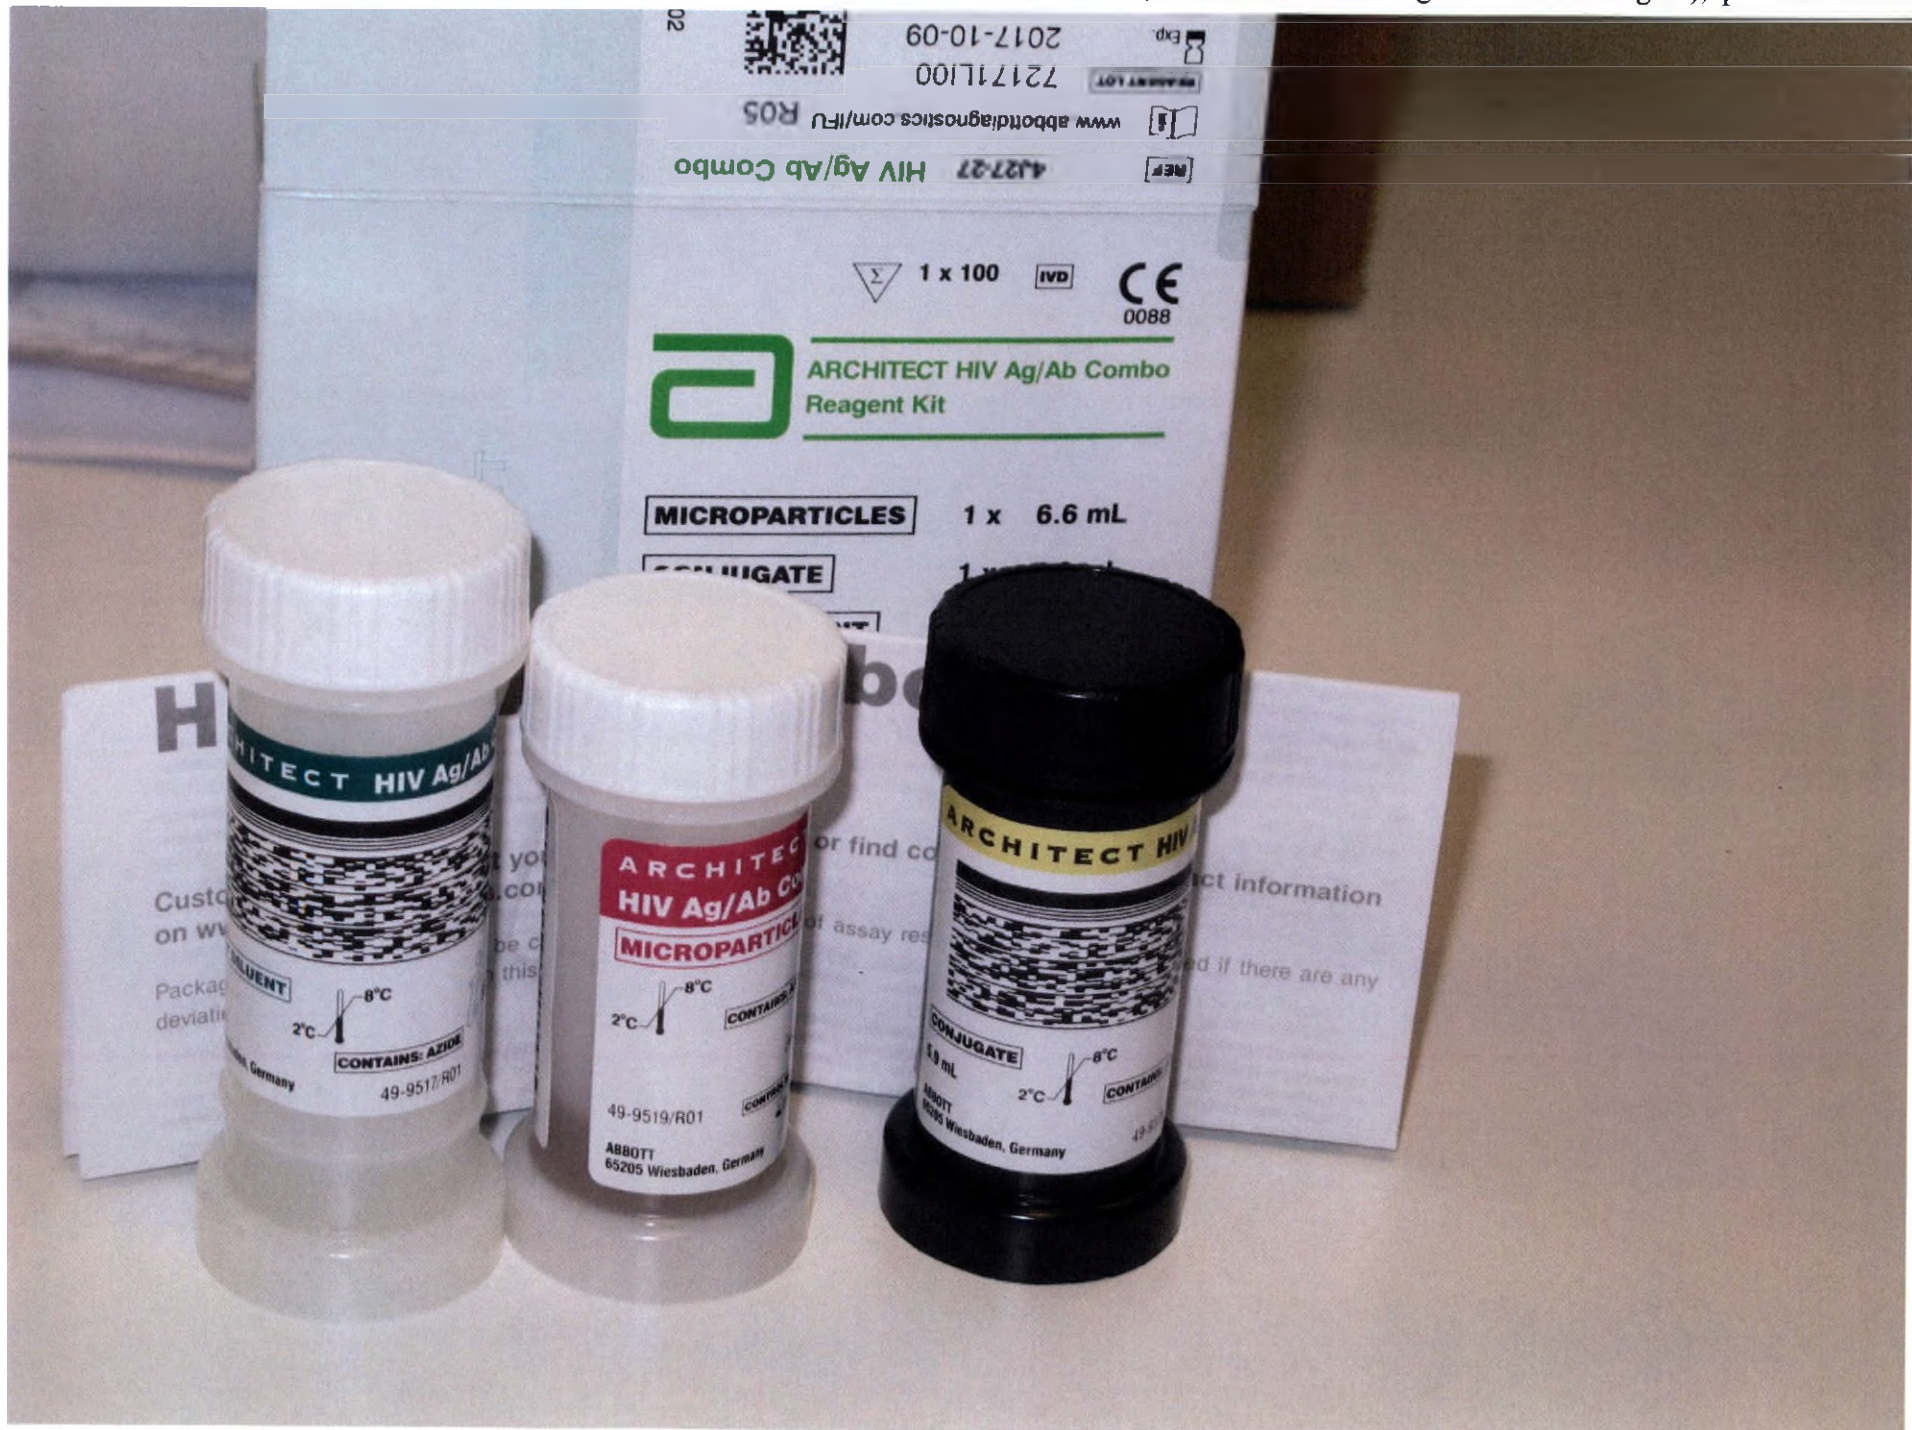


Фотографическое изображение вида упаковки ARCHITECT ВИЧ Аг/Ат Комбо реагент (ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Reagent), фасовка 4x100.




Фотографическое изображение открытой упаковки ARCHITECT ВИЧ Ag/At Комбо реагент (ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Reagent), фасовка 4x100.




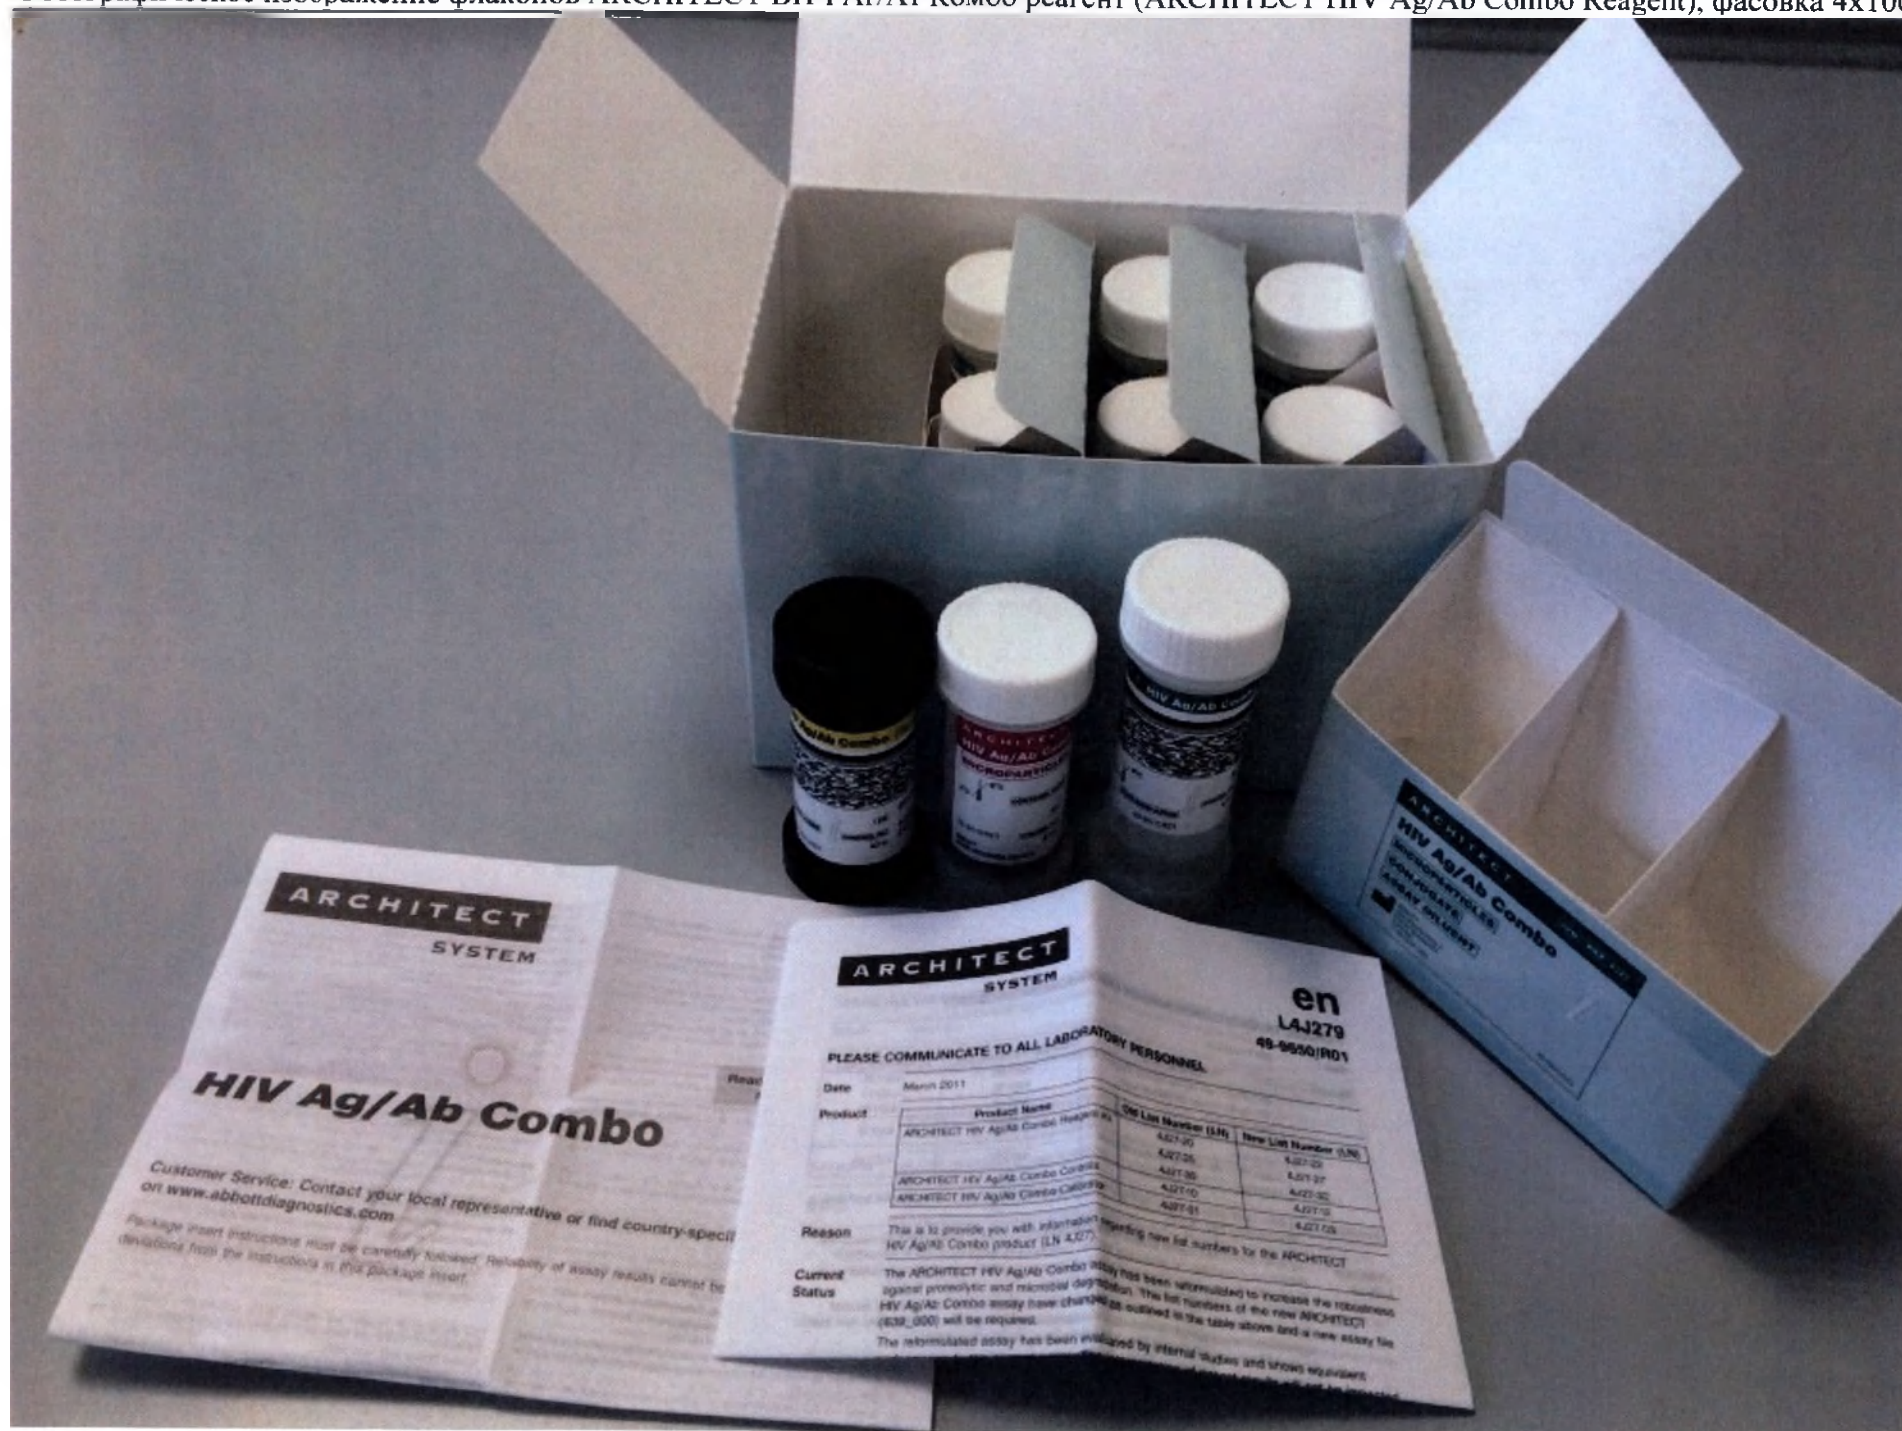


Фотографическое изображение вида упаковки ARCHITECT ВИЧ Аг/Ат Комбо реагент (ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Reagent), фасовка 4x500.

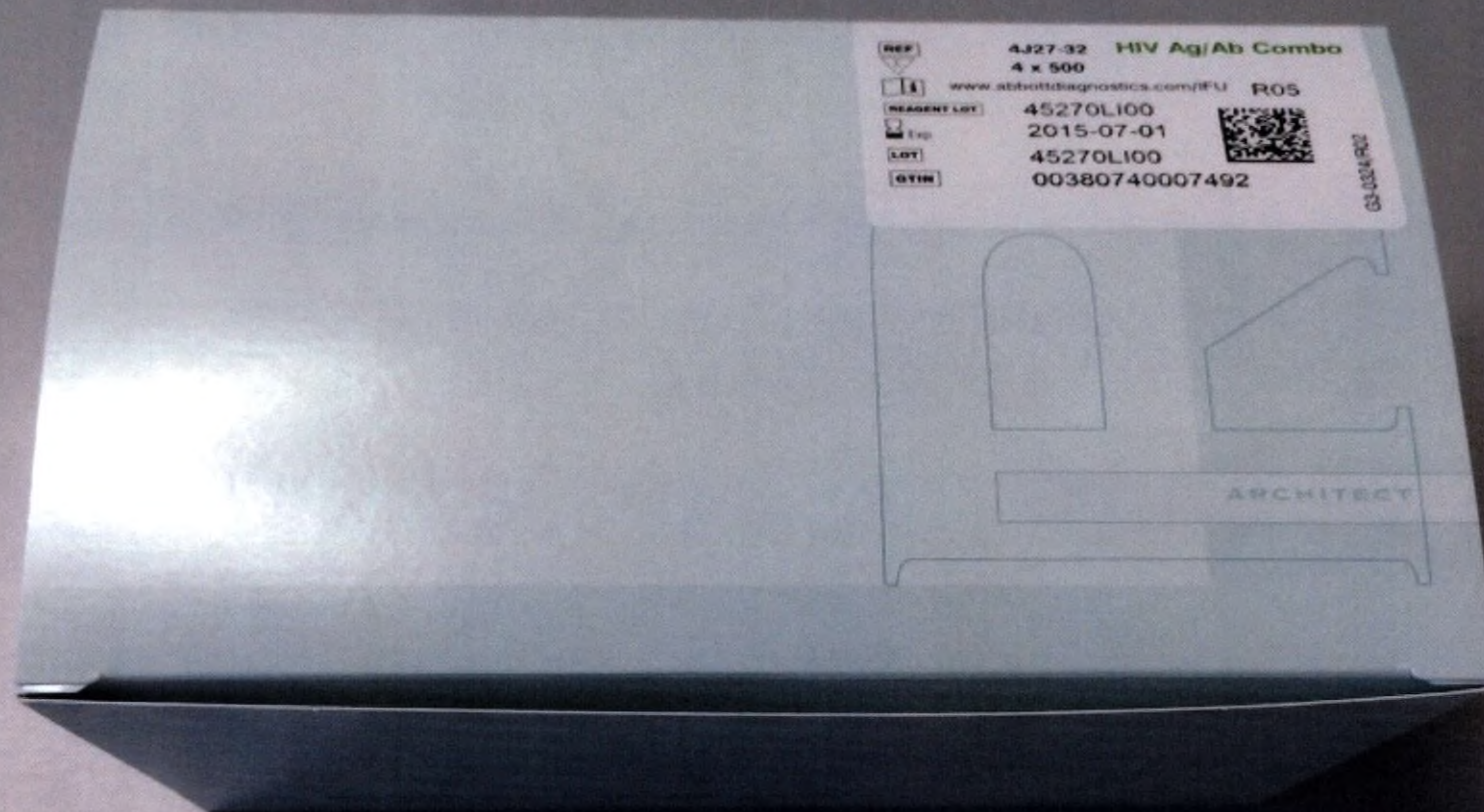




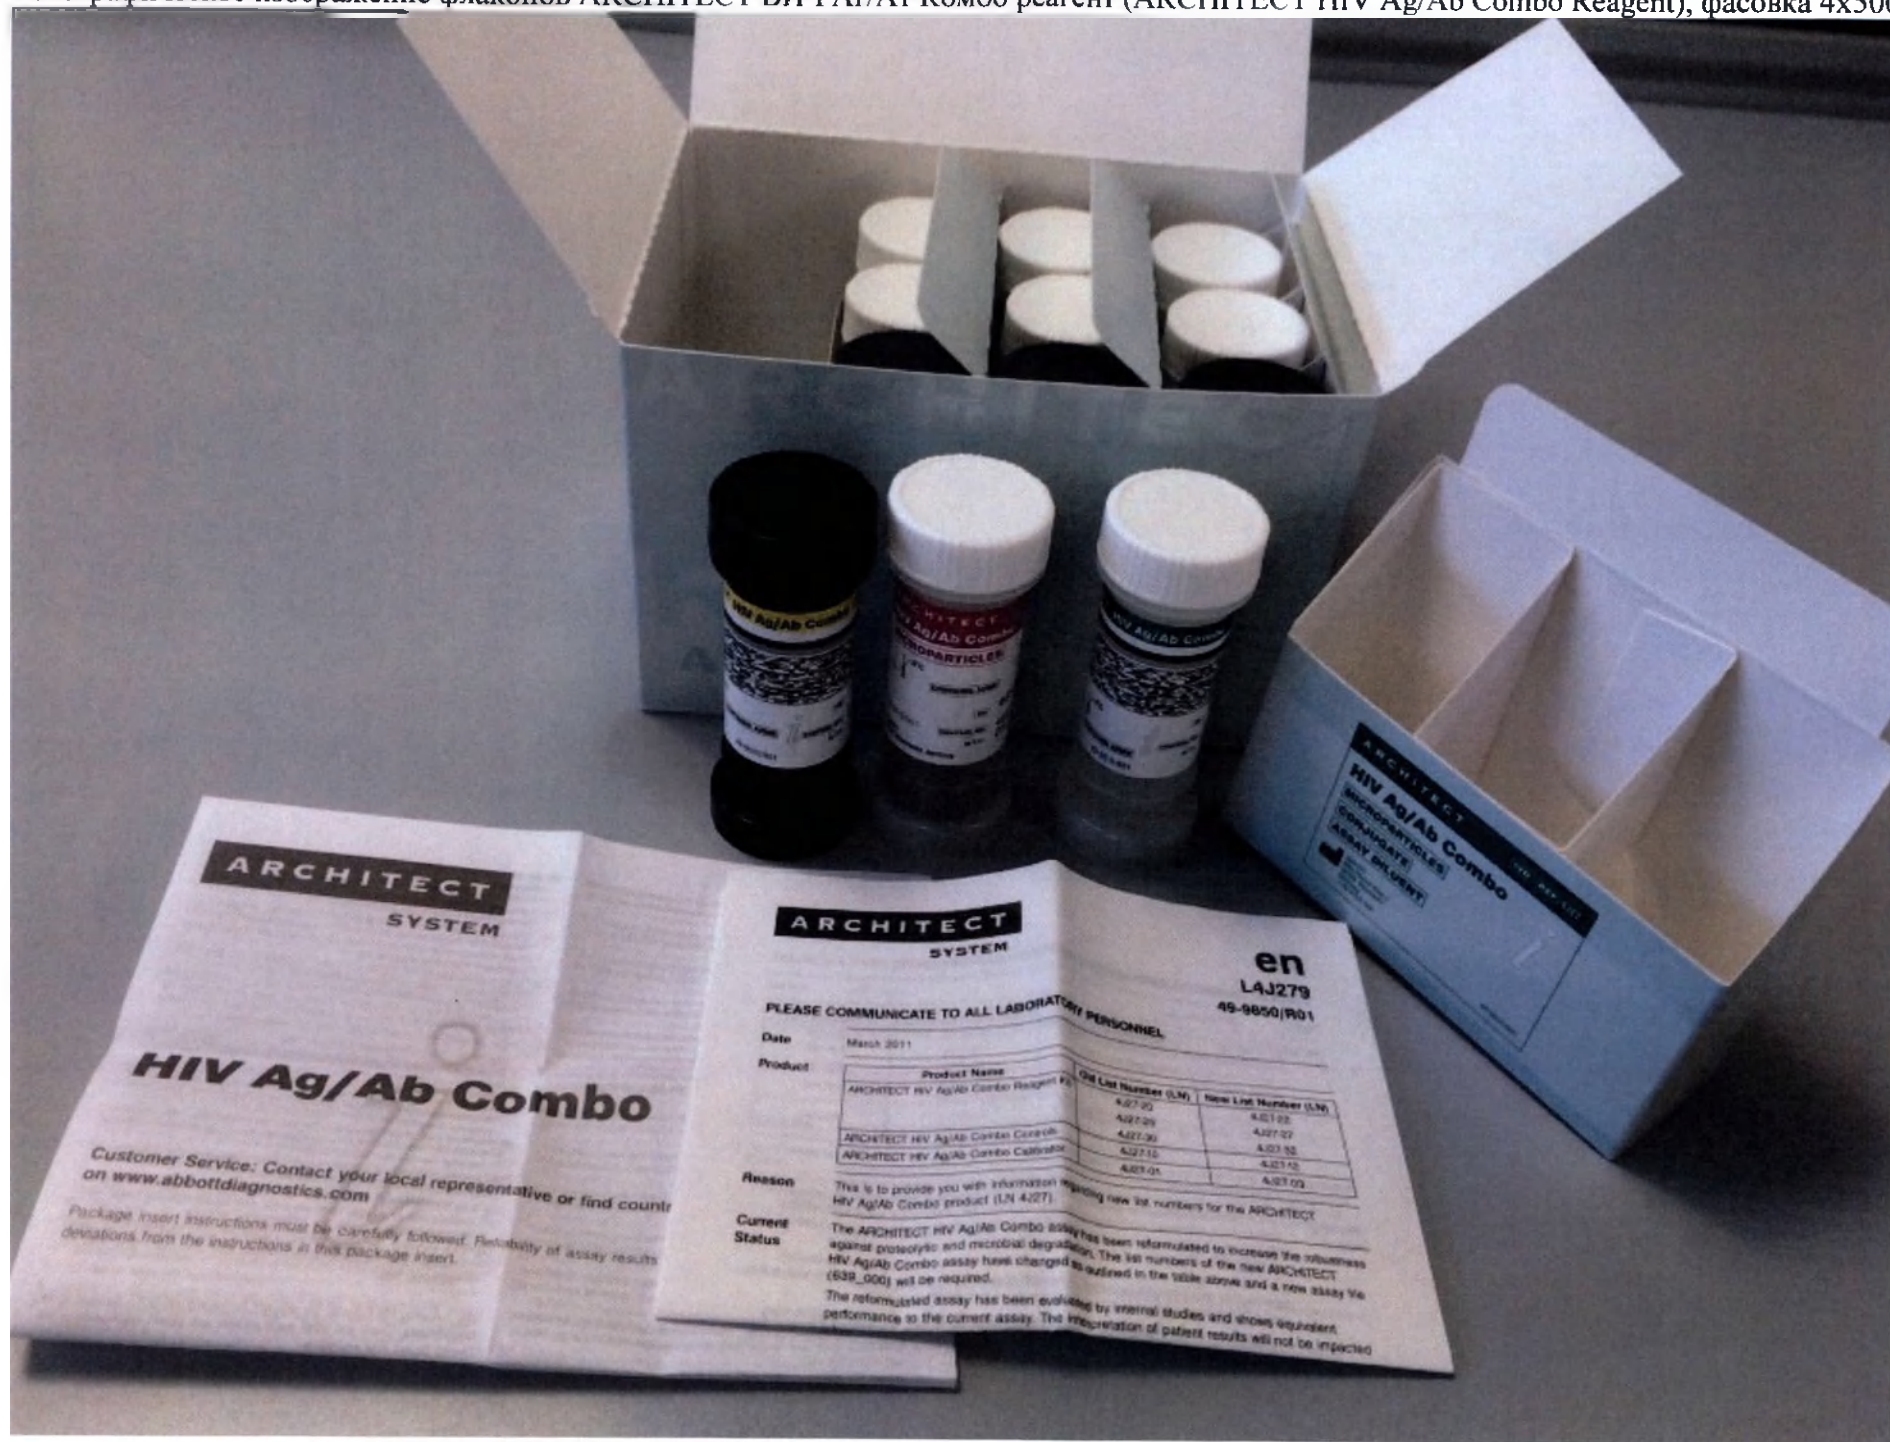

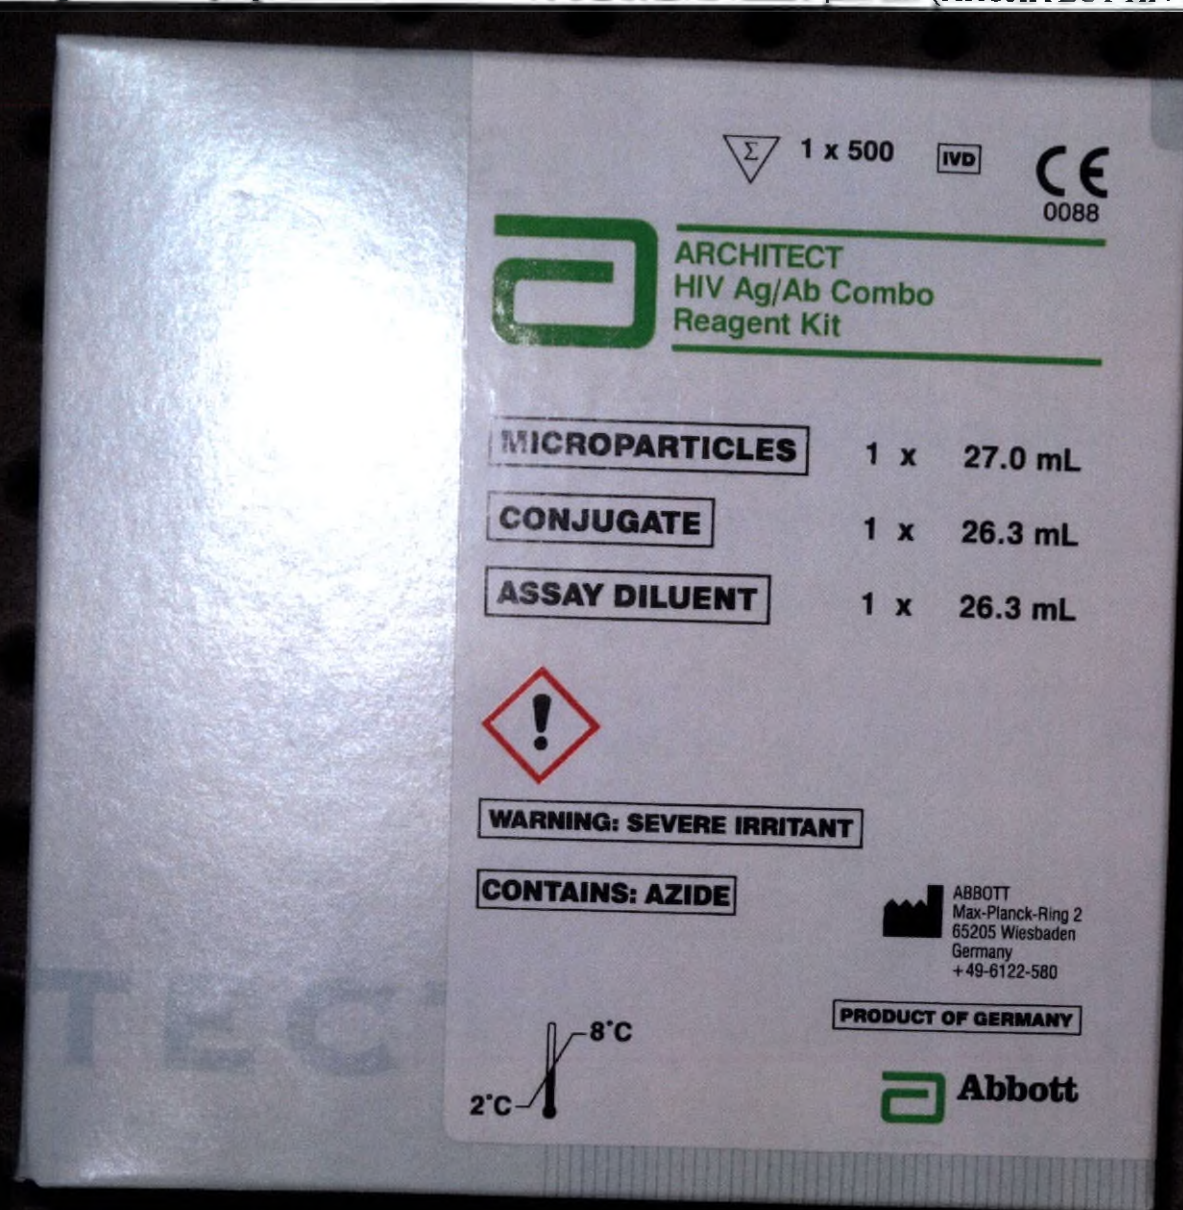

Фотографическое изображение открытой упаковки ARCHITECT ВИЧ Аг/Ат Комбо реагент (ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Reagent), фасовка 1x500.

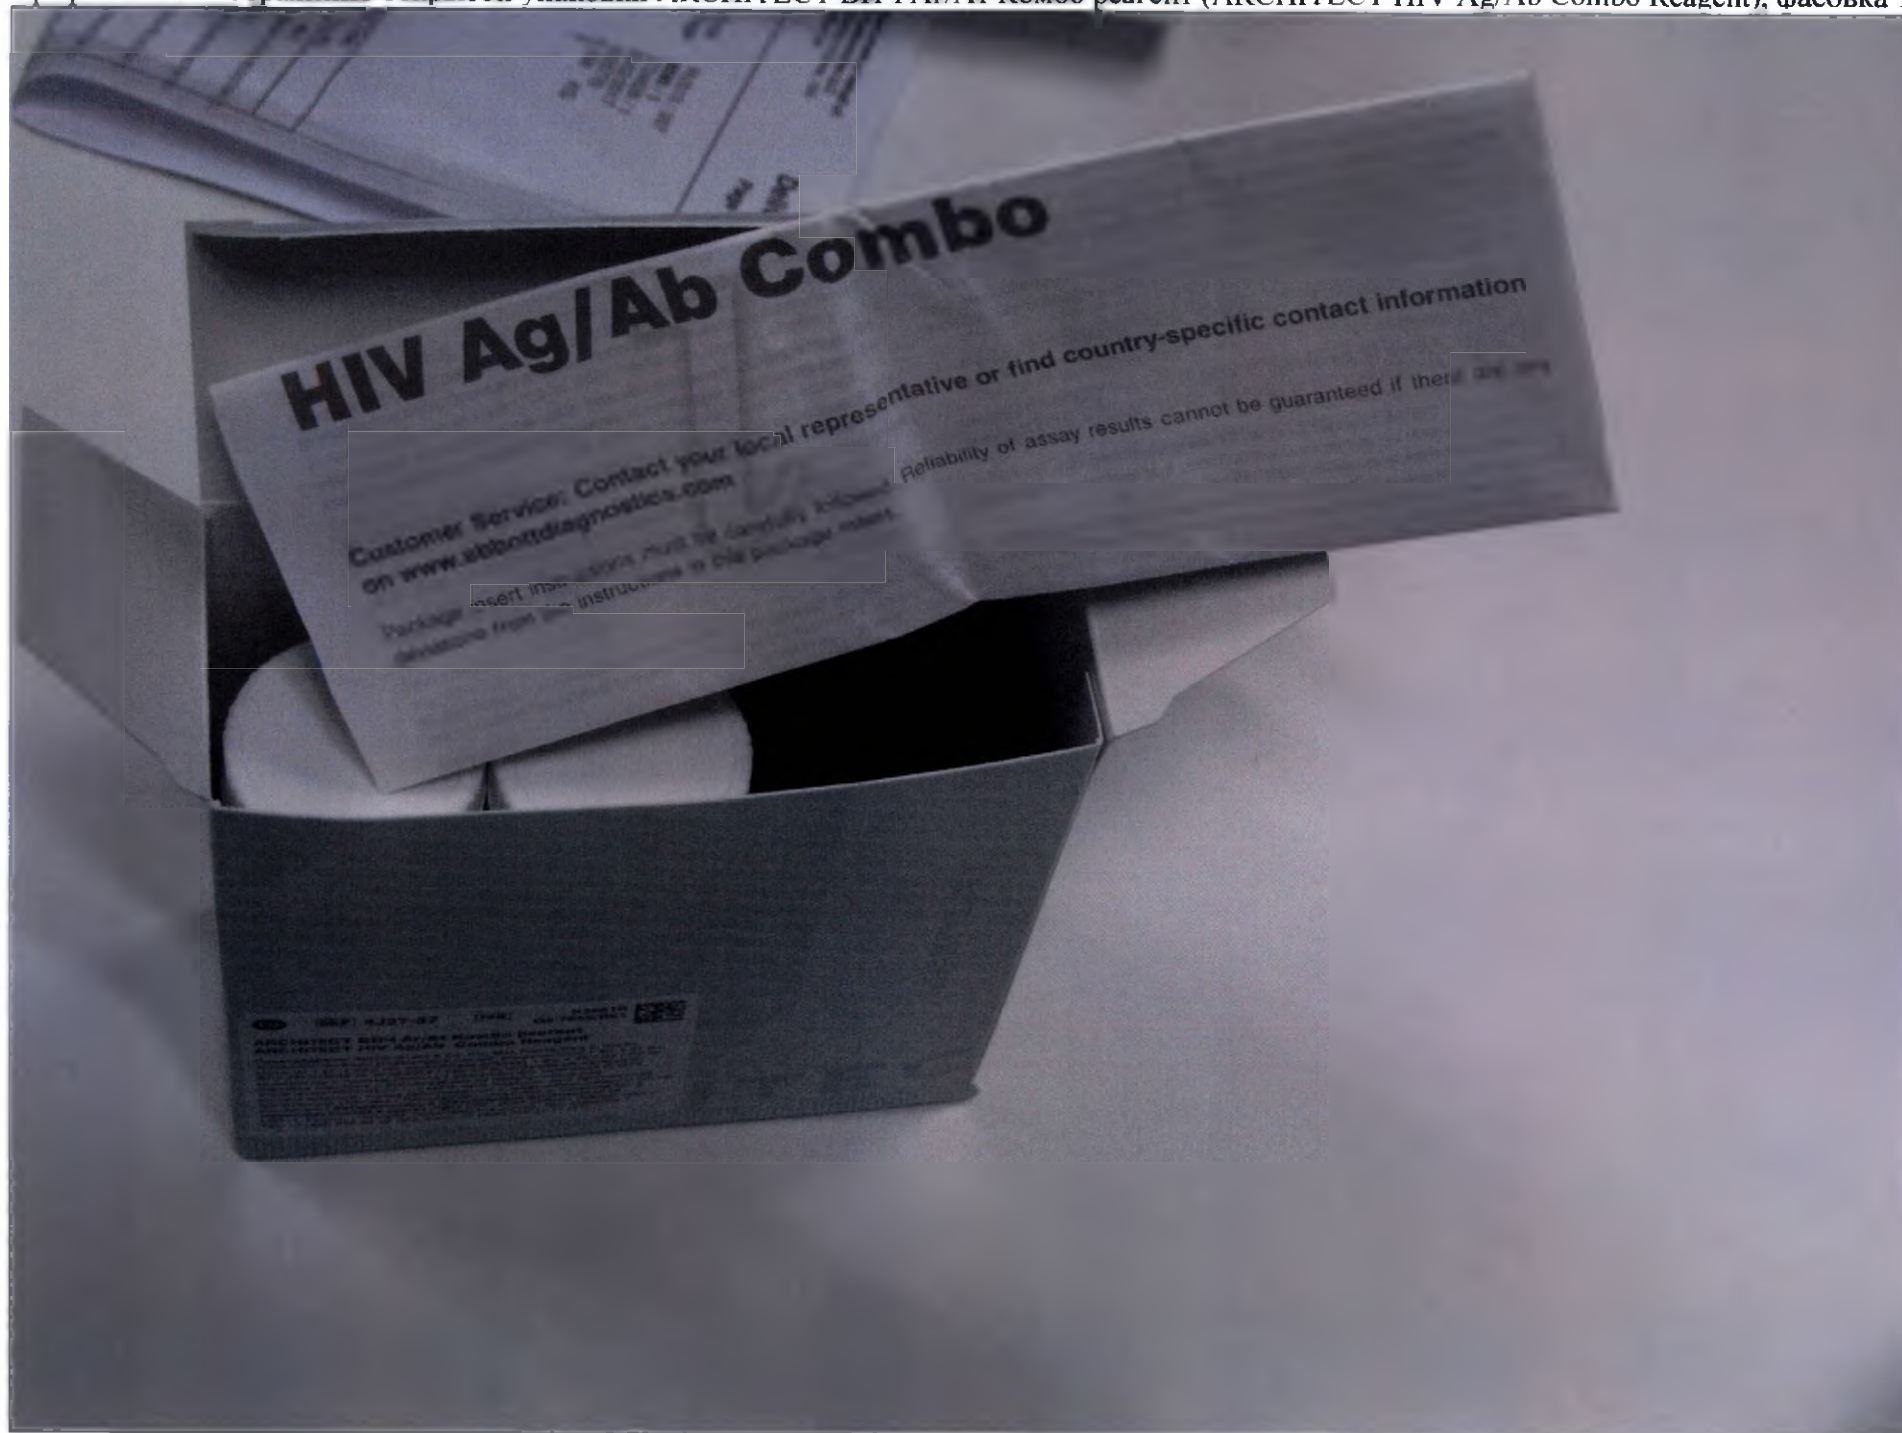

Фотографическое изображение флаконов ARCHITECT ВИЧ Аг/Ат Комбо реагент (ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Reagent), фасовка 1x500.





Фотографическое изображение вида упаковки ARCHITECT ВИЧ Аг/Ат Комбо калибратор (ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Calibrator).





Графическое изображение флаконов ARCHITECT ВИЧ Ag/Ат Комбо калибратор (ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Calibrator).

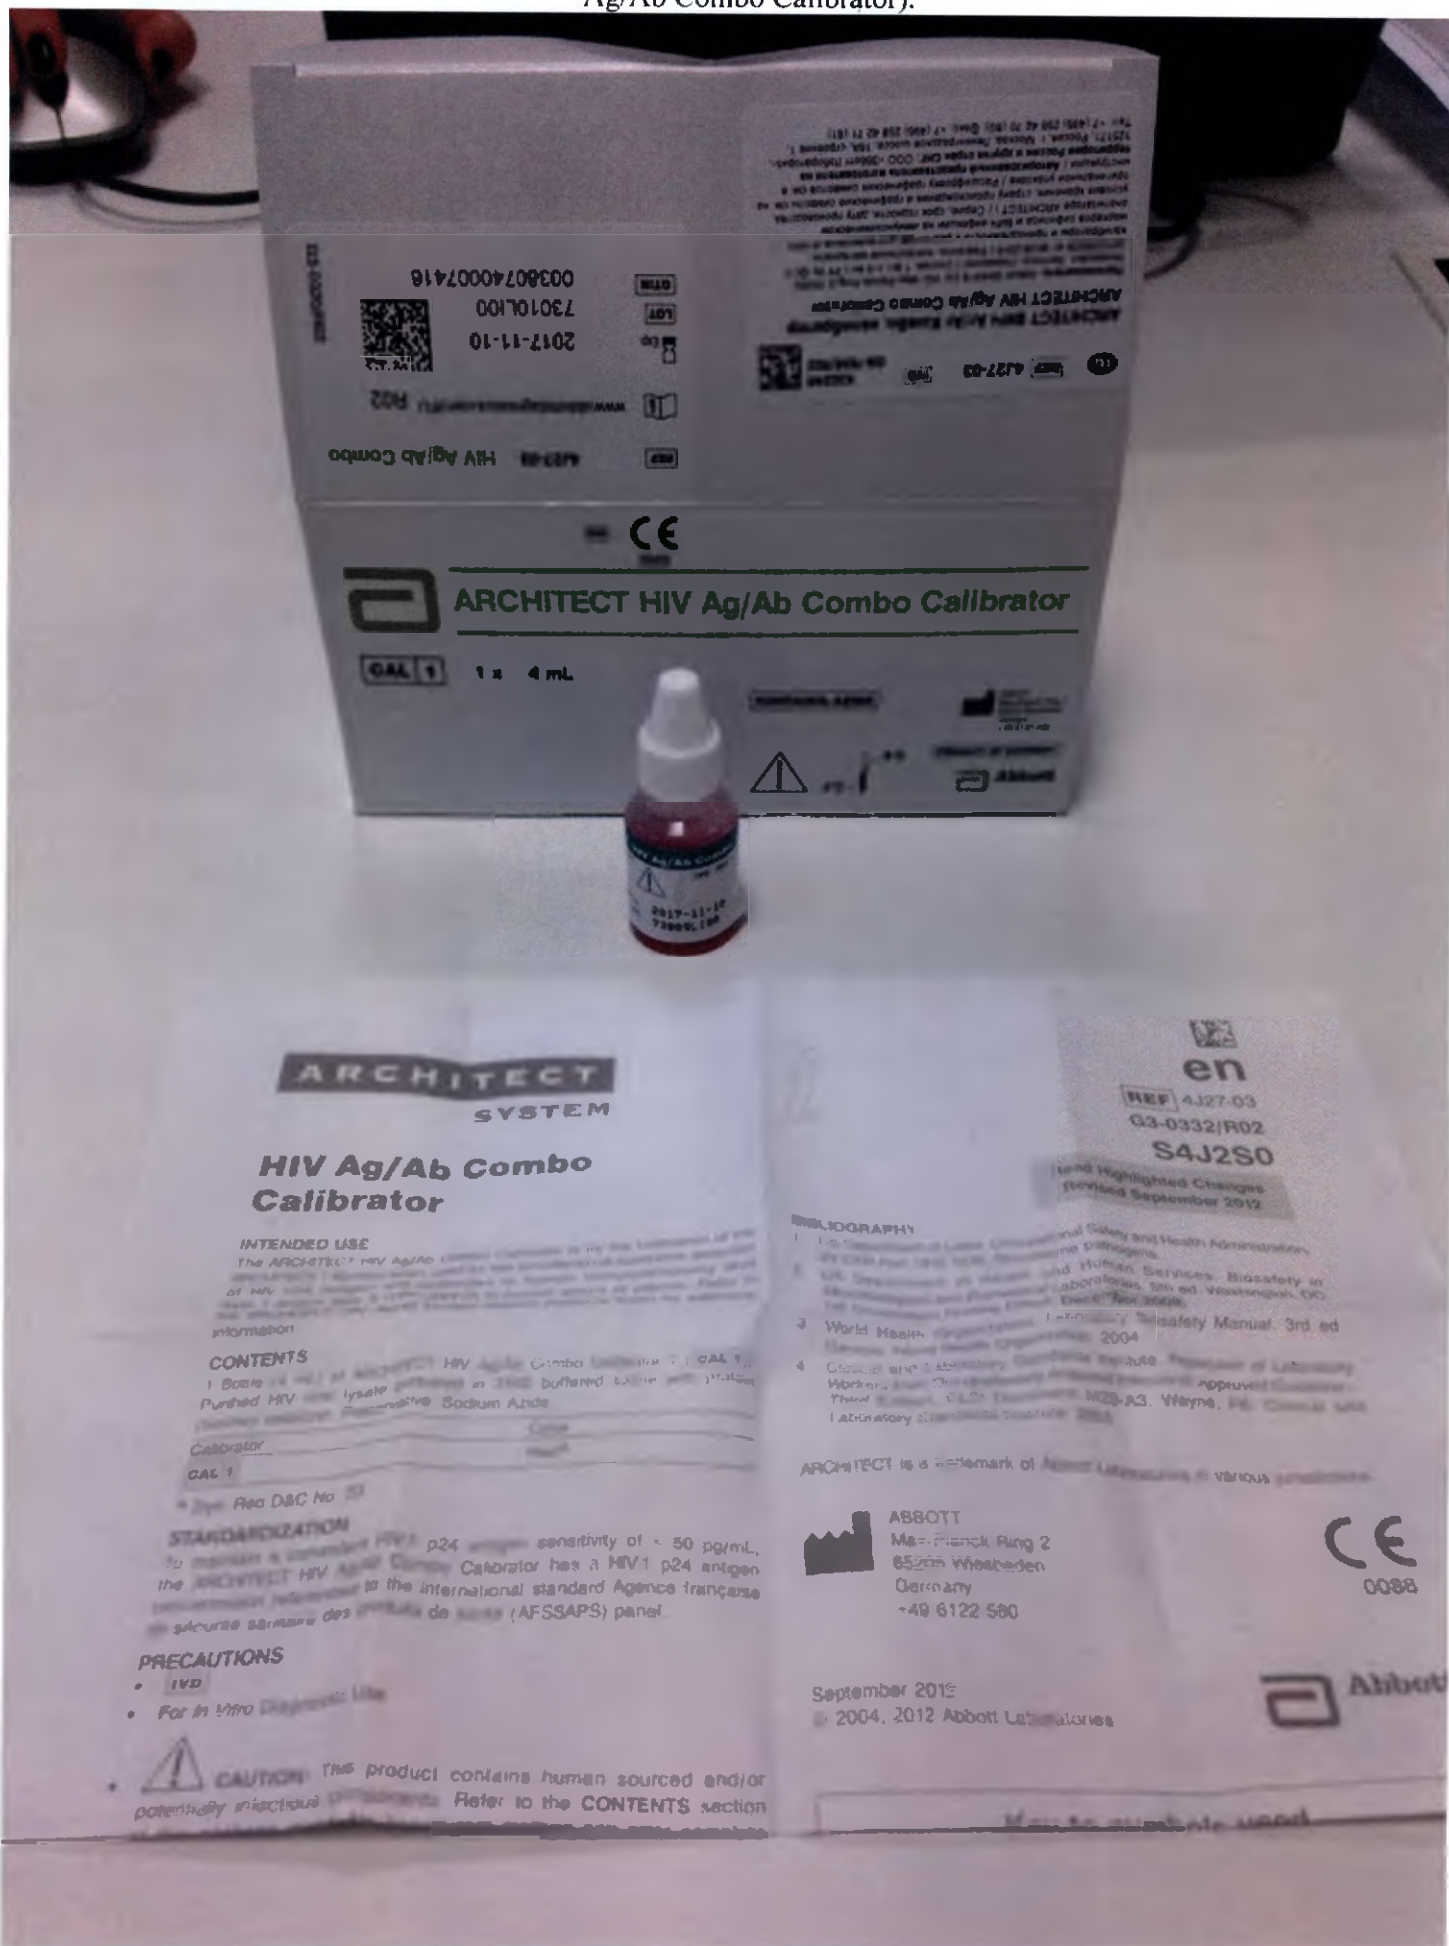

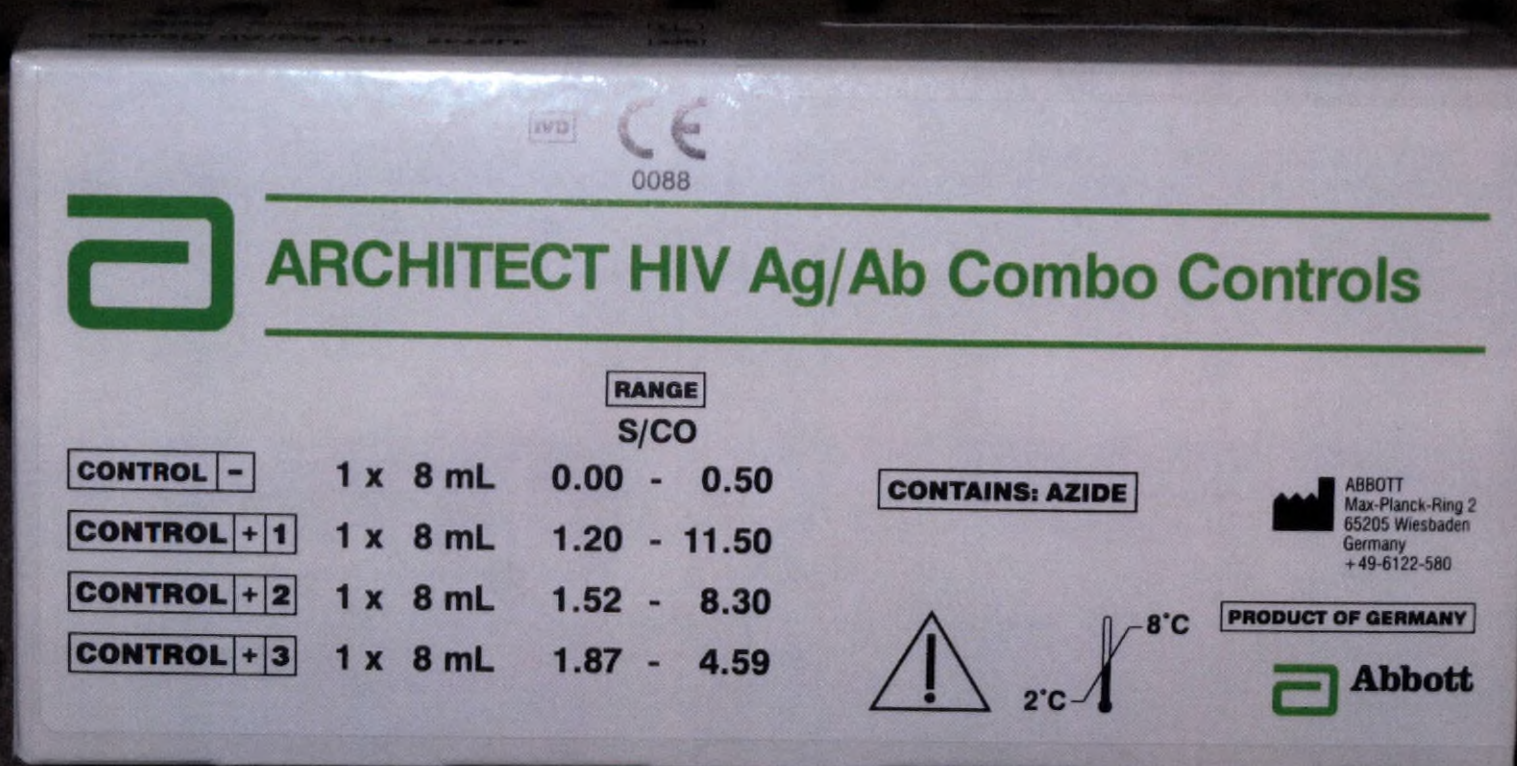

Фотографическое изображение открытой упаковки ARCHITECT ВИЧ Аг/Ат Комбо контроли (ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Controls).







Фотографическое изображение вида упаковки ARCHITECT Сифилис реагент (ARCHITECT Syphilis TP Reagent), фасовка 1x100.




Фотографическое изображение открытой упаковки ARCHITECT Сифилис реагент (ARCHITECT Syphilis TP Reagent), фасовка 1x100.

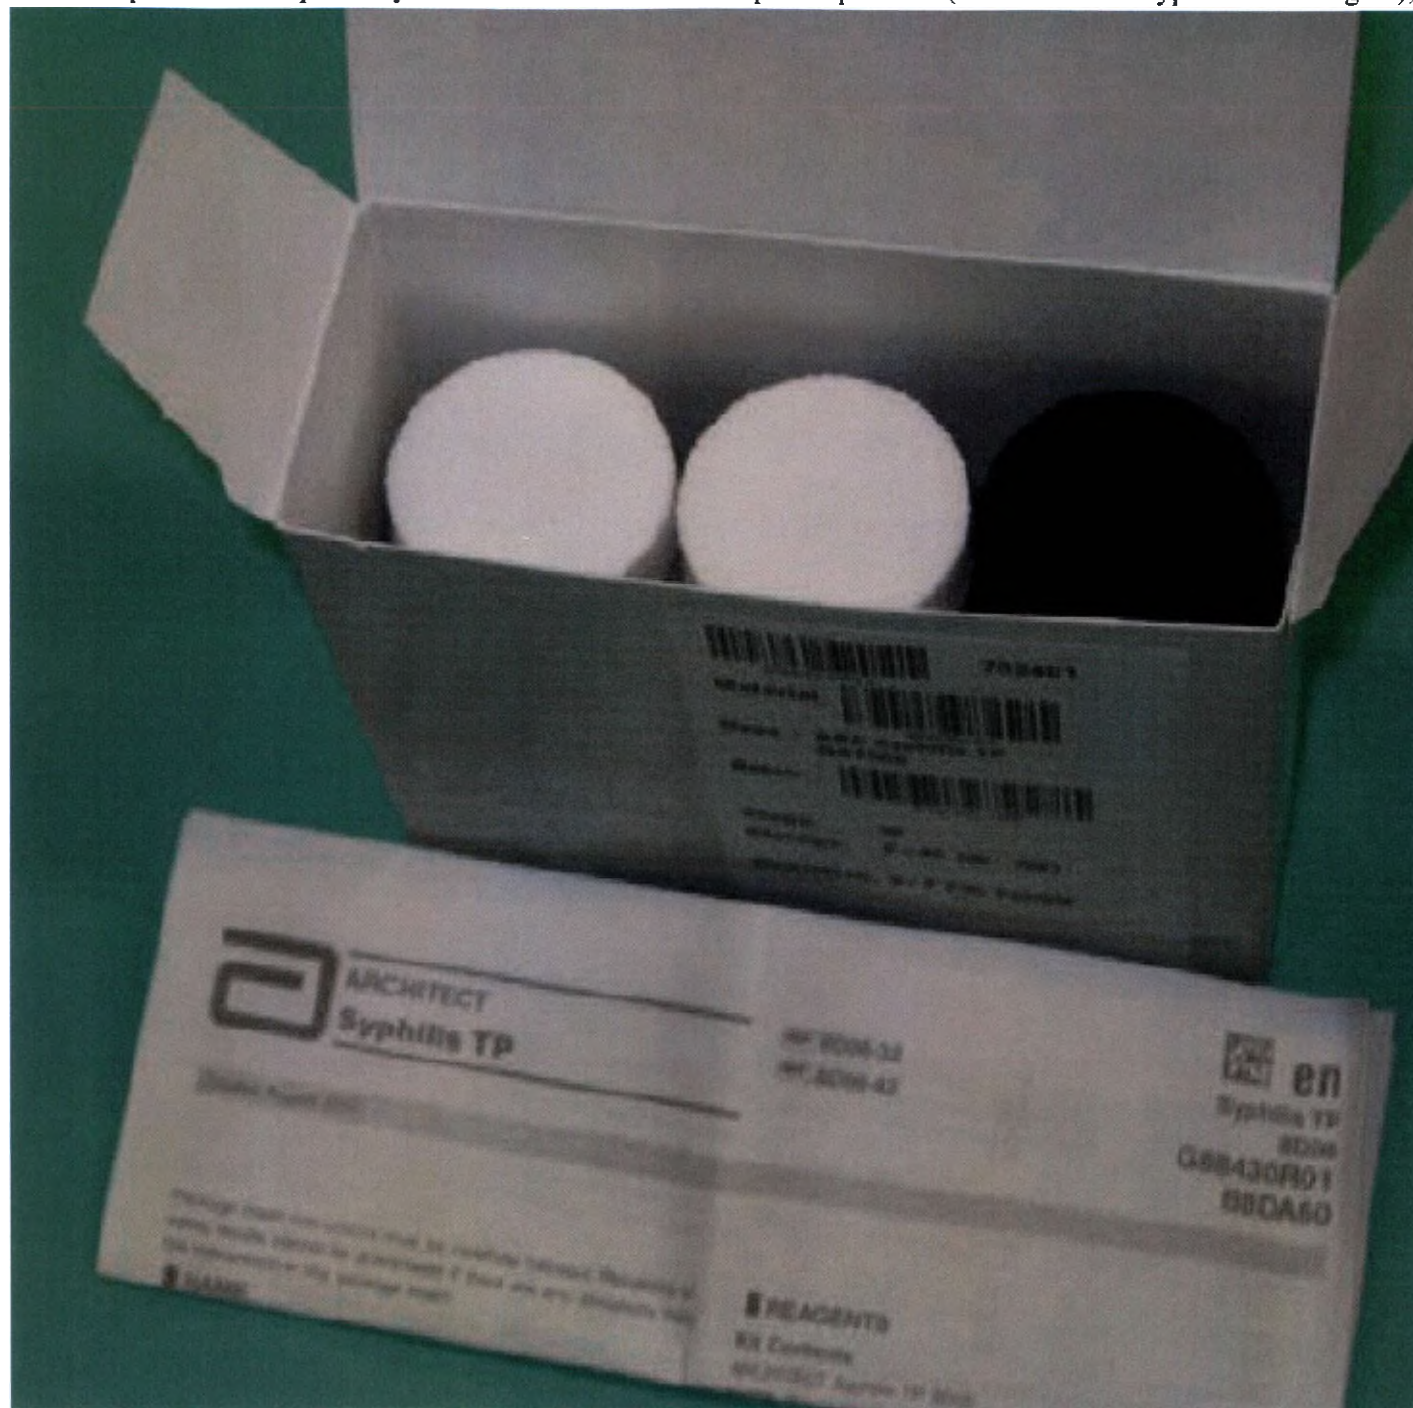


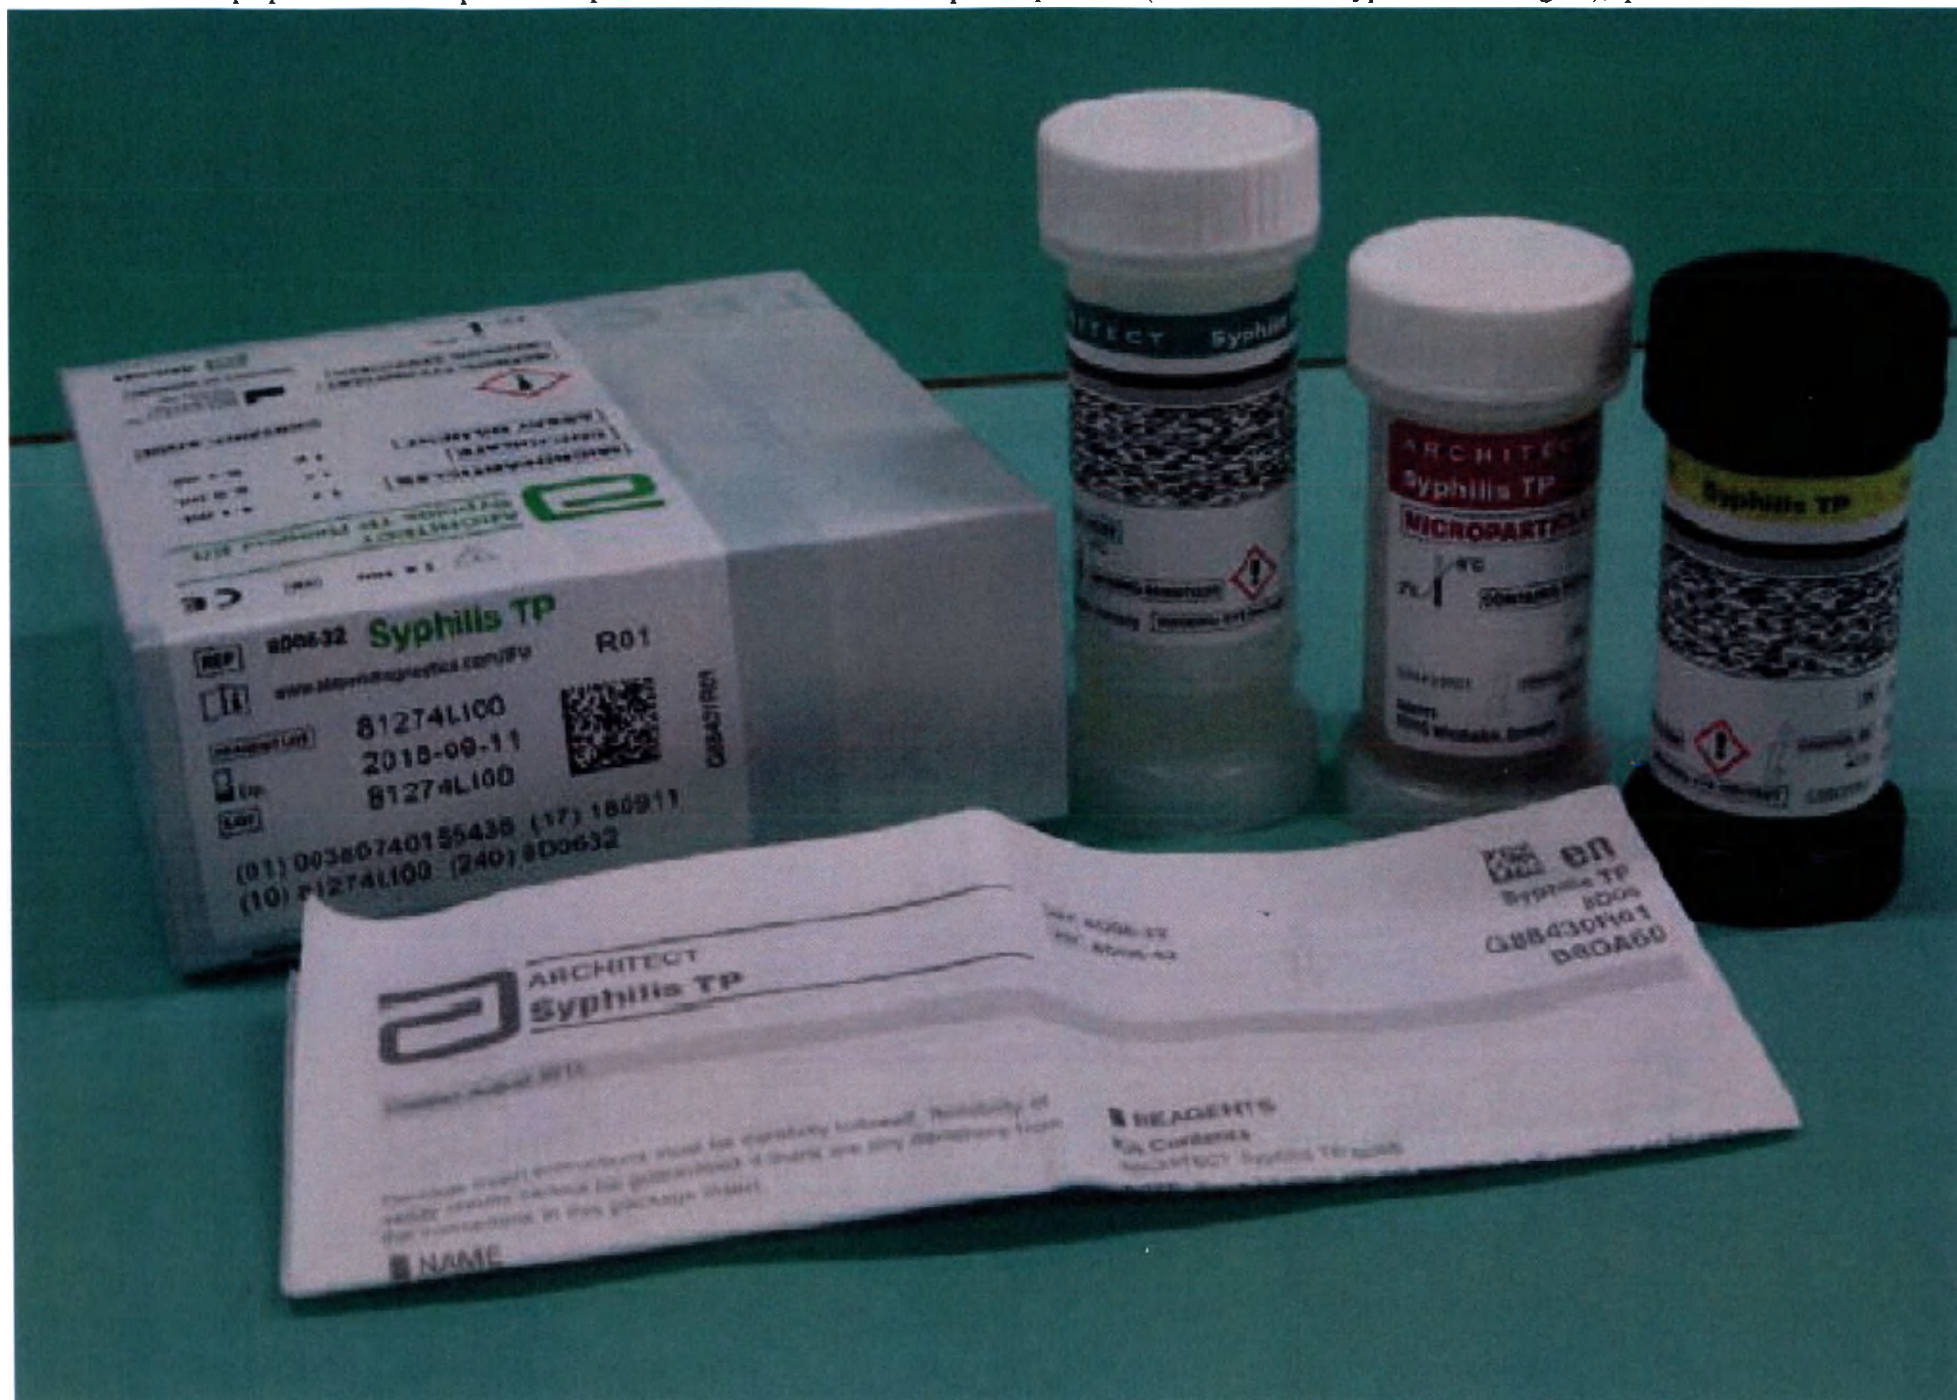



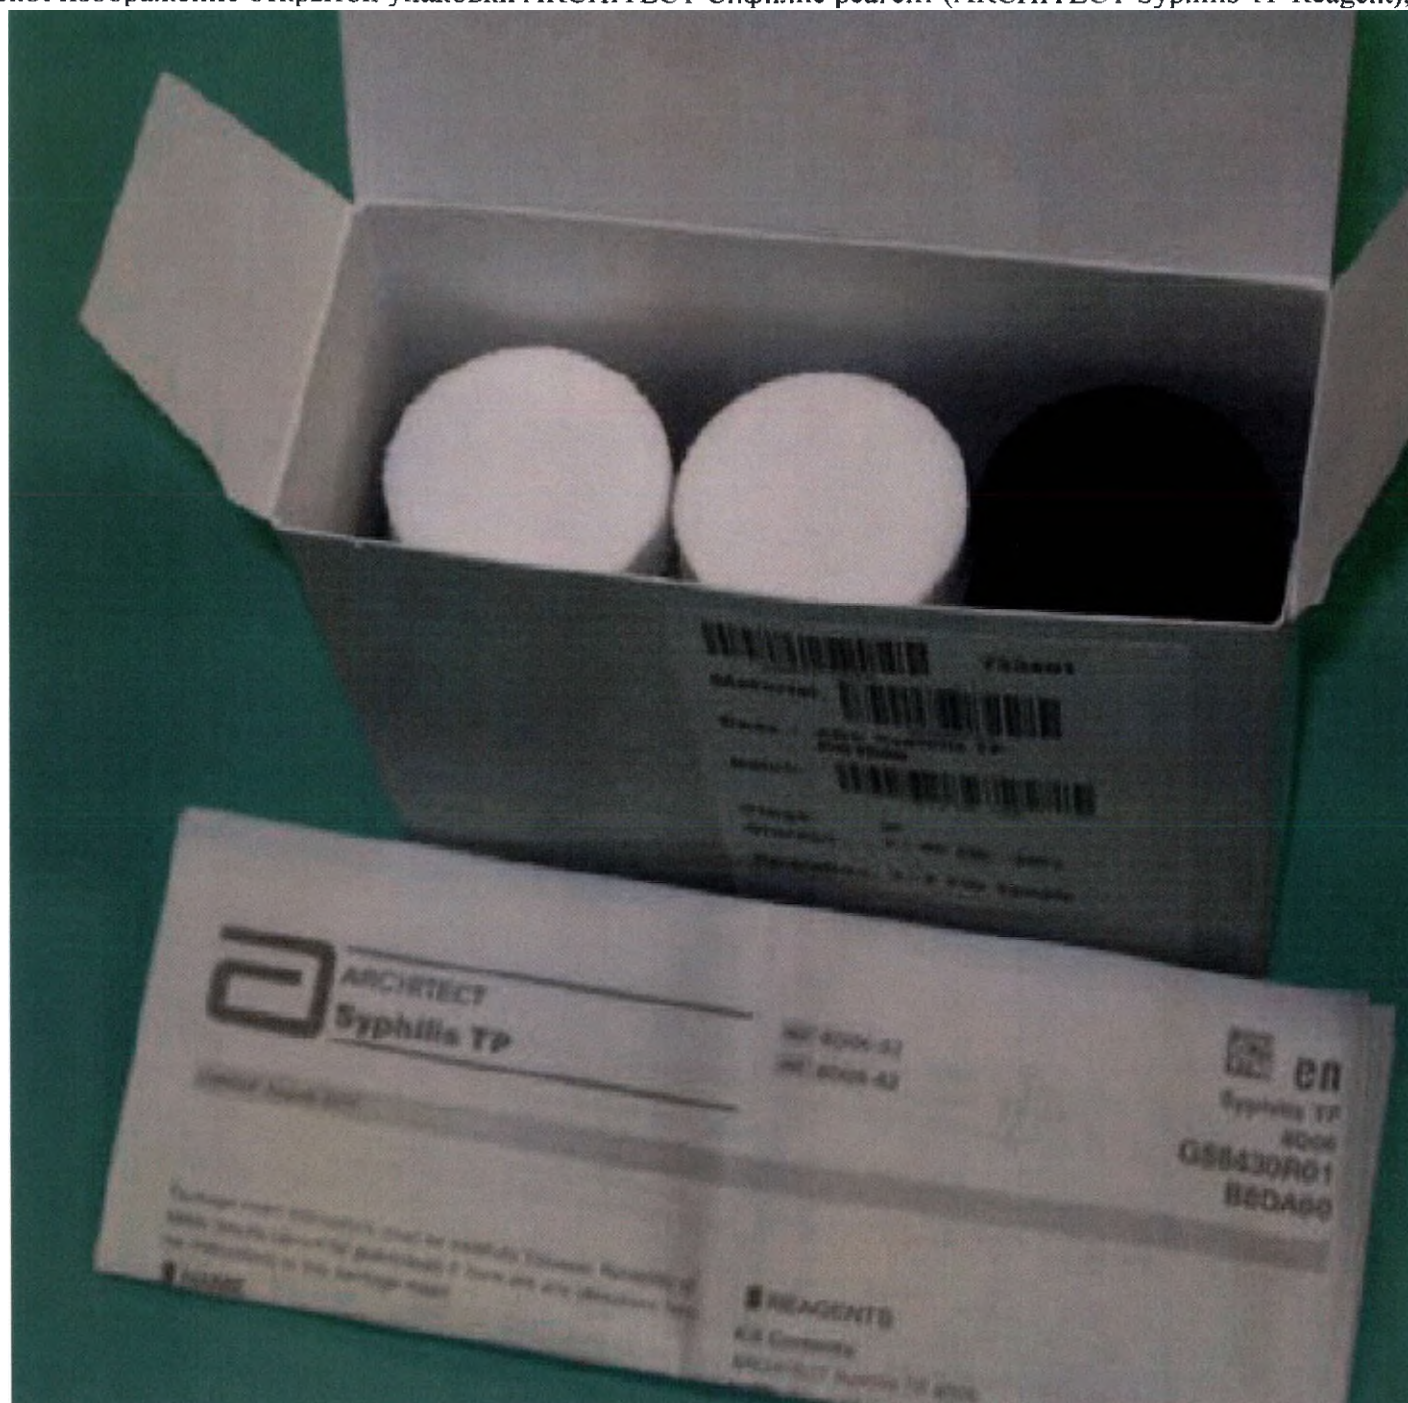

Фотографическое изображение флаконов ARCHITECT Сифилис реагент (ARCHITECT Syphilis TP Reagent), фасовка 1x500.

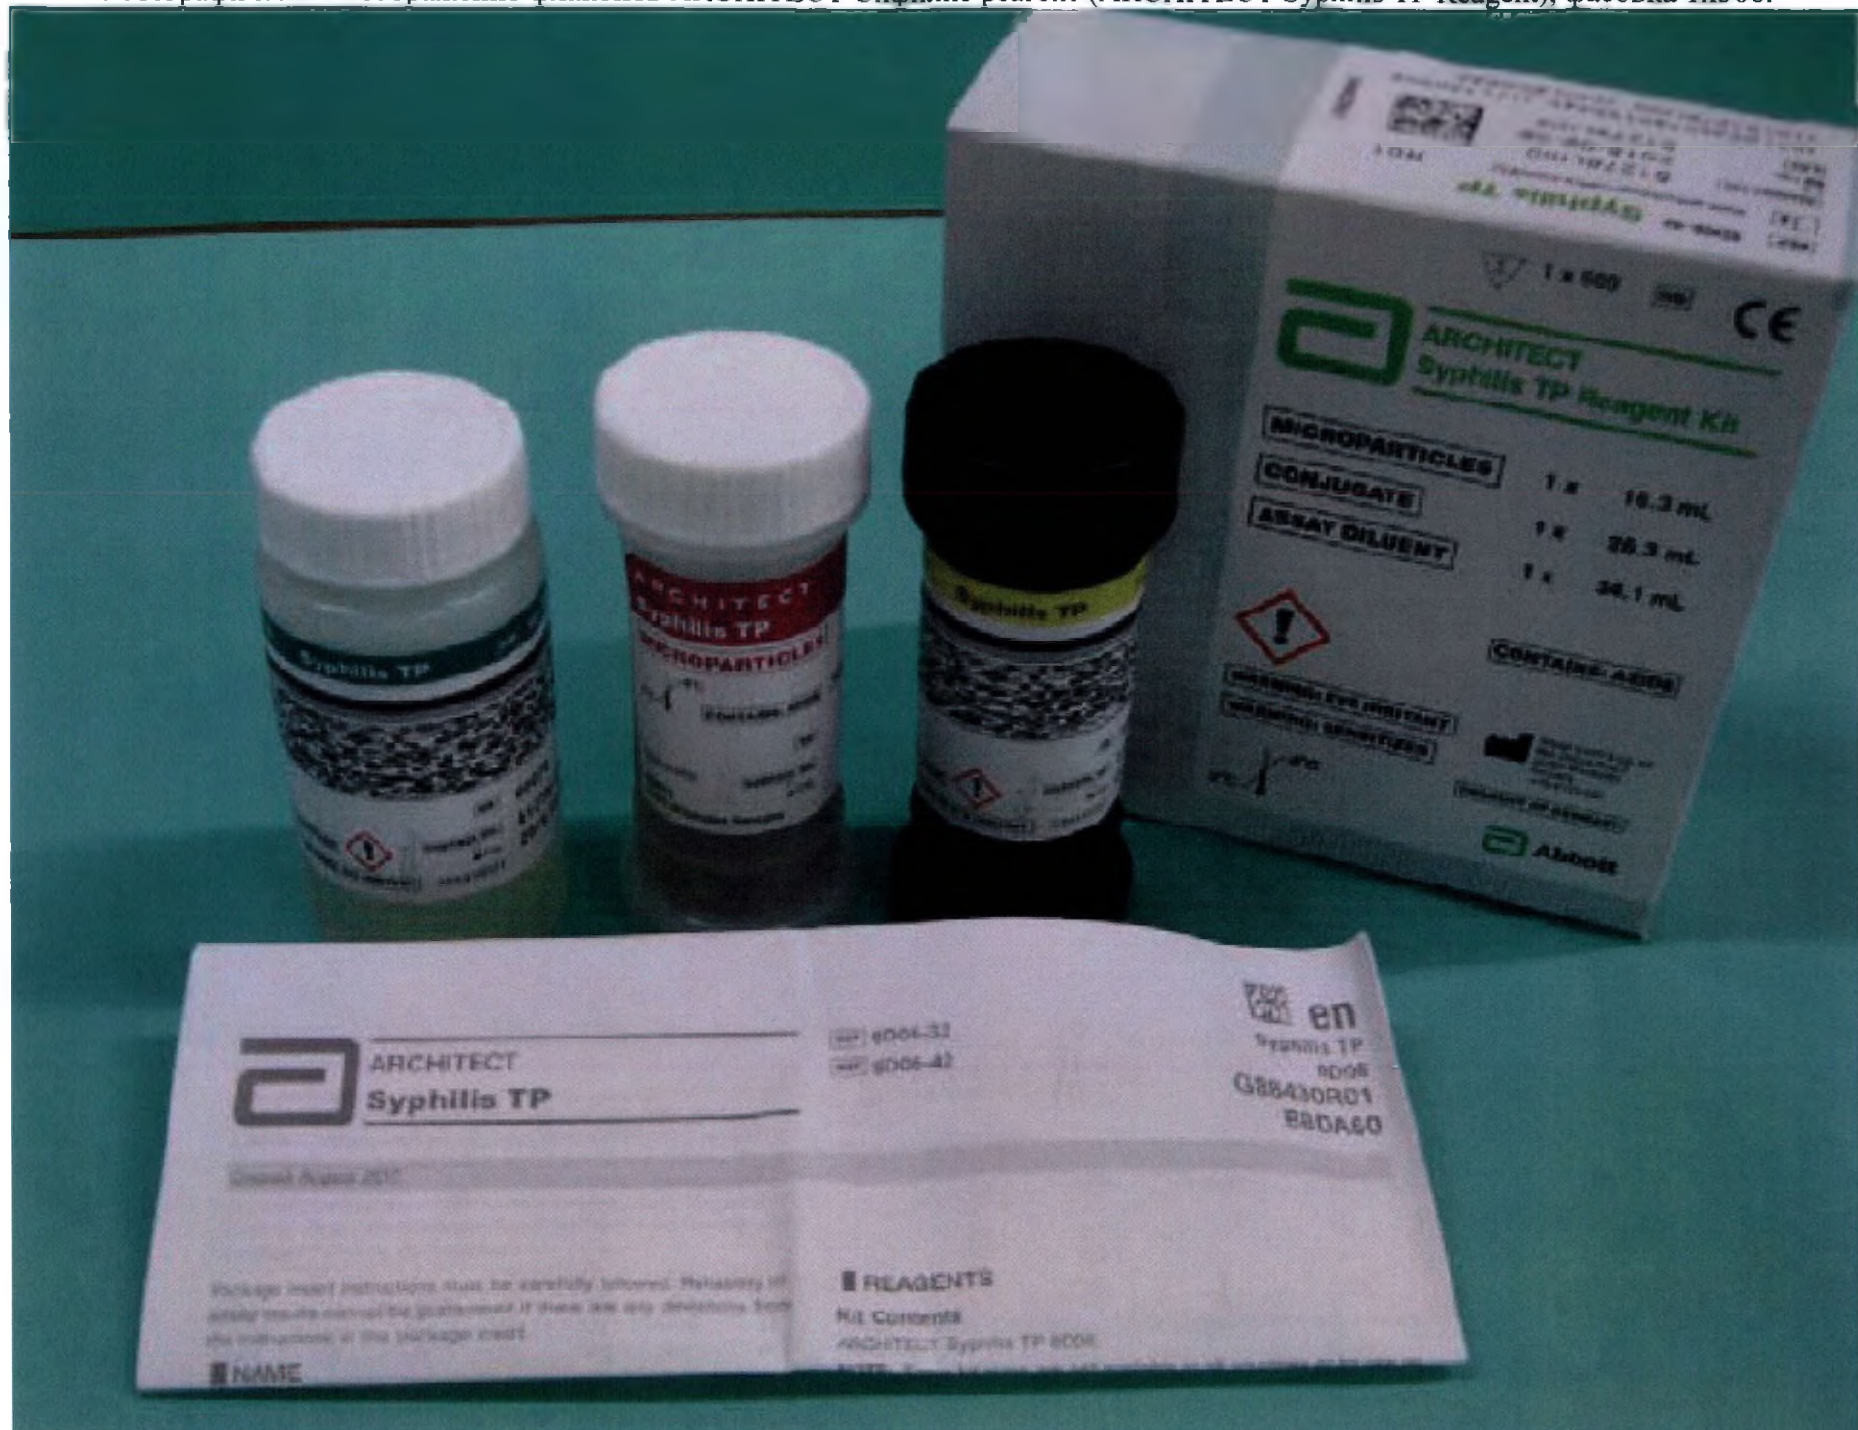






Фотографическое изображение флаконов ARCHITECT Сифилис калибратор (ARCHITECT Syphilis TP Calibrator).




Фотобрографическое изображение вида упаковки ARCHITECT Сифилис контроли (ARCHITECT Syphilis TP Controls).

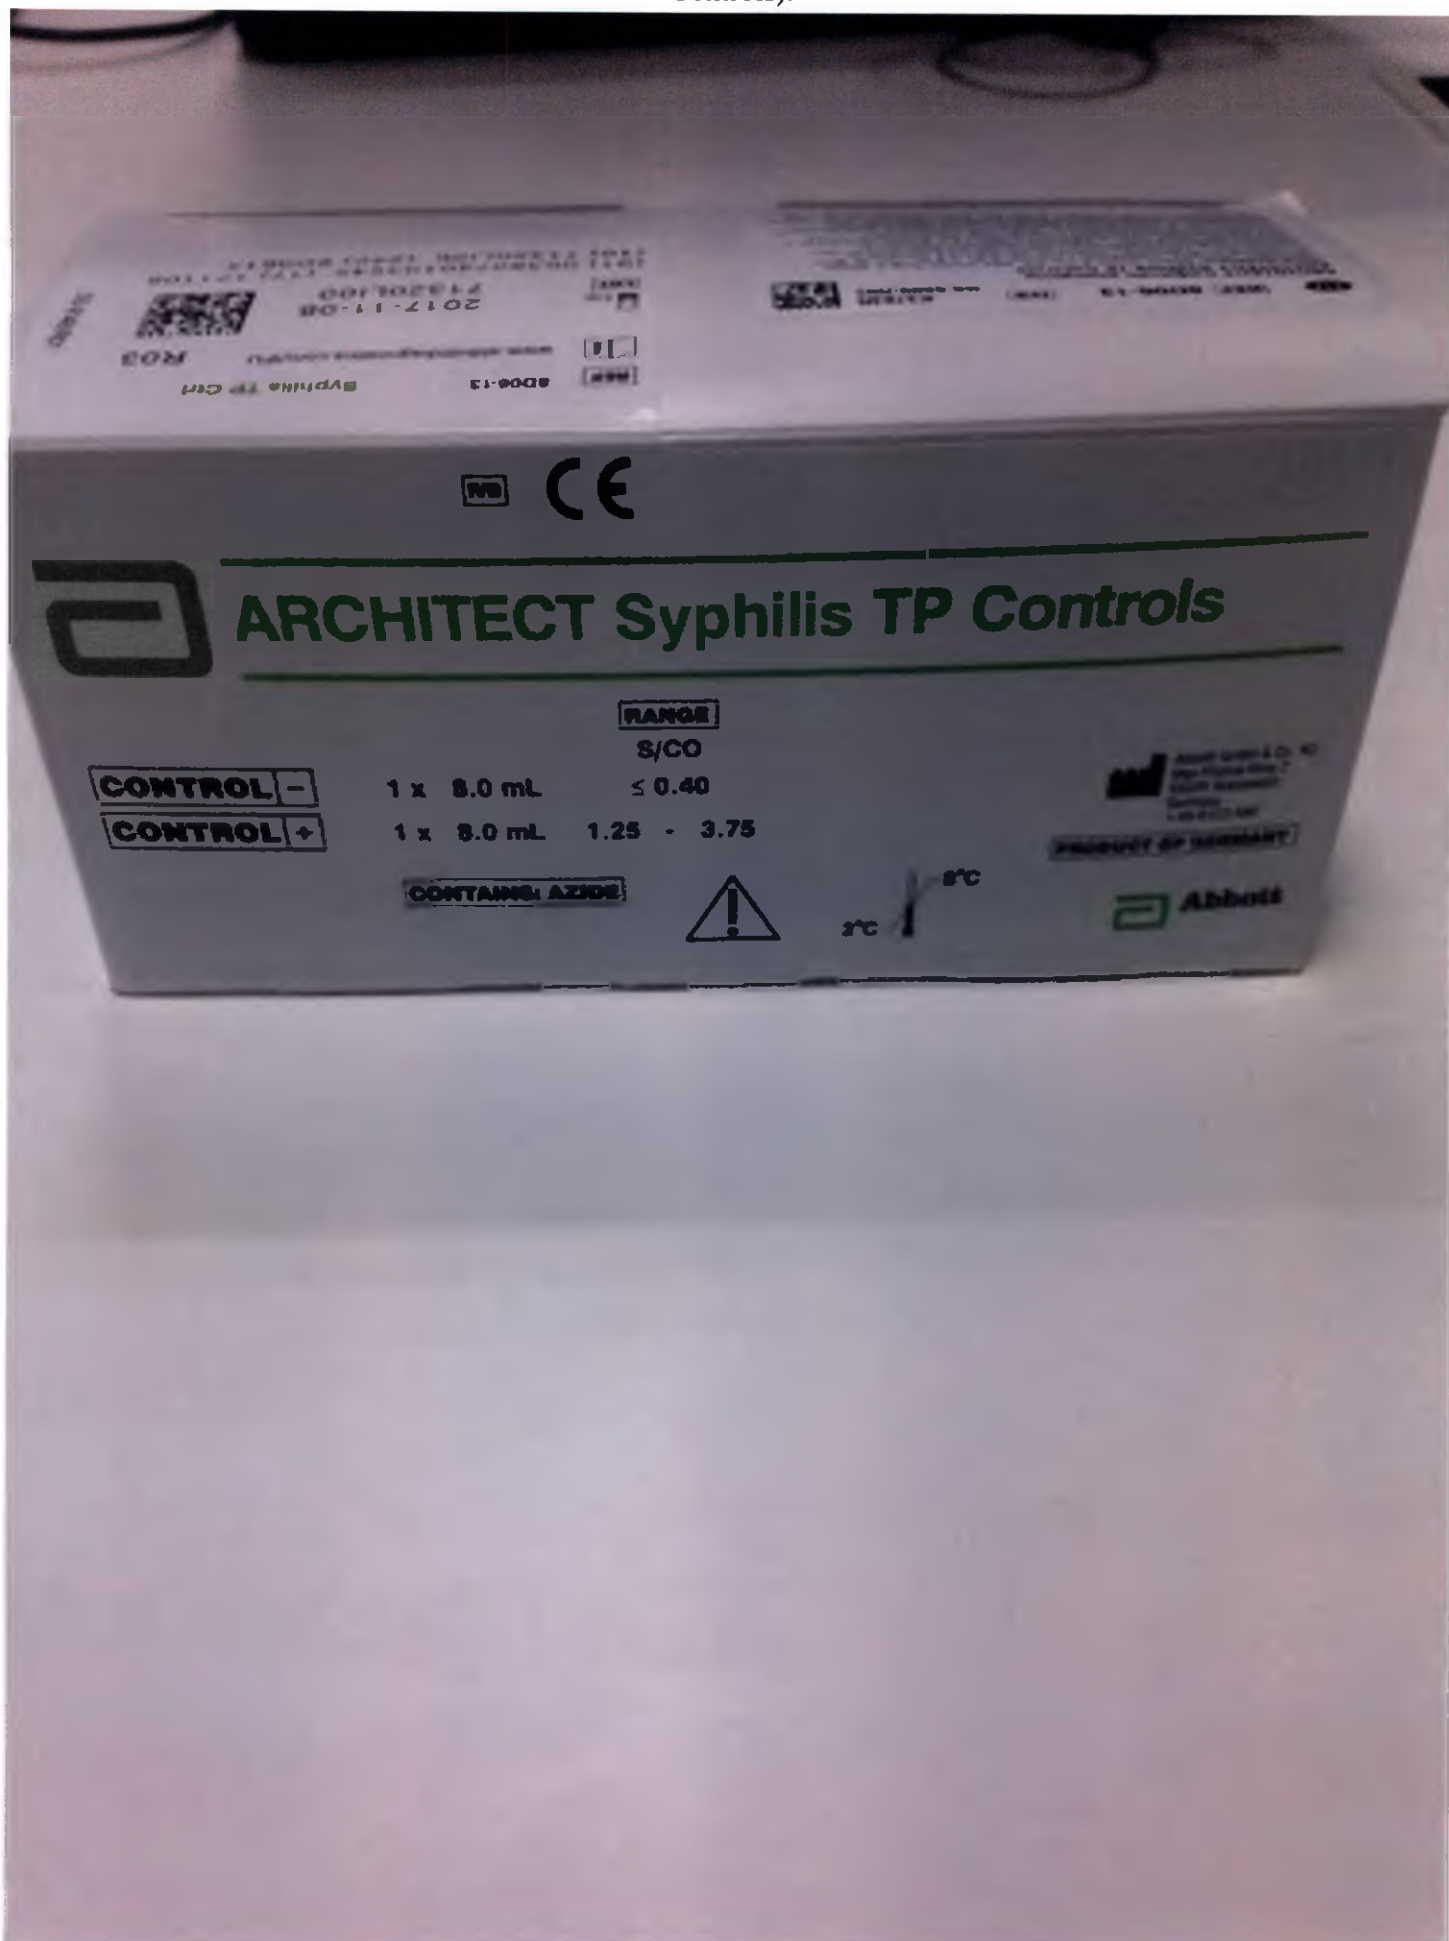



Фотографическое изображение флаконов ARCHITECT Сифилис контроли (ARCHITECT Syphilis TP Controls).

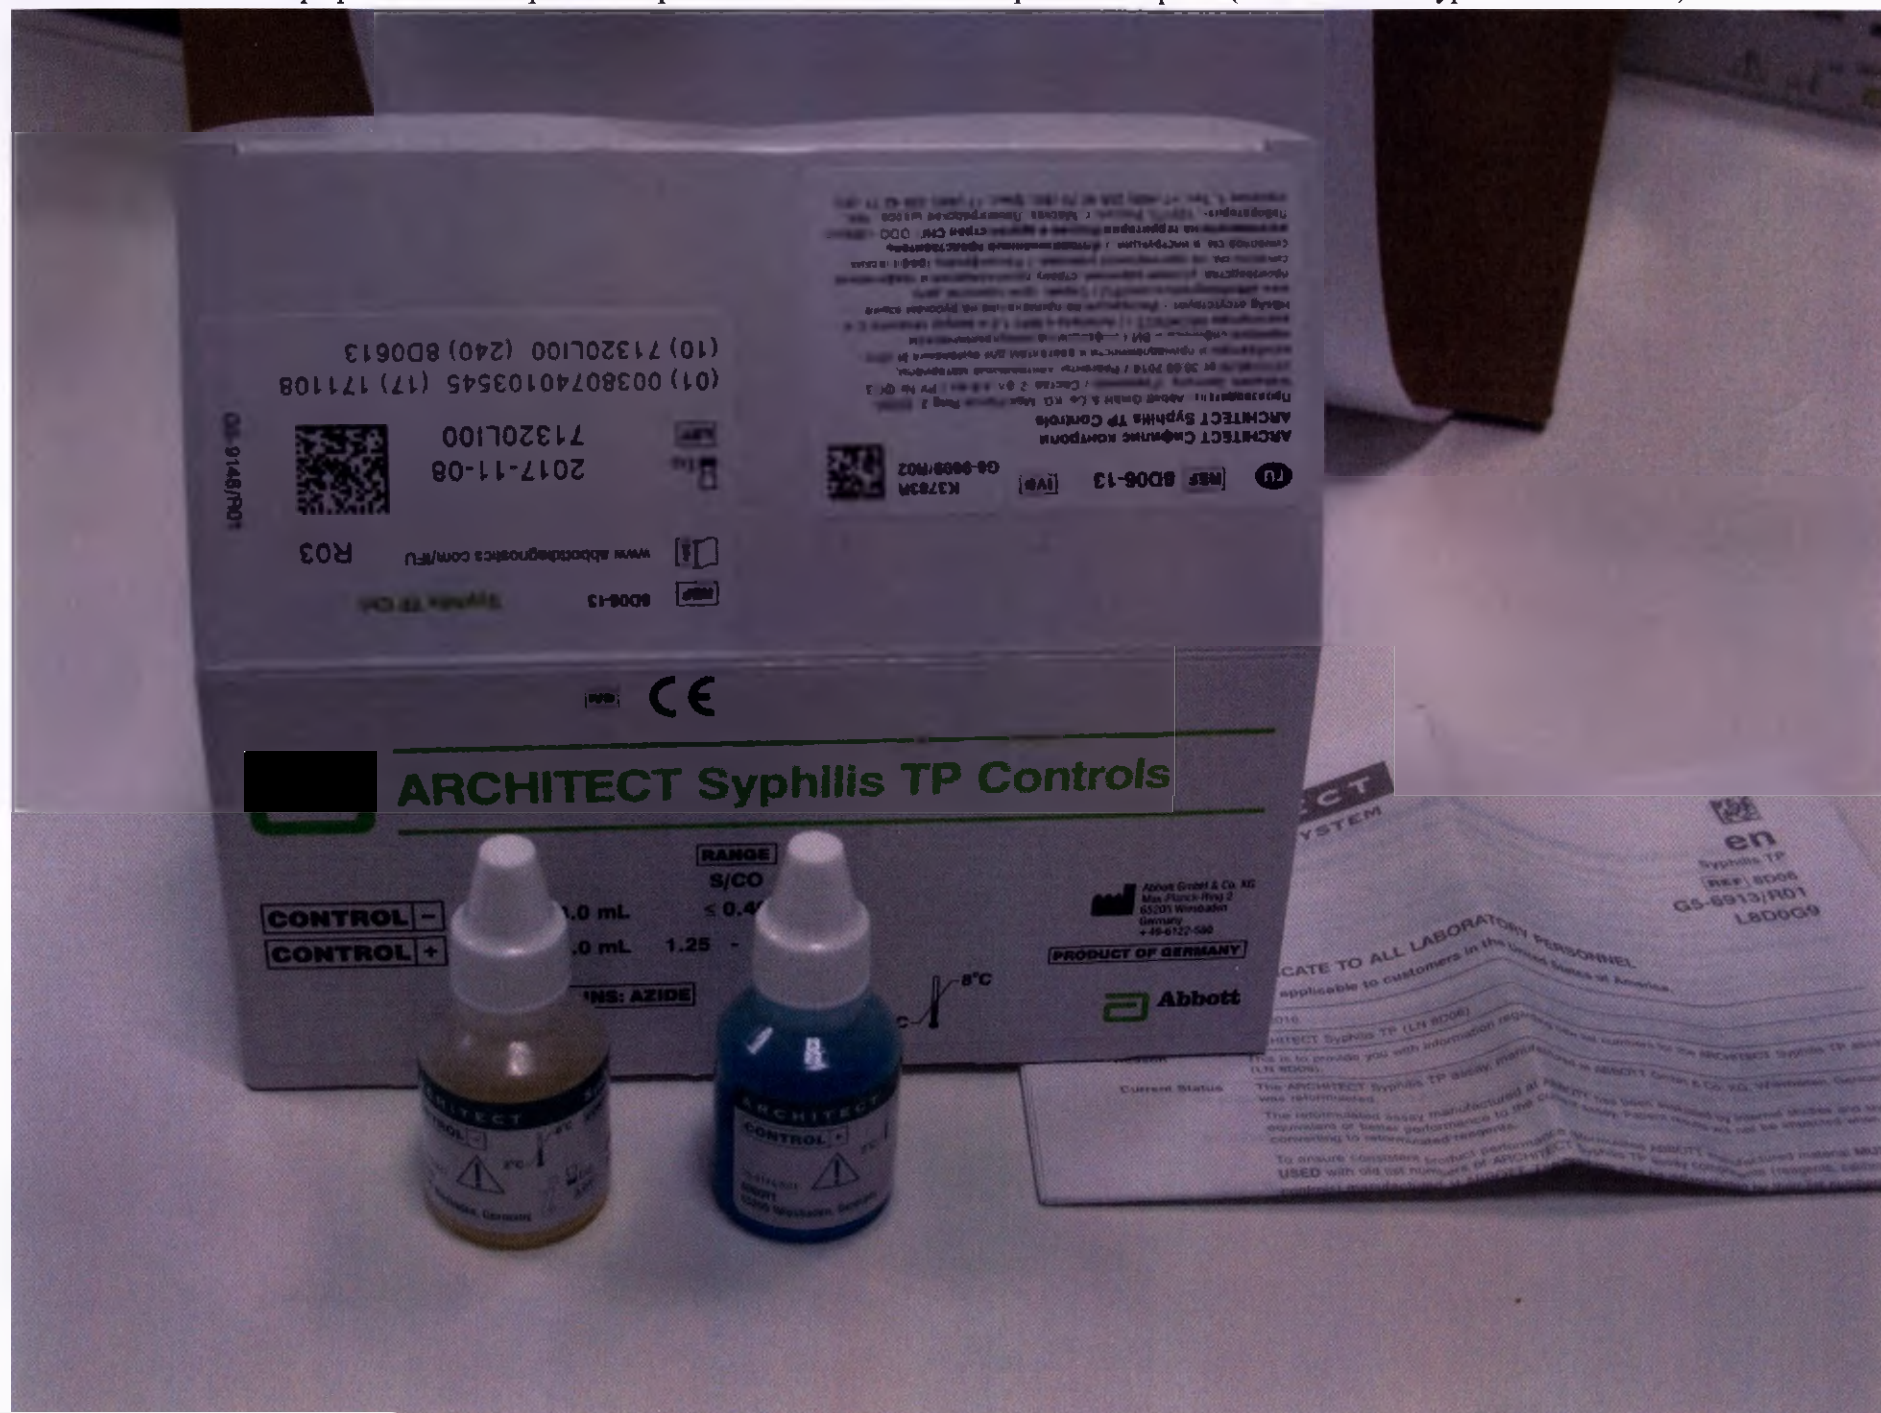

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на _____
31 _____ листах



Макет маркировки на медицинское изделие

**Реагенты, контрольные материалы, калибраторы и принадлежности к
реагентам для выявления in vitro маркёров сифилиса и ВИЧ -
инфекции на иммунохимическом анализаторе ARCHITECT i
после внесения изменений в регистрационное удостоверение на медицинское
изделие маркировка будет введена в обращение и нанесена на медицинское
изделие**

**REF 4J27-27****IVD**

ARCHITECT ВИЧ Ag/Аг Комбо реагент ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Reagent

Производитель: Abbott GmbH & Co. KG, Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany (Германия) / **Состав:** микрочастицы 1 фл. х 6,6 мл; конъюгат 1 фл. х 5,9 мл; дилуент теста 1 фл. х 5,9 мл / РУ № ФСЗ 2010/06539 от 17.07.2017/ Реагенты, контрольные материалы, калибраторы и принадлежности к реагентам для выявления in vitro маркёров сифилиса и ВИЧ - инфекции на иммунохимическом анализаторе ARCHITECT i/ Инструкция по применению на русском языке: www.abbottdiagnostics.com/IFU /

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ: ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,

Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

G30323R03



HIV Ag/Ab Combo 4J27-27

www.abbottdiagnostics.com/IFU

1 x 100



0123

**ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo
Reagent Kit****MICROPARTICLES**

1 x 6.6 mL

CONJUGATE

1 x 5.9 mL

ASSAY DILUENT

1 x 5.9 mL

**WARNING: SEVERE IRRITANT****CONTAINS: AZIDE**

ABBOTT
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden
Germany
+49-6122-580

PRODUCT OF GERMANY**HIV Ag/Ab
Combo**

Макет маркировки флаконов на 100 тестов

ARCHITECT
HIV Ag/Ab Combo



IVD

REF

4J27G

MICROPARTICLES

6.6 mL



CONTAINS: AZIDE



SN

49-9519/R01

CONTROL NO.



Exp.

ABBOTT

65205 Wiesbaden, Germany

ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo

IVD


REF

4J27H



CONJUGATE

5.9 mL



CONTAINS: AZIDE



CONTROL NO.



Exp.

SN

ABBOTT

65205 Wiesbaden, Germany

49-9521/R01

ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo

IVD


REF

4J27J



ASSAY DILUENT

5.9 mL



WARNING: SEVERE IRRITANT

CONTAINS: AZIDE



CONTROL NO.



Exp.

SN

ABBOTT

65205 Wiesbaden, Germany

G8-1883/R02

**REF 4J27-22****IVD**

ARCHITECT ВИЧ Ag/Аг Комбо реагент ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Reagent


Производитель: Abbott GmbH & Co. KG, Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany (Германия) / **Состав:** микрочастицы 4 фл. х 6,6 мл; конъюгат 4 фл. х 5,9 мл; дилуент теста 4 фл. х 5,9 мл / РУ № ФСЗ 2010/06539 от 17.07.2017/ Реагенты, контрольные материалы, калибраторы и принадлежности к реагентам для выявления in vitro маркёров сифилиса и ВИЧ - инфекции на иммунохимическом анализаторе ARCHITECT i/ Инструкция по применению на русском языке: www.abbottdiagnostics.com/IFU /

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:
ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,

Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

0300220006

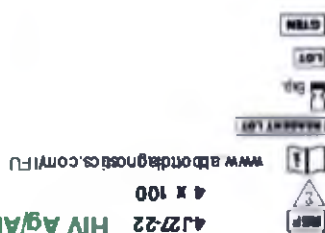

4 x 100

IVD



0123



ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit

MICROPARTICLES	4 x	6.6 mL
CONJUGATE	4 x	5.9 mL
ASSAY DILUENT	4 x	5.9 mL

**WARNING: SEVERE IRRITANT****CONTAINS: AZIDE**

Abbott
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden
Germany
+49-6122-580

PRODUCT OF GERMANY**Abbott**

HIV Ag/Ab Combo

Макет маркировки флаконов на 400 тестов


ARCHITECT
HIV Ag/Ab Combo



IVD **REF** 4J27G

MICROPARTICLES

6.6 mL



CONTAINS: AZIDE



SN

49-9519/R01

CONTROL NO.



Exp.

ABBOTT

65205 Wiesbaden, Germany

ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo

IVD


REF

4J27H



CONJUGATE

5.9 mL



CONTAINS: AZIDE



CONTROL NO.



Exp.

SN

ABBOTT

65205 Wiesbaden, Germany

49-9521/R01

ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo

IVD


REF

4J27J



ASSAY DILUENT

5.9 mL



WARNING: SEVERE IRRITANT

CONTAINS: AZIDE



CONTROL NO.



Exp.

SN

ABBOTT

65205 Wiesbaden, Germany

G8-1883/R02

**REF 4J27-32****IVD**

ARCHITECT ВИЧ Аг/Ат Комбо реагент ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Reagent


Производитель: Abbott GmbH & Co. KG, Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany (Германия) / **Состав:** микрочастицы 4 фл. х 27 мл; конъюгат 4 фл. х 26,3 мл; дилуент теста 4 фл. х 26,3 мл / РУ № ФСЗ 2010/06539 от 17.07.2017/ Реагенты, контрольные материалы, калибраторы и принадлежности к реагентам для выявления in vitro маркёров сифилиса и ВИЧ - инфекции на иммунохимическом анализаторе ARCHITECT i/ Инструкция по применению на русском языке: www.abbottdiagnostics.com/IFU/

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:
ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,

Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

G30324R03

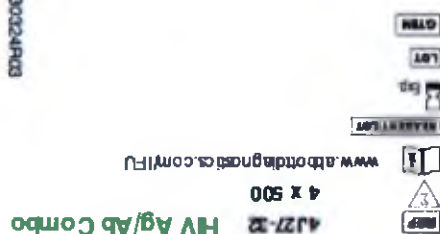

ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit

MICROPARTICLES	4 x	27.0 mL
CONJUGATE	4 x	26.3 mL
ASSAY DILUENT	4 x	26.3 mL

**WARNING: SEVERE IRRITANT****CONTAINS: AZIDE**

ABBOTT
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden
Germany
+49-6122-580

PRODUCT OF GERMANY

HIV Ag/Ab Combo

ARCHITECT
HIV Ag/Ab Combo




IVD

REF 4J27G

MICROPARTICLES

27.0 mL



CONTAINS: AZIDE



SN

49-9518/R01

CONTROL NO.



Exp.

ABBOTT

65205 Wiesbaden, Germany


ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo

IVD

REF 4J27H



CONJUGATE



26.3 mL

CONTAINS: AZIDE



CONTROL NO.

SN



Exp.

ABBOTT

65205 Wiesbaden, Germany

49-9520/R01

ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo


IVD

REF 4J27J



ASSAY DILUENT

26.3 mL



WARNING: SEVERE IRRITANT



CONTROL NO.

SN



Exp.

ABBOTT

65205 Wiesbaden, Germany

CONTAINS: AZIDE

G8-1882/R02

**REF 4J27-37****IVD**

ARCHITECT ВИЧ Аг/Ат Комбо реагент ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Reagent

Производитель: Abbott GmbH & Co. KG, Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany (Германия) / **Состав:** микрочастицы 1 фл. х 27 мл; конъюгат 1 фл. х 26,3 мл; дилуент теста 1 фл. х 26,3 мл / РУ № ФСЗ 2010/06539 от 17.07.2017/ Реагенты, контрольные материалы, калибраторы и принадлежности к реагентам для выявления in vitro маркёров сифилиса и ВИЧ - инфекции на иммунохимическом анализаторе ARCHITECT i/ Инструкция по применению на русском языке: www.abbottdiagnostics.com/IFU /

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:
ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,

Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

**CONTAINS: AZIDE****WARNING: SEVERE IRRITANT****ASSAY DILUENT**


1 x 26.3 mL

CONJUGATE

1 x 26.3 mL

MICROPARTICLES

1 x 27.0 mL

**ARCHITECT
HIV Ag/Ab Combo
Reagent Kit**

0123

4J27-37 HIV Ag/Ab Combowww.abbottdiagnostics.com/IFU**REF****REAGENT LOT****Exp****LOT****QTM**

G47682R02

**HIV Ag/Ab
Combo****PRODUCT OF GERMANY****ABBOTT**
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden
Germany
+49-6122-580

ARCHITECT
HIV Ag/Ab Combo

IVD REF 4J27G

MICROPARTICLES

27.0 mL



CONTAINS: AZIDE

SN

49-9518/R01

CONTROL NO.




ABBOTT
65205 Wiesbaden, Germany

ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo

IVD REF 4J27H

CONJUGATE

26.3 mL



CONTAINS: AZIDE

CONTROL NO.



ABBOTT
65205 Wiesbaden, Germany


49-9520/R01

ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo

IVD REF 4J27J

ASSAY DILUENT

26.3 mL



WARNING: SEVERE IRRITANT

CONTAINS: AZIDE

CONTROL NO.



ABBOTT
65205 Wiesbaden, Germany

G8-1882/R02

**REF 4J27-03****IVD**

ARCHITECT ВИЧ Аг/Ат Комбо калибратор ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Calibrator

Производитель: Abbott GmbH & Co. KG, Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany (Германия) / Состав: 1 фл. х 4 мл / РУ № ФСЗ 2010/06539 от 17.07.2017/ Реагенты, контрольные материалы, калибраторы и принадлежности к реагентам для выявления in vitro маркёров сифилиса и ВИЧ - инфекции на иммунохимическом анализаторе ARCHITECT i/ Инструкция по применению на русском языке: www.abbottdiagnostics.com/IFU/

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ: ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,

Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

6520500503

www.abbottdiagnostics.com/IFU/


HIV Ag/Ab Combo 4J27-03



0123

**ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Calibrator****CAL 1** 1 x 4 mL**CONTAINS: AZIDE**


ABBOTT
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden
Germany
+49-6122-980

**HIV Ag/Ab
Combo**

PRODUCT OF GERMANY



Макет маркировки каждого компонента медицинского изделия

ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo**CAL 1****IVD REF 4J27K**
4 mL**CONTAINS: AZIDE****LOT**

49-9515/R01

ABBOTT
65205 Wiesbaden, Germany

**REF 4J27-12****IVD**

ARCHITECT ВИЧ Аг/Ат Комбо контроли ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Controls

Производитель: Abbott GmbH & Co. KG, Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany (Германия) / **Состав:** 4 фл. х 8 мл / **РУ № ФСЗ** 2010/06539 от 17.07.2017/ **Реагенты**, контрольные материалы, калибраторы и принадлежности к реагентам для выявления in vitro маркёров сифилиса и ВИЧ - инфекции на иммунохимическом анализаторе ARCHITECT i/ **Инструкция** по применению на русском языке: www.abbottdiagnostics.com/IFU/

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ: ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,

Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

GOSZDR1P03

MFG

LOT

www.abbottdiagnostics.com/IFU/

HIV Ag/Ab Combo 4J27-12

REF

IVD



0123

**ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Controls**

RANGE


S/CO

CONTROL -	1 x 8 mL	0.00 - 0.50
CONTROL +1	1 x 8 mL	1.20 - 11.50
CONTROL +2	1 x 8 mL	1.52 - 8.30
CONTROL +3	1 x 8 mL	1.87 - 4.59

CONTAINS: AZIDE


ABBOTT
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden
Germany
+49-6122-580

PRODUCT OF GERMANY

**HIV Ag/Ab
Combo**

Макет маркировки каждого компонента медицинского изделия


ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo

CONTROL -   **CONTAINS: AZIDE** **IVD REF** 4J27P 8 mL

49-9514/R01

ABBOTT
65205 Wiesbaden, Germany   Exp. **LOT**


ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo

CONTROL +1   **CONTAINS: AZIDE** **IVD REF** 4J27T 8 mL

G3-0378/R02

ABBOTT
65205 Wiesbaden, Germany   Exp. **LOT**


ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo

CONTROL +2   **CONTAINS: AZIDE** **IVD REF** 4J27U 8 mL

G3-0377/R02

ABBOTT
65205 Wiesbaden, Germany   Exp. **LOT**

ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo

CONTROL +3   **CONTAINS: AZIDE** **IVD REF** 4J27R 8 mL

G3-0376/R02

ABBOTT
65205 Wiesbaden, Germany   Exp. **LOT**

**REF****8D06-32****IVD**

ARCHITECT Сифилис реагент ARCHITECT Syphilis TP Reagent

Производитель: Abbott GmbH & Co. KG, Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany (Германия) / **Состав:** микрочастицы 1 фл. х 4,1 мл; конъюгат 1 фл. х 5,9 мл; дилуент теста 1 фл. х 6,3 мл / РУ № ФСЗ 2010/06539 от 17.07.2017/ Реагенты, контрольные материалы, калибраторы и принадлежности к реагентам для выявления in vitro маркёров сифилиса и ВИЧ - инфекции на иммунохимическом анализаторе ARCHITECT i/ Инструкция по применению на русском языке: www.abbottdiagnostics.com/IFU /

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ: ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,

Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)



2°C 8°C

WARNING: EYE IRRITANT

WARNING: SENSITIZER



CONTAINS: AZIDE

MICROPARTICLES	1 x	4.1 mL
CONJUGATE	1 x	5.9 mL
ASSAY DILUENT	1 x	6.3 mL



ARCHITECT
Syphilis TP Reagent Kit

1 x 100

CE

Syphilis TP

8D06-32

www.abbottdiagnostics.com/IFU

REF

LOT

EXP

Abbott

PRODUCT OF GERMANY

Abbott GmbH & Co. KG
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden
Germany
+49-6122-580

Syphilis TP

ARCHITECT
Syphilis TP

IVD REF 8D06G

MICROPARTICLES

4.1 mL

2°C 8°C

CONTAINS: AZIDE

WARNING: EYE IRRITANT

SN

G88433R01

i

CONTROL NO.

ABBOTT

65205 Wiesbaden, Germany

Exp.

ARCHITECT		Syphilis TP		IVD	REF 8D06J	☐
ASSAY DILUENT 6.3 mL ABBOTT 65205 Wiesbaden, Germany 8°C 2°C WARNING: SENSITIZER WARNING: EYE IRRITANT SN CONTROL NO. Exp. G88437R01						

**REF 8D06-42****IVD**

ARCHITECT Сифилис реагент ARCHITECT Syphilis TP Reagent

Производитель: Abbott GmbH & Co. KG, Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany (Германия) / **Состав:** микрочастицы 1 фл. х 16,3 мл; конъюгат 1 фл. х 26,3 мл; дилуент теста 1 фл. х 34,1 мл / РУ № ФСЗ 2010/06539 от 17.07.2017/ Реагенты, контрольные материалы, калибраторы и принадлежности к реагентам для выявления in vitro маркёров сифилиса и ВИЧ - инфекции на иммунохимическом анализаторе ARCHITECT i/ Инструкция по применению на русском языке: www.abbottdiagnostics.com/IFU/

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:
ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,

Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)



WARNING: EYE IRRITANT
WARNING: SENSITIZER

Abbott GmbH & Co. KG
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden
Germany
+49-5172-590

PRODUCT OF GERMANY

Abbott



CONTAINS: AZIDE

MICROPARTICLES	1 x	16.3 mL
CONJUGATE	1 x	26.3 mL
ASSAY DILUENT	1 x	34.1 mL



ARCHITECT
Syphilis TP Reagent Kit



1 x 500

IVD



Syphilis TP

8D06-42

REF

011/14005255016131210017 WWW



REAGENT LOT



LOT

G88432R01

Syphilis TP

ARCHITECT Syphilis TP 	
MICROPARTICLES	16.3 mL
	
CONTAINS: AZIDE	WARNING: EYE IRRITANT
SN	
G88434R01	CONTROL NO.
ABBOTT	 Exp.
65205 Wiesbaden, Germany	

ARCHITECT Syphilis TP 	IVD REF 8D06H
CONJUGATE	
26.3 mL	SN
	
CONTAINS: AZIDE	CONTROL NO.
ABBOTT	 Exp.
65205 Wiesbaden, Germany	WARNING: EYE IRRITANT
G88436R01	

ARCHITECT Syphilis TP 	IVD REF 8D06J
ASSAY DILUENT	
34.1 mL	SN
	
WARNING: SENSITIZER	CONTROL NO.
ABBOTT	 Exp.
65205 Wiesbaden, Germany	WARNING: EYE IRRITANT
G88438R01	



REF 8D06-04

IVD



ARCHITECT Сифилис калибратор ARCHITECT Syphilis TP Calibrator

Производитель: Abbott GmbH & Co. KG, Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany (Германия) / Состав: 1 фл. х 4 мл / РУ № ФСЗ 2010/06539 от 17.07.2017/ Реагенты, контрольные материалы, калибраторы и принадлежности к реагентам для выявления in vitro маркёров сифилиса и ВИЧ - инфекции на иммунохимическом анализаторе ARCHITECT i/ Инструкция по применению на русском языке: www.abbottdiagnostics.com/IFU/

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ: ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,

Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

06-5047/1002



www.abbottdiagnostics.com/IFU

Syphilis TP Cal



ARCHITECT Syphilis TP Calibrator

CAL 1

1 x 4.0 mL

Abbott GmbH & Co. KG
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden
Germany
+49-6172-5100

PRODUCT OF GERMANY

Syphilis TP Cal

CONTAINS: AZIDE



2°C 8°C



Макет маркировки каждого компонента медицинского изделия

ARCHITECT Syphilis TP

CAL 1

2°C 8°C

CONTAINS: AZIDE

IVD

REF

8D06K
4.0 mL

G5-9146/R01
ABBOTT
65205 Wiesbaden, Germany



Exp.
LOT

**REF 8D06-13****IVD**

ARCHITECT Сифилис контроли ARCHITECT Syphilis TP Controls

Производитель: Abbott GmbH & Co. KG, Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany (Германия) / **Состав:** 2 фл. х 8 мл / **ПУ № ФСЗ 2010/06539** от 17.07.2017/ Реагенты, контрольные материалы, калибраторы и принадлежности к реагентам для выявления in vitro маркёров сифилиса и ВИЧ - инфекции на иммунохимическом анализаторе ARCHITECT i/ **Инструкция по применению на русском языке:** www.abbottdiagnostics.com/IFU/ / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ: ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,

Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

05-10-019/1002

REF 8D06-13 Syphilis TP Ctrl
www.abbottdiagnostics.com/IFU

**ARCHITECT Syphilis TP Controls**

CONTROL -		1 x 8.0 mL		RANGE
CONTROL +		1 x 8.0 mL		S/CO
				≤ 0.40
				1.25 - 3.75

CONTAINS: AZIDE



PRODUCT OF GERMANY

Abbott GmbH & Co. KG
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden
Germany
+49 670 400

**Syphilis TP Ctrl**

Макет маркировки каждого компонента медицинского изделия

ARCHITECT Syphilis TP

CONTROL -

IVD REF 8D06L 8 mL

D5-Y203-4-1/R1
ABBOTT
65205 Wiesbaden, Germany

ARCHITECT

Syphilis TP

CONTROL +



IVD

REF

8D06M
8 mL

D5-Y203-4-2/R1

ABBOTT

65205 Wiesbaden, Germany



Exp.

LOT

Сведения о стандартах, применяемых к этикетке на МИ:

Стандарт	Наименование стандарта
ГОСТ Р ИСО 18113-1 – 2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> . Информация, предоставляемая изготовителем (маркировка). Часть 1. Термины, определения и общие требования.
ГОСТ Р ИСО 18113-2 – 2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> – Информация, предоставляемая производителем (маркировка) – Часть 2: Реагенты для диагностики <i>in vitro</i> для профессионального применения.
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования.

Расшифровка символов представлена в инструкции.

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на _____
19 _____ листах

