


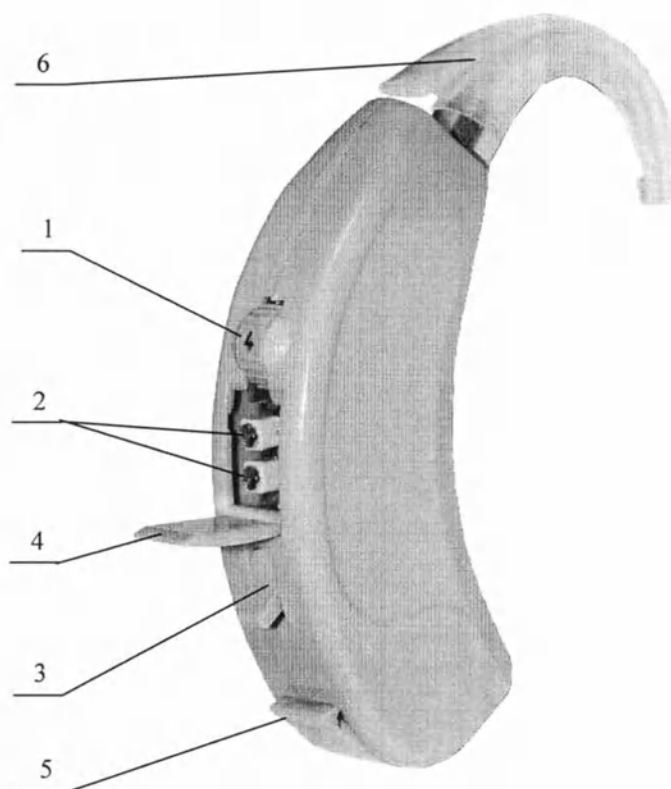

- 1 – регулятор усиления;
- 2 – неоперативные регуляторы (триммеры). Назначение и количество триммеров зависит от модели аппарата;
- 3 – переключатель рода работ – выключатель питания;
- 4 – крышка триммерного отсека;
- 5 – держатель источника питания;
- 6 – звукопровод (крючок).

Рисунок 1 – Внешний вид слуховых аппаратов серии «РЕТРО».

Подпись и дата	Инд. № докл.	Взам. инд. №	Подпись и дата	Ид. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата