


OXFORD

Оксфорд Медикал
Россия, 127287, Москва
Петровско-Разумовский проезд, д. 29
тел/факс: (495) 614-91-33, 614-68-16
E.Mail: oxford@oxfordmed.ru

Oxford Medical
Russia, 127287, Moscow
Petrovsko-Razumovskiy proezd, 29
tel.(495) 614-91-33, 614-68-16
E.Mail: oxford@oxfordmed.ru

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Оксфорд Медикал»

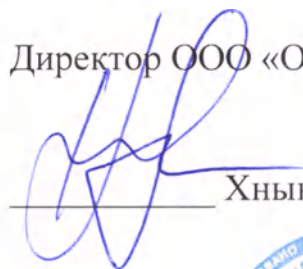

Хныкин К.В.

« _____ »

2020 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Монитор фетальный Sonicaid TEAM 3 (Соникейд ТИМ Три)
с принадлежностями

производства

ArjoHuntleigh AB («АрджоХантли АБ»), Швеция



Sonicaid TEAM 3-A: Блок основной. Вид спереди.



Sonicaid TEAM 3-A: Блок основной. Вид сзади.



Sonicaid TEAM 3-I: Блок основной. Вид спереди.



Sonicaid TEAM 3-E-CTG: Блок основной. Вид спереди.



Sonicaid TEAM 3-E-CTG: Блок основной. Вид сзади.



Ремень для крепления датчика.

Датчик ТОСО проводной.

Датчик ультразвуковой проводной.

Датчик ТОСО беспроводной.

Датчик ультразвуковой беспроводной.




Отметчик шевелений плода проводной.



1. Sonicaid TEAM 3-I: Блок основной. 2-4. Датчик ультразвуковой проводной в упаковке. 5. Датчик TOCO проводной в упаковке. 6. Бумага для термопринтера Z-образно сложенная. 7. Инструкция по эксплуатации на CD. 8. Гель ультразвуковой, 250 мл. 9. Отметчик шевелений плода проводной. 10. Ремень для крепления датчика.



Система телеметрии «Sonicaid Freedom»: Приемник.

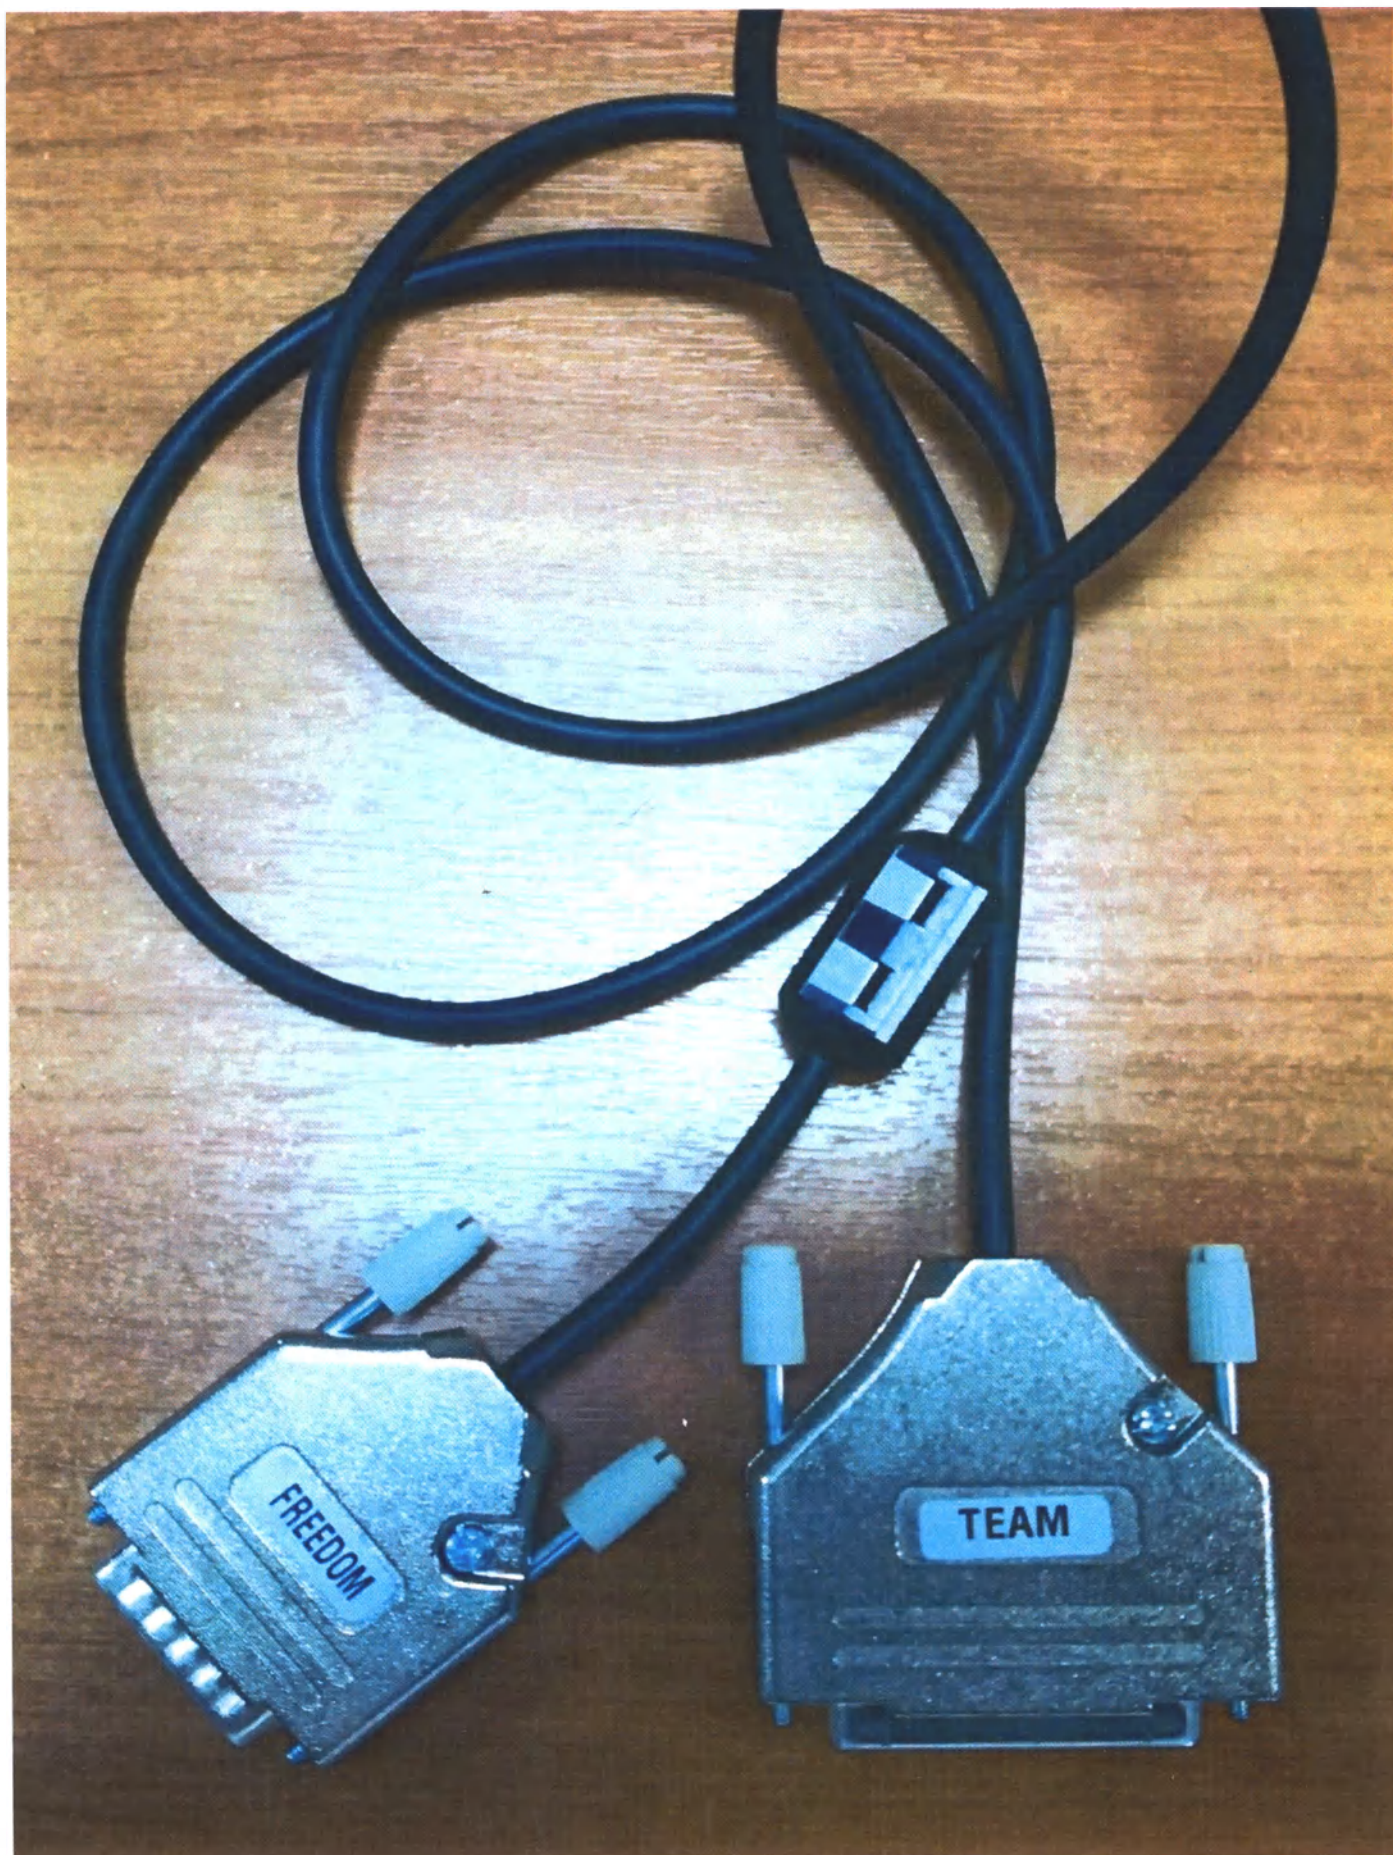

Система телеметрии «Sonicaid Freedom»: Кабель соединительный.






Манжета для измерения артериального давления большая для окружности руки 32-42 см.



Манжета для измерения артериального давления большая плюс для окружности руки 35-45 см.



Датчик пульсоксиметрический пальцевой.
Кабель соединительный для датчика пульсоксиметрического.

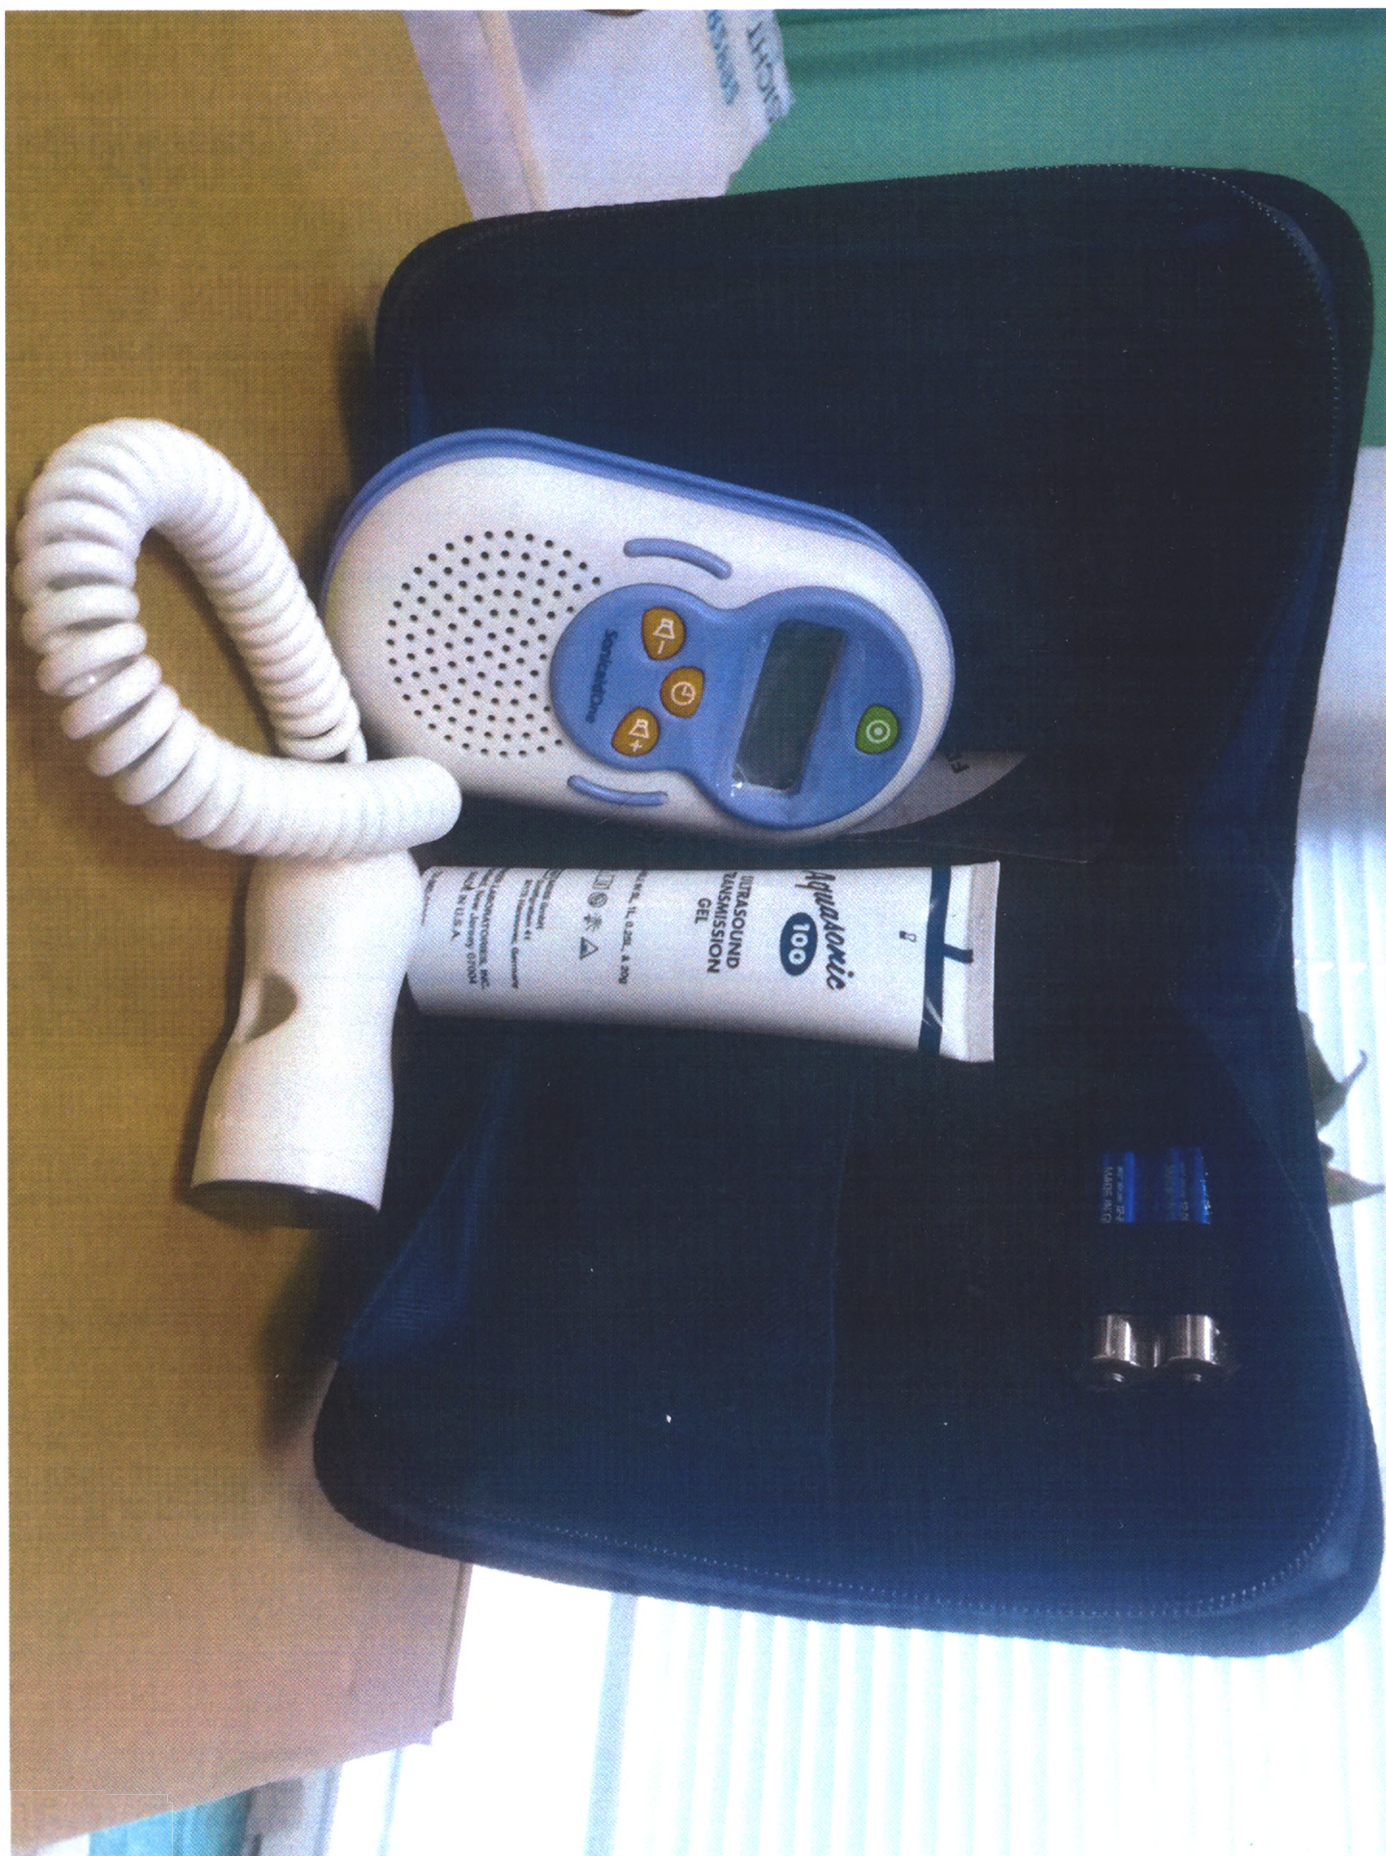

Детектор сердцебиений плода «Sonicaid One»: Детектор портативный, Гель ультразвуковой 60 мл., Чехол, Батарейка пальчиковая AA 2 шт.



Кабель ЭКГ матери.

INTRAN[®] PLUS IUP-400




Disposable Intrauterine Pressure Catheter System

With Amnioinfusion Capability

Zeroing Switch in Disposable Catheter; Regular Size Tip

Package Contents

1. INTRAN PLUS with Sensaflex[™]
2. Adhesive pad for securing INTRAN PLUS to patient's thigh or abdomen
3. Velcro strap to secure INTRAN PLUS to adhesive pad

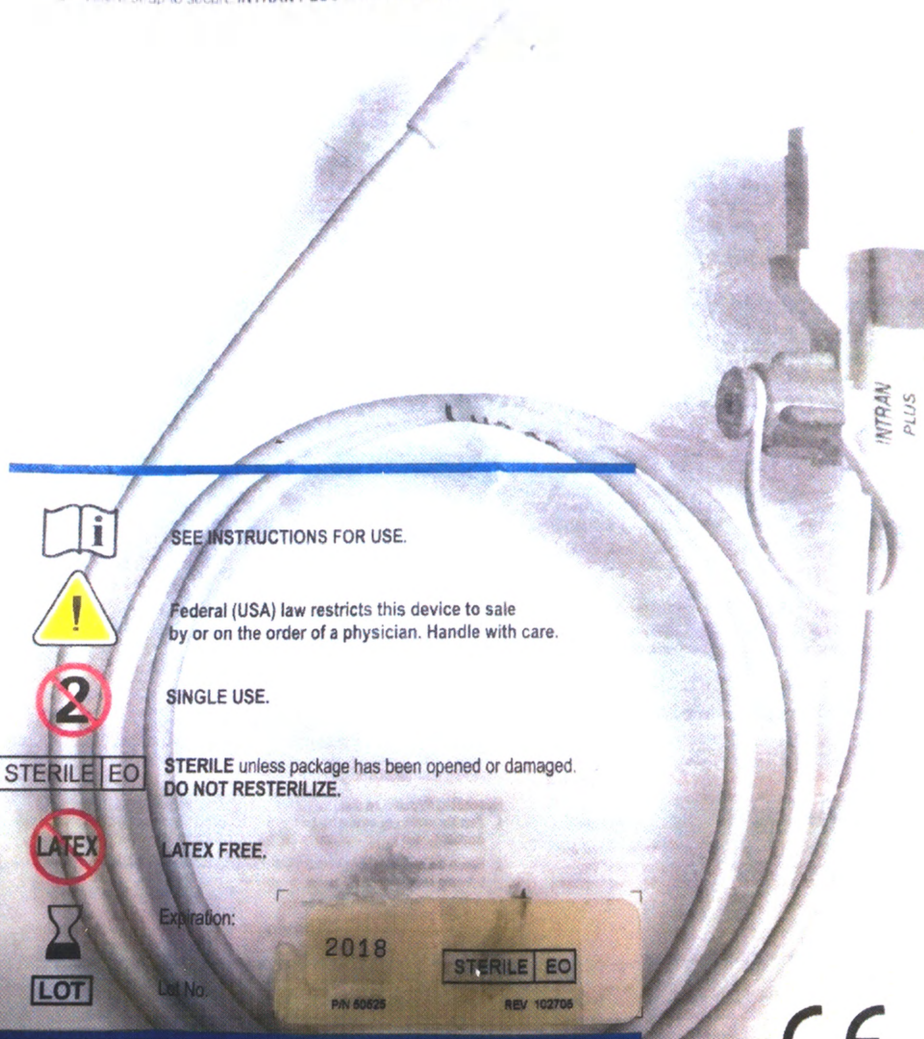

SEE INSTRUCTIONS FOR USE.



Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician. Handle with care.



SINGLE USE.

STERILE EO

STERILE unless package has been opened or damaged. DO NOT RESTERILIZE.



LATEX FREE.



Expiration:

2018

LOT

Lot No.

P/N 60625

REV 102705

STERILE EO

Protected Under U.S. Patent Number 4,785,822

Made in U.S.A.

CE
0344

+H671IUP4001L



UTAH MEDICAL PRODUCTS INC.

United States

7043 South 300 West,
Midvale, Utah, 84047 USA
(800) 533-4984
(801) 566-1200

Europe


Utah Medical Products Ltd.
Athlone Business & Technology Park
Dublin Road
Athlone, Co Westmeath, Ireland

PN 4524

Катетер внутриматочный одноразовый.



Кабель для катетера внутриматочного одноразового.

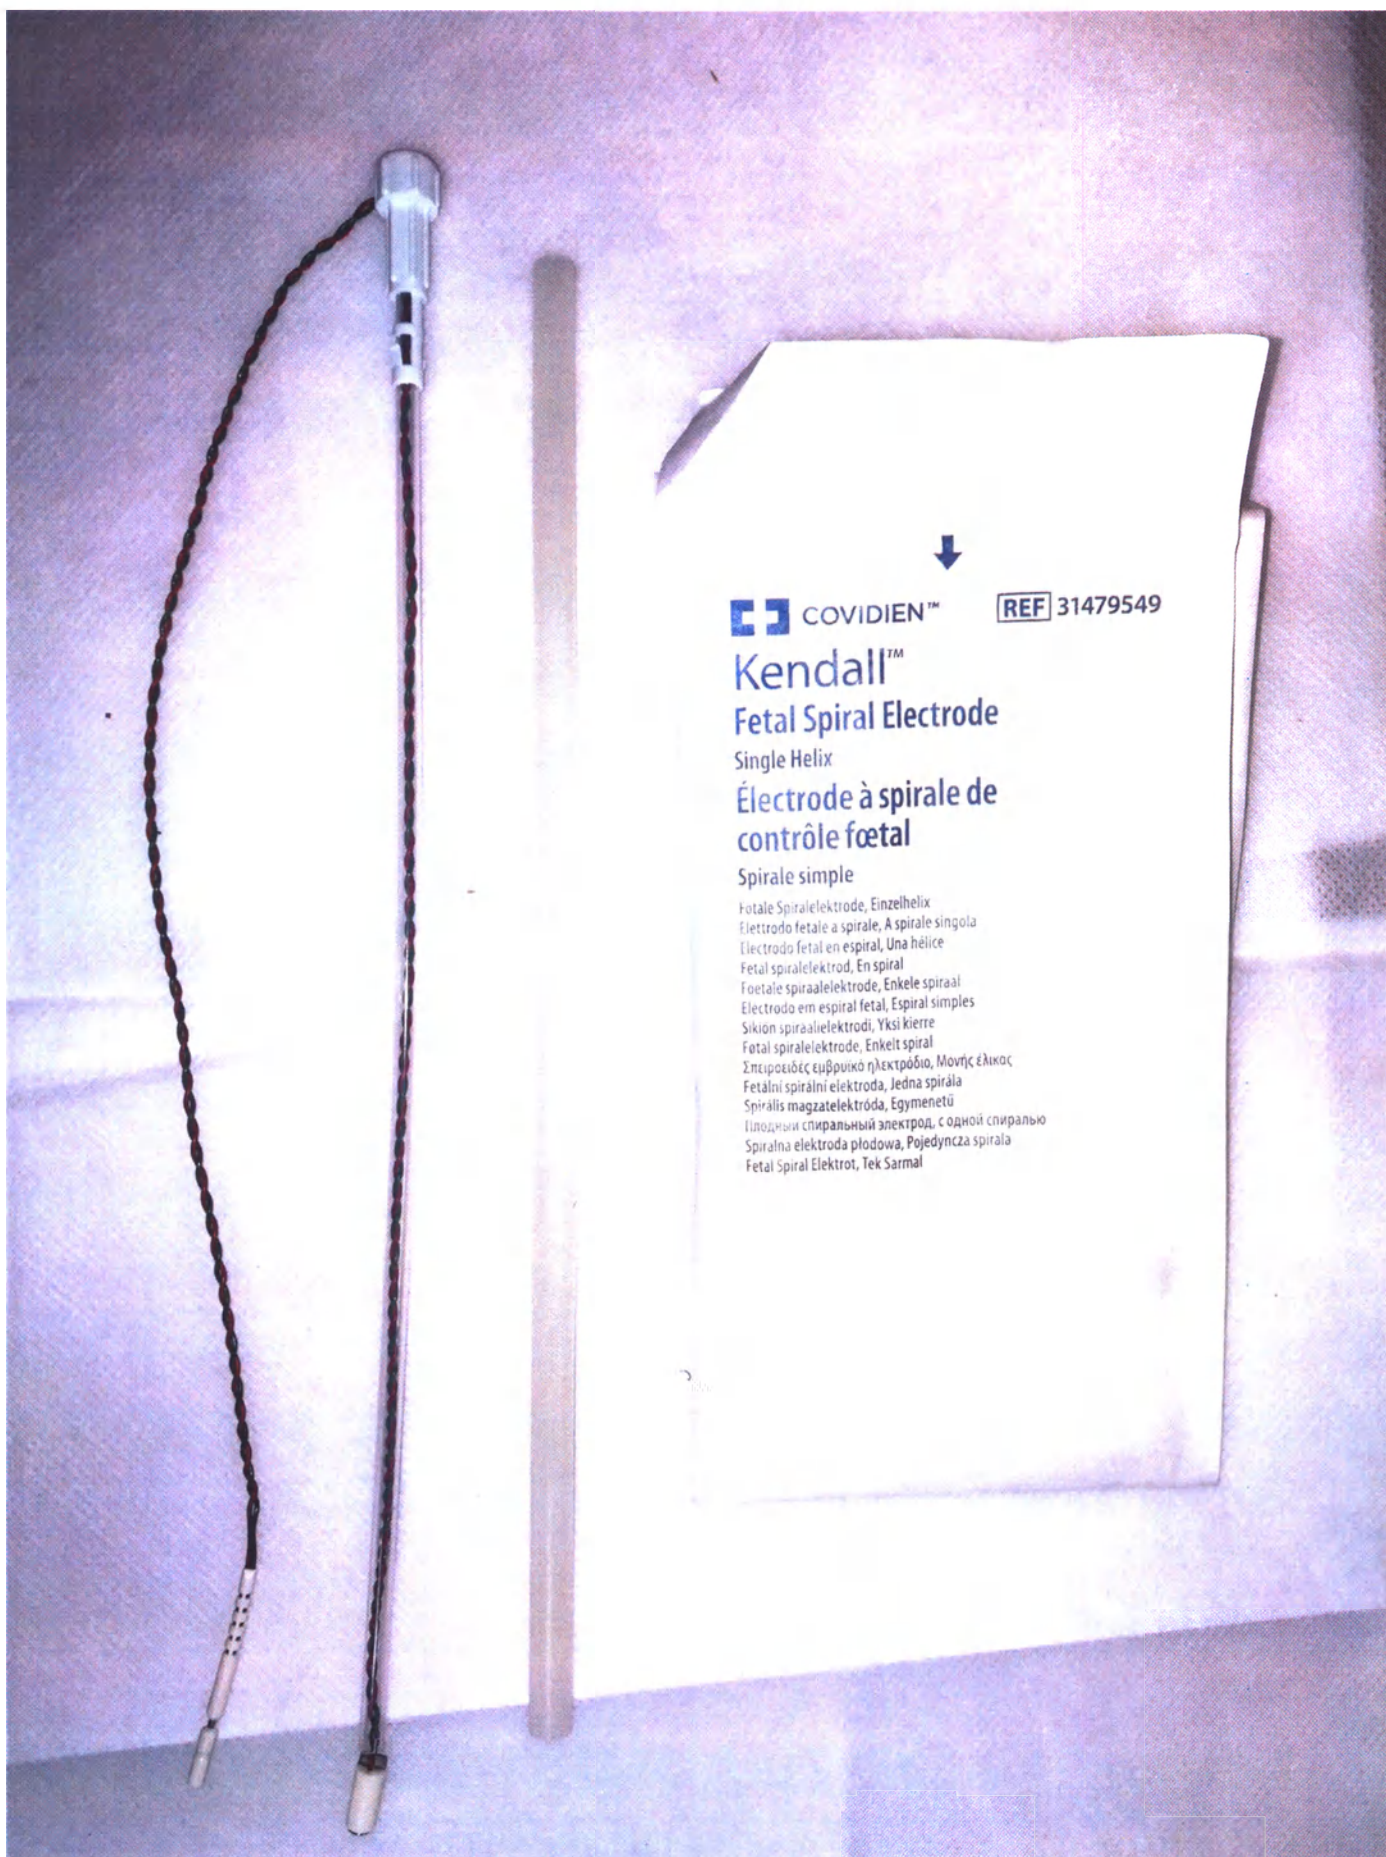


Скальп-электрод одноразовый.



Кабель для скальп-электрода.



Тележка.

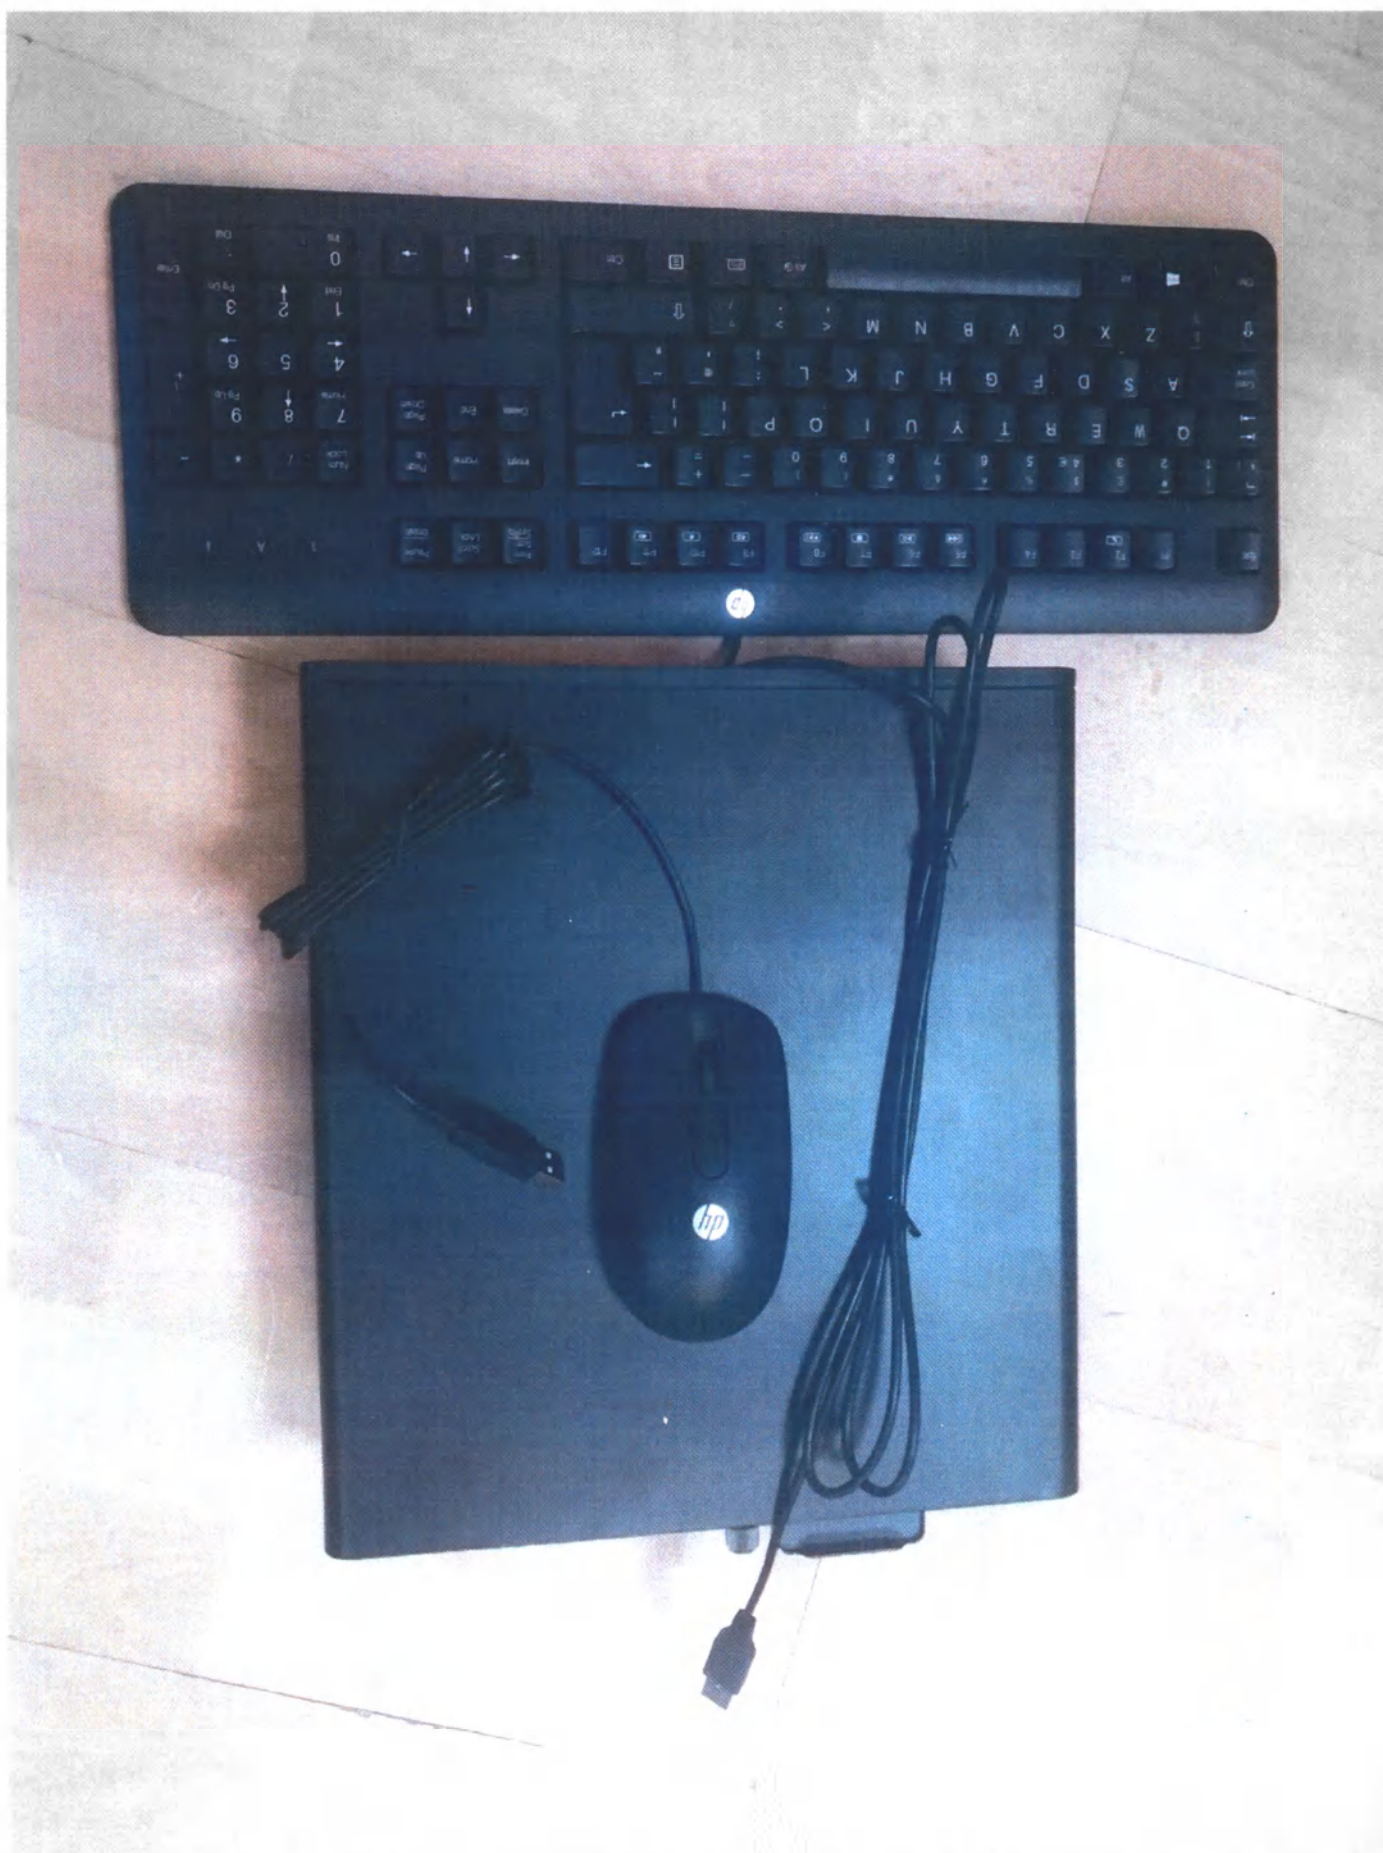

Система центрального мониторинга «Sonicaid Centrale» для объединения нескольких мониторов в единую сеть: Системный блок, Клавиатура, Манипулятор типа «мышь».

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 24 (Хныкин К.В.)

лист а

Директор ООО «Оксфорд Медикал»
Хныкин К.В.

