

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «КаВо Дентал Руссланд»



[Signature]
А.А.Шавырин

" 31 " марта 2021 г.

Маслачовенко И.В.
по доверенности
от 09.01.20

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Наконечники торговой марки «KAVO» стоматологические воздушные порошокоструйные, с принадлежностями.

Содержание

Наконечники торговой марки «KAVO» стоматологические воздушные порошкоструйные, с принадлежностями:	6
I. Варианты исполнения:	6
1. Наконечник торговой марки «KAVO» стоматологический воздушный порошкоструйный PROPHYflex 4, Wave (синий) в составе:	6
1.1 Наконечник торговой марки «KAVO» стоматологический воздушный порошкоструйный PROPHYflex 4, Wave (синий) в составе:	6
1.1.1 Наконечник PROPHYflex 4, Wave (синий) – 1 шт.	7
1.1.2 Вмонтируемая длинная втулка – не более 100 шт. (при необходимости).....	8
1.1.3 Канюля – не более 100 шт. (при необходимости).....	9
1.1.4 Емкость для порошка – не более 100 шт. (при необходимости)	10
1.2 Короткая удерживающая втулка с канюлей – не более 100 шт. (при необходимости)	11
1.3 Емкость для порошка с резиновой зеленой пробкой – не более 100 шт. (при необходимости).....	12
1.4 Чистящий бор – не более 100 шт. (при необходимости).	13
1.5 Игла для прочистки форсунок – не более 100 шт. (при необходимости).....	14
1.6. Ключ для канюли - не более 100 шт. (при необходимости).	15
1.7 Канюля POWER – не более 100 шт. (при необходимости).....	16
1.8 Уплотнительные кольца – 5 шт.	17
1.9 Инструкция по эксплуатации	18
2. Наконечник торговой марки "KAVO" стоматологический воздушный порошкоструйный PROPHYflex 4, Lime (желто-зеленый), в составе:	19
2.1 Наконечник торговой марки "KAVO" стоматологический воздушный порошкоструйный PROPHYflex 4, Lime (желто-зеленый), в составе:	20
2.1.1 Наконечник PROPHYflex 4, Lime (желто-зеленый) -1 шт	20
2.1.2 Вмонтируемая длинная втулка – не более 100 шт. (при необходимости).....	21
2.1.3 Канюля – не более 100 шт. (при необходимости).....	22
2.1.4 Емкость для порошка – не более 100 шт. (при необходимости).....	23

2.2	Короткая удерживающая втулка с канюлей – не более 100 шт. (при необходимости)	24
2.3	Емкость для порошка с резиновой зеленой пробкой – не более 100 шт. (при необходимости).....	25
2.4	Чистящий бор – не более 100 шт. (при необходимости.).	26
2.5	Игла для прочистки форсунок – не более 100 шт. (при необходимости).	27
2.6	Ключ для канюли - не более 100 шт. (при необходимости)	28
2.7	Канюля POWER – не более 100 шт. (при необходимости).....	29
2.8	Уплотнительные кольца – 5 шт.	30
2.9	Инструкция по эксплуатации.....	31
3.	Наконечник торговой марки «KAVO» стоматологический воздушный порошокоструйный PROPHYflex 4, Flamingo (розовый), в составе:	32
3.1	Наконечник торговой марки «KAVO» стоматологический воздушный порошокоструйный PROPHYflex 4, Flamingo (розовый), в составе:	32
3.1.1	Наконечник PROPHYflex 4, Flamingo (розовый) -1 шт.....	33
3.1.2	Вмонтируемая длинная втулка - не более 100 шт. (при необходимости)	34
3.1.3	Канюля - не более 100 шт. (при необходимости).....	35
3.1.4	Емкость для порошка - не более 100 шт. (при необходимости).....	36
3.2	Короткая удерживающая втулка с канюлей - не более 100 шт. (при необходимости).	37
3.3	Емкость для порошка с резиновой зеленой пробкой – не более 100 шт. (при необходимости).....	38
3.4	Чистящий бор - не более 100 шт. (при необходимости).	39
3.5	Игла для прочистки форсунок – не более 100 шт. (при необходимости).	40
3.7	Канюля POWER – не более 100 шт. (при необходимости).	42
3.8	Уплотнительные кольца – 5 шт.	43
3.9	Инструкция по эксплуатации	44
4.	Наконечник торговой марки «KAVO» стоматологический воздушный порошокоструйный PROPHYflex 4 S, Wave (синий) в составе:...	45
4.1	Наконечник торговой марки "KAVO" стоматологический воздушный порошокоструйный PROPHYflex 4 S, Wave (синий), в составе:.....	46
4.1.1	Наконечник PROPHYflex 4 S, Wave (синий) -1 шт.	46
4.1.2	Вмонтируемая длинная втулка - не более 100 шт. (при необходимости).	47

4.1.3 Канюля - не более 100 шт. (при необходимости).....	48
4.1.4 Емкость для порошка - не более 100 шт. (при необходимости).....	49
4.2 Короткая удерживающая втулка с канюлей - не более 100 шт. (при необходимости).....	50
4.3 Емкость для порошка с резиновой зеленой пробкой – не более 100 шт. (при необходимости).....	51
4.4 Чистящий бор – не более 100 шт. (при необходимости).	52
4.5 Игла для прочистки форсунок – не более 100 шт. (при необходимости).	53
4.6 Ключ для канюли - не более 100 шт. (при необходимости).....	54
4.7 Канюля POWER – не более 100 шт. (при необходимости).....	55
4.8 Уплотнительные кольца – 5 шт.	56
4.9 Инструкция по эксплуатации	57
5. Наконечник торговой марки «KAVO» стоматологический воздушный порошкоструйный PROPHYflex 4 S, Lime (желто-зеленый) в составе:	58
5.1 Наконечник торговой марки "KAVO" стоматологический воздушный порошкоструйный PROPHYflex 4 S, Lime (желто-зеленый), в составе:	58
5.1.1 Наконечник PROPHYflex 4 S, Lime (желто-зеленый) -1 шт.	59
5.1.2 Вмонтируемая длинная втулка - не более 100 шт. (при необходимости)	60
5.1.3 Канюля - не более 100 шт. (при необходимости).....	61
5.1.4 Емкость для порошка - не более 100 шт. (при необходимости).....	62
5.2 Короткая удерживающая втулка с канюлей - не более 100 шт. (при необходимости).....	63
5.3 Емкость для порошка с резиновой зеленой пробкой – не более 100 шт. (при необходимости).....	64
5.4 Чистящий бор – не более 100 шт. (при необходимости).	65
5.5 Игла для прочистки форсунок – не более 100 шт. (при необходимости).	66
5.7 Канюля POWER – не более 100 шт. (при необходимости).....	68
5.8 Уплотнительные кольца – 5 шт.	69
5.9 Инструкция по эксплуатации	70

6. Наконечник торговой марки «KAVO» стоматологический воздушный порошкоструйный PROPHYflex 4 S, Flamingo (розовый) в составе:	71
6.1 Наконечник торговой марки "KAVO" стоматологический воздушный порошкоструйный PROPHYflex 4 S, Flamingo (розовый), в составе:	72
6.1.1 Наконечник PROPHYflex 4 S, Flamingo (розовый) -1 шт.	72
6.1.2 Вмонтируемая длинная втулка - не более 100 шт. (при необходимости)	73
6.1.3 Канюля - не более 100 шт. (при необходимости).....	74
6.1.4 Емкость для порошка - не более 100 шт. (при необходимости).....	75
6.2 Короткая удерживающая втулка с канюлей - не более 100 шт. (при необходимости).....	76
6.3 Емкость для порошка с резиновой зеленой пробкой – не более 100 шт. (при необходимости).....	77
6.4 Чистящий бор – не более 100 шт. (при необходимости)	78
6.5 Игла для прочистки форсунок – не более 100 шт. (при необходимости)	79
6.6 Ключ для канюли - не более 100 шт. (при необходимости)	80
6.7 Канюля POWER – не более 100 шт. (при необходимости).....	81
6.8 Уплотнительные кольца – 5 шт.	82
6.9 Инструкция по эксплуатации	83
II. Принадлежности:	84
1. Резиновая пробка, розовая (порошок для поддесневой чистки).	84
2. Форсунка.....	85
3. Адаптер для очистки PROPHYflex 4, длинный.	86
4. Крышка для очистки PROPHYflex 4.....	87
5. Адаптер для очистки PROPHYflex 4.....	88
6. Адаптер для очистки PROPHYflex 4S.	89
Макет этикетки для поставок в РФ	90
Приложение	91

Наконечники торговой марки «KAVO» стоматологические воздушные порошкоструйные, с принадлежностями:

I. Варианты исполнения:

1. Наконечник торговой марки «KAVO» стоматологический воздушный порошкоструйный PROPHYflex 4, Wave (синий) в составе:

1.1. Наконечник торговой марки «KAVO» стоматологический воздушный порошкоструйный PROPHYflex 4, Wave (синий) в составе:




1.1.1 Наконечник PROPHYflex 4, Wave (синий) – 1 шт.



1.1.2 Вмонтируемая длинная втулка – не более 100 шт. (при необходимости)



1.1.3. Канюля – не более 100 шт. (при необходимости)

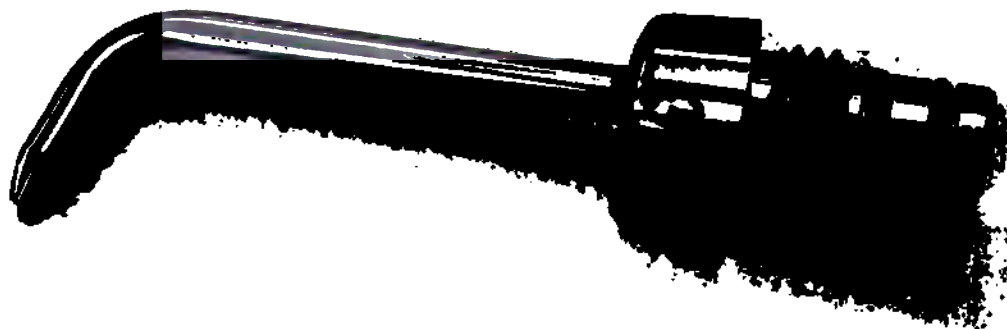

1.1.4 Емкость для порошка – не более 100 шт. (при необходимости)



1.2 Короткая удерживающая втулка с канюлей – не более 100 шт. (при необходимости)




1.3 Емкость для порошка с резиновой зеленой пробкой – не более 100 шт. (при необходимости)



1.4 Чистящий бор – не более 100 шт. (при необходимости).



1.5 Игла для прочистки форсунок – не более 100 шт. (при необходимости)

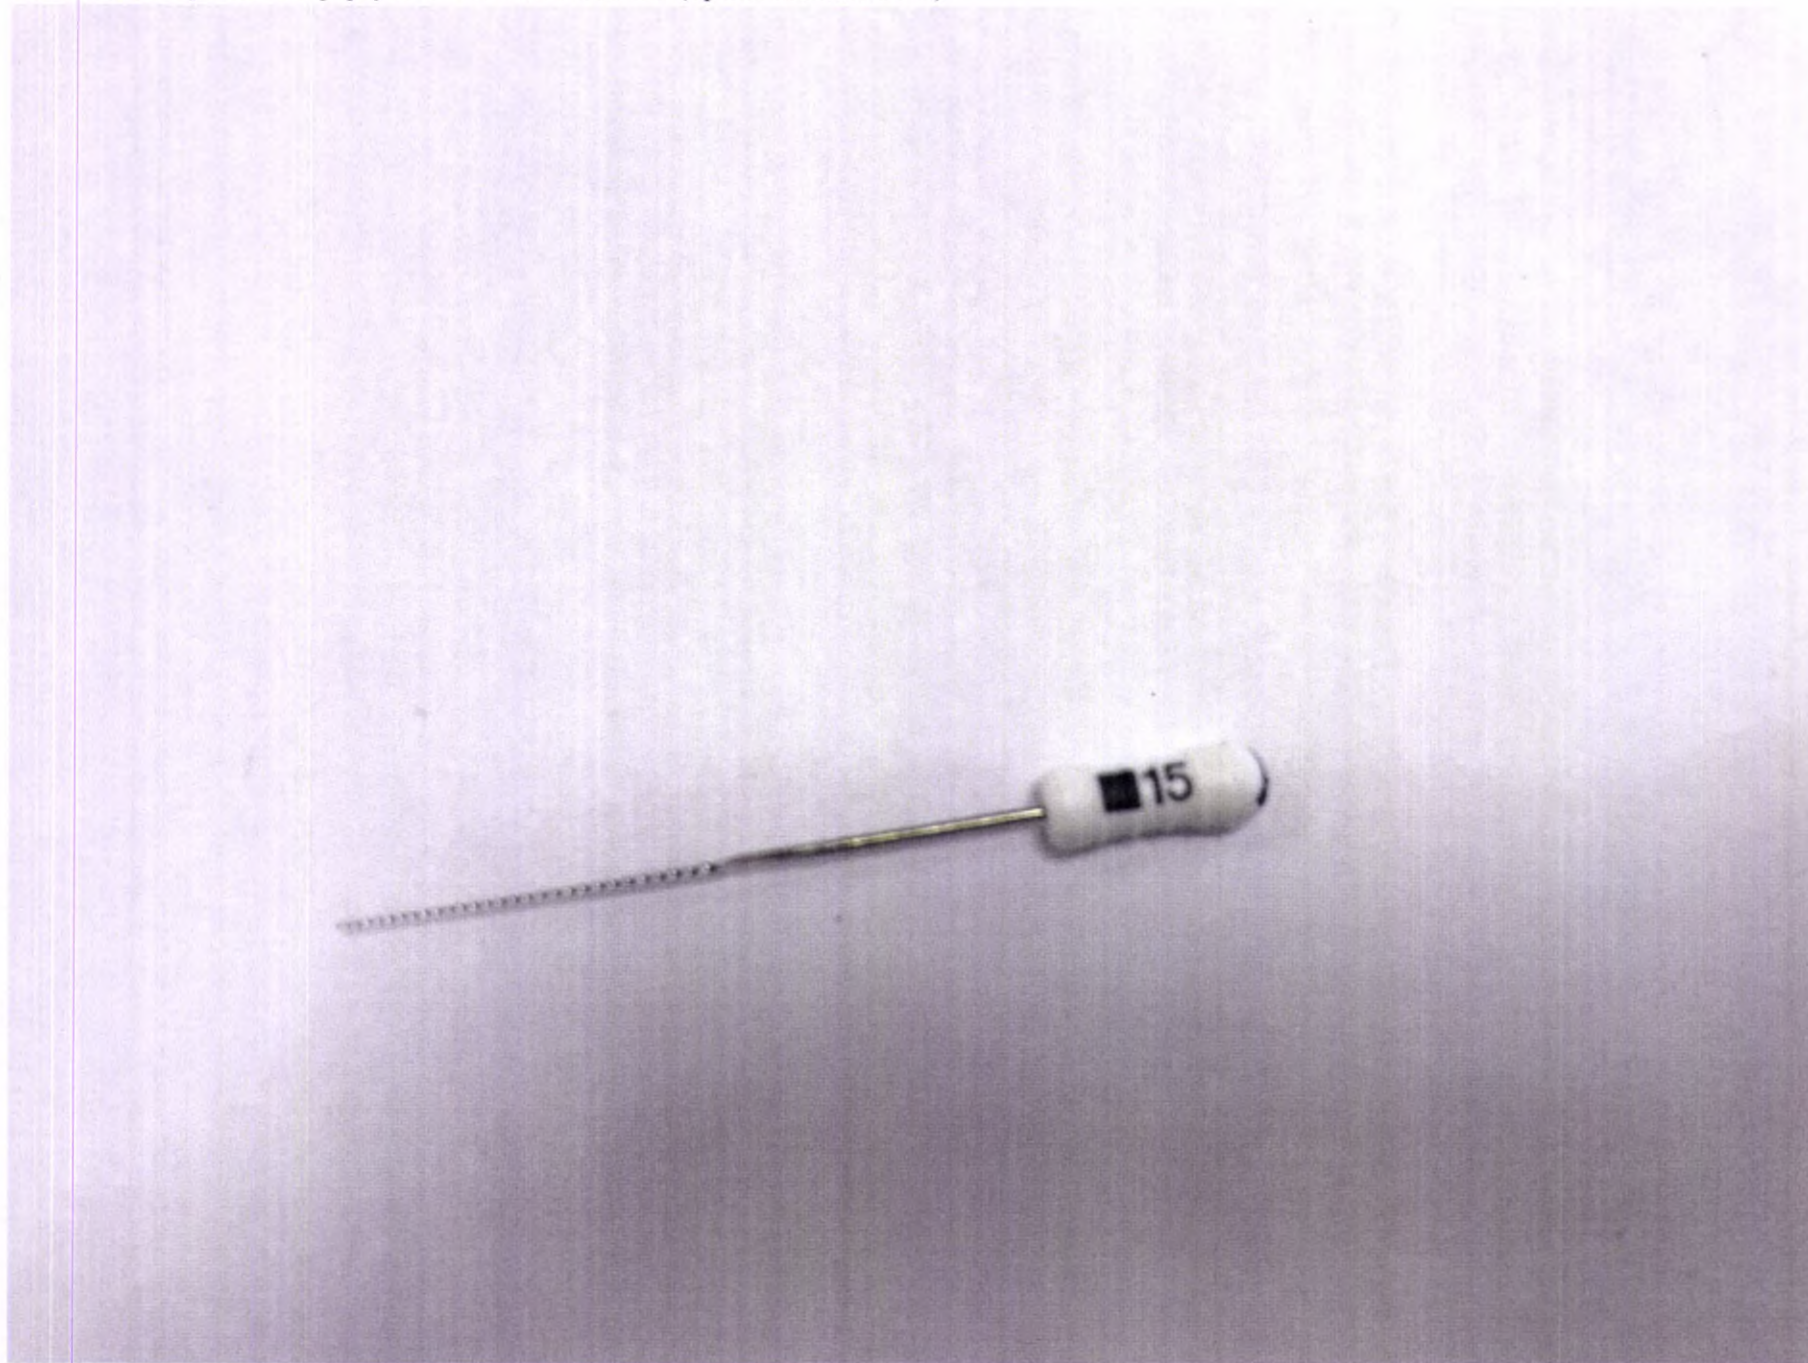

1.6. Ключ для канюли - не более 100 шт. (при необходимости).



1.7 Канюля POWER – не более 100 шт. (при необходимости).



1.8 Уплотнительные кольца – 5 шт.



Инструкция по эксплуатации PROPHYflex 4



KAVO
Dental Excellence

2. Наконечник торговой марки "KAVO" стоматологический воздушный порошкоструйный PROPHYflex 4, Lime (желто-зеленый), в составе:



de Vor Anwendung des KAVO-Produktes muss die Gebrauchsanweisung gelesen werden. Sie kann im Internet unter www.kavo.com/download heruntergeladen oder per Telefon bestellt werden.


2.1. Наконечник торговой марки "KAVO" стоматологический воздушный порошкоструйный PROPHYflex 4, Lime (желто-зеленый), в составе:
2.1.1. Наконечник PROPHYflex 4, Lime (желто-зеленый) -1 шт



2.1.2 Вмонтируемая длинная втулка – не более 100 шт. (при необходимости).



2.1.3 Канюля – не более 100 шт. (при необходимости)

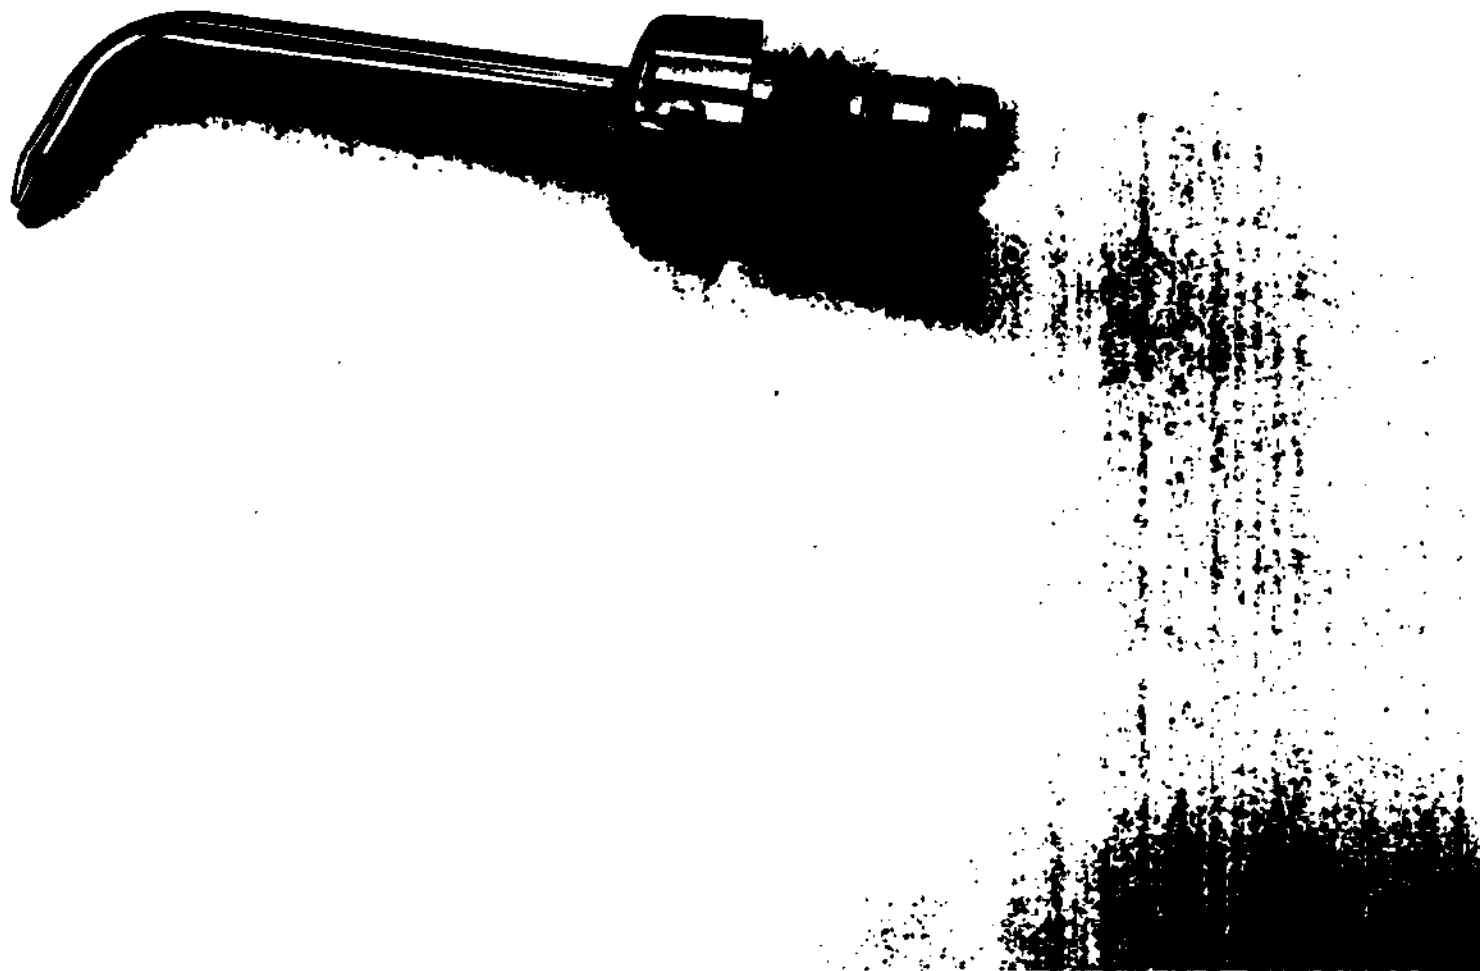

2.1.4 Емкость для порошка – не более 100 шт. (при необходимости)




2.2 Короткая удерживающая втулка с канюлей – не более 100 шт. (при необходимости)




2.3 Емкость для порошка с резиновой зеленой пробкой – не более 100 шт. (при необходимости)



2.4 Чистящий бор – не более 100 шт. (при необходимости.).

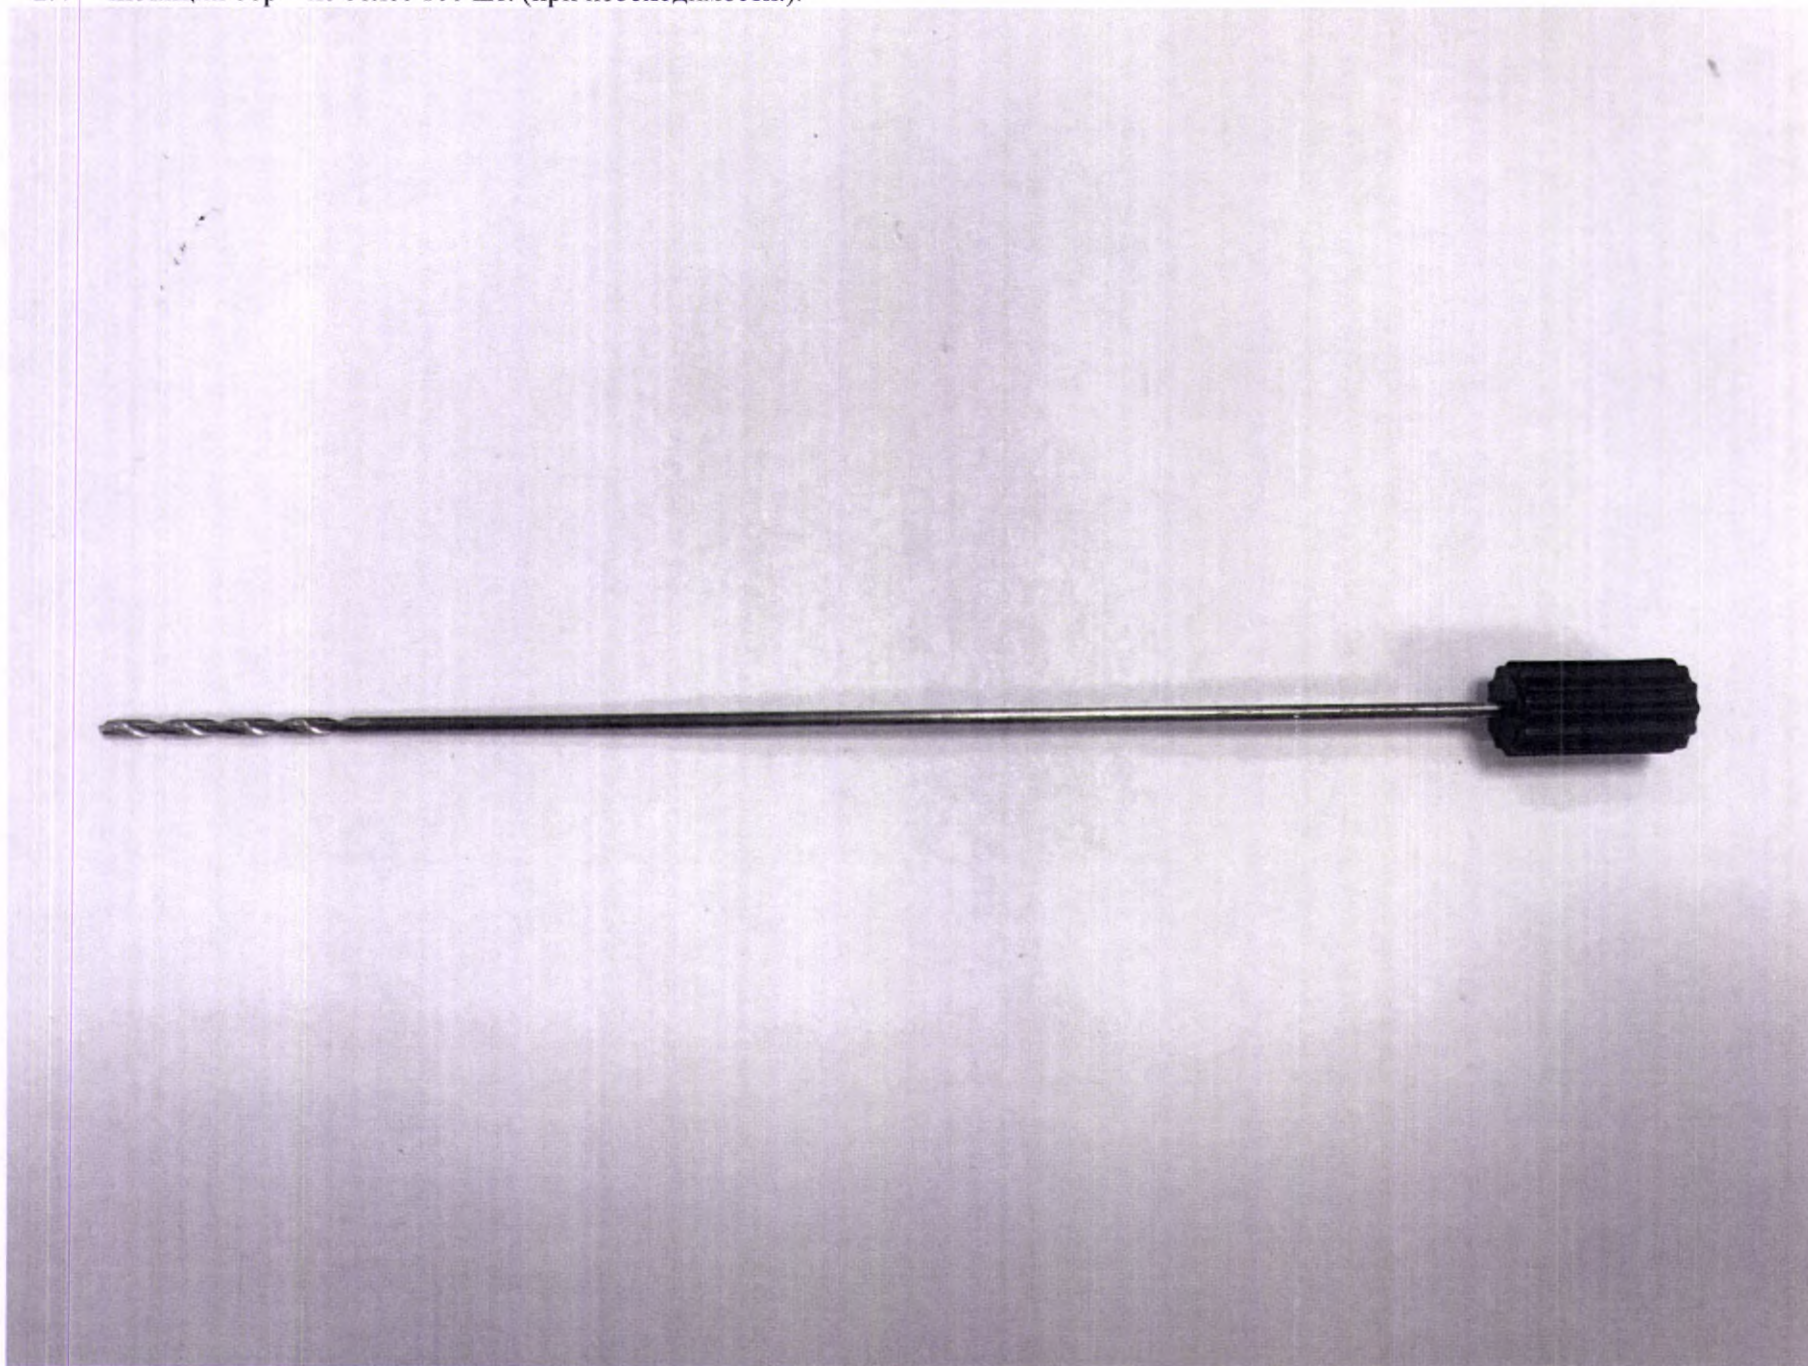

2.5 Игла для прочистки форсунок – не более 100 шт. (при необходимости).

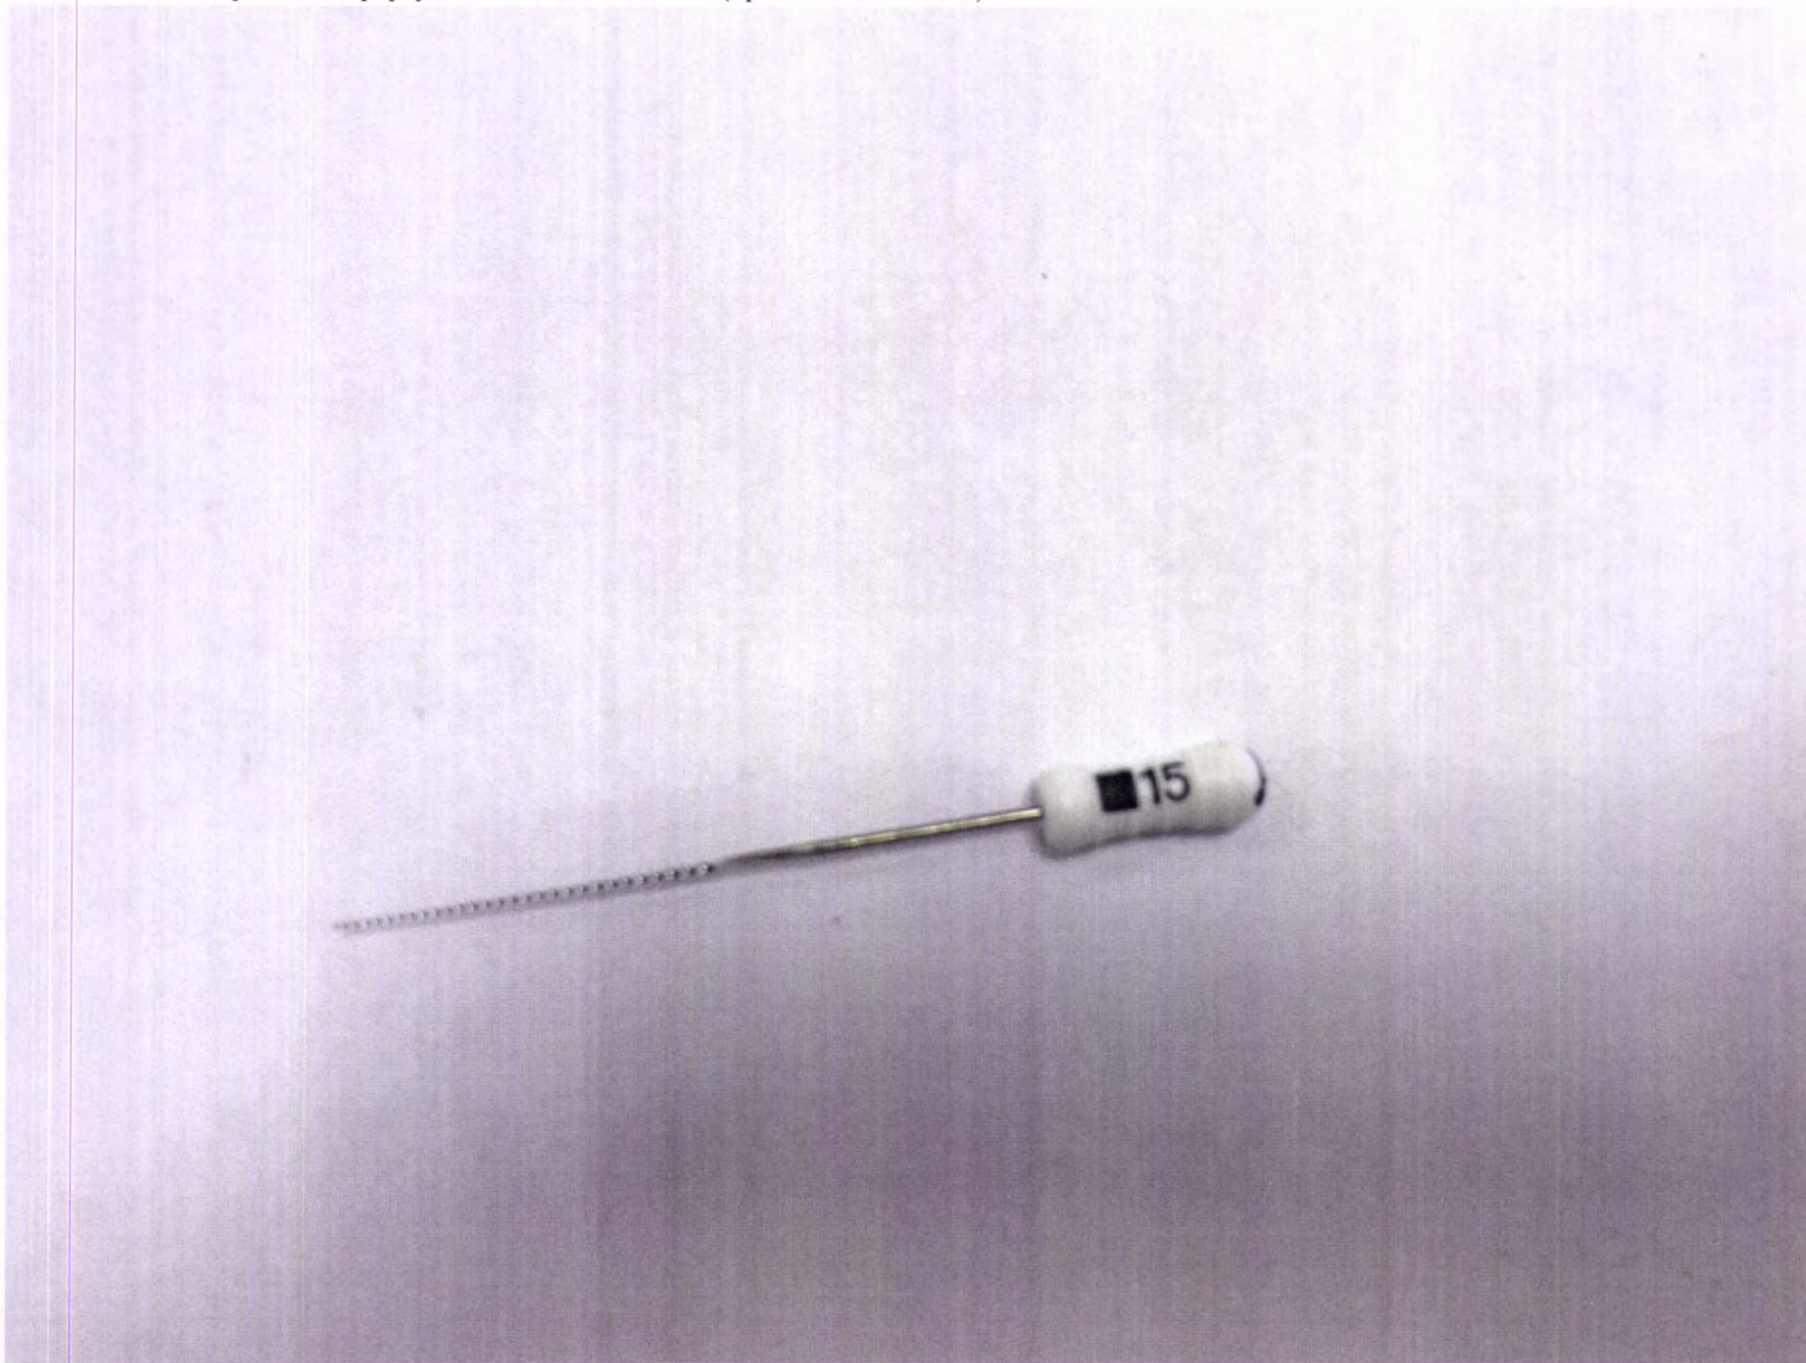

2.6 Ключ для канюли - не более 100 шт. (при необходимости)



2.7 Канюля POWER – не более 100 шт. (при необходимости).



2.8 Уплотнительные кольца – 5 шт.



Инструкция по эксплуатации
PROPHYflex 4



KAVO
Dental Excellence

3. Наконечник торговой марки «KAVO» стоматологический воздушный порошкоструйный PROPHYflex 4, Flamingo (розовый), в составе:
3.1. Наконечник торговой марки «KAVO» стоматологический воздушный порошкоструйный PROPHYflex 4, Flamingo (розовый), в составе:



3.1.1. Наконечник PROPHYflex 4, Flamingo (розовый) -1 шт



3.1.2. Вмонтируемая длинная втулка - не более 100 шт. (при необходимости)



3.1.3. Канюля - не более 100 шт. (при необходимости)




3.1.4. Емкость для порошка - не более 100 шт. (при необходимости)




3.2 Короткая удерживающая втулка с канюлей - не более 100 шт. (при необходимости).




3.3 Емкость для порошка с резиновой зеленой пробкой – не более 100 шт. (при необходимости)

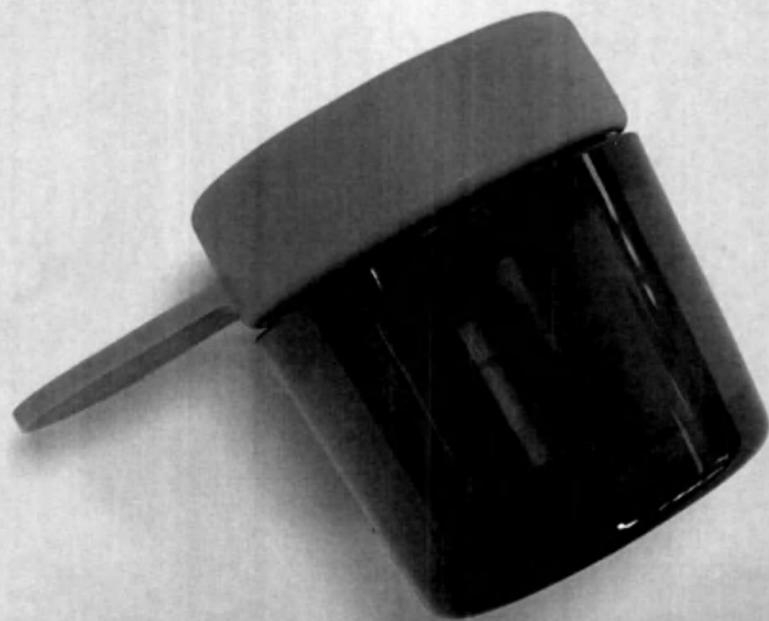

3.4 Чистящий бор - не более 100 шт. (при необходимости).

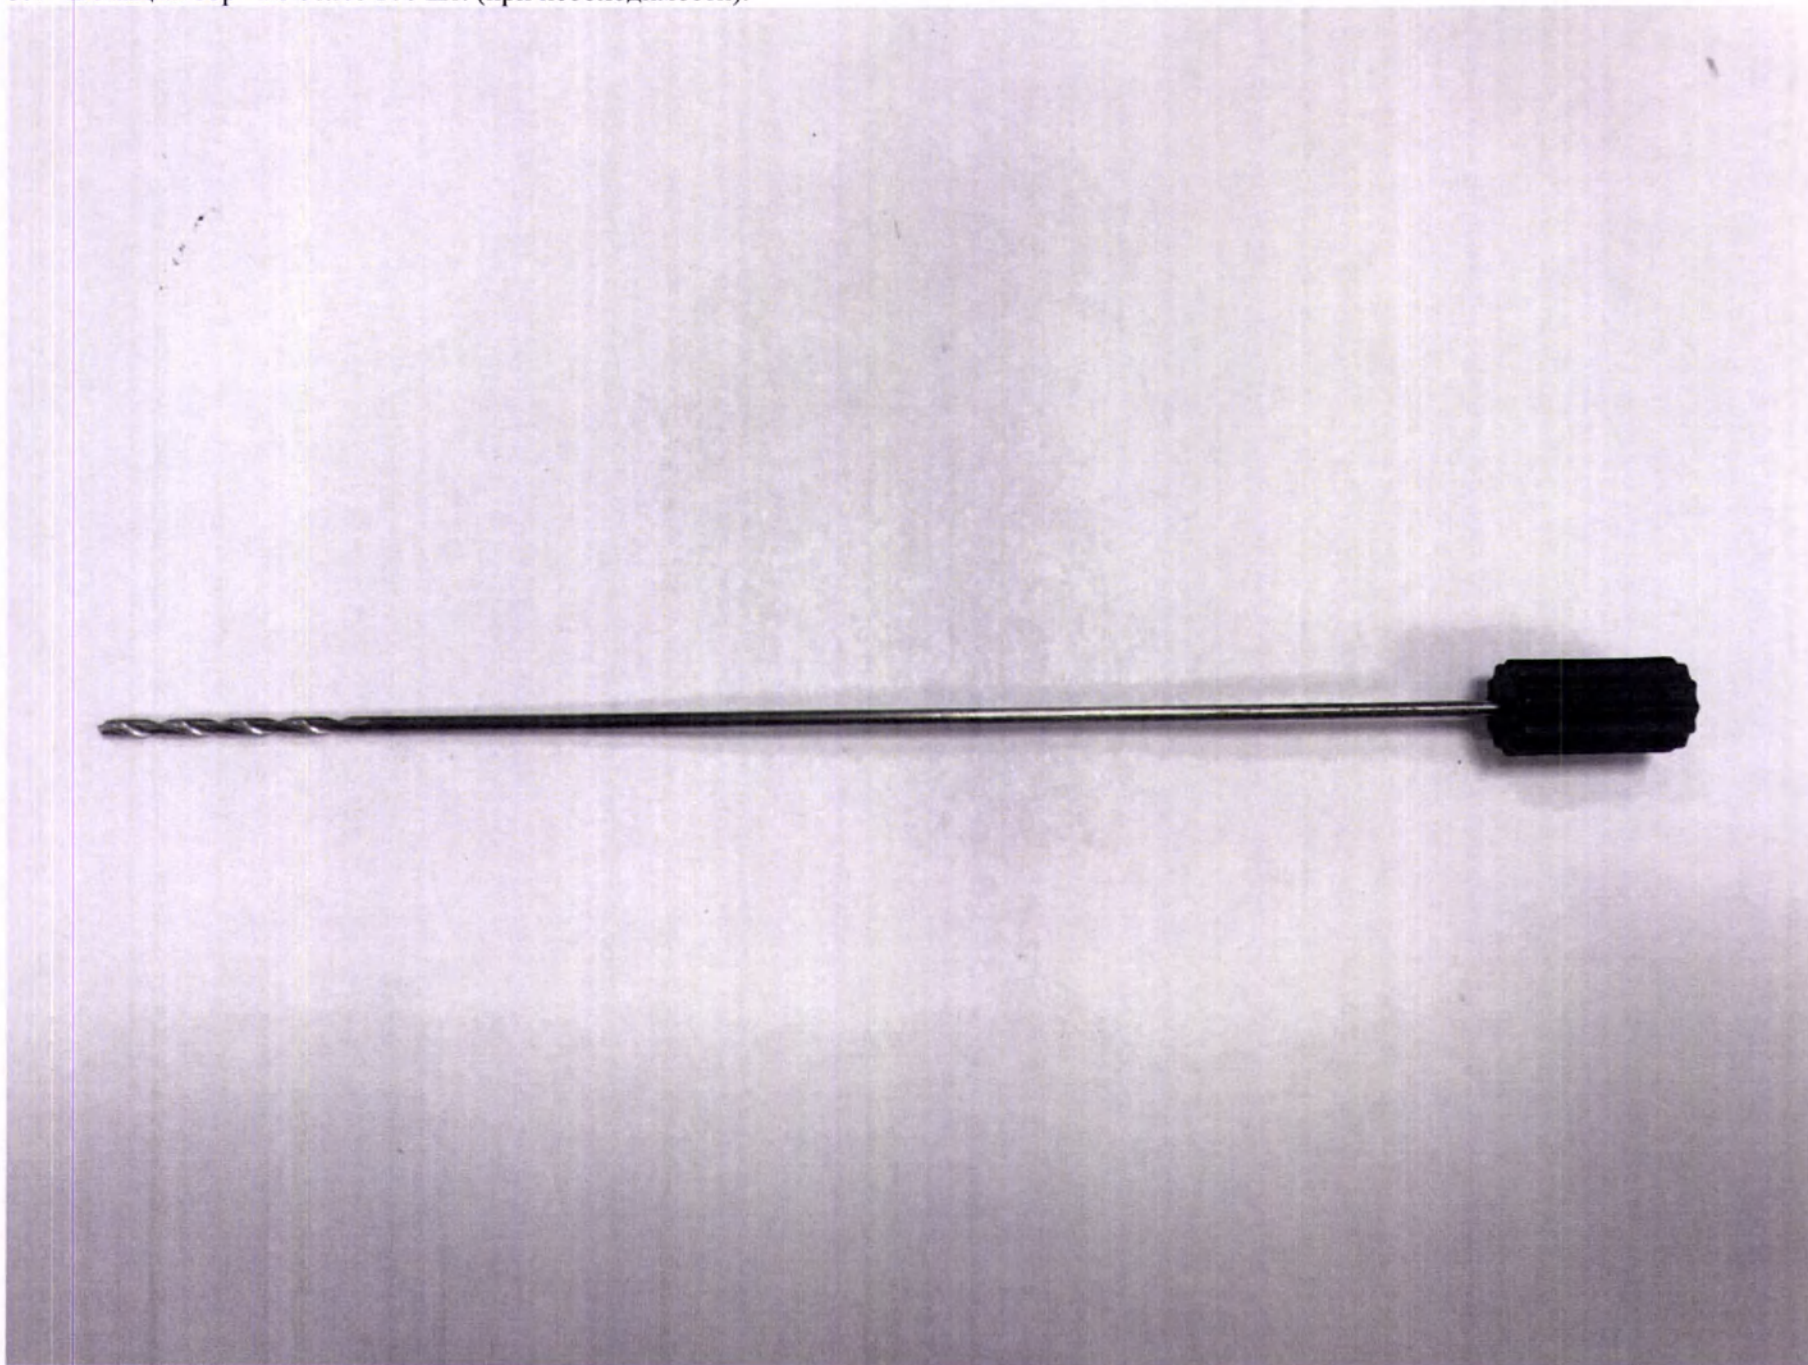


3.5 Игла для прочистки форсунок – не более 100 шт. (при необходимости).

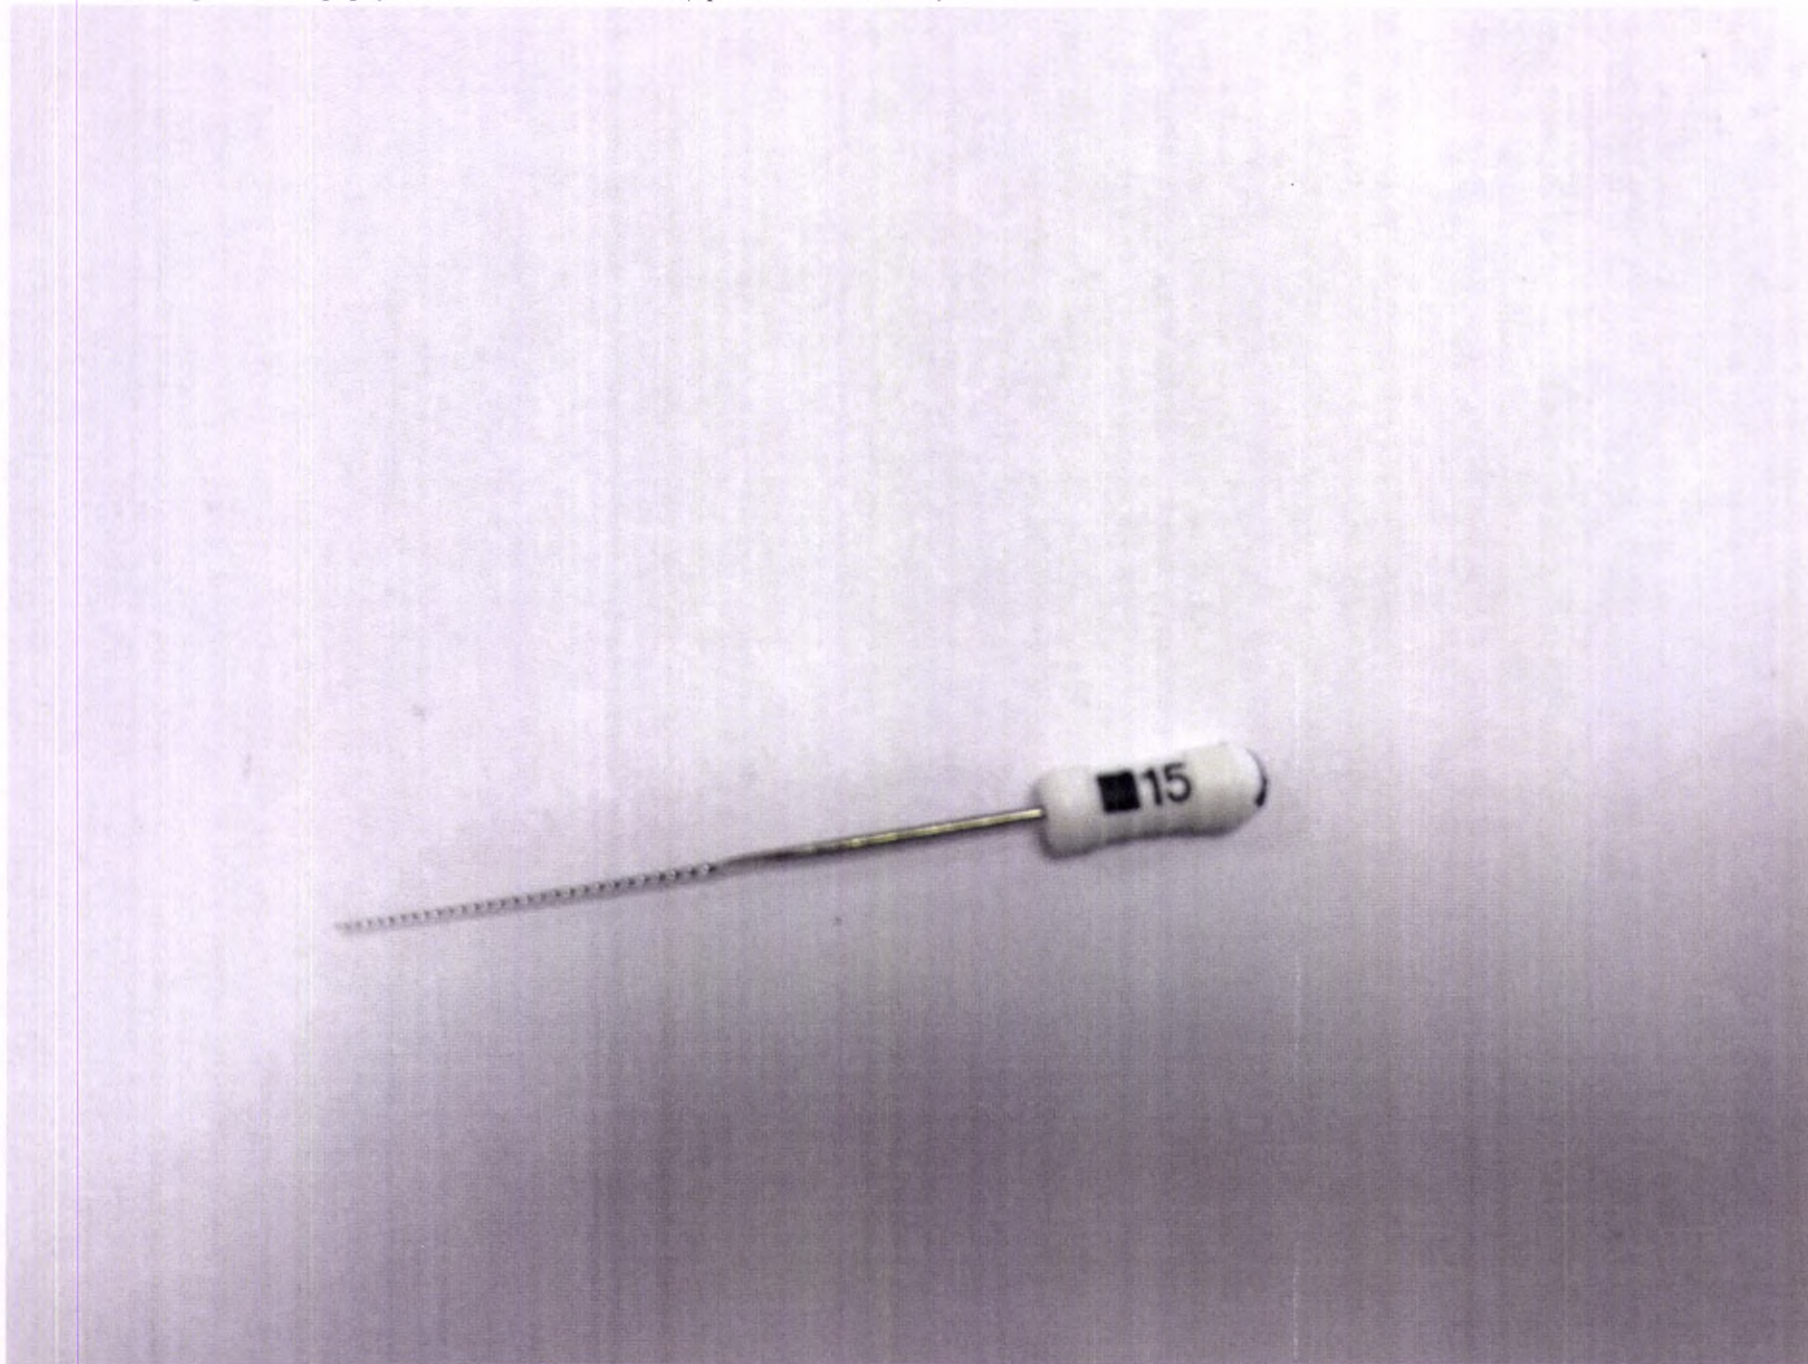

3.6 Ключ для каниюли - не более 100 шт. (при необходимости).



3.7 Канюля POWER – не более 100 шт. (при необходимости).

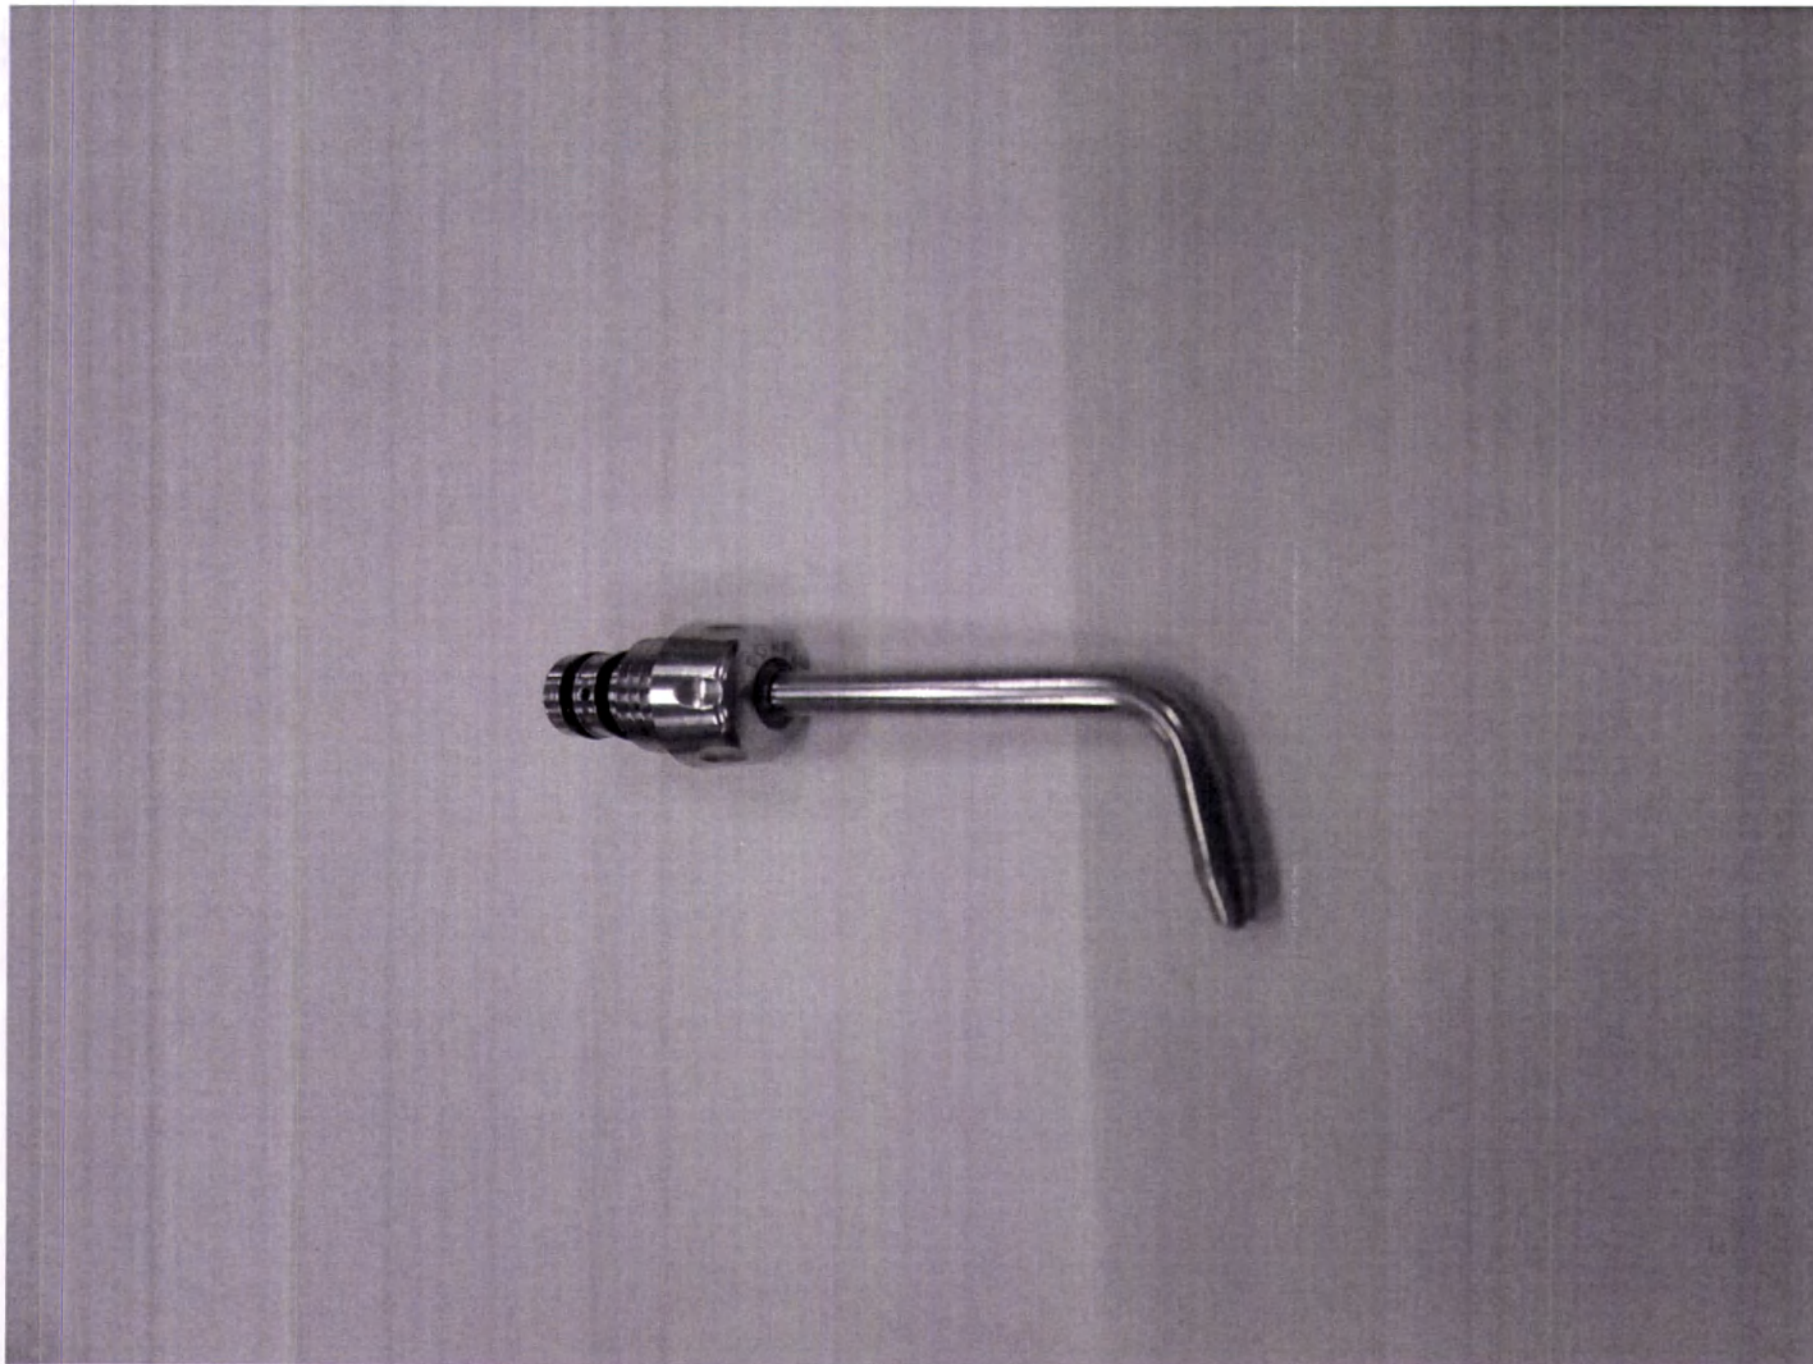

3.8 Уплотнительные кольца – 5 шт.



Инструкция по эксплуатации PROPHYflex 4



KAVO
Dental Excellence

4. Наконечник торговой марки «KAVO» стоматологический воздушный порошкоструйный PROPHYflex 4 S, Wave (синий) в составе:




4.1. Наконечник торговой марки "KAVO" стоматологический воздушный порошкоструйный PROPHYflex 4 S, Wave (синий), в составе:
4.1.1. Наконечник PROPHYflex 4 S, Wave (синий) - 1 шт.



4.1.2. Вмонтируемая длинная втулка - не более 100 шт. (при необходимости).




4.1.3. Канюля - не более 100 шт. (при необходимости)

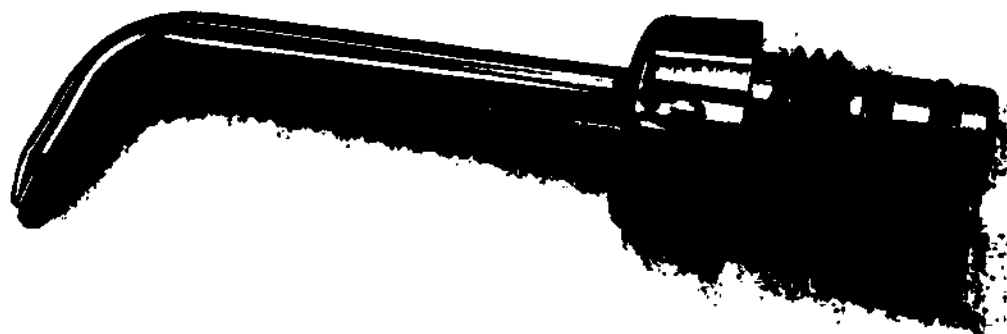


4.1.4. Емкость для порошка - не более 100 шт. (при необходимости)



4.2 Короткая удерживающая втулка с канюлей - не более 100 шт. (при необходимости).

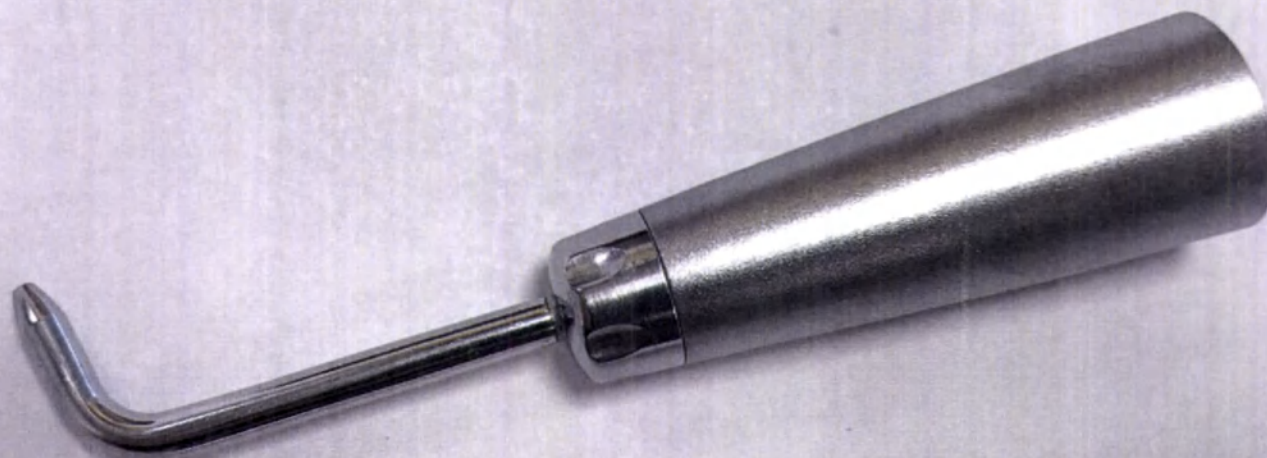


4.3 Емкость для порошка с резиновой зеленой пробкой – не более 100 шт. (при необходимости)

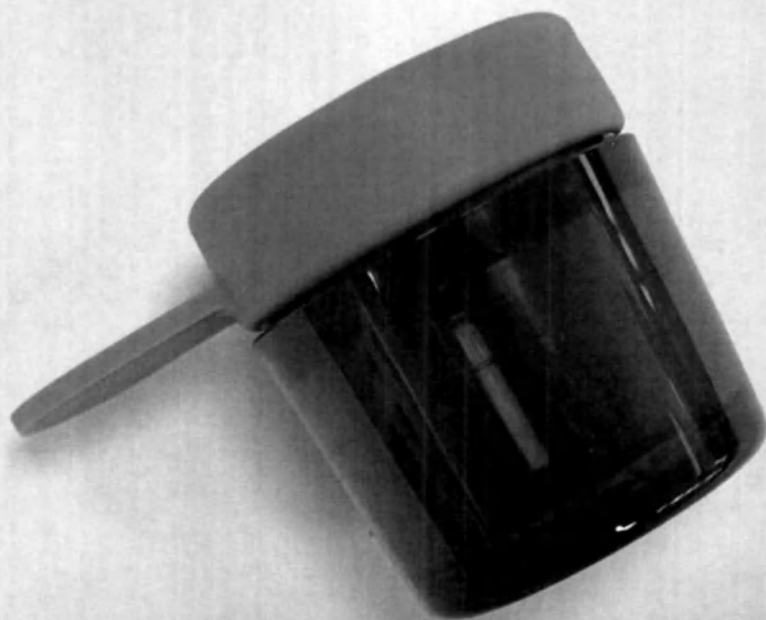

4.4 Чистящий бор – не более 100 шт. (при необходимости).



4.5 Игла для прочистки форсунок – не более 100 шт. (при необходимости).

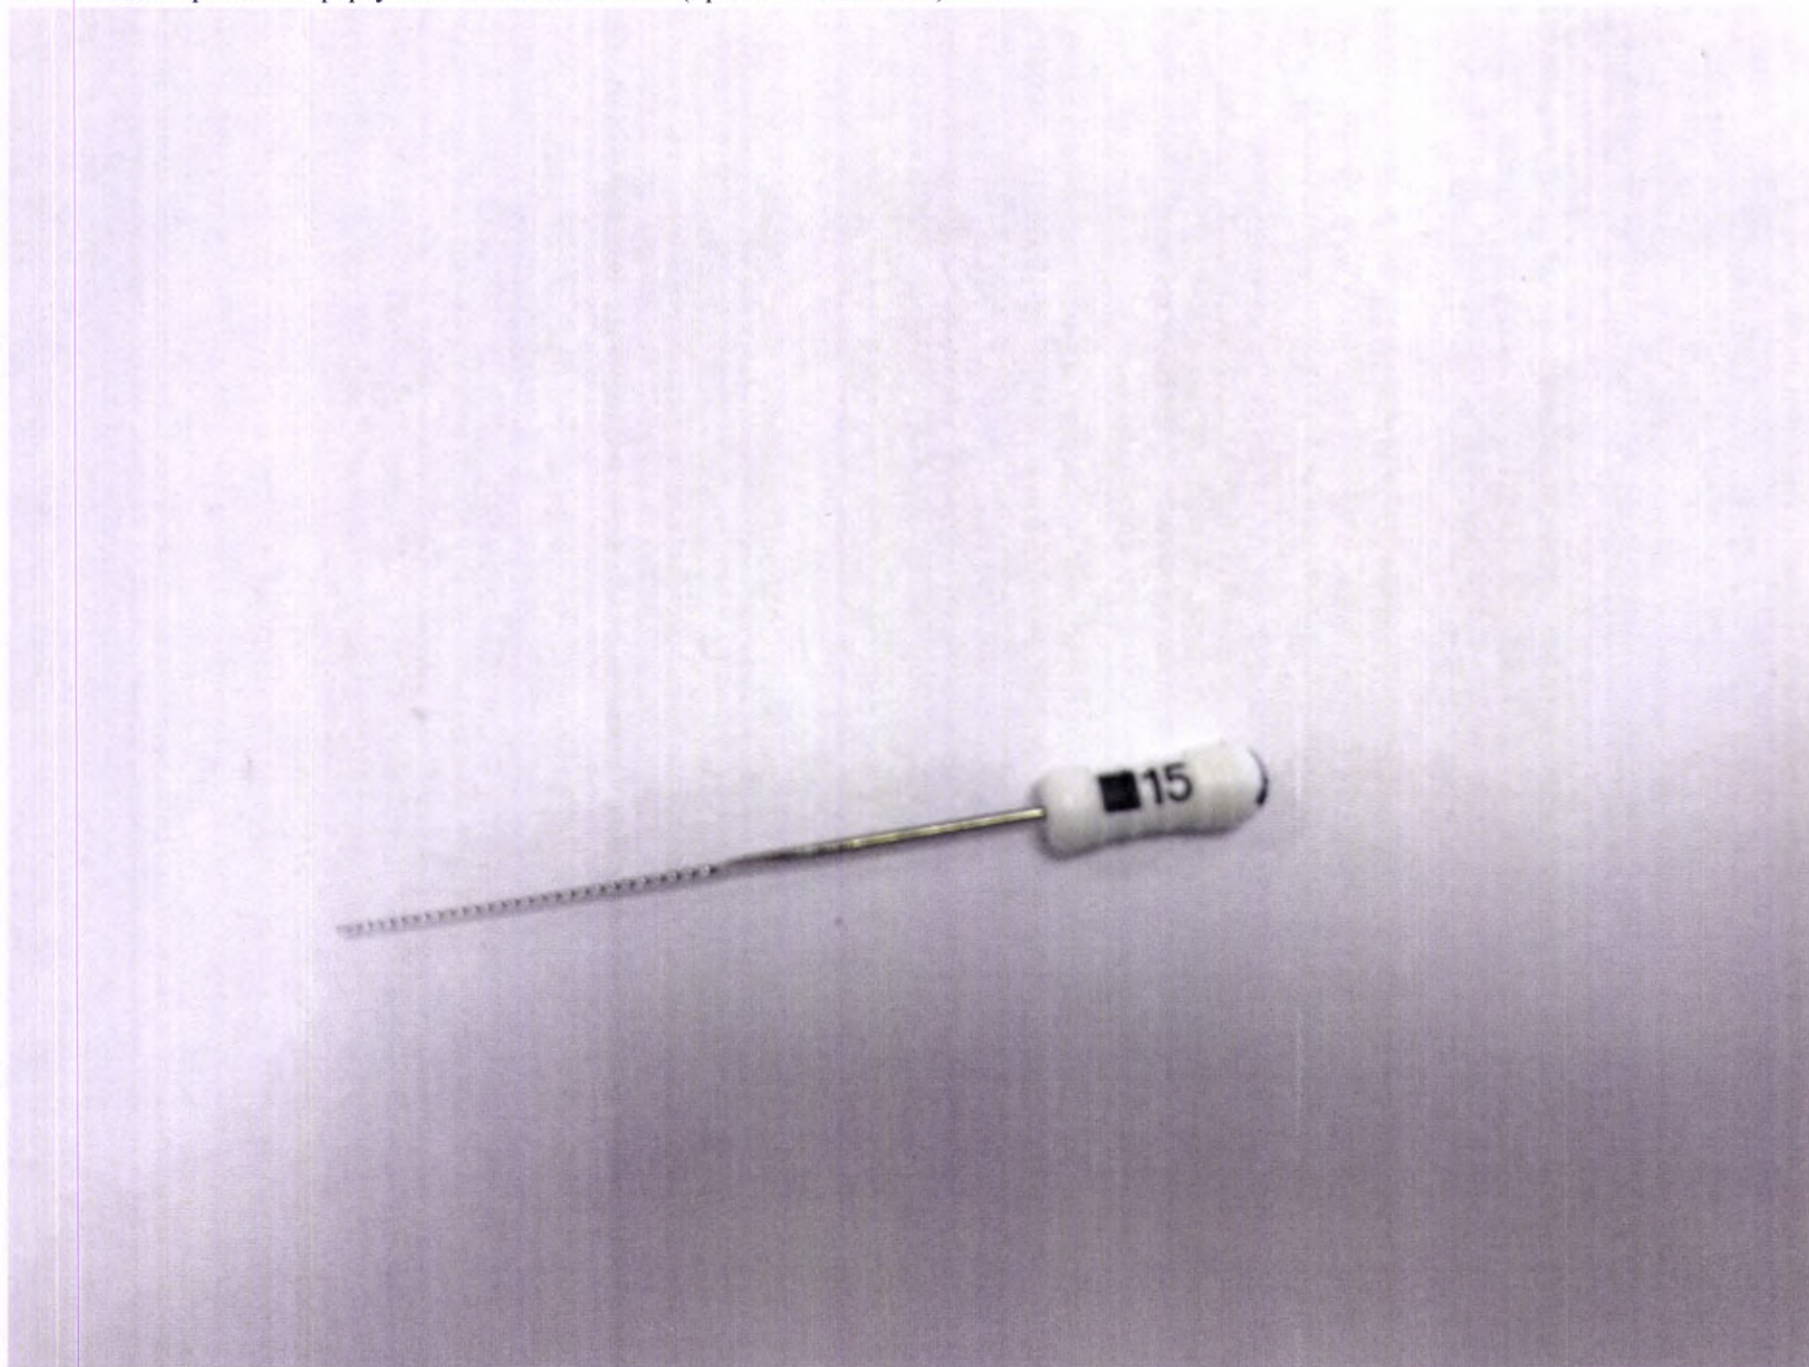

4.6 Ключ для канюли - не более 100 шт. (при необходимости)



4.7 Канюля POWER – не более 100 шт. (при необходимости).





Инструкция по эксплуатации

PROPHYflex 4



KAVO
Dental Excellence

5. Наконечник торговой марки «KAVO» стоматологический воздушный порошкоструйный PROPHYflex 4 S, Lime (желто-зеленый) в составе:

5.1. Наконечник торговой марки "KAVO" стоматологический воздушный порошкоструйный PROPHYflex 4 S, Lime (желто-зеленый), в составе:




5.1.1. Наконечник PROPHYflex 4 S, Lime (желто-зеленый) -1 шт.



5.1.2. Вмонтируемая длинная втулка - не более 100 шт. (при необходимости)



5.1.3. Канюля - не более 100 шт. (при необходимости).

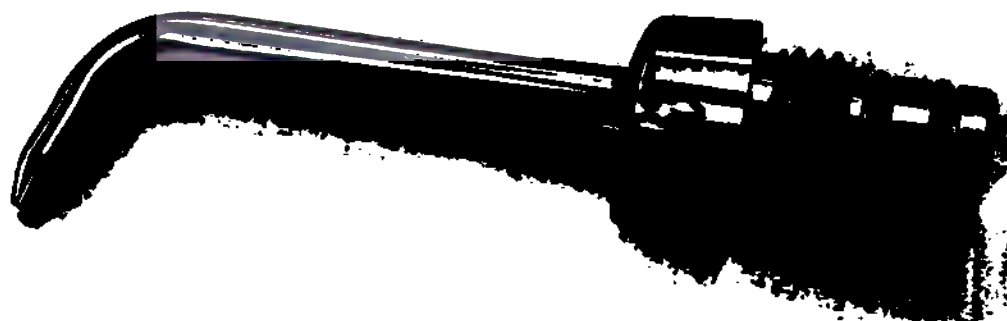

5.1.4. Емкость для порошка - не более 100 шт. (при необходимости)



5.2 Короткая удерживающая втулка с канюлей - не более 100 шт. (при необходимости).




5.3 Емкость для порошка с резиновой зеленой пробкой – не более 100 шт. (при необходимости)



5.4 Чистящий бор – не более 100 шт. (при необходимости).



5.5 Игла для прочистки форсунок – не более 100 шт. (при необходимости).

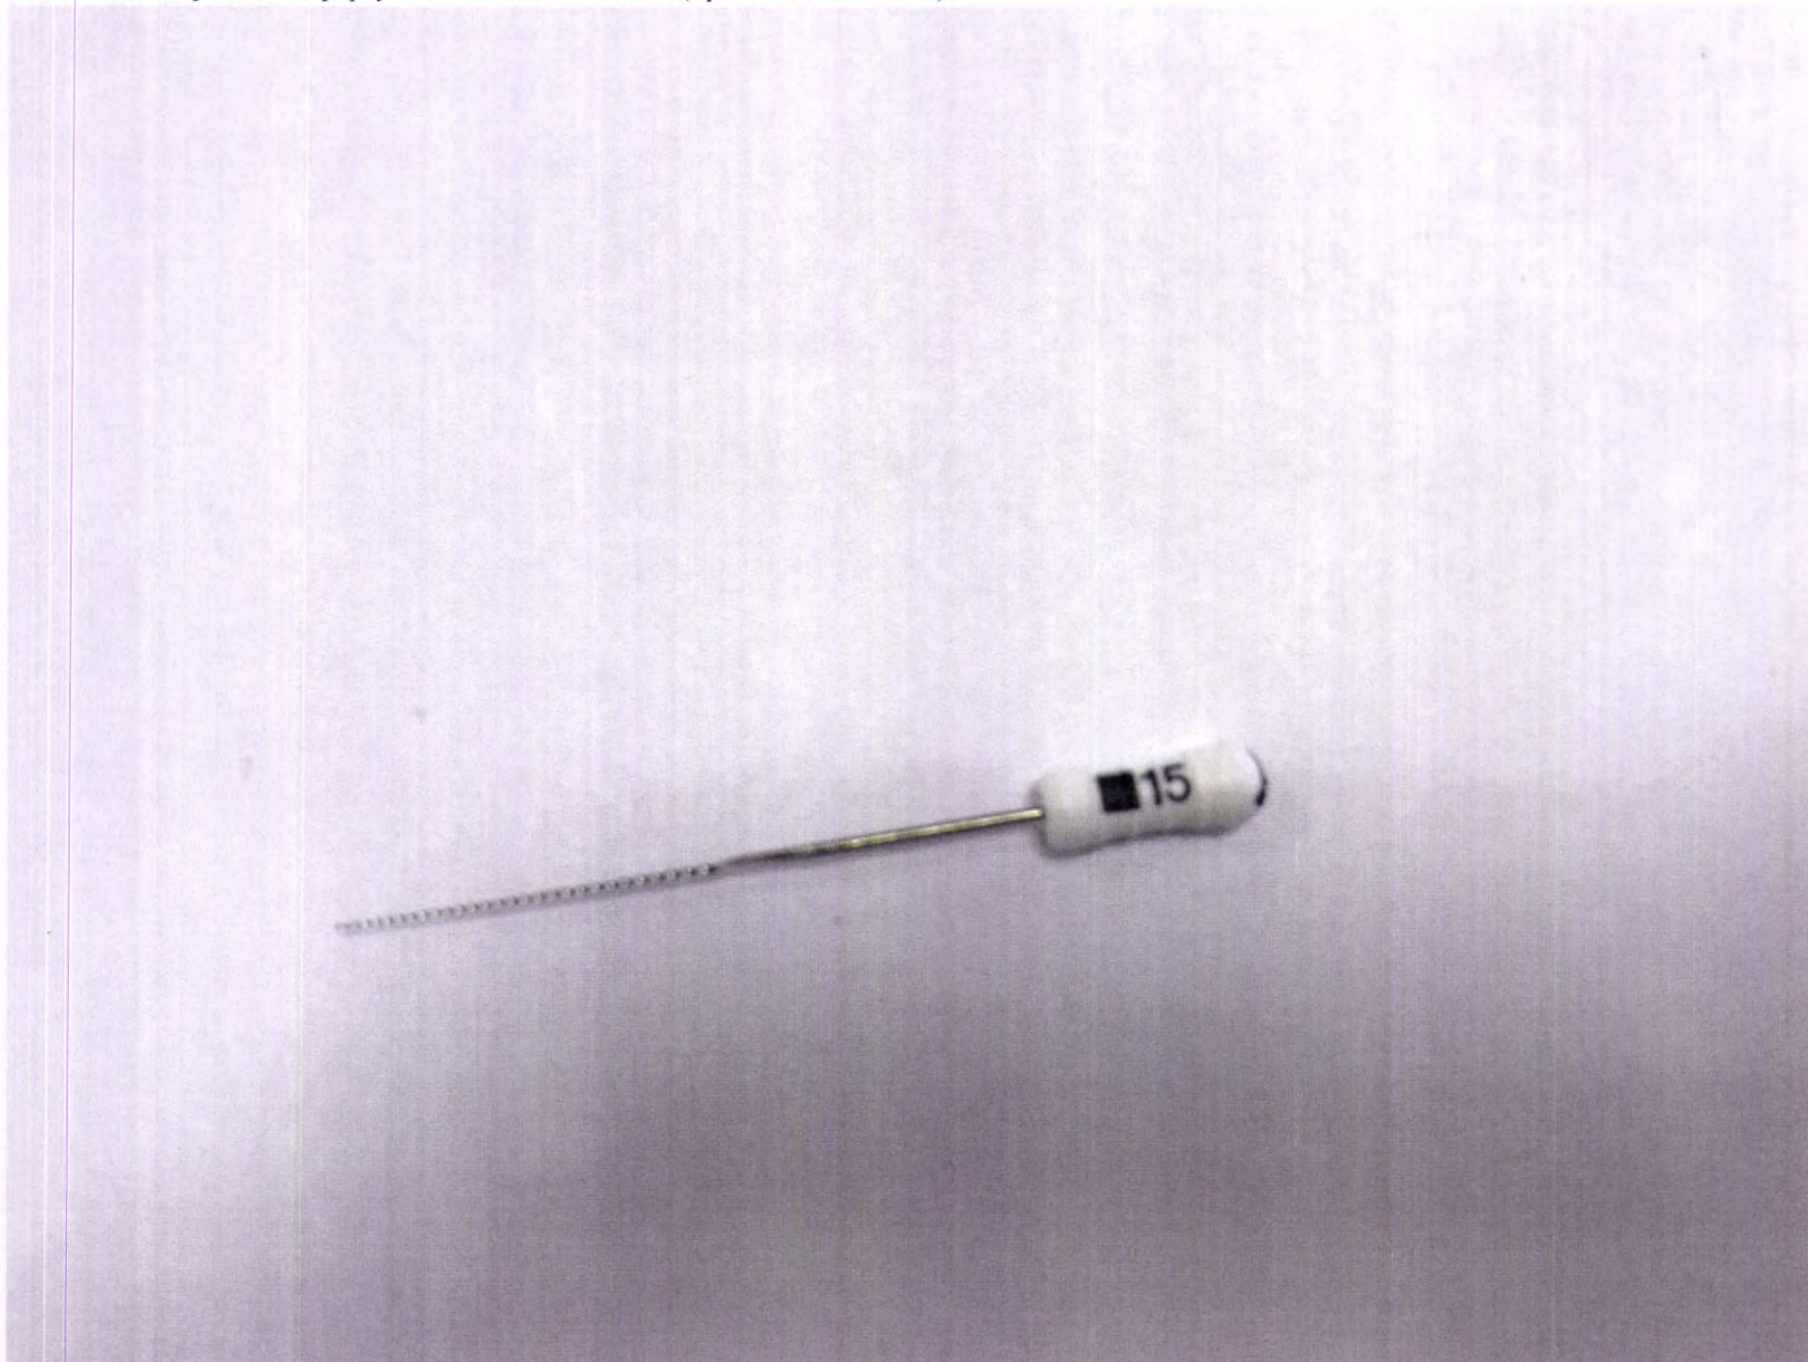

5.6 Ключ для канюли - не более 100 шт. (при необходимости).



5.7 Канюля POWER – не более 100 шт. (при необходимости).



5.8 Уплотнительные кольца – 5 шт.



Инструкция по эксплуатации

PROPHYflex 4



KAVO
Dental Excellence


6. Наконечник торговой марки «KAVO» стоматологический воздушный порошкоструйный PROPHYflex 4 S, Flamingo (розовый) в составе:




6.1. Наконечник торговой марки "KAVO" стоматологический воздушный порошкоструйный PROPHYflex 4 S, Flamingo (розовый), в составе:
6.1.1. Наконечник PROPHYflex 4 S, Flamingo (розовый) - 1 шт.



6.1.2. Вмонтируемая длинная втулка - не более 100 шт. (при необходимости)

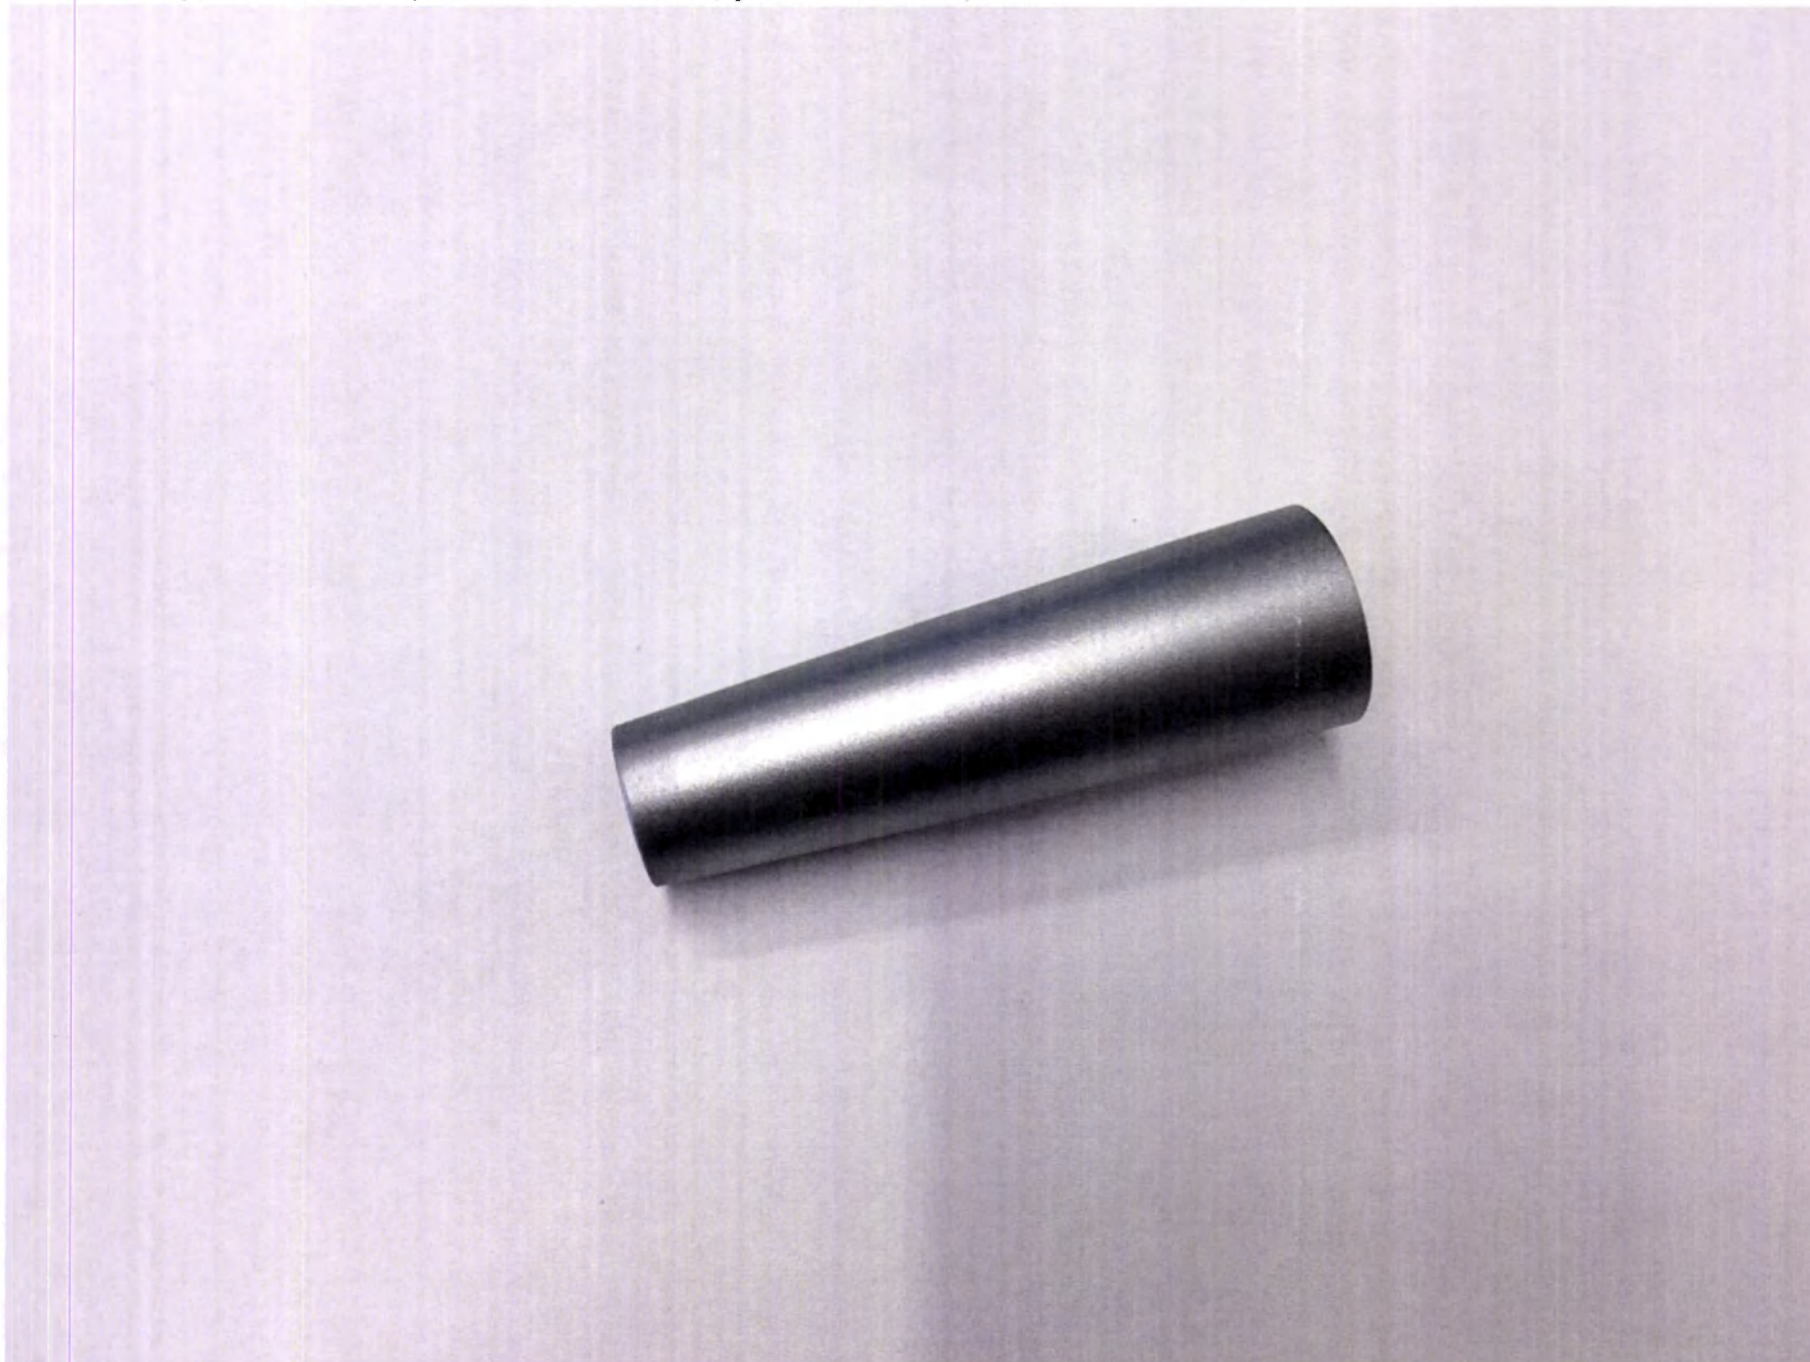


6.1.3. Канюля - не более 100 шт. (при необходимости)

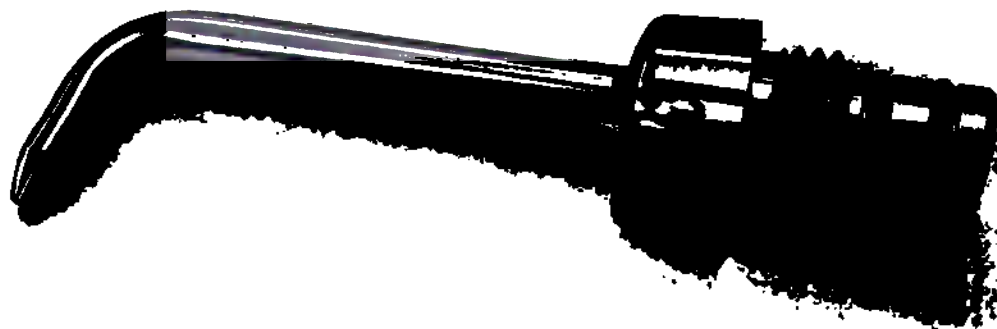

6.1.4. Емкость для порошка - не более 100 шт. (при необходимости)




6.2 Короткая удерживающая втулка с канюлей - не более 100 шт. (при необходимости)

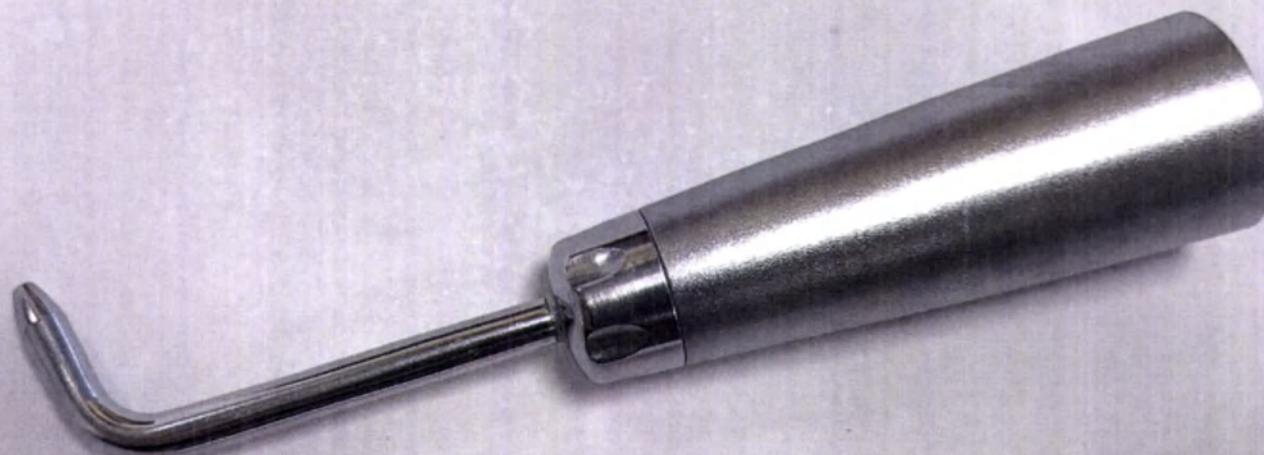


6.3 Емкость для порошка с резиновой зеленой пробкой – не более 100 шт. (при необходимости)



6.4 Чистящий бор – не более 100 шт. (при необходимости)

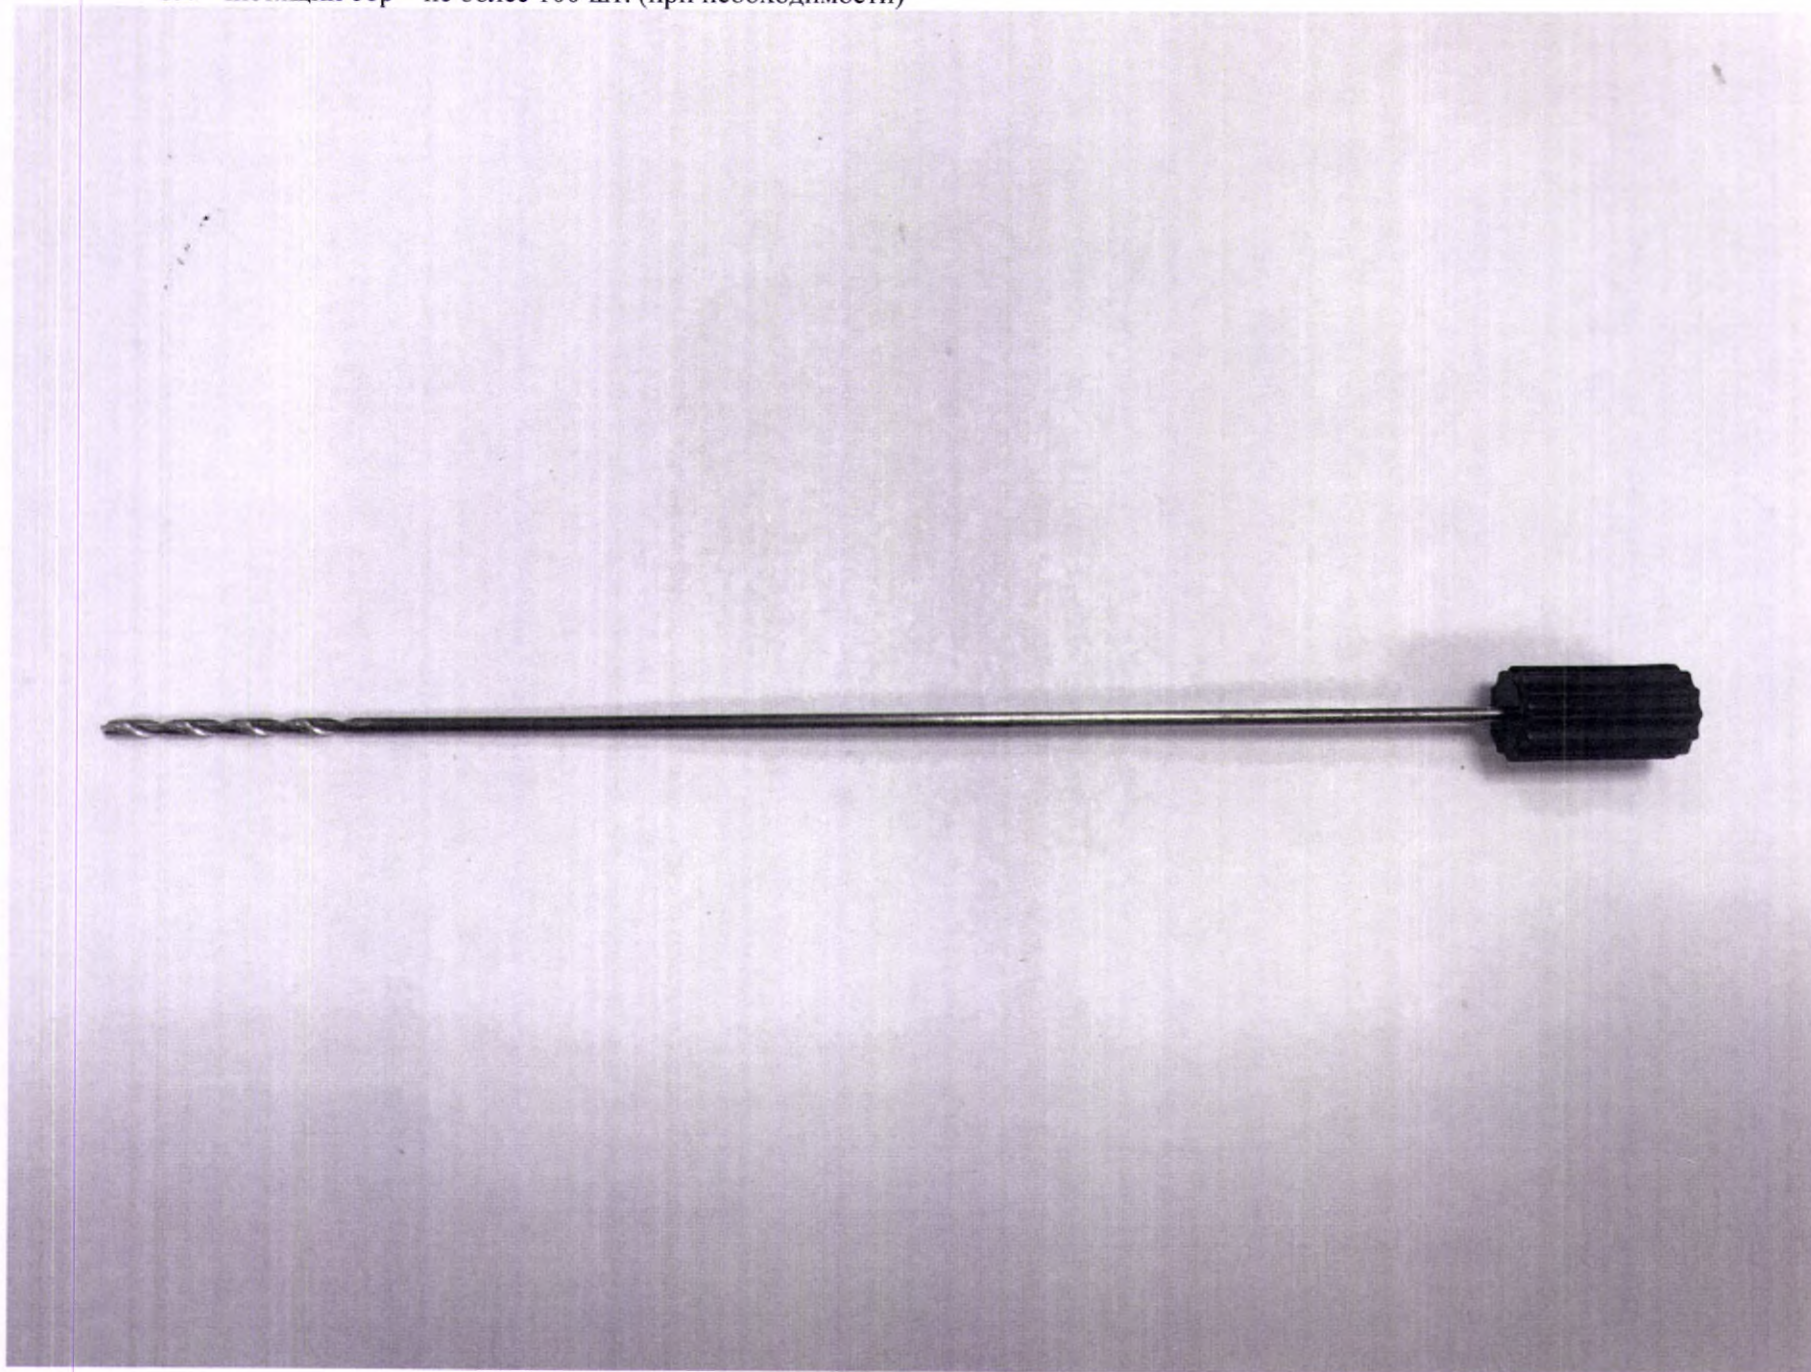

6.5 Игла для прочистки форсунок – не более 100 шт. (при необходимости)

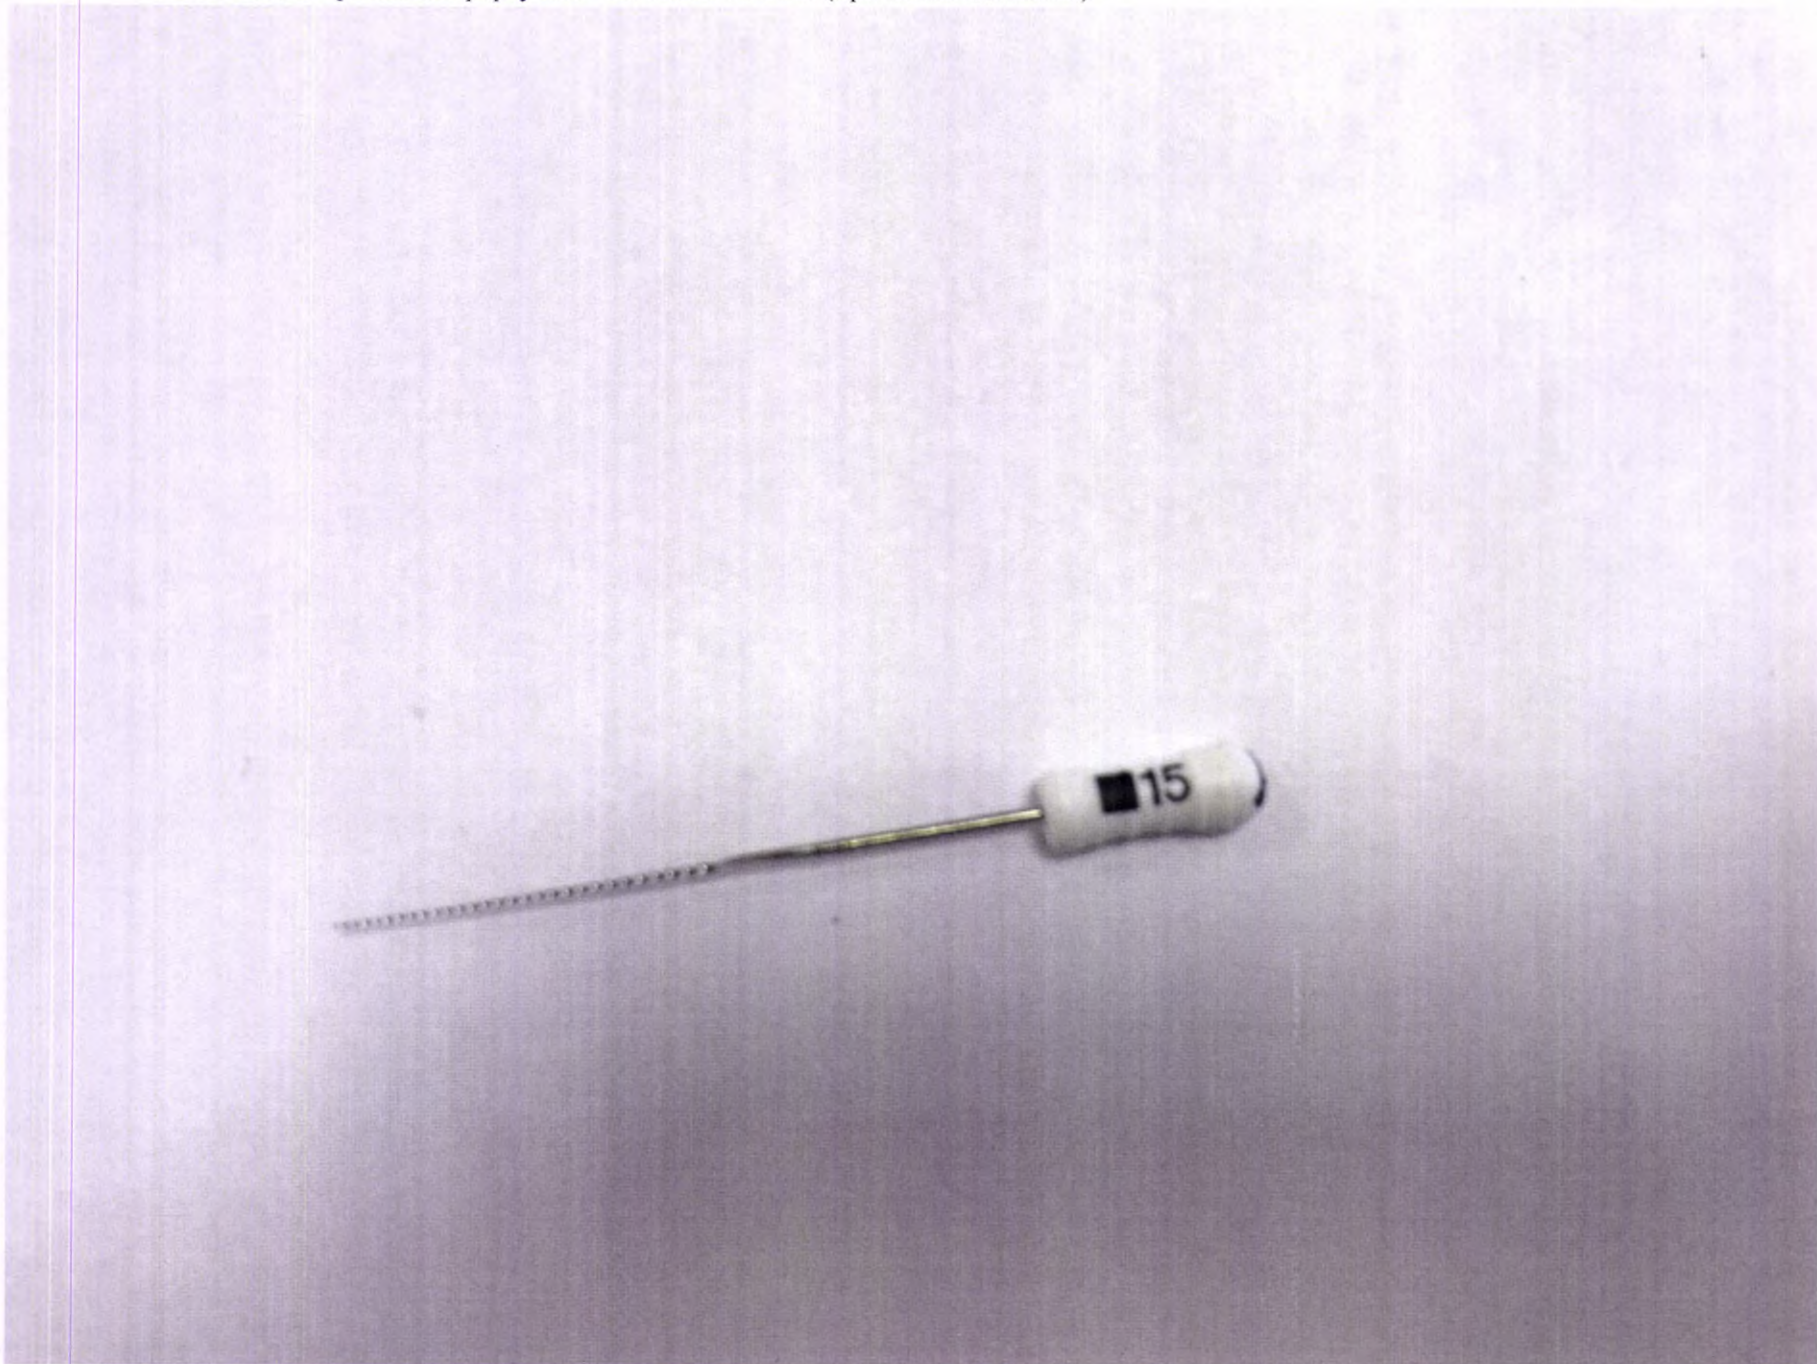

6.6 Ключ для канюли - не более 100 шт. (при необходимости)



6.7 Канюля POWER – не более 100 шт. (при необходимости).



6.8 Уплотнительные кольца – 5 шт.



Инструкция по эксплуатации


PROPHYflex 4



KAVO
Dental Excellence

II. Принадлежности:

1. Резиновая пробка, розовая (порошок для поддесневой чистки).

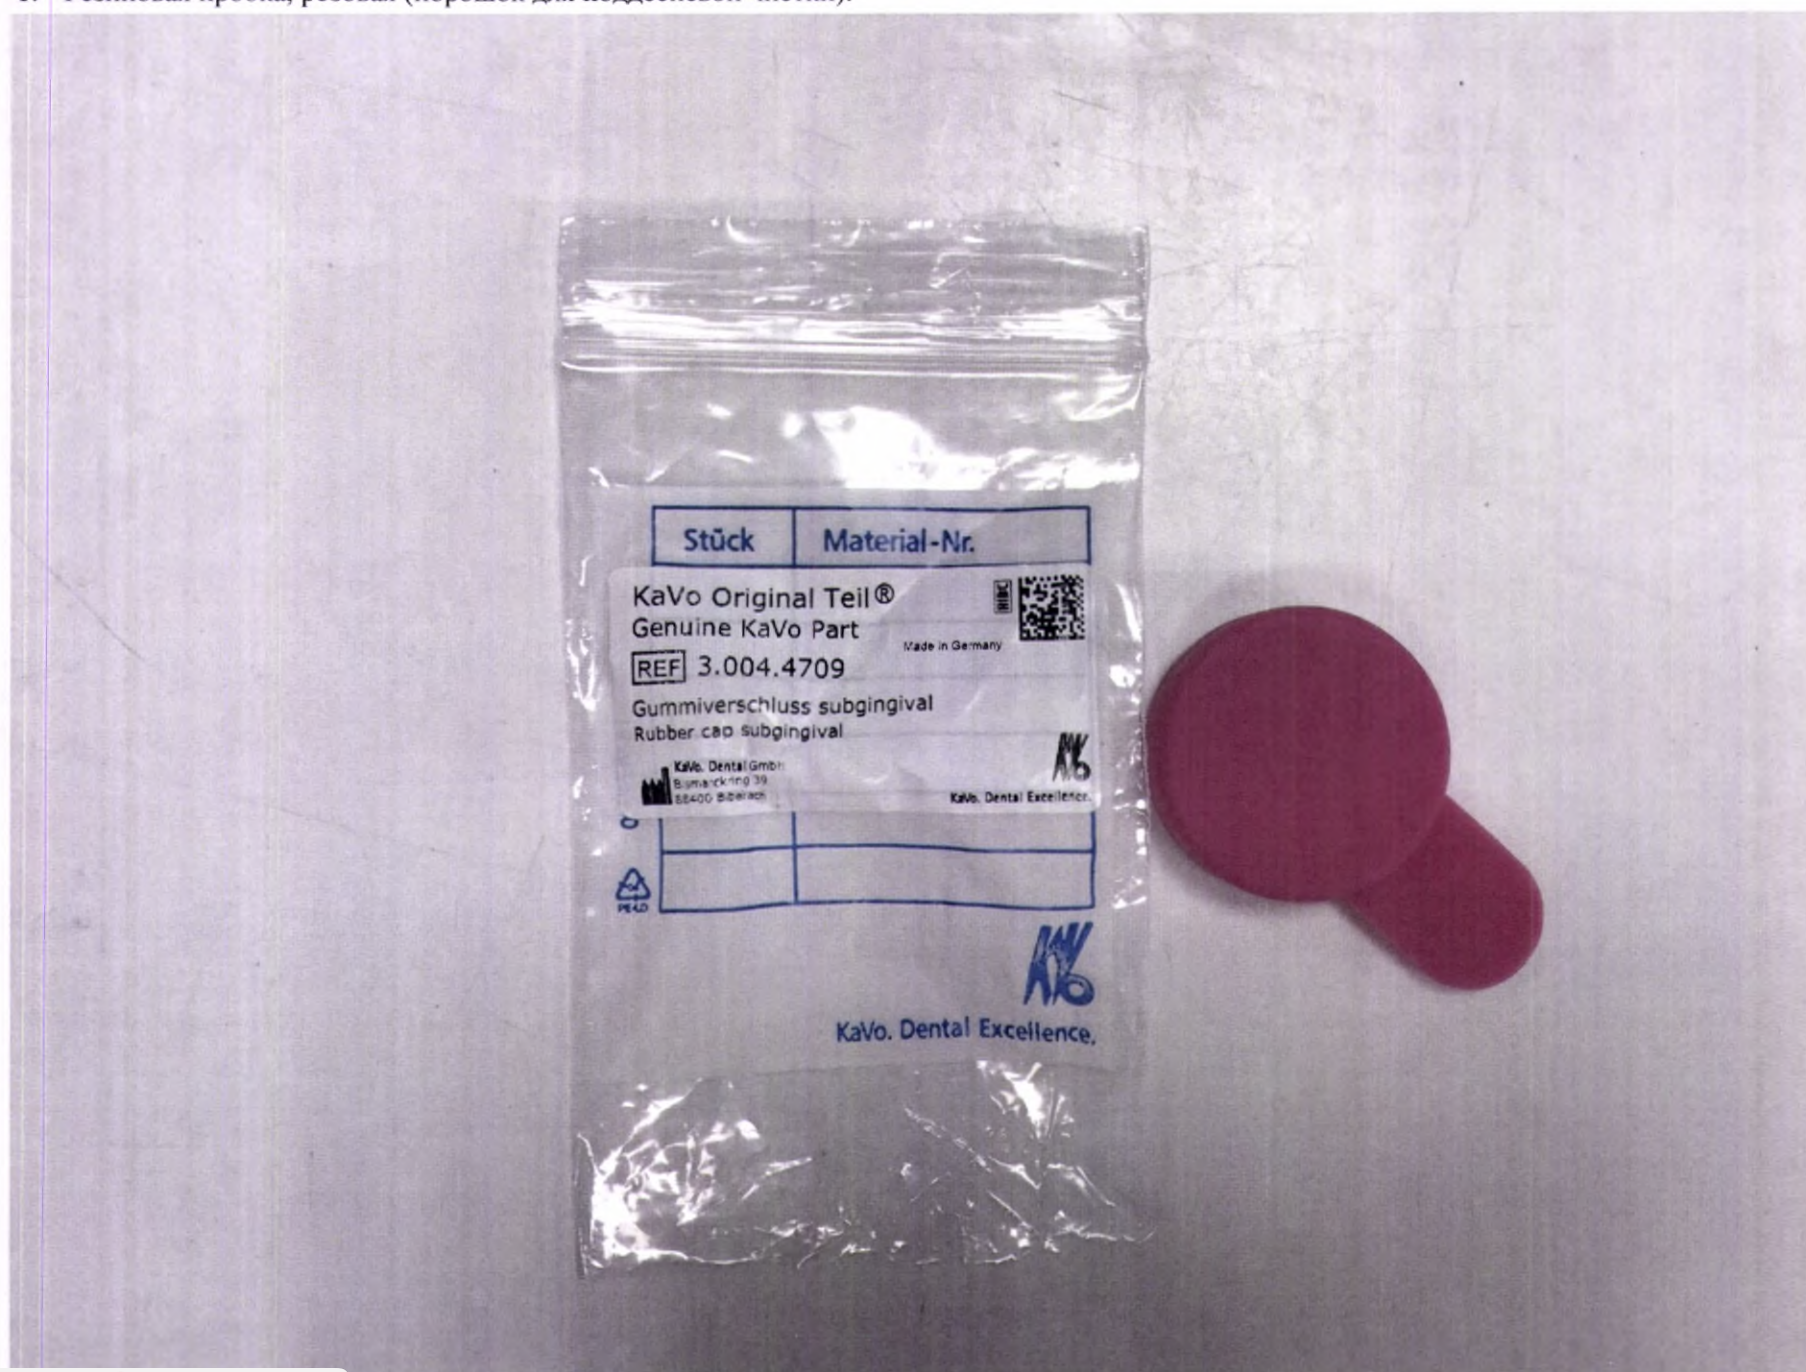

2. Форсунка.

KaVo Original Teil®
Genuine KaVo Part

REF 3.004.2324

Düse
Nozzle



KaVo. Dental GmbH
Bismarckring 39
88400 Biberach



Made in Germany




KaVo. Dental Excellence.



3. Адаптер для очистки PROPHYflex 4, длинный.



4. Крышка для очистки PROPHYflex 4.

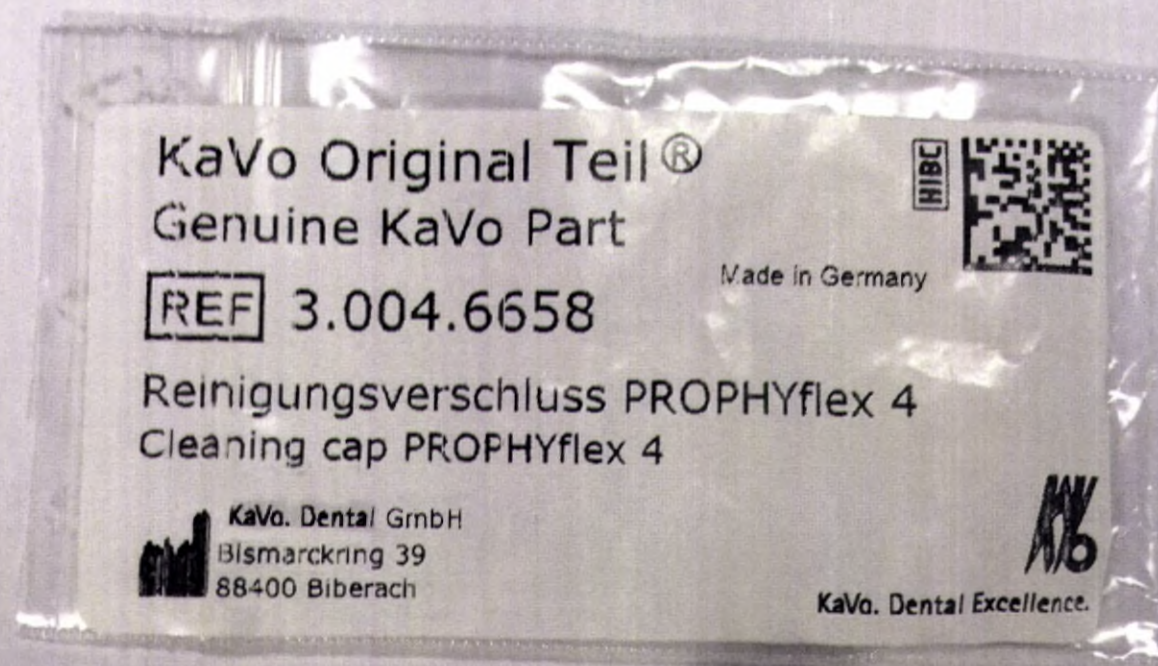

5. Адаптер для очистки PROPHYflex 4.



6. Адаптер для очистки PROPHYflex 4S.





**3.002.8000 Наконечник торговой марки «KAVO» стоматологический
воздушный порошкоструйный PROPHYflex 4, Wave (синий)**

Произведено: KaVo Dental GmbH, Бисмарклинг 39, 88400 Биберах, Германия

Рекомендуется хранить и утилизировать в соответствии с инструкцией.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



РУ № отг.

Уполномоченный представитель производителя: ООО «КаВо Дентал Руссланд»

Россия, 195112 Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, литера В, помещение 26Н.

Тел.: +7 (812) 324-42-12, факс: +7 (812) 324-20-53

Изготовлено в Германии

Приложение

Наконечники торговой марки «KAVO» стоматологические воздушные порошкоструйные, с принадлежностями:

1. Варианты исполнения:

1. Наконечник торговой марки «KAVO» стоматологический воздушный порошкоструйный PROPHYflex 4, Wave (синий), в составе:

1.1 Наконечник торговой марки «KAVO» стоматологический воздушный порошкоструйный PROPHYflex 4, Wave (синий), в составе:

1.1.1. Наконечник PROPHYflex 4, Wave (синий) - 1 шт.

1.1.2. Вмонтируемая длинная втулка - не более 100 шт. (при необходимости).

1.1.3. Канюля - не более 100 шт. (при необходимости).

1.1.4. Емкость для порошка - не более 100 шт. (при необходимости).

1.2. Короткая удерживающая втулка с канюлей - не более 100 шт. (при необходимости).

1.3. Емкость для порошка с резиновой зеленой пробкой - не более 100 шт. (при необходимости).

1.4. Чистящий бор - не более 100 шт. (при необходимости).

1.5. Игла для прочистки форсунок - не более 100 шт. (при необходимости).

1.6. Ключ для канюли - не более 100 шт. (при необходимости).

1.7. Канюля POWER – не более 100 шт. (при необходимости).

1.8. Уплотнительные кольца – 5 шт.

1.9. Инструкция по эксплуатации.

2. Наконечник торговой марки «KAVO» стоматологический воздушный порошкоструйный PROPHYflex 4, Lime (желто-зеленый), в составе:

2.1 Наконечник торговой марки «KAVO» стоматологический воздушный порошкоструйный PROPHYflex 4, Lime (желто-зеленый), в составе:

2.1.1. Наконечник PROPHYflex 4, Lime (желто-зеленый) - 1 шт.

2.1.2. Вмонтируемая длинная втулка - не более 100 шт. (при необходимости).

2.1.3. Канюля - не более 100 шт. (при необходимости).

2.1.4. Емкость для порошка - не более 100 шт. (при необходимости).

2.2. Короткая удерживающая втулка с канюлей - не более 100 шт. (при необходимости).

2.3. Емкость для порошка с резиновой зеленой пробкой - не более 100 шт. (при необходимости).

2.4. Чистящий бор - не более 100 шт. (при необходимости).

2.5. Игла для прочистки форсунок - не более 100 шт. (при необходимости).

2.6. Ключ для канюли - не более 100 шт. (при необходимости).

2.7. Канюля POWER – не более 100 шт. (при необходимости).

2.8. Уплотнительные кольца - 5 шт.

2.9. Инструкция по эксплуатации.

3. Наконечник торговой марки «KAVO» стоматологический воздушный порошкоструйный PROPHYflex 4, Flamingo (розовый), в составе:

3.1. Наконечник торговой марки «KAVO» стоматологический воздушный порошкоструйный PROPHYflex 4, Flamingo (розовый), в составе:

- 3.1.1. Наконечник PROPHYflex 4, Flamingo (розовый) - 1 шт.
- 3.1.2. Вмонтируемая длинная втулка - не более 100 шт. (при необходимости).
- 3.1.3. Канюля - не более 100 шт. (при необходимости).
- 3.1.4. Емкость для порошка - не более 100 шт. (при необходимости).
- 3.2. Короткая удерживающая втулка с канюлей - не более 100 шт. (при необходимости).

- 3.3. Емкость для порошка с резиновой зеленой пробкой - не более 100 шт. (при необходимости).
- 3.4. Чистящий бор - не более 100 шт. (при необходимости).
- 3.5. Игла для прочистки форсунок - не более 100 шт. (при необходимости).
- 3.6. Ключ для канюли - не более 100 шт. (при необходимости).
- 3.7. Канюля POWER – не более 100 шт. (при необходимости).
- 3.8. Уплотнительные кольца - 5 шт.
- 3.9. Инструкция по эксплуатации.

4. Наконечник торговой марки «KAVO» стоматологический воздушный порошкоструйный PROPHYflex 4 S, Wave (синий), в составе:

4.1. Наконечник торговой марки «KAVO» стоматологический воздушный порошкоструйный PROPHYflex 4 S, Wave (синий), в составе:

- 4.1.1. Наконечник PROPHYflex 4 S, Wave (синий) - 1 шт.
- 4.1.2. Вмонтируемая длинная втулка - не более 100 шт. (при необходимости).
- 4.1.3. Канюля - не более 100 шт. (при необходимости).
- 4.1.4. Емкость для порошка - не более 100 шт. (при необходимости).
- 4.2. Короткая удерживающая втулка с канюлей - не более 100 шт. (при необходимости).
- 4.3. Емкость для порошка с резиновой зеленой пробкой - не более 100 шт. (при необходимости).
- 4.4. Чистящий бор - не более 100 шт. (при необходимости).
- 4.5. Игла для прочистки форсунок - не более 100 шт. (при необходимости).
- 4.6. Ключ для канюли - не более 100 шт. (при необходимости).
- 4.7. Канюля POWER – не более 100 шт. (при необходимости).
- 4.8. Уплотнительные кольца - 5 шт.
- 4.9. Инструкция по эксплуатации.

5. Наконечник торговой марки «KAVO» стоматологический воздушный порошкоструйный PROPHYflex 4 S, Lime (желто-зеленый), в составе:

5.1. Наконечник торговой марки «KAVO» стоматологический воздушный порошкоструйный PROPHYflex 4 S, Lime (желто-зеленый), в составе:

- 5.1.1. Наконечник PROPHYflex 4 S, Lime (желто-зеленый) - 1 шт.
- 5.1.2. Вмонтируемая длинная втулка - не более 100 шт. (при необходимости).
- 5.1.3. Канюля - не более 100 шт. (при необходимости).
- 5.1.4. Емкость для порошка - не более 100 шт. (при необходимости).
- 5.2. Короткая удерживающая втулка с канюлей - не более 100 шт. (при необходимости).

- 5.3. Емкость для порошка с резиновой зеленой пробкой - не более 100 шт. (при необходимости).
- 5.4. Чистящий бор - не более 100 шт. (при необходимости).
- 5.5. Игла для прочистки форсунок - не более 100 шт. (при необходимости).
- 5.6. Ключ для канюли - не более 100 шт. (при необходимости).
- 5.7. Канюля POWER – не более 100 шт. (при необходимости).
- 5.8. Уплотнительные кольца - 5 шт.
- 5.9. Инструкция по эксплуатации.

6. Наконечник торговой марки «KAVO» стоматологический воздушный порошкоструйный PROPHYflex 4 S, Flamingo (розовый), в составе:

6.1. Наконечник торговой марки «KAVO» стоматологический воздушный порошкоструйный PROPHYflex 4 S, Flamingo (розовый), в составе:

- 6.1.1. Наконечник PROPHYflex 4 S, Flamingo (розовый) - 1 шт.
- 6.1.2. Вмонтируемая длинная втулка - не более 100 шт. (при необходимости).
- 6.1.3. Канюля - не более 100 шт. (при необходимости).
- 6.1.4. Емкость для порошка - не более 100 шт. (при необходимости).
- 6.2. Короткая удерживающая втулка с канюлей - не более 100 шт. (при необходимости).
- 6.3. Емкость для порошка с резиновой зеленой пробкой - не более 100 шт. (при необходимости).
- 6.4. Чистящий бор - не более 100 шт. (при необходимости).
- 6.5. Игла для прочистки форсунок - не более 100 шт. (при необходимости).
- 6.6. Ключ для канюли - не более 100 шт. (при необходимости).
- 6.7. Канюля POWER – не более 100 шт. (при необходимости).
- 6.8. Уплотнительные кольца - 5 шт.
- 6.9. Инструкция по эксплуатации.

II. Принадлежности:

- 1. Резиновая пробка, розовая (порошок для поддесневой чистки).
- 2. Форсунка.
- 3. Адаптер для очистки PROPHYflex 4, длинный.
- 4. Крышка для очистки PROPHYflex 4.
- 5. Адаптер для очистки PROPHYflex 4.
- 6. Адаптер для очистки PROPHYflex 4S.

Прошито и пронумеровано.

Всего 93 (девяносто три) листов

Ведущий специалист по
сертификации и регистрации

ООО «КаВо Дентал Руссланд» М.В. Масиановская/
(действующий на основании Доверенности б/н от 09 января 2020г.)

