



Фотографические изображения

Набор контрольных материалов для контроля качества количественного определения кортизола иммунохемилюминесцентным методом в слюне человека на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (PreciControl Cortisol Saliva Elecsys and cobas e analyzers)

ООО «Рош Диагностика Рус»

Россия, 115114, Москва
ул. Летниковская, дом 2, стр. 2
Бизнес-центр "Вивальди Плаза"

Тел.: +7 (495) 229 69 99
Факс: +7 (495) 229 62 64

www.roche.ru

Roche Diagnostics Rus LLC

2, Letnikovskaya street, bld.2
Business Center "Vivaldi Plaza"
115114, Moscow, Russia

Tel.: +7 (495) 229 69 99
Fax: +7 (495) 229 62 64

www.roche.ru



Набор контрольных материалов для контроля качества количественного определения Кс иммунохемилюминесцентным методом в слюне человека на анализаторах и модулях иммунохимических (PreciControl Cortisol Saliva Elecsys and cobas e analyzers), в составе:

1. Контрольная сыворотка 1, объем 1,0 мл (2 шт.).
2. Контрольная сыворотка 2, объем 1,0 мл (2 шт.).
3. Флакон пустой, объем 1,0 мл (4 шт.).
4. Инструкция по применению.
5. Паспорт присвоенных значений.

PreciControl Cortisol Saliva

For **USA:** **CONTENT**

PC CS1 Cortisol in a buffer/protein matrix
PC CS2 Cortisol in a buffer/protein matrix

REF 06687768190

LOT 47038701

 2021-05-31

 2020-03-30

GTIN 04015630933440





Rx only

03





Набор контрольных материалов для контроля качества количественного определения кортизола иммунохемилюминесцентным методом в слюне человека на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (PreciControl Cortisol Saliva Elecsys and cobas e analyzers)

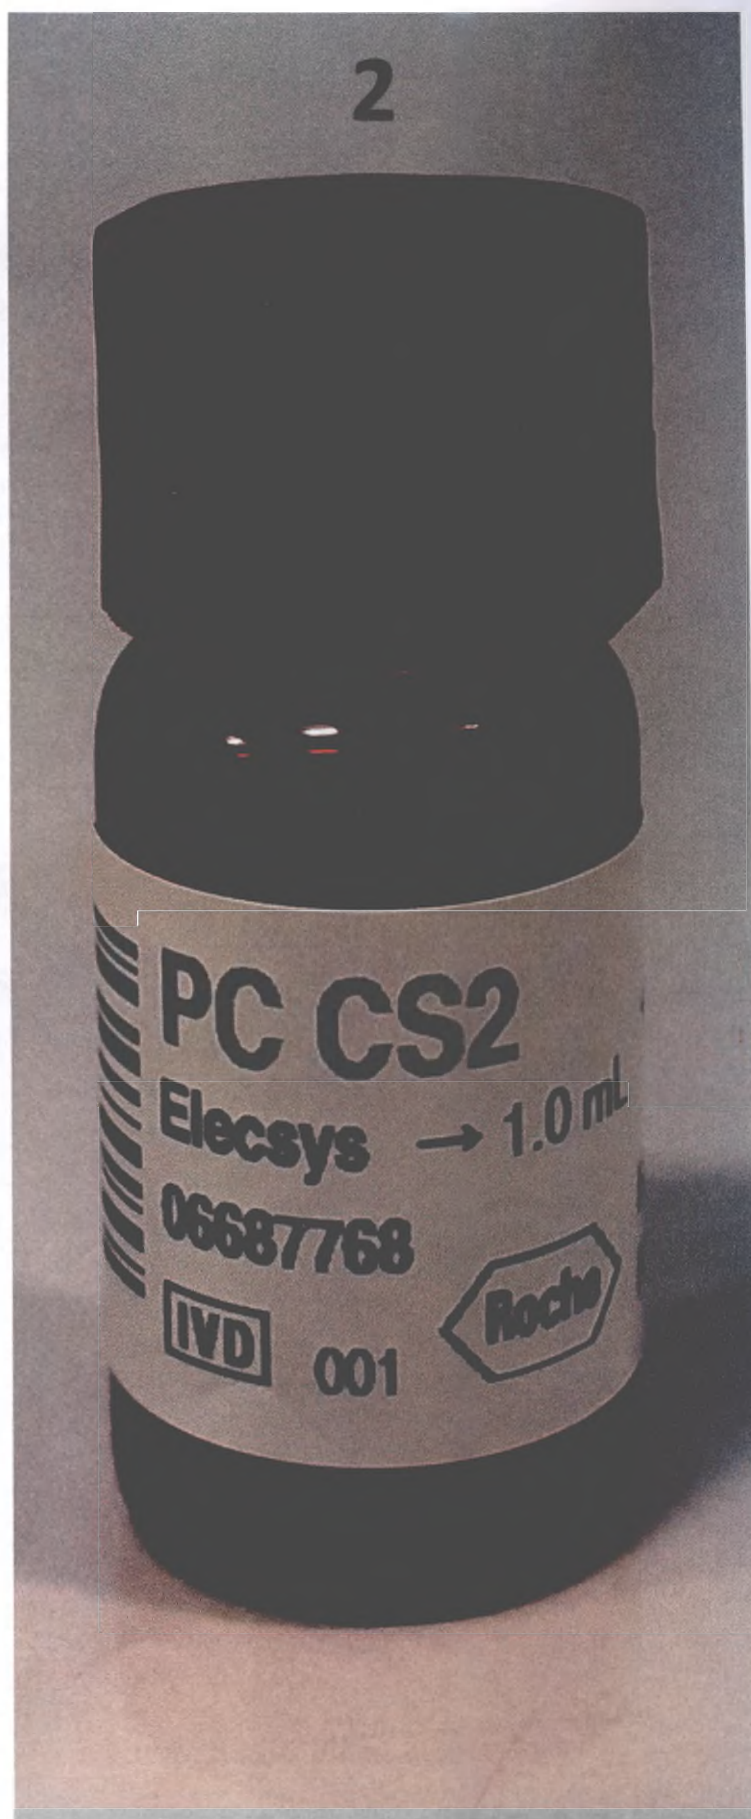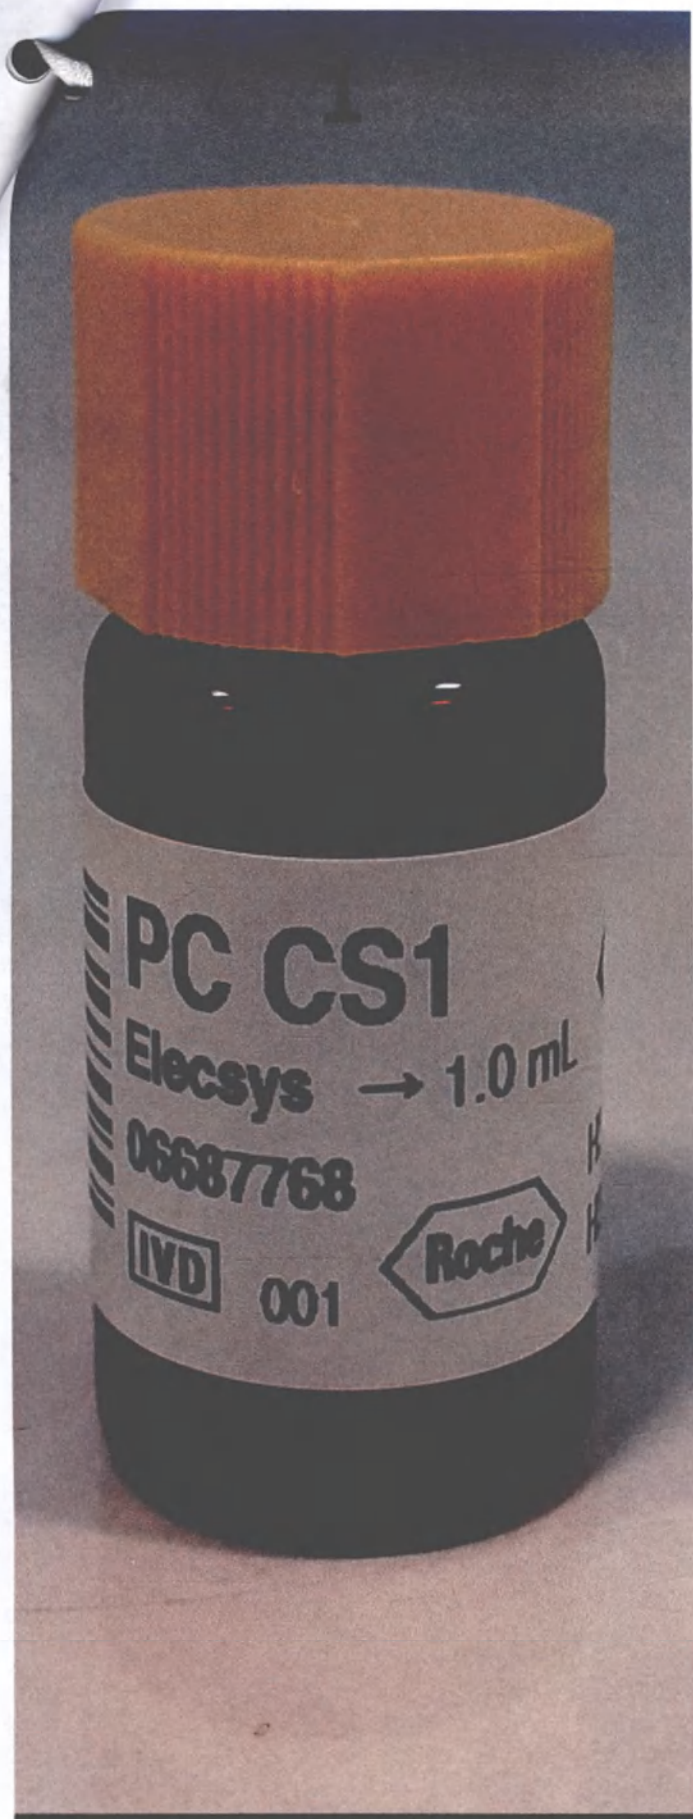


Набор контрольных материалов для контроля в иммунохемилюминесцентном методе в слюне человека на анализаторах и модулях иммунохимических cobas PreciControl Cortisol Saliva Elecsys and cobas e analyzers):

- Контрольная сыворотка 1, объем 1,0 мл (2 шт.).
- Контрольная сыворотка 2, объем 1,0 мл (2 шт.).

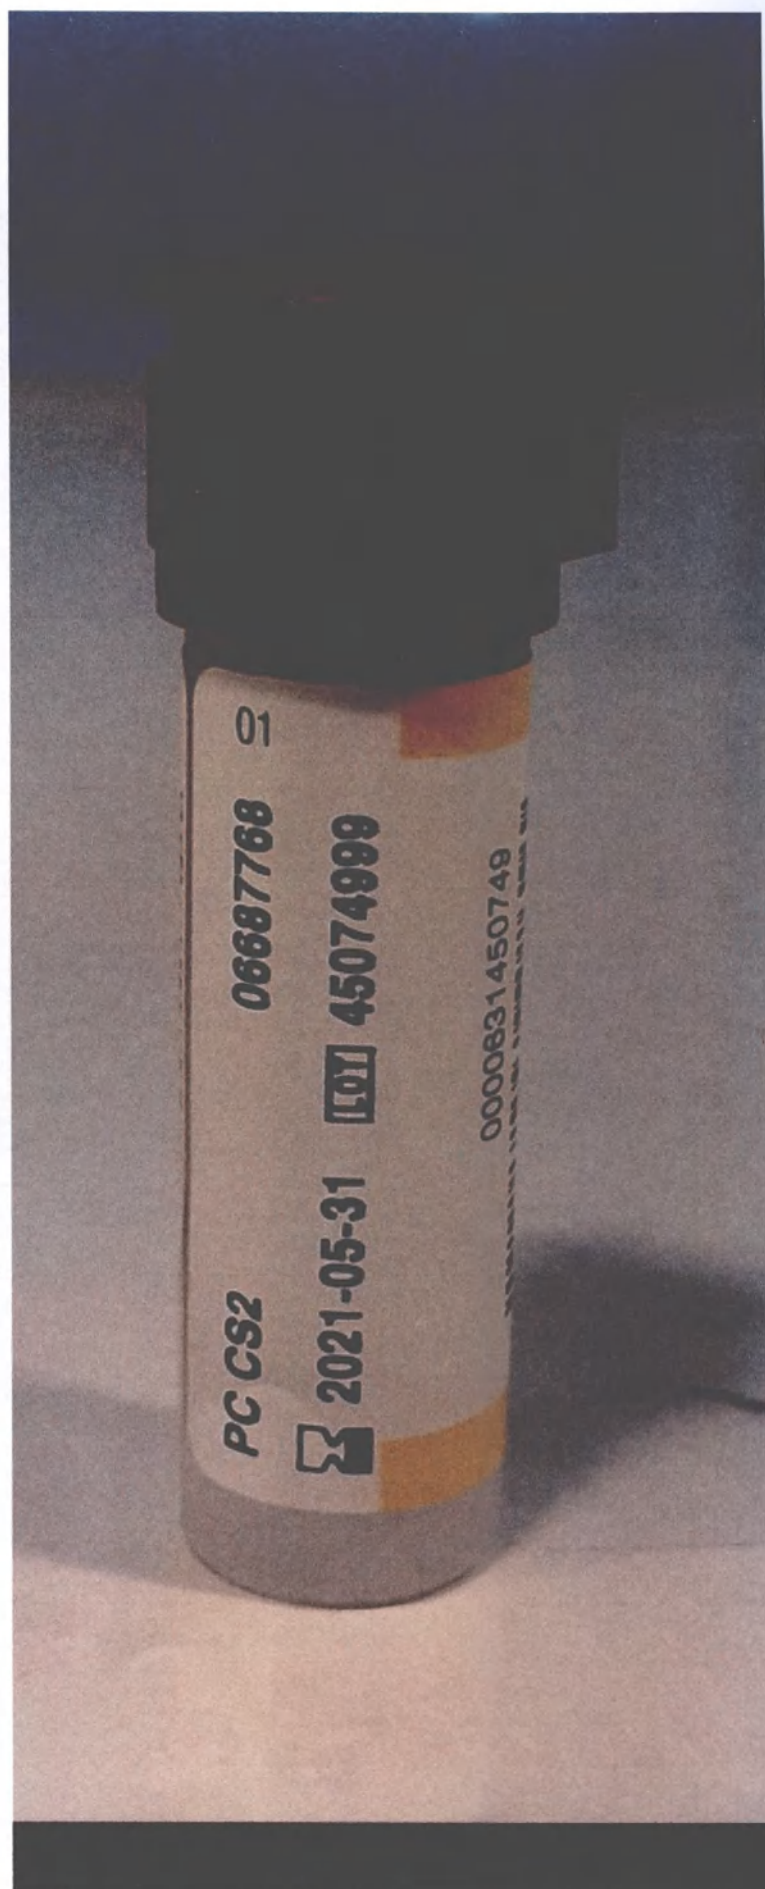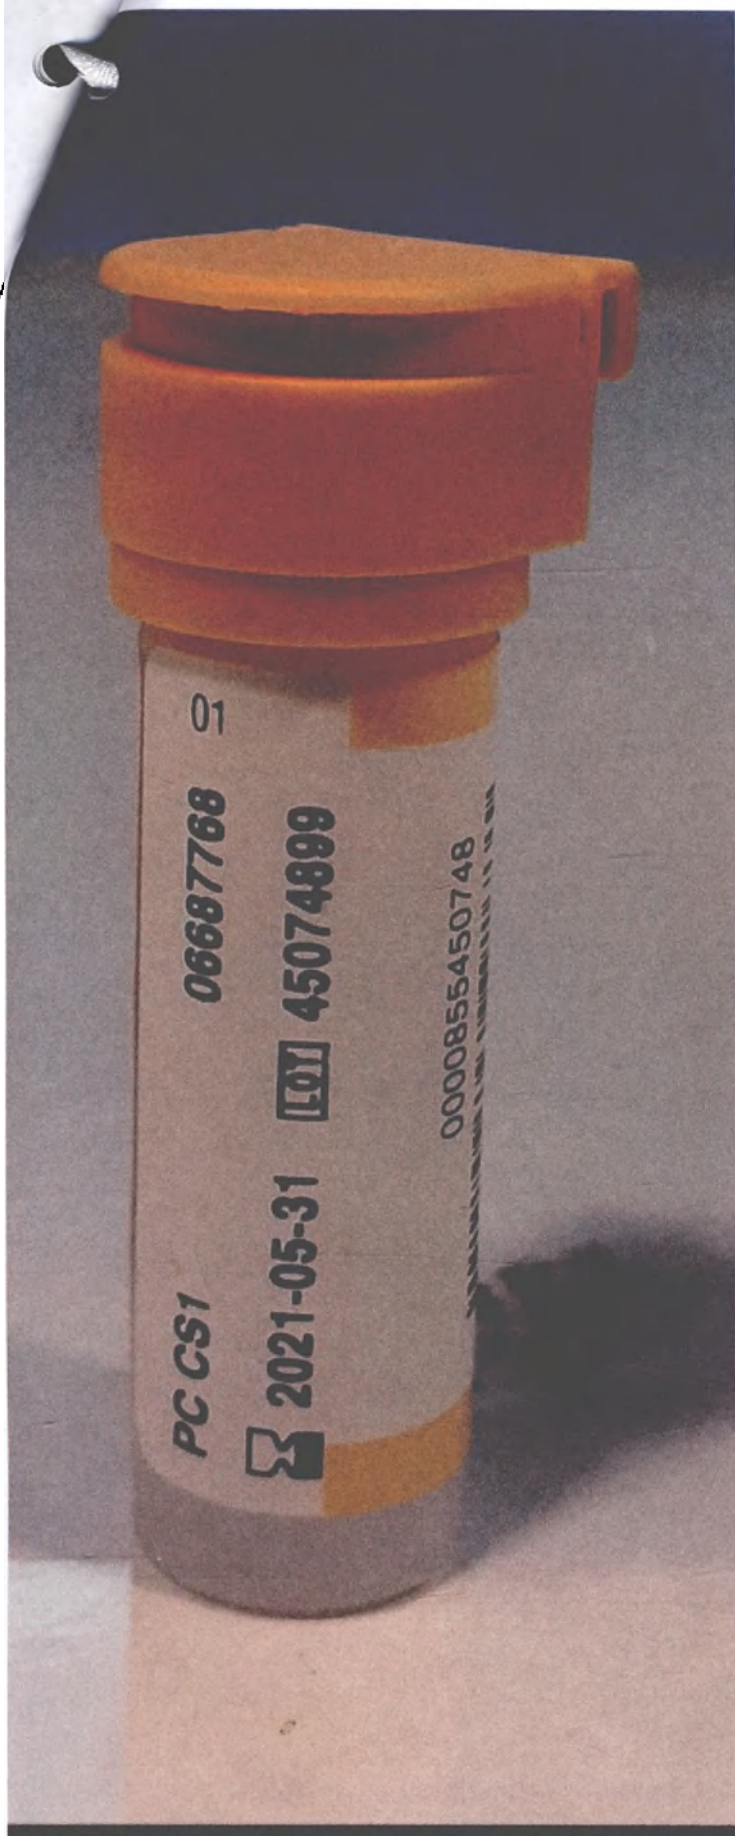

Набор контрольных материалов для контроля качества количественного определения кортизол (иммунохемилюминесцентным методом в слюне человека на анализаторах и модулях иммунохимических cobas PreciControl Cortisol Saliva Elecsys and cobas e analyzers):

3. Флакон пустой, объем 1,0 мл (4 шт.)



REF 00687768 190

CORT II	Elecsys Cortisol II	11.0	8.05 - 18.0	1.65	30.1
	06687733	0.40	0.22 - 0.58	0.06	1.08
		3.99	2.19 - 5.79	0.80	10.9

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

(This card is at the end of the document.) / Übersetzungen siehe Glossar am Ende des Dokumentes. / Pour connaître les traductions, consulter le glossaire à la fin du présent document. / Per le traduzioni, vedere il glossario alla fine del presente documento. / Para traducir, ver el glosario al final de este documento. / Se ordlistan i slutet av detta dokument. / Tiesatiet lör översättningar. / Översätteren, se den förklarande termen till detta dokument. / Thesaurusen, patry stowoznik w końcu tekstu. / Тлумачэнне, Бэзе на вышчагодзі або тлумачэнні аўтара ў гэтым дакуменце. / База на вышчагодзі іліпс оліват аднастакі. / Del vertimų ir, šio dokumento pateiktose mairių glaistyti. / La lista delle parole, presentate nel documento è all'estremità dello stesso documento.

Лучина И. А.
Руководитель отдела
и качества по договору

02 июля 2018

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
7 листа (ов)