

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Дентсплай Сирона»



Левин К.Г.

«08» декабря 2020 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Материал стоматологический текучий объемного внесения SDR® Plus
для пломбирования зубов в отдельных упаковках, с принадлежностями**

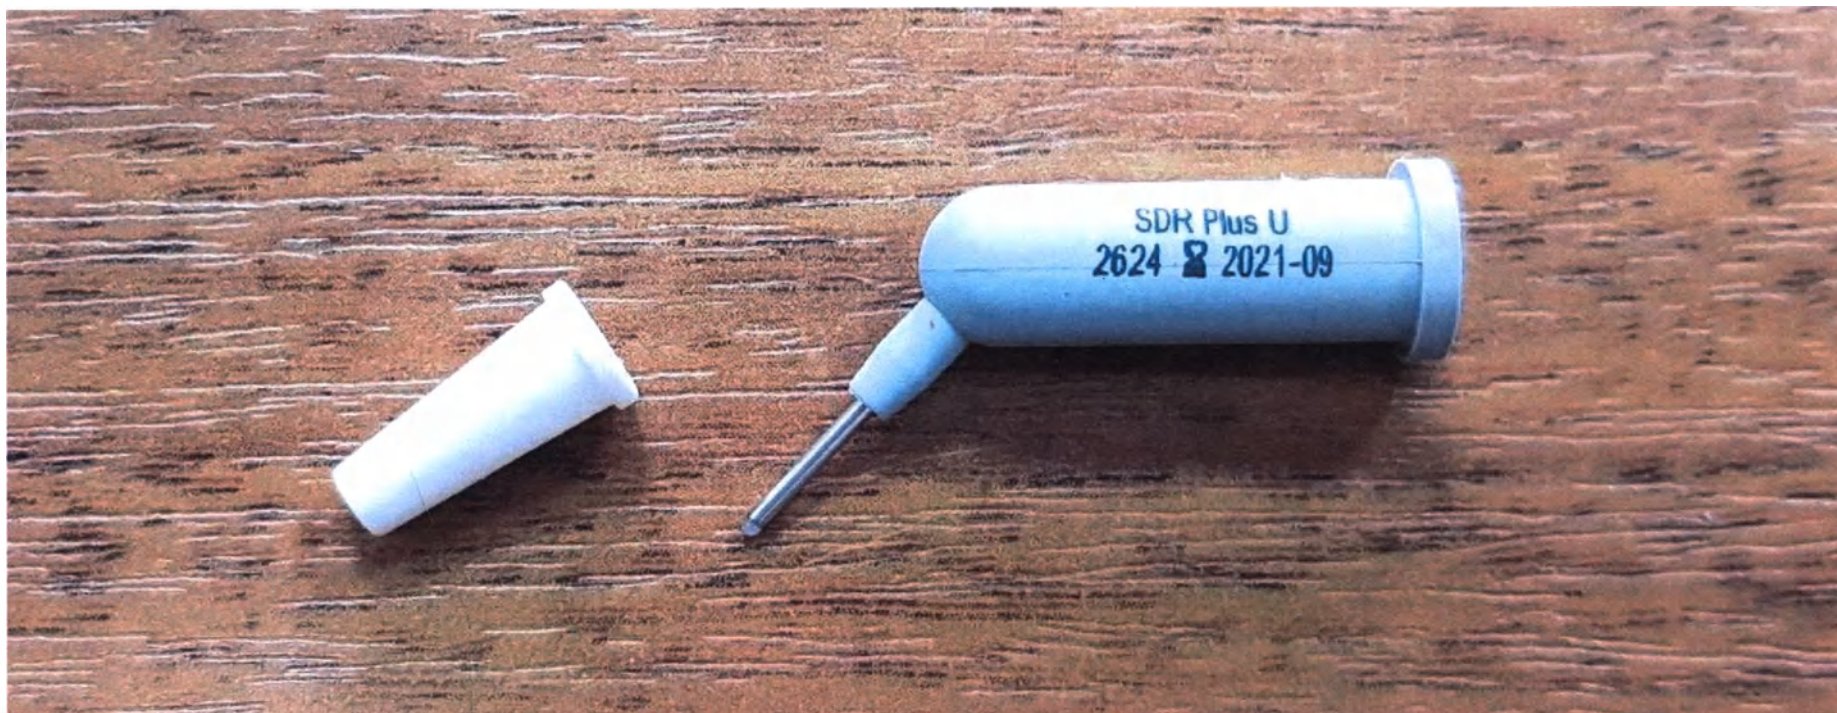


Фото 1 – Материал стоматологический текучий объемного внесения SDR® Plus
в компюлах по 0,25 г (SDR® Plus Compula® Tips), оттенки: универсальный
оттенок



Фото 2 - Материал стоматологический текучий объемного внесения SDR® Plus
в компьюлах по 0,25 г (SDR® Plus Compula® Tips), оттенки: A1\



Фото 3 – Материал стоматологический текучий объемного внесения SDR® Plus
в компьюлах по 0,25 г (SDR® Plus Compula® Tips), оттенки: A2



Фото 4 – Материал стоматологический текучий объемного внесения SDR® Plus
в компьюлах по 0,25 г (SDR® Plus Compula® Tips), оттенки: A3

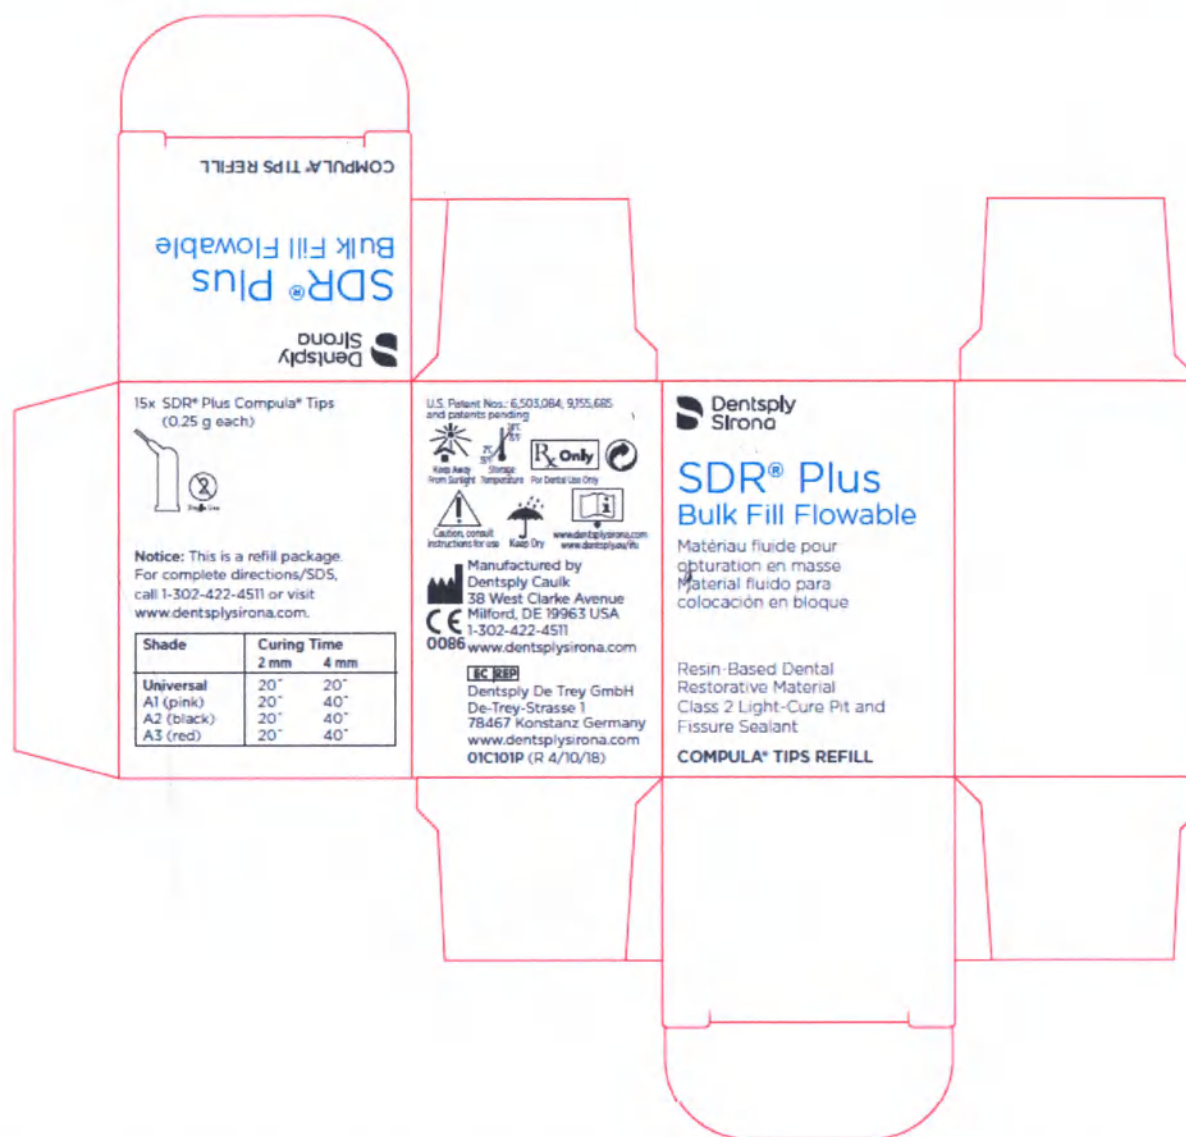


Фото 5 – Материал стоматологический текучий объемного внесения SDR® Plus

в компьютерных по 0,25 г (SDR® Plus Compula® Tips), оттенки: универсальный оттенок, A1, A2, A3 – 15 шт./уп.

(потребительская упаковка)

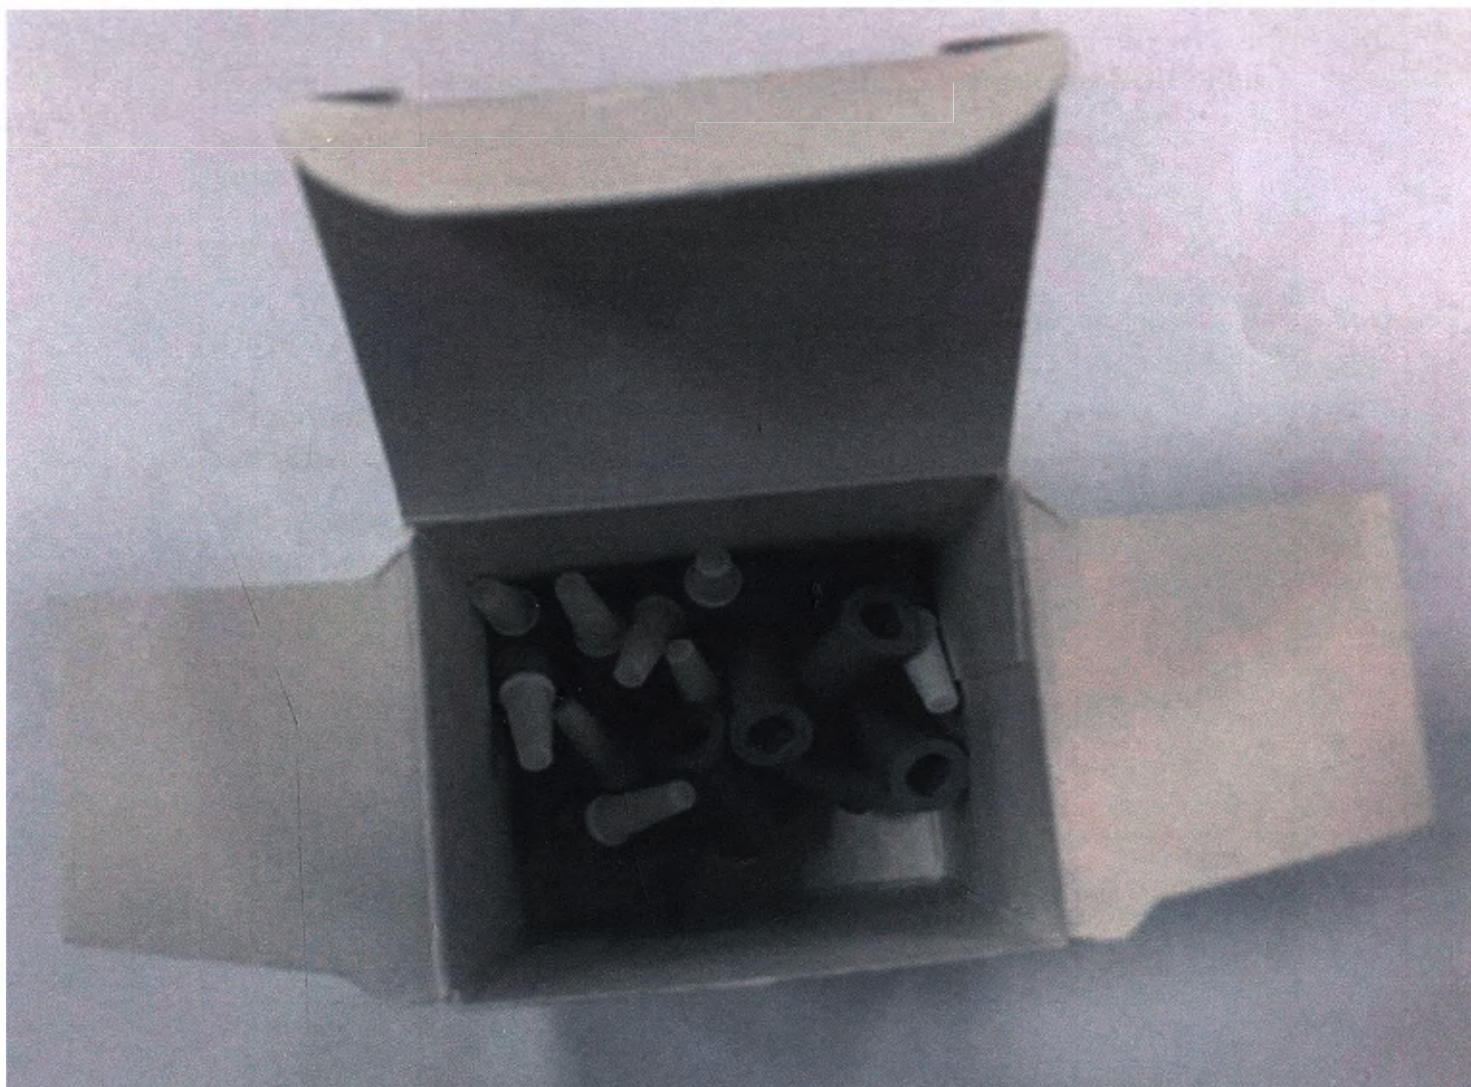


Фото 6 – Материал стоматологический текучий объемного внесения SDR® Plus
в компьюлах по 0,25 г (SDR® Plus Compula® Tips), оттенки: универсальный оттенок, A1, A2, A3 – 15 шт./уп.
(упаковка компьюл)

SDR® Plus Compula® Tips

Материал стоматологический текущий объемного внесения SDR® Plus в компьюлах по 0,25 г (SDR® Plus Compula® Tips), оттенки: универсальный оттенок, A1, A2, A3 - 15 шт./уп.

РУ № РЗН #####/##### от ##.##.####

Только для использования врачами стоматологами.

Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях представлена в инструкции по применению.

 Информация о сроках и условиях хранения представлена на упаковке и в инструкции по применению.

Сохраняйте упаковку до окончания использования продукта.

Производитель:

Dentsply LLC also dba Dentsply
Caulk / Дентсплай ЭлЭлСи
также осуществляющая
деятельность под
наименованием Дентсплай
Колк
Адрес: 38 West Clarke Avenue,
Milford, Delaware, 19963, USA

Страна происхождения:

**Уполномоченный
представитель:**

ООО «Дентсплай Сирона»,
Российская Федерация,
115432, Москва, проспект
Андропова, д.18, корп. 6,
офисы 1 39 40,
тел.: +7 (495) 725 10 87

США



Место для номера
стикера

Фото 7 – Материал стоматологический текущий объемного внесения SDR® Plus

в компьюлах по 0,25 г (SDR® Plus Compula® Tips), оттенки: универсальный оттенок, A1, A2, A3 - 15 шт./уп.

(маркировка потребительской упаковки)

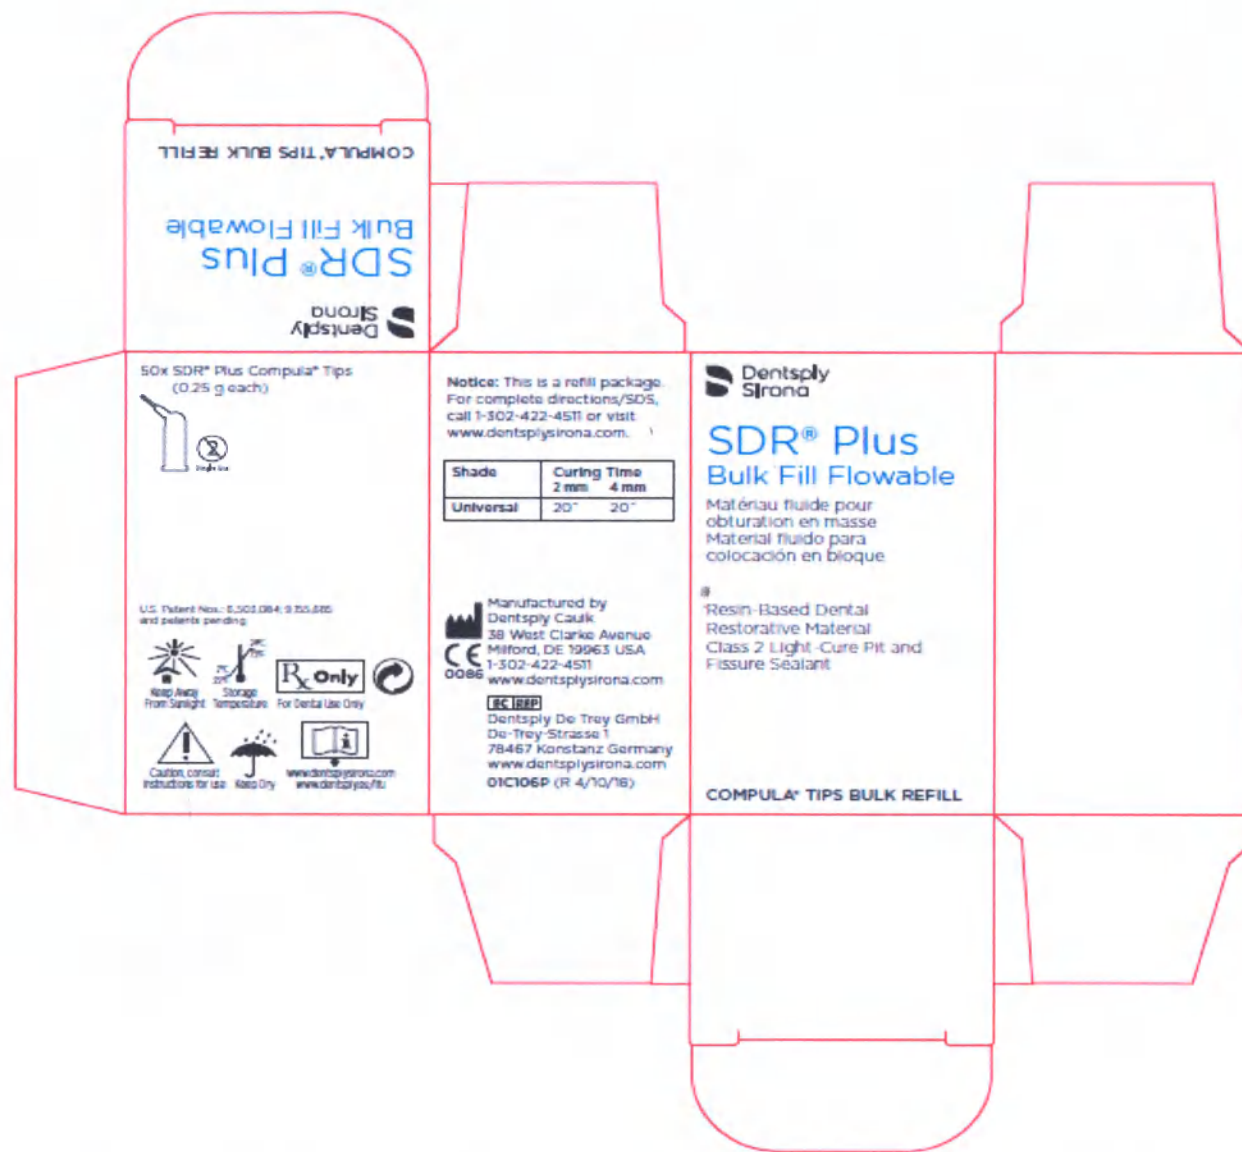


Фото 11 – Материал стоматологический текущий объемного внесения SDR® Plus

в компьютерных по 0,25 г (SDR® Plus Complia® Tips), оттенки: универсальный оттенок, A1, A2, A3 – 50 шт./уп.

(потребительская упаковка)

SDR® Plus Compula® Tips

Материал стоматологический текучий объемного внесения SDR® Plus в компьютерных по 0,25 г (SDR® Plus Compula® Tips), оттенки: универсальный оттенок, А1, А2, А3 - 50 шт./уп.
РУ № РЗН #####/##### от ##.##.####

Только для использования врачами стоматологами.

Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях представлена в инструкции по применению.

■ Информация о сроках и условиях хранения представлена на упаковке и в инструкции по применению.

Сохраняйте упаковку до окончания использования продукта.

Производитель:

Dentsply LLC also dba Dentsply
Caulk / Дентсплай ЭлЭлСи
также осуществляющая
деятельность под
наименованием Дентсплай
Колк
Адрес: 38 West Clarke Avenue,
Milford, Delaware, 19963, USA

Страна происхождения:

Уполномоченный

представитель:

ООО «Дентсплай Сирона»,
Российская Федерация,
115432, Москва, проспект
Андропова, д.18, корп. 6,
офисы 1 39 40,
тел.: +7 (495) 725 10 87

США



Место для номера
стикера

Фото 12 – Материал стоматологический текучий объемного внесения SDR® Plus

в компьютерных по 0,25 г (SDR® Plus Compula® Tips), оттенки: универсальный оттенок, А1, А2, А3 - 50 шт./уп.

(маркировка потребительской упаковки)

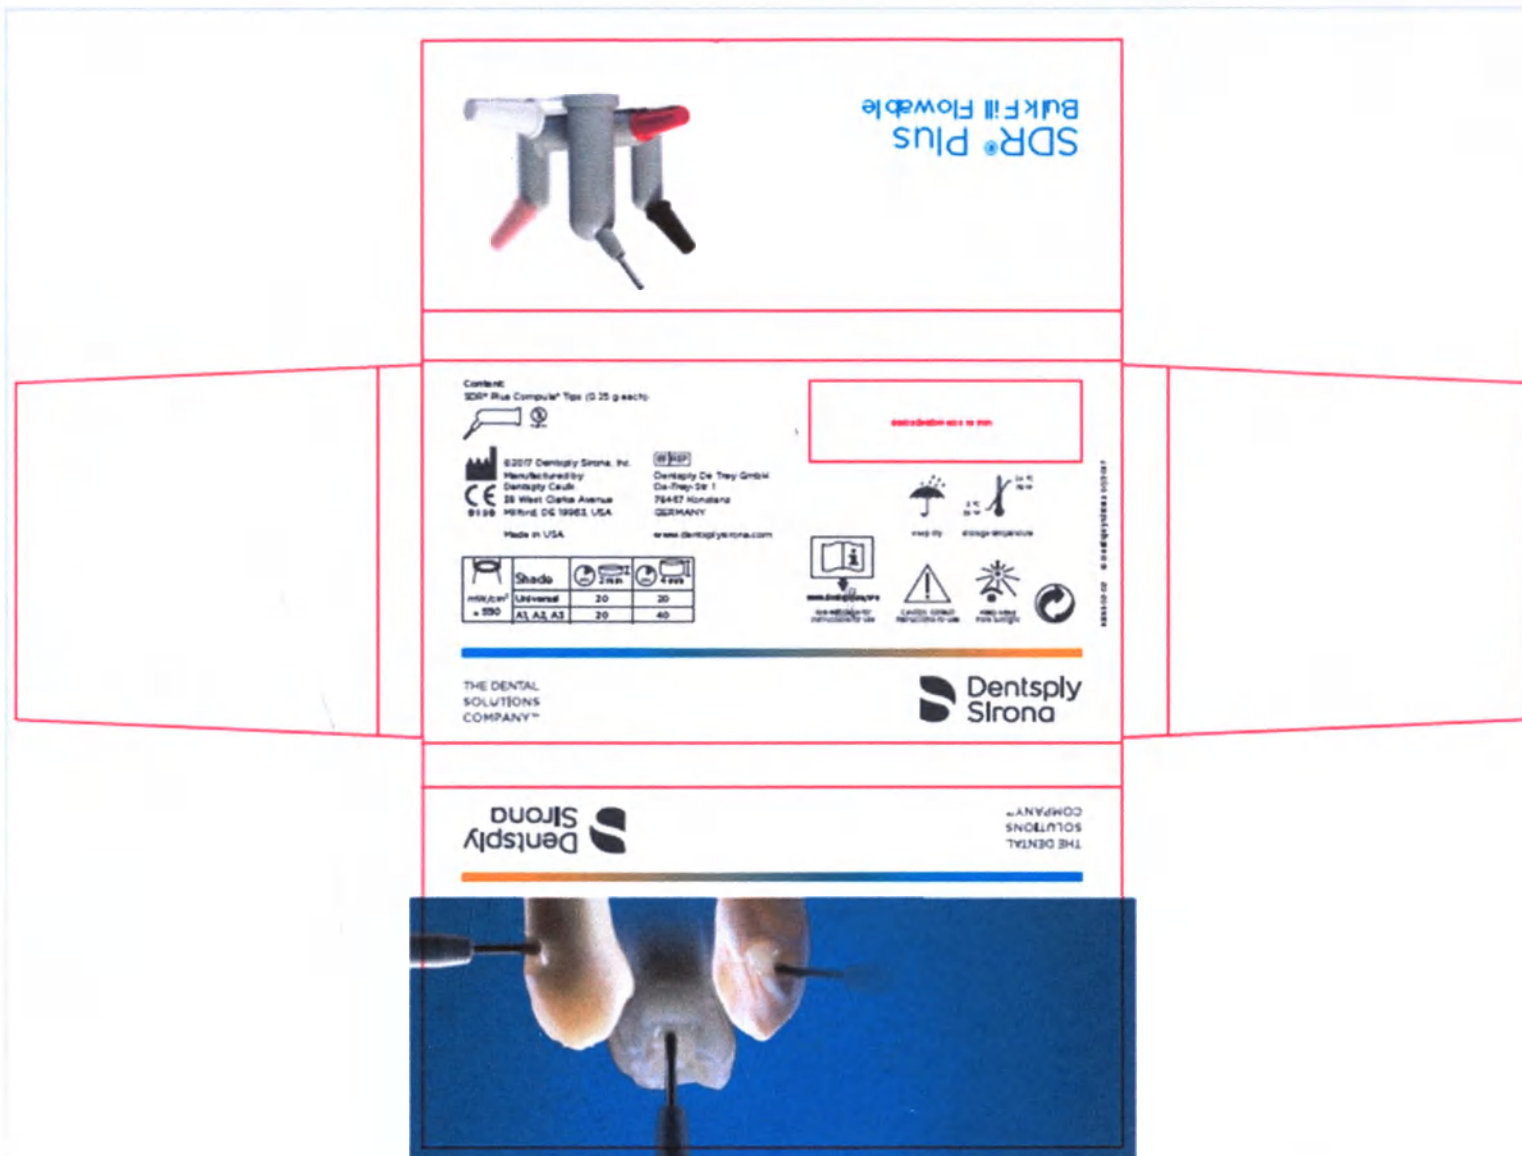


Фото 13 - Материал стоматологический текучий объемного внесения SDR® Plus в компьюлах по 0.25 г (SDR® Plus Compula® Tips), универсальный оттенок – 4 шт. / уп., инструкция по применению – 1 шт., иллюстрированное техническое руководство – 1 шт. (потребительская упаковка)



Фото 14 - Материал стоматологический текущий объемного внесения SDR® Plus в компьютерных по 0.25 г (SDR® Plus Compu® Tips), универсальный оттенок – 4 шт. / уп., инструкция по применению – 1 шт., иллюстрированное техническое руководство – 1 шт. (упаковка компьютер)

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

РУ № РЗН ####/##### от ##.##.####

Только для использования врачами стоматологами.

Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях представлена в инструкции по применению.

■ Информация о сроках и условиях хранения представлена на упаковке и в инструкции по применению.

Сохраняйте упаковку до окончания использования продукта.

Производитель:

Dentsply LLC also dba Dentsply
Caulk / Дентсплай ЭлЭлСи
также осуществляющая
деятельность под
наименованием Дентсплай
Колк
Адрес: 38 West Clarke Avenue,
Milford, Delaware, 19963, USA

Уполномоченный

представитель:
ООО «Дентсплай Сирона»,
Российская Федерация,
115432, Москва, проспект
Андропова, д.18, корп. 6,
офисы 1 39 40,
тел.: +7 (495) 725 10 87



Место для номера
стикера

Страна происхождения:

США

Фото 15 - Материал стоматологический текучий объемного внесения SDR® Plus в компьюлах по 0.25 г (SDR® Plus Compula® Tips), универсальный оттенок – 4 шт. / уп., инструкция по применению – 1 шт., иллюстрированное техническое руководство – 1 шт. (маркировка потребительской упаковки)

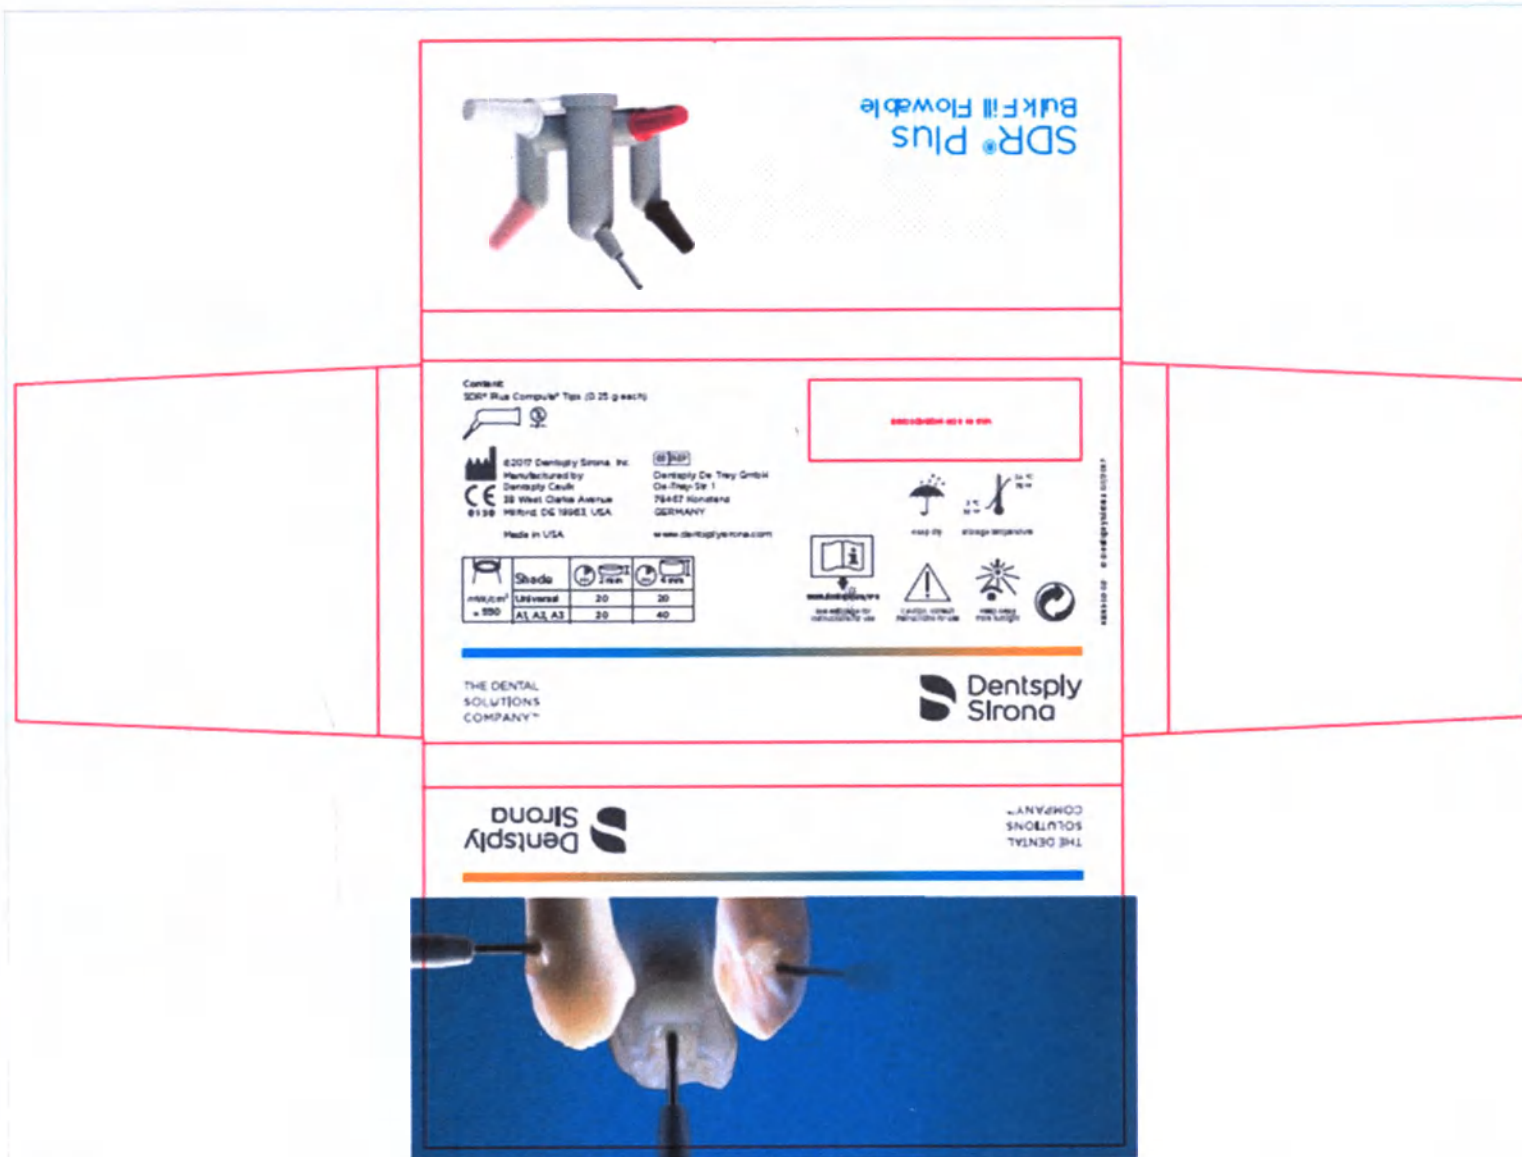


Фото 16 - Материал стоматологический текучий объемного внесения SDR® Plus в компьюлах по 0.25 г (SDR® Plus Compupa® Tips), универсальный оттенок – 10 шт. / уп., инструкция по применению – 1 шт., иллюстрированное техническое руководство – 1 шт.

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

РУ № РЗН ##### от ##.##.####

Только для использования врачами стоматологами.

Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях представлена в инструкции по применению.

■ Информация о сроках и условиях хранения представлена на упаковке и в инструкции по применению.

Сохраняйте упаковку до окончания использования продукта.

Производитель:

Dentsply LLC also dba Dentsply
Caulk / Дентсплай ЭлЭлСи
также осуществляющая
деятельность под
наименованием Дентсплай
Колк
Адрес: 38 West Clarke Avenue,
Milford, Delaware, 19963, USA

Уполномоченный

представитель:

ООО «Дентсплай Сирона»,
Российская Федерация,
115432, Москва, проспект
Андропова, д.18, корп. 6,
офисы 1 39 40,
тел.: +7 (495) 725 10 87



Место для номера
стикера

Страна происхождения:

США

Фото 17 - Материал стоматологический текущий объемного внесения SDR® Plus в компьюлах по 0.25 г (SDR® Plus Compula® Tips), универсальный оттенок – 10 шт. / уп., инструкция по применению – 1 шт., иллюстрированное техническое руководство – 1 шт. (маркировка потребительской упаковки)

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

РУ № РЗН #####/##### от ##.##.####

Только для использования врачами стоматологами.

Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях представлена в инструкции по применению.

■ Информация о сроках и условиях хранения представлена на упаковке и в инструкции по применению.

Сохраняйте упаковку до окончания использования продукта.

Производитель:

Dentsply LLC also dba Dentsply
Caulk / Дентсплай ЭлЭлСи
также осуществляющая
деятельность под
наименованием Дентсплай
Колк
Адрес: 38 West Clarke Avenue,
Milford, Delaware, 19963, USA

**Уполномоченный
представитель:**

ООО «Дентсплай Сирона»,
Российская Федерация,
115432, Москва, проспект
Андропова, д.18, корп. 6,
офисы 1 39 40,
тел.: +7 (495) 725 10 87



Место для номера
стикера

Страна происхождения:

США

Фото 19 - Материал стоматологический текучий объемного внесения SDR® Plus в компьюлах по 0.25 г (SDR® Plus Compu® Tips), универсальный оттенок – 2 шт., оттенок A1 – 1 шт., оттенок A2 – 1 шт., оттенок A3 – 1 шт., инструкция по применению – 1 шт., иллюстрированное техническое руководство – 1 шт. (маркировка потребительской упаковки)

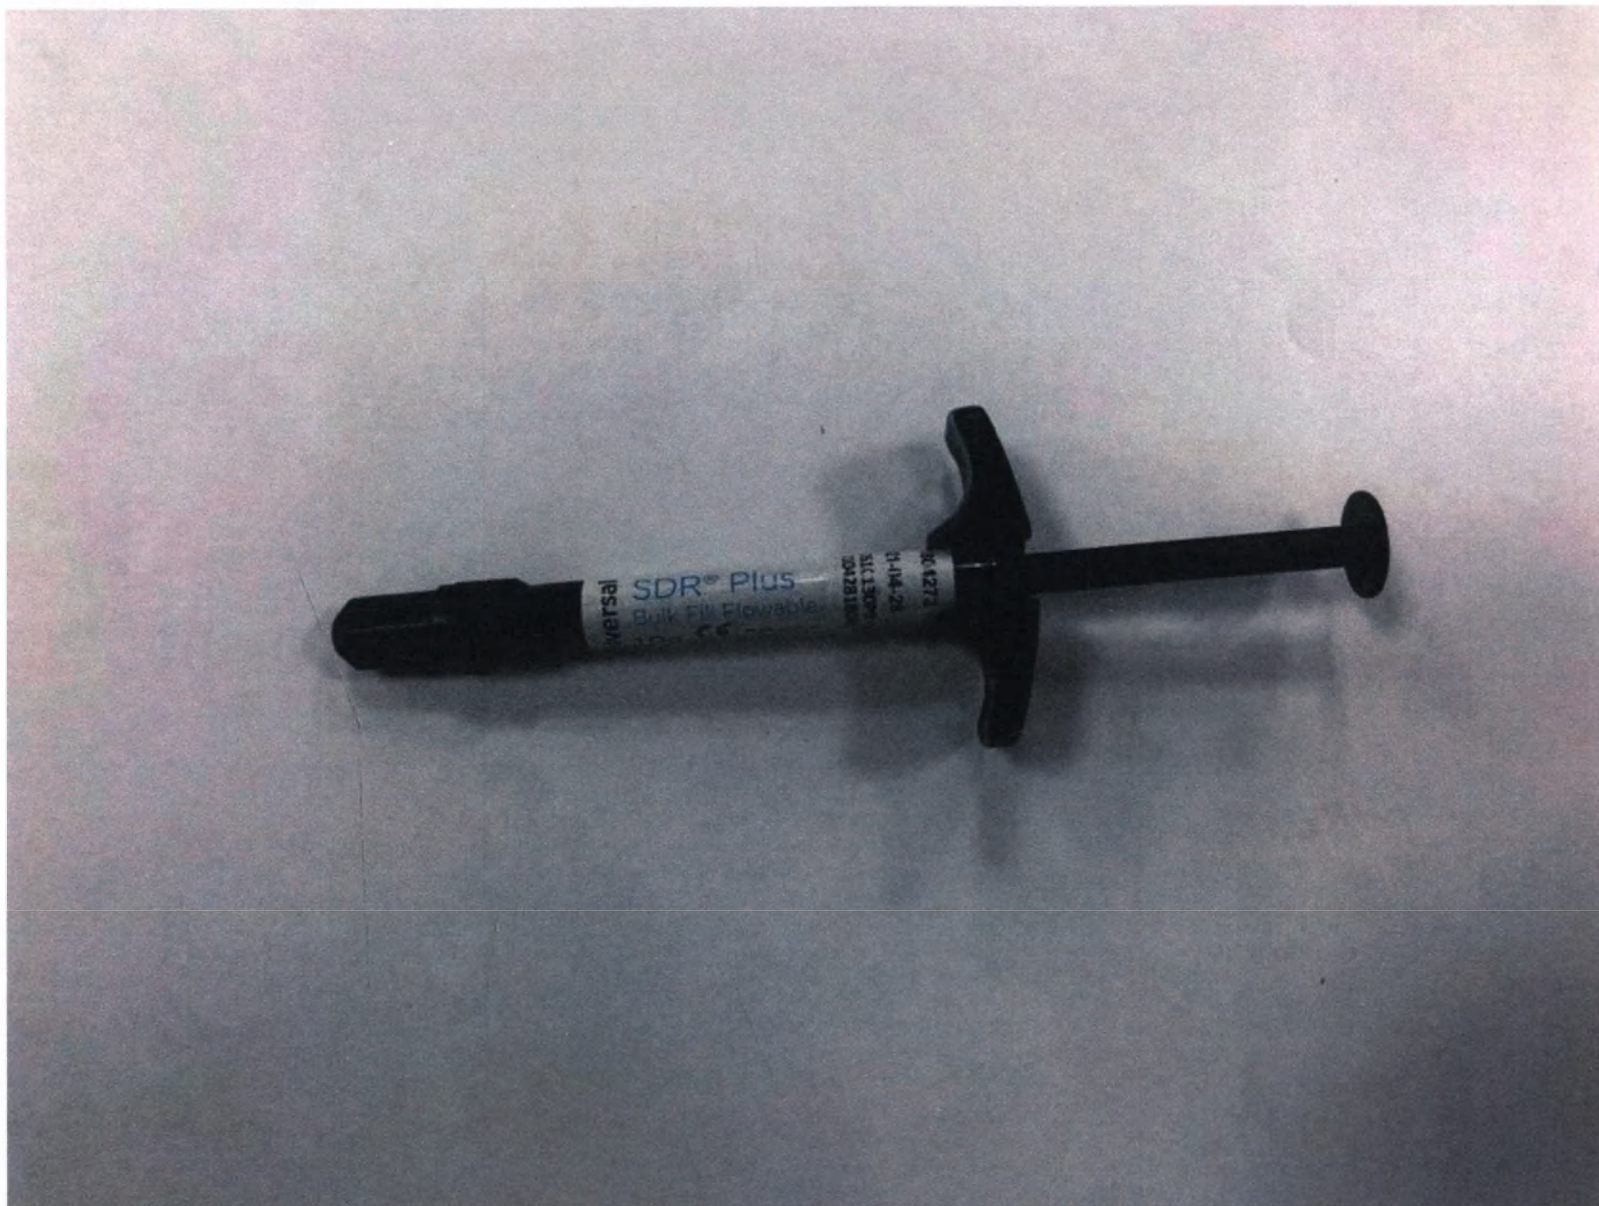


Фото 20 - Материал стоматологический текучий объемного внесения SDR® Plus в шприцах по 1 г каждый
(Универсальный оттенок)



Фото 21 - Аппликаторы (syringe tips) (упаковка аппликаторов)

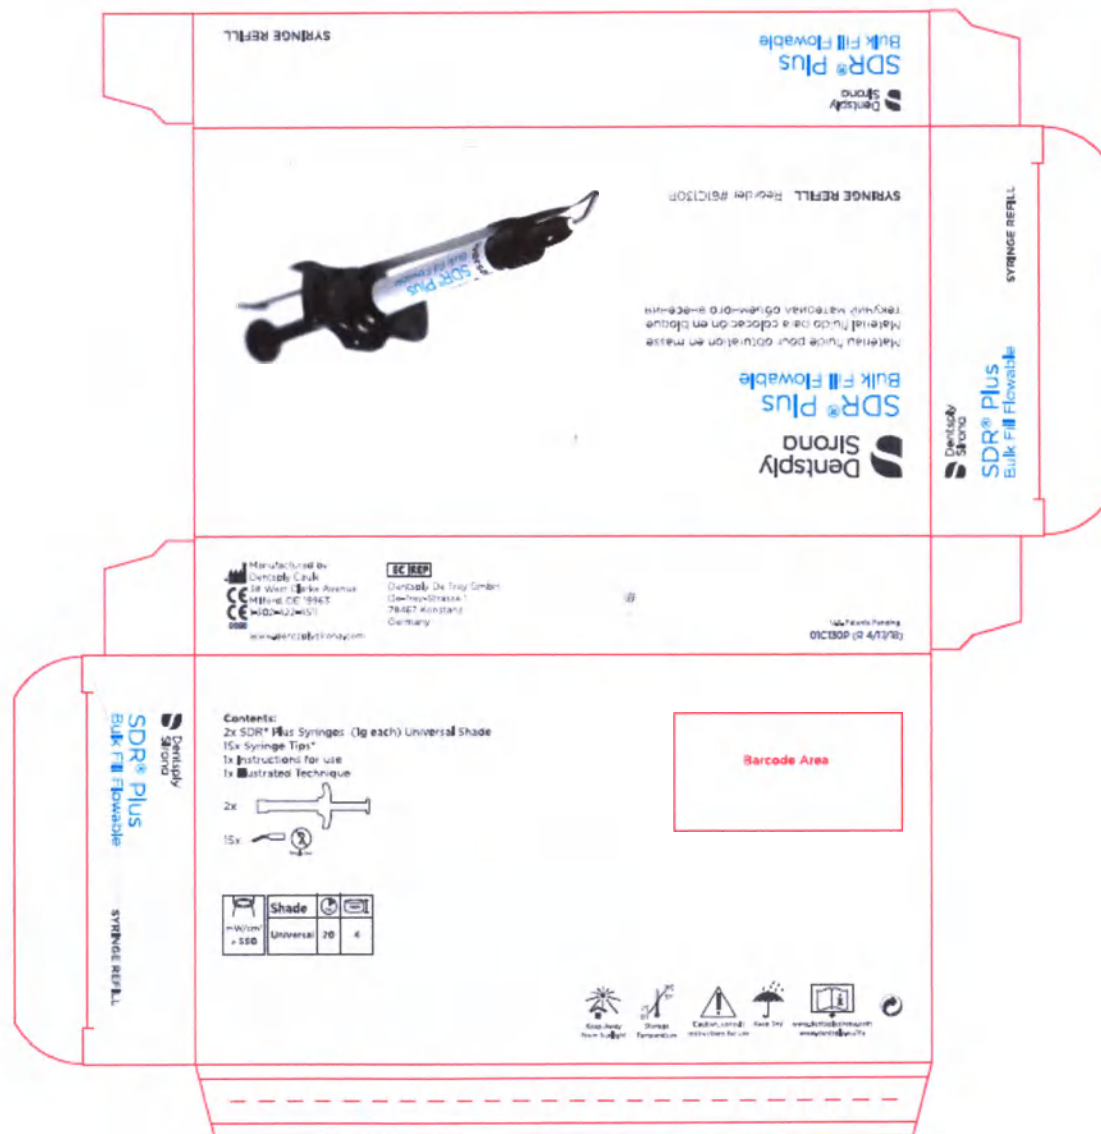


Фото 22 - Материал стоматологический текучий объемного внесения SDR® Plus в шприцах по 1 г каждый – 2 шт. (Универсальный оттенок), аппликаторы (syringe tips) – 15 шт., инструкция по применению – 1 шт., иллюстрированное техническое руководство – 1 шт. (потребительская упаковка)



Фото 23 - Материал стоматологический текучий объемного внесения SDR® Plus в шприцах по 1 г каждый – 2 шт.
(Универсальный оттенок), аппликаторы (syringe tips) – 15 шт., инструкция по применению – 1 шт., иллюстрированное
техническое руководство – 1 шт.

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

РУ № РЗН ##### от ##.##.####

Только для использования врачами стоматологами.

Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях представлена в инструкции по применению.

■ Информация о сроках и условиях хранения представлена на упаковке и в инструкции по применению.

Сохраняйте упаковку до окончания использования продукта.

Производитель:

Dentsply LLC also dba Dentsply
Caulk / Дентсплай ЭлЭлСи
также осуществляющая
деятельность под
наименованием Дентсплай
Колк
Адрес: 38 West Clarke Avenue,
Milford, Delaware, 19963, USA

Страна происхождения:

Уполномоченный

представитель:»
ООО «Дентсплай Сирона»,
Российская Федерация,
115432, Москва, проспект
Андропова, д.18, корп. 6,
офисы 1 39 40,
тел.: +7 (495) 725 10 87

США



Место для номера
стикера

Фото 24 - Материал стоматологический текучий объемного внесения SDR® Plus в шприцах по 1 г каждый – 2 шт.
(Универсальный оттенок), аппликаторы (syringe tips) – 15 шт., инструкция по применению – 1 шт., иллюстрированное
техническое руководство – 1 шт. (маркировка потребительской упаковки)



Фото 26 - Материал стоматологический текучий объемного внесения SDR® Plus в шприцах по 1 г. каждый – 10 шт. (Универсальный оттенок), аппликаторы (syringe tips) – 60 шт.; инструкция по применению – 1 шт., иллюстрированное техническое руководство – 1 шт.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

РУ № РЗН #####/##### от ##.##.####

Только для использования врачами стоматологами.

Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях представлена в инструкции по применению.

■ Информация о сроках и условиях хранения представлена на упаковке и в инструкции по применению.

Сохраняйте упаковку до окончания использования продукта.

Производитель:

Dentsply LLC also dba Dentsply
Caulk / Дентсплай ЭлЭлСи
также осуществляющая
деятельность под
наименованием Дентсплай
Колк
Адрес: 38 West Clarke Avenue,
Milford, Delaware, 19963, USA

Страна происхождения:

Уполномоченный

представитель:
ООО «Дентсплай Сирона»,
Российская Федерация,
115432, Москва, проспект
Андропова, д.18, корп. 6,
офисы 1 39 40,
тел.: +7 (495) 725 10 87

США



Место для номера
стикера

Фото 27 - Материал стоматологический текущий объемного внесения SDR® Plus в шприцах по 1 г. каждый – 10 шт.
(Универсальный оттенок), аппликаторы (syringe tips) – 60 шт.; инструкция по применению – 1 шт., иллюстрированное
техническое руководство – 1 шт. (маркировка потребительской упаковки)



Фото 28 - Материал стоматологический текучий объемного внесения SDR® Plus в шприце по 1 г – 1 шт. (Универсальный оттенок), аппликаторы (syringe tips) – 3 шт., инструкция по применению – 1 шт., иллюстрированное техническое руководство – 1 шт., карточка ID – 1 шт., карточка повторного заказа – 1 шт. (потребительская упаковка)



Фото 29 - Материал стоматологический текучий объемного внесения SDR® Plus в шприце по 1 г – 1 шт. (Универсальный оттенок), аппликаторы (syringe tips) – 3 шт., инструкция по применению – 1 шт., иллюстрированное техническое руководство – 1 шт., карточка ID – 1 шт., карточка повторного заказа – 1 шт.

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

РУ № РЗН ##### от ##.##.####

Только для использования врачами стоматологами.

Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях представлена в инструкции по применению.

 Информация о сроках и условиях хранения представлена на упаковке и в инструкции по применению.

Сохраняйте упаковку до окончания использования продукта.

Производитель:

Dentsply LLC also dba Dentsply
Caulk / Дентсплай ЭлЭлСи
также осуществляющая
деятельность под
наименованием Дентсплай
Колк
Адрес: 38 West Clarke Avenue,
Milford, Delaware, 19963, USA

**Уполномоченный
представитель:**

ООО «Дентсплай Сирона»,
Российская Федерация,
115432, Москва, проспект
Андропова, д.18, корп. 6,
офисы 1 39 40,
тел.: +7 (495) 725 10 87



Место для номера
стикера

Страна происхождения:

США

Фото 30 - Материал стоматологический текучий объемного внесения SDR® Plus в шприце по 1 г – 1 шт. (Универсальный оттенок), аппликаторы (syringe tips) – 3 шт., инструкция по применению – 1 шт., иллюстрированное техническое руководство – 1 шт., карточка ID – 1 шт., карточка повторного заказа – 1 шт. (маркировка потребительской упаковки)



Фото 32 - Аппликаторы (syringe tips) – 60 шт./уп.

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

РУ № РЗН #####/##### от ##.##.####

Только для использования врачами стоматологами.

Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях представлена в инструкции по применению.

■ Информация о сроках и условиях хранения представлена на упаковке и в инструкции по применению.

Сохраняйте упаковку до окончания использования продукта.

Производитель:

Dentsply LLC also dba Dentsply
Caulk / Дентсплай ЭлЭлСи
также осуществляющая
деятельность под
наименованием Дентсплай
Колк
Адрес: 38 West Clarke Avenue,
Milford, Delaware, 19963, USA

Страна происхождения:

Уполномоченный

представитель:
ООО «Дентсплай Сирона»,
Российская Федерация,
115432, Москва, проспект
Андропова, д.18, корп. 6,
офисы 1 39 40,
тел.: +7 (495) 725 10 87

США



Место для номера
стикера

Фото 33 - Аппликаторы (syring tips) – 60 шт./уп. (маркировка потребительской упаковки)



Фото 34 – Коробка для хранения (SDR[®] storage box)



Сшито 32 листа(ов)

Генеральный директор
ООО "Дентсплай Сирона"
Левин К.Г. 