

Фотографии медицинского изделия:
«Система хирургическая радиочастотная плазменная ARS»

производства. JIANGSU BONSS MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD/ ЦЗЯНСУ БОНСС МЕДИКАЛ ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД.

Директор ООО «СМК-Трейд»
(должность)



(подпись и печать заявителя)

Жданюк А.С.,
(И.О.Фамилия)



Фото 1. Система хирургическая радиочастотная плазменная ARS600



Фото 2. Контроллер ARS600;

Radio Frequency Plasma Surgical System

Model: ARS600

AC ~230V, 5A, 50Hz

Output: 330 W/250G₁ 100KHz



Jiangsu Bonss Medical Technology Co, Ltd

Building #7, No.898, China Medical City Avenue, Hailing
District, Taizhou City, 225316 Jiangsu P.R. China



MedNet GmbH

Borkstrasse 10, 48163 Münster, Germany


SN: A6-1905010 (G)



2025.05



2019.05



0197

IPX2



Фото 4. Система хирургическая радиочастотная плазменная ARS700/



Radio Frequency Plasma Surgical System

Model: ARS700


AC ~230V, 5A, 50Hz

Output: 330 W/250 Ω 100KHz



Jiangsu Bonss Medical Technology Co, Ltd

Building #7, №.898, China Medical Avenue, Hailing District,
Taizhou City, 225 Jiangsu P.R. China




MedNet GmbH

Borkstrasse 10, 48163 Münster, Germany



SN: A7-1811034 (T)



2024.11



2018.11




0197

IPX2



Фото 7. Блок управления потоком и кабель блока управления потоком.

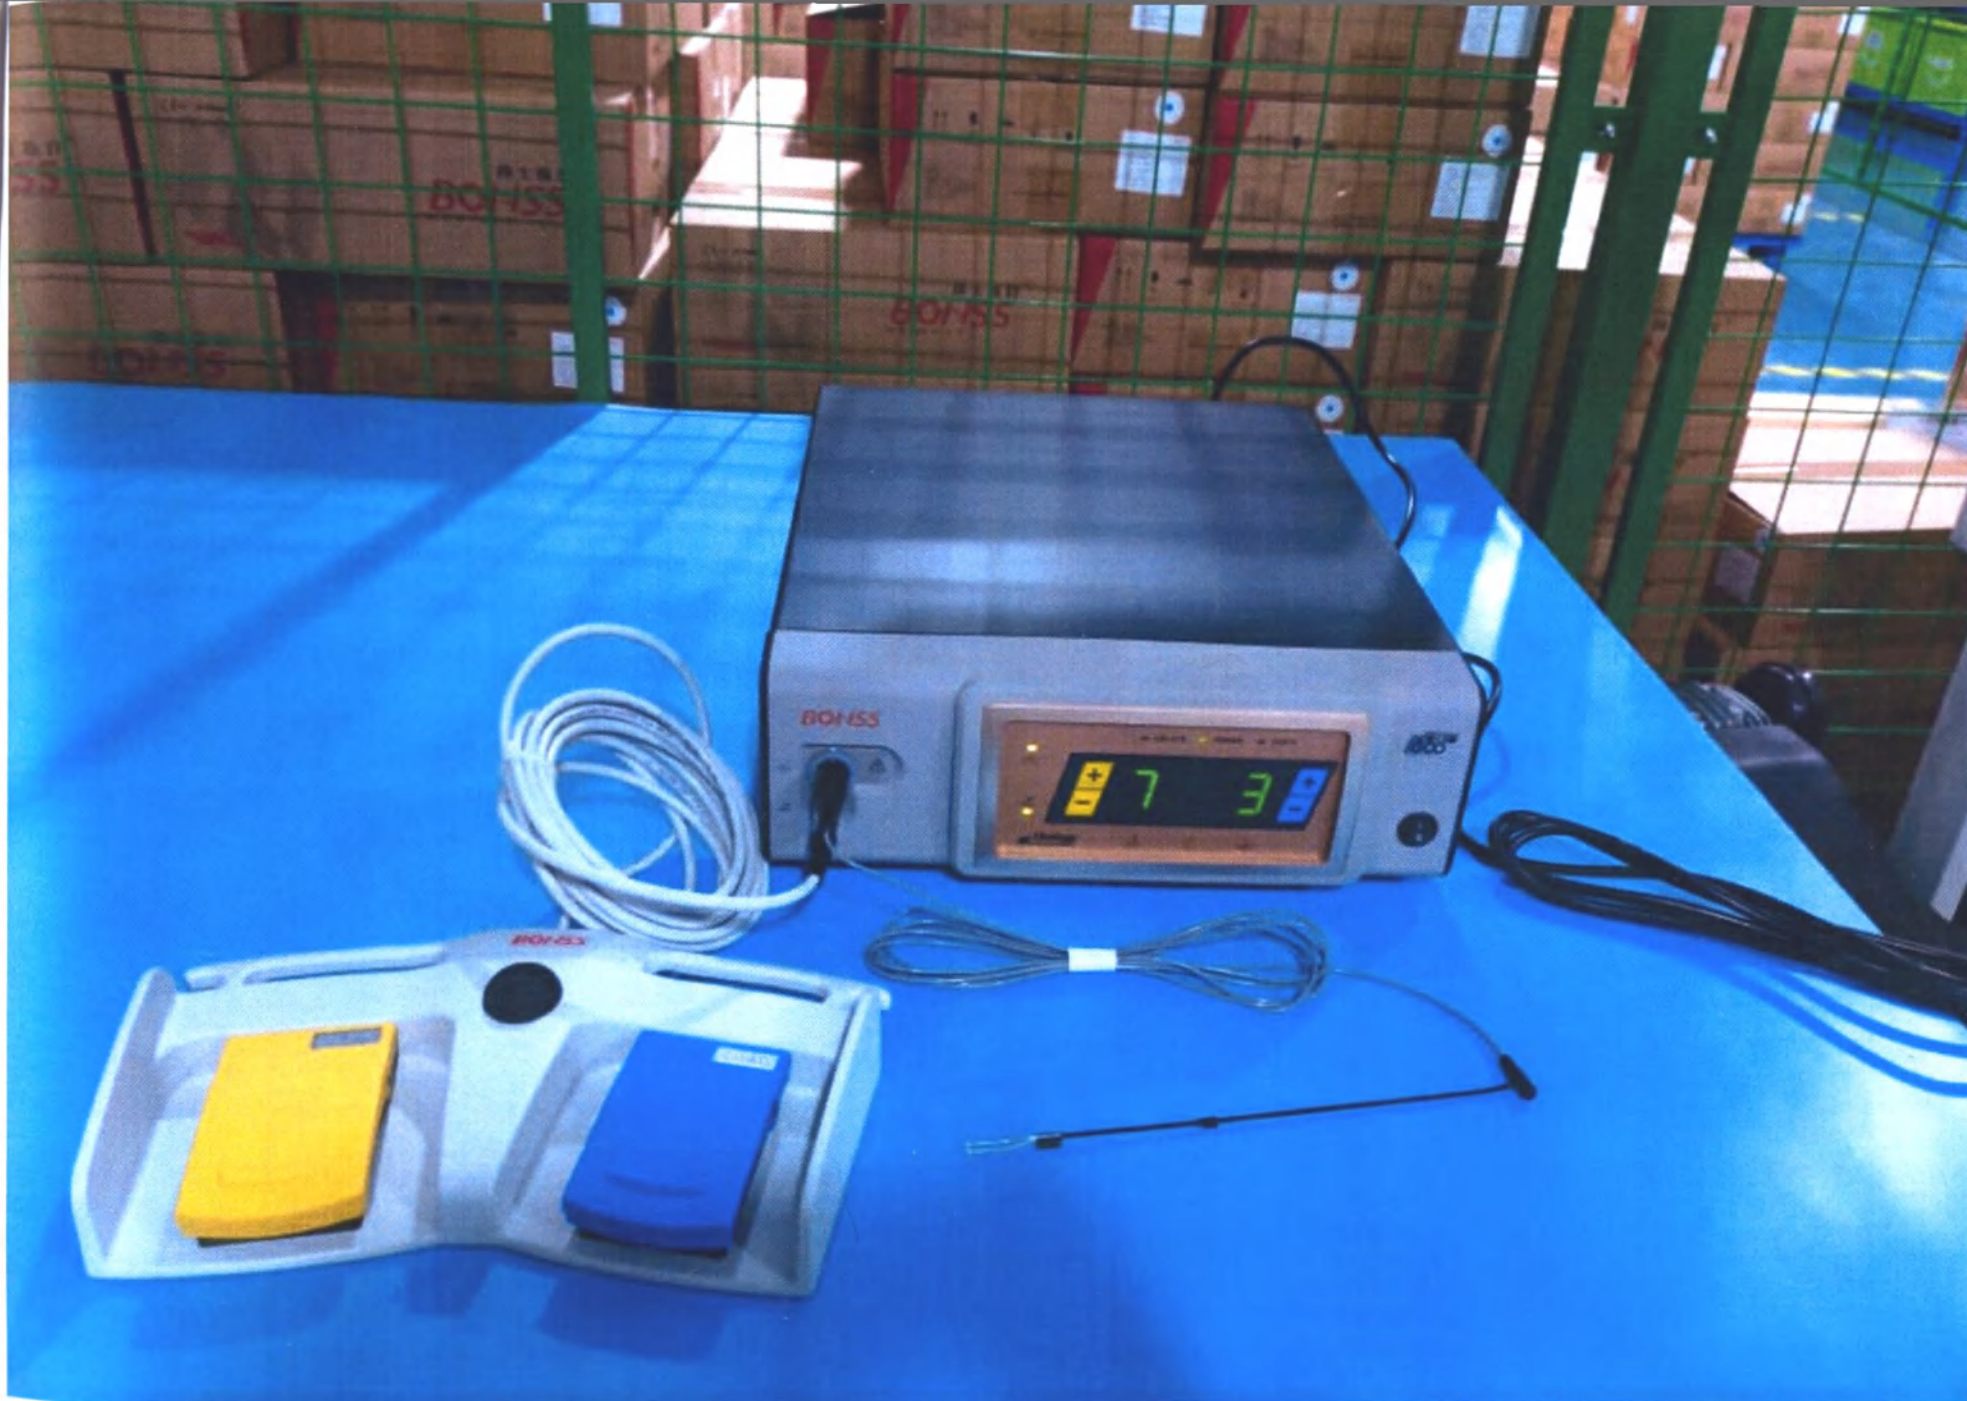

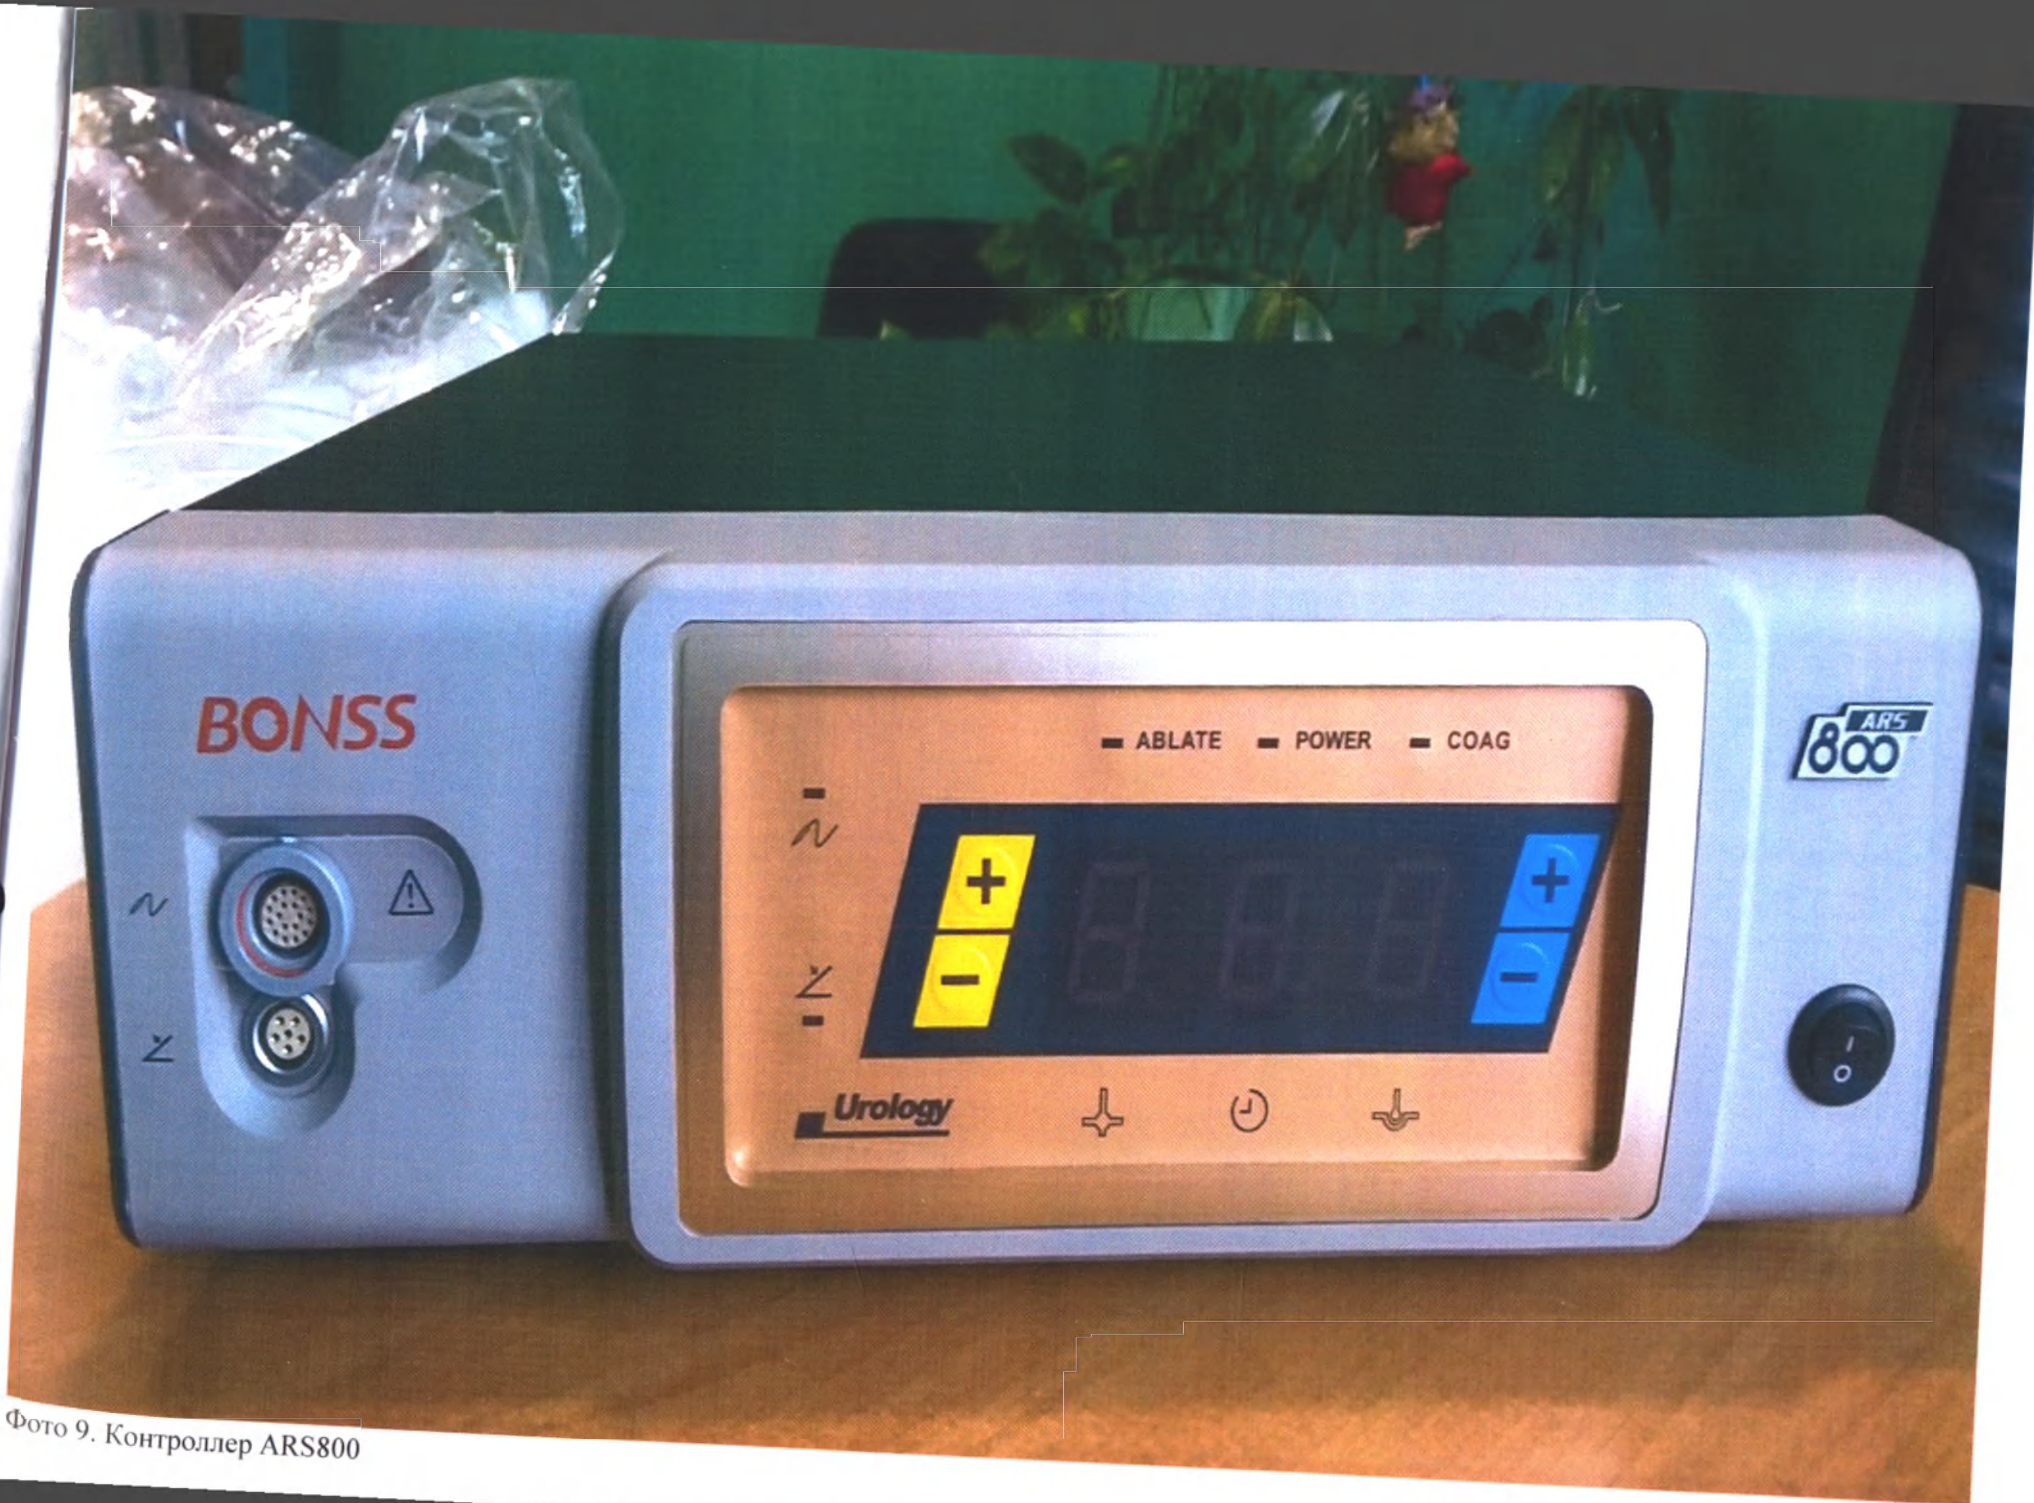


Фото 9. Контроллер ARS800

Radio Frequency Plasma Surgical System

Model: ARS800


AC ~230V, 5A, 50Hz

Output: 380W/250Ω, 100KHz



Jiangsu Bonss Medical Technology Co., Ltd


Building #7, No.898, China Medical City Avenue, Yaling District,
Taizhou City, 225316 Jiangsu P.R., China



MedNet GmbH

Borkstrasse 10, 48163 Münster, Germany

SN: A8-1809068 (D) 2024.09 2018.09



0197 IPX2

Фото 10. Шнур питания





产品名称：脚踏开关

产品编号：AJ18081315-S 型号：AJ120

生产日期：2018年08月 控制电压：DC5V

生产企业名称：江苏邦士医疗科技有限公司

联系电话：052386813258

www.bonss.com.cn

Product Name: Foot Switch

Product No.: AJ18081315-S Model No.: AJ120

Production Date: Aug. 2018 Control Voltage: DC5V

 Jiangsu Bonss Medical Technology Co., Ltd

IPX8



Фото 12. Маркировка Педелей переключения AJ120



Фото 13. Предохранитель SA – 2 шт.

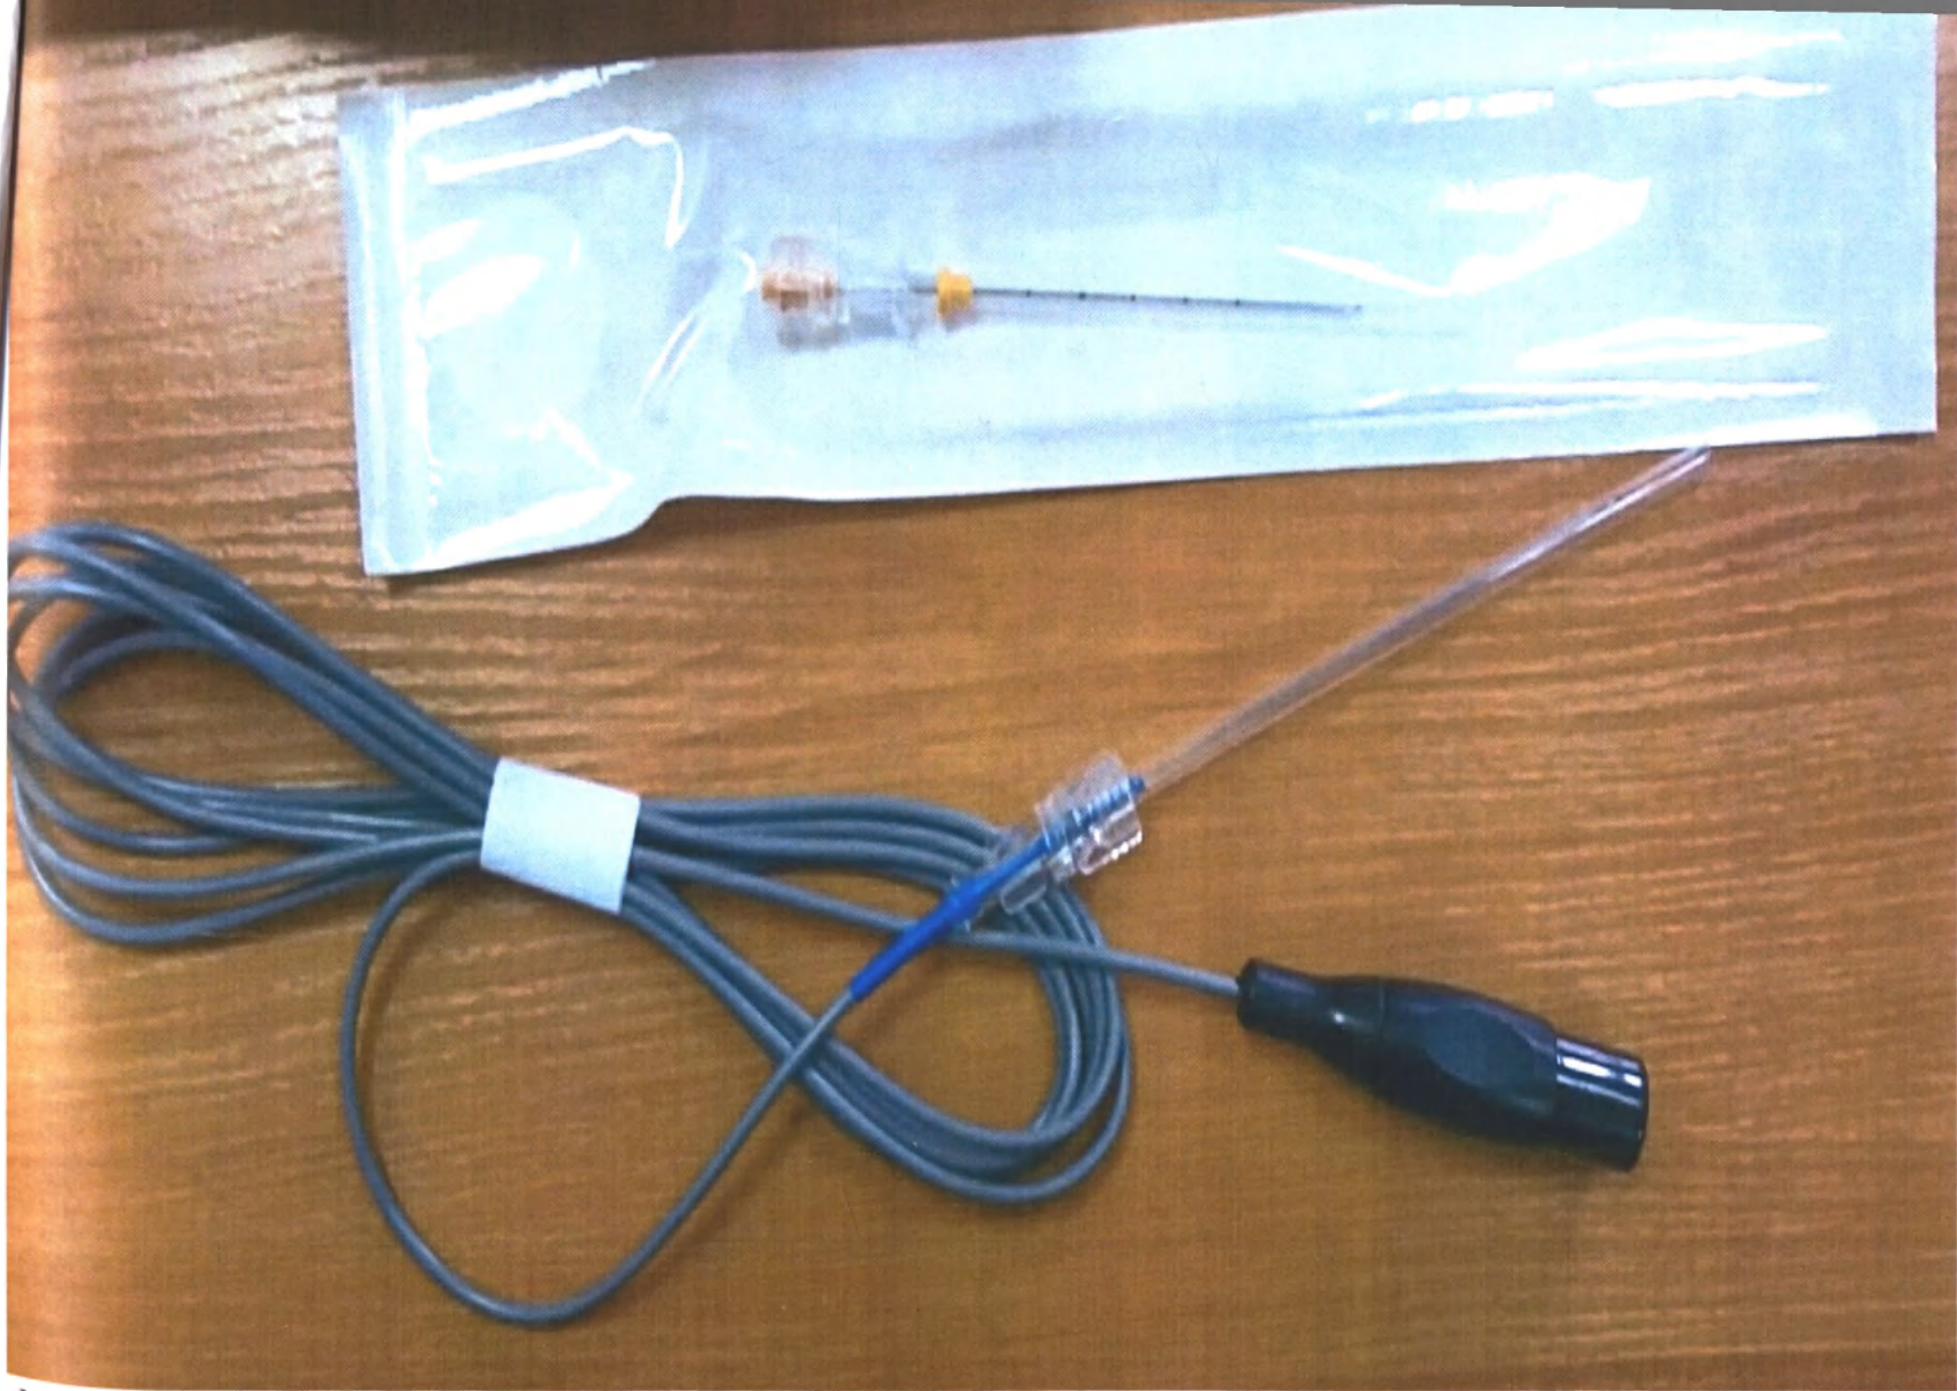


Фото 14. Датчик АС301-20102

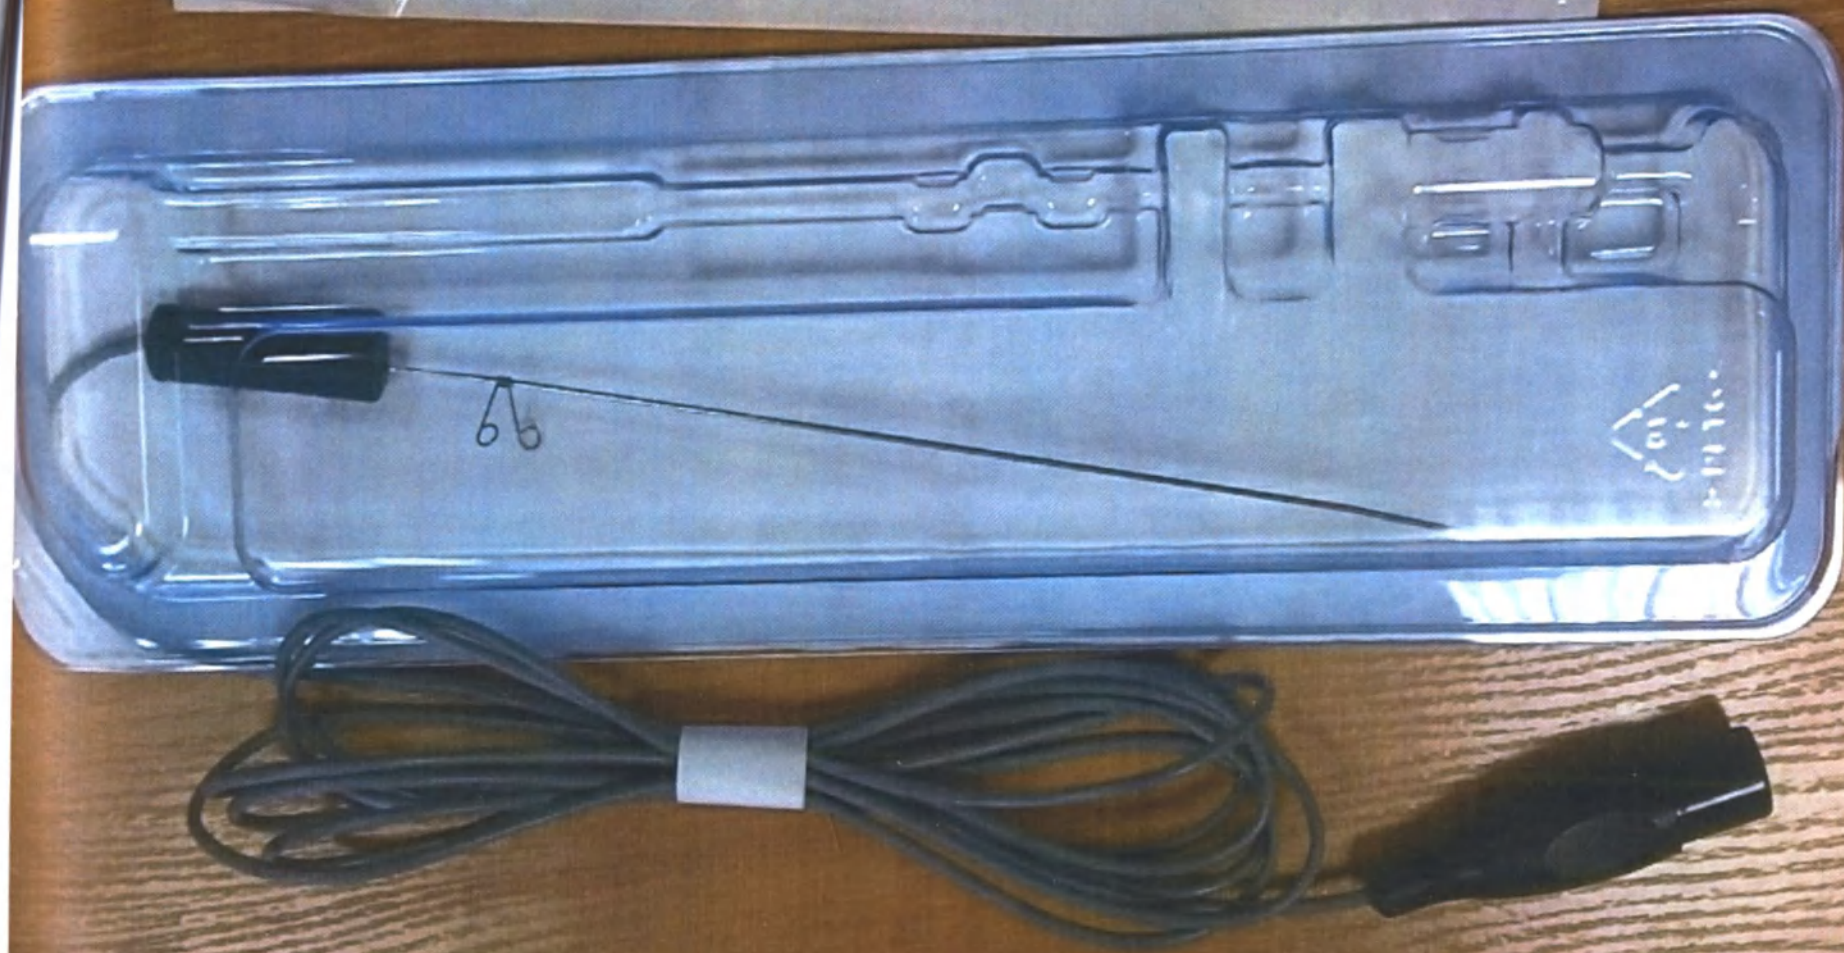


Фото 15. Электрод АС302, 302Q4;



Фото 16. Электрод МС302, 302Q5



Фото 17. Электрод АС306, 306Q1;



Фото 18.. Электрод AC306, 306Q2





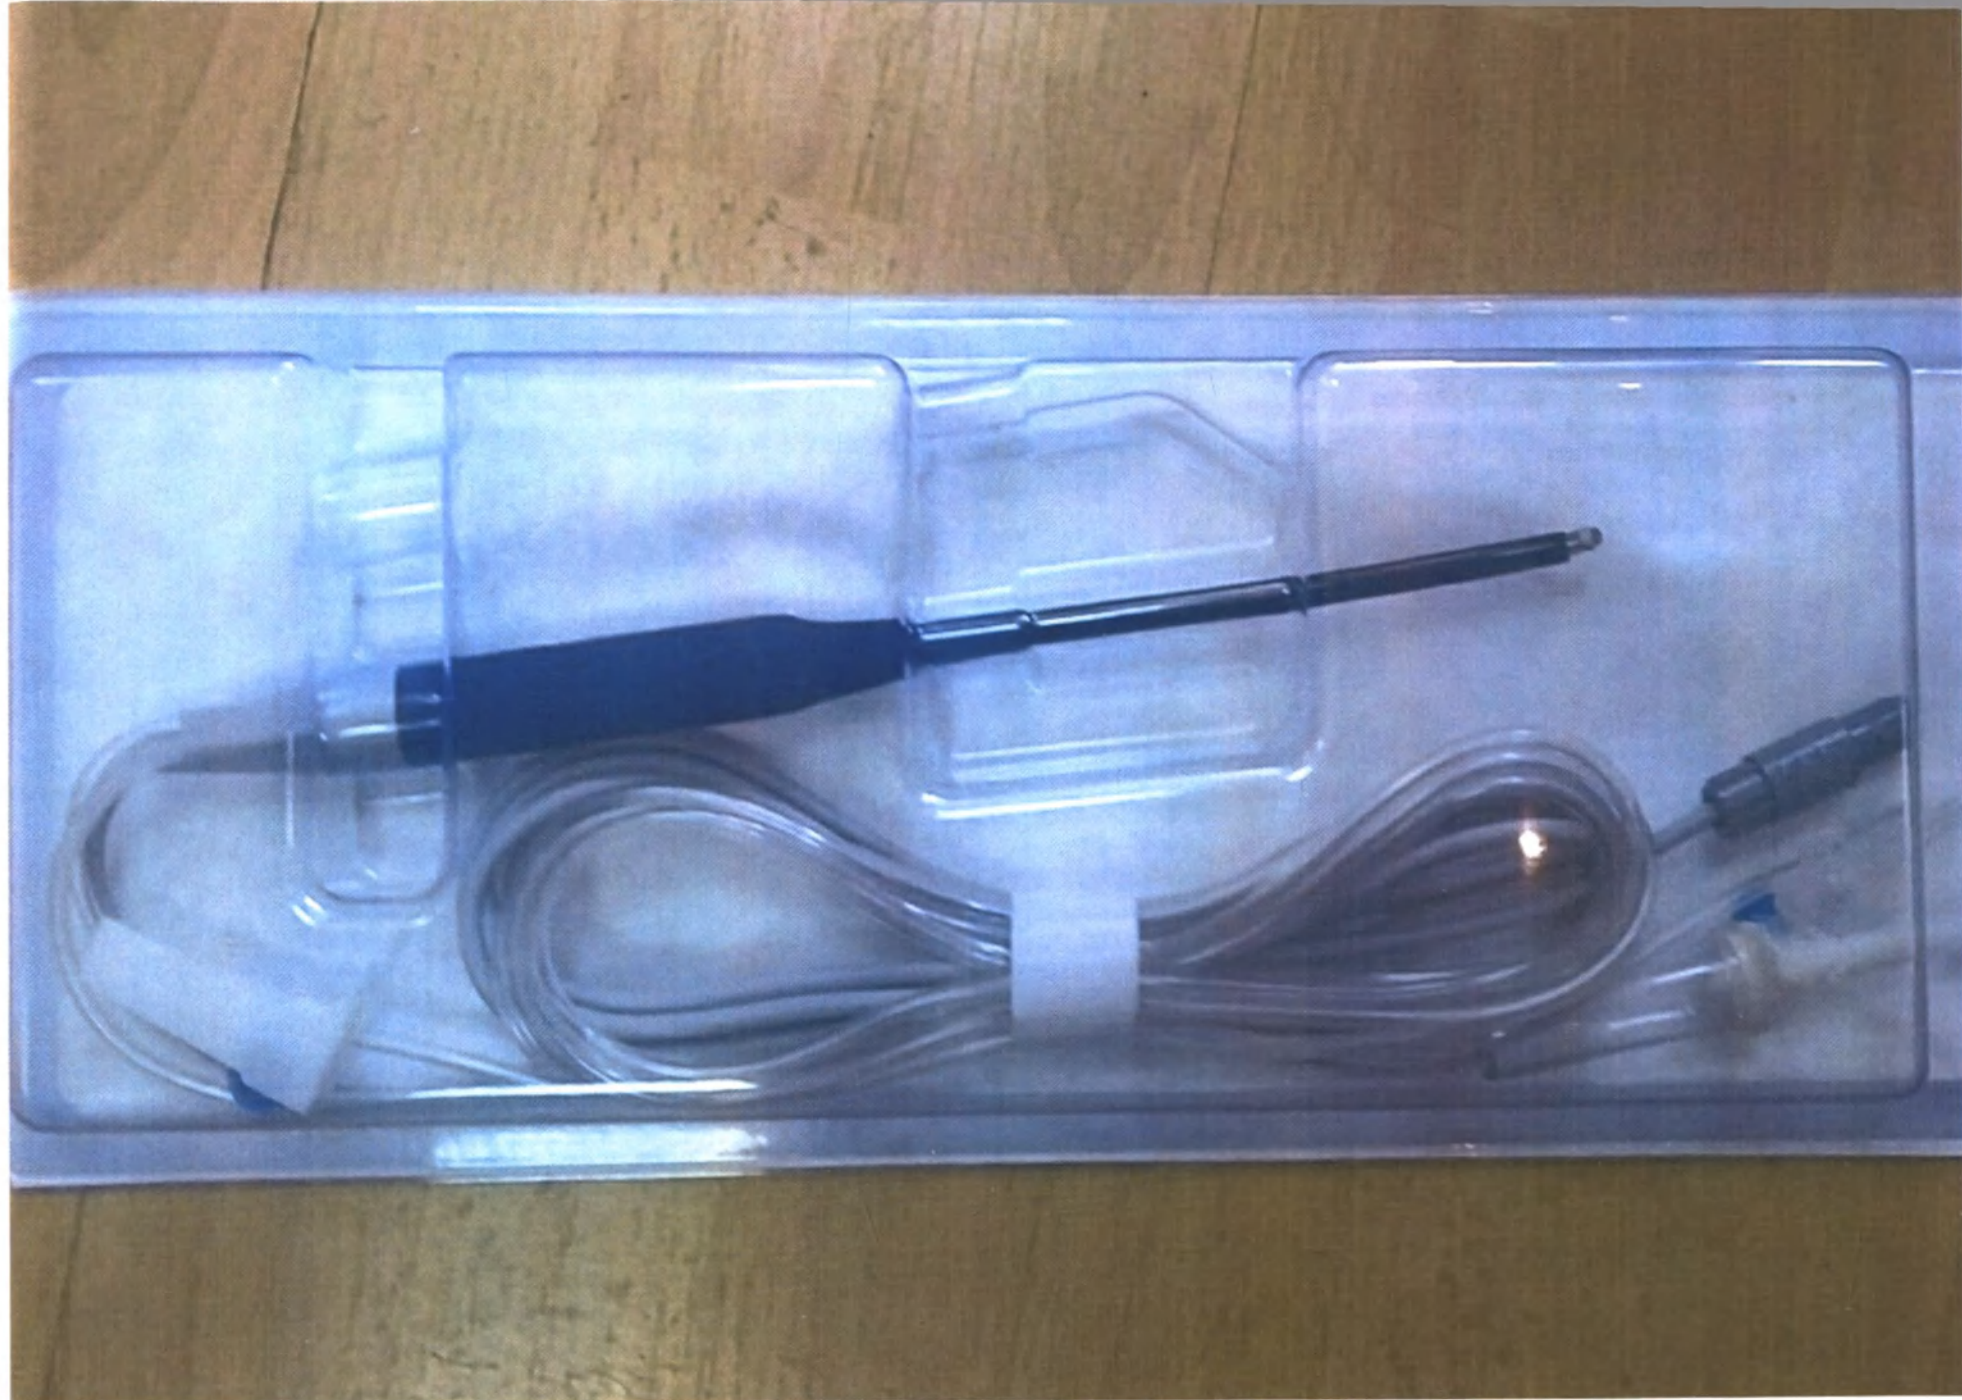


Фото 21. Электрод АС405, 405Q2;






















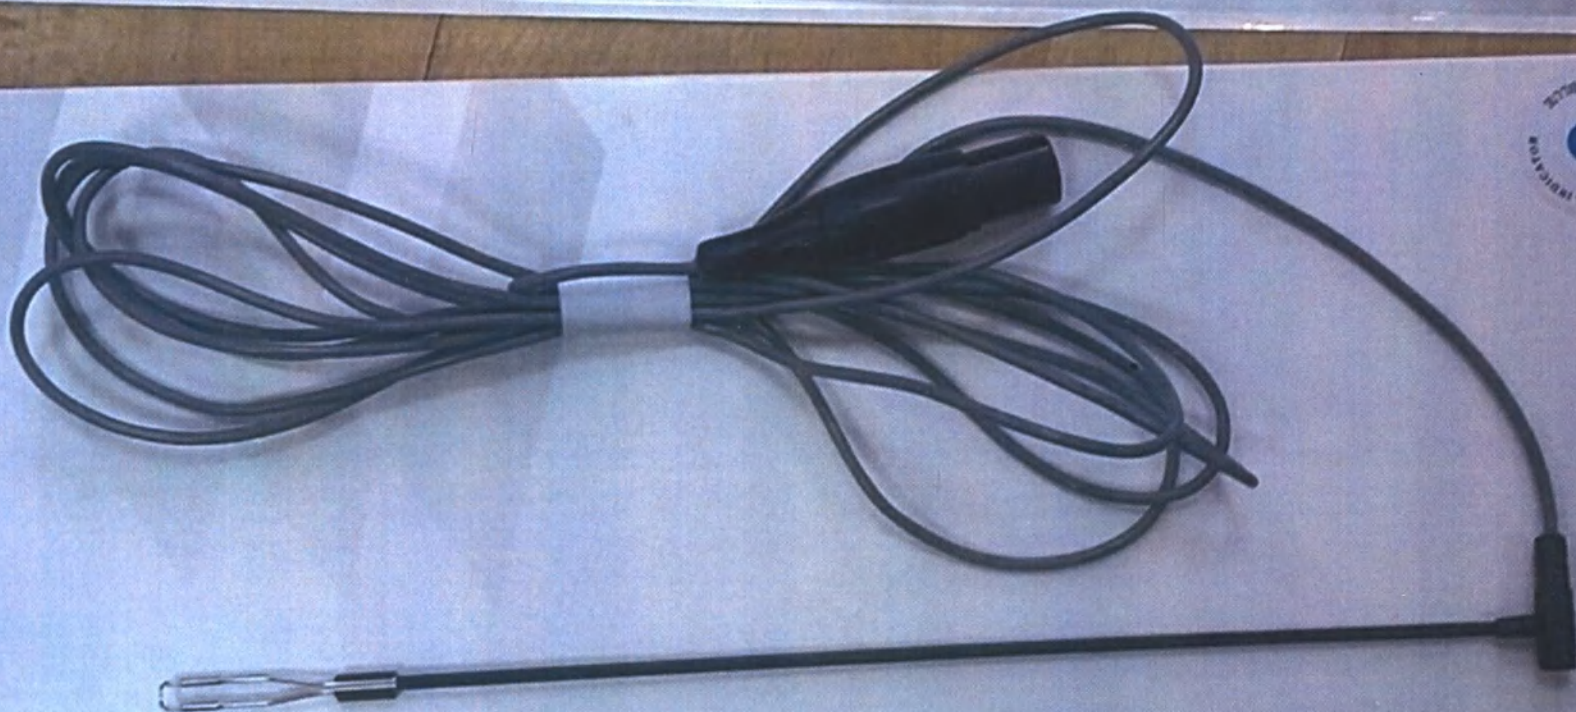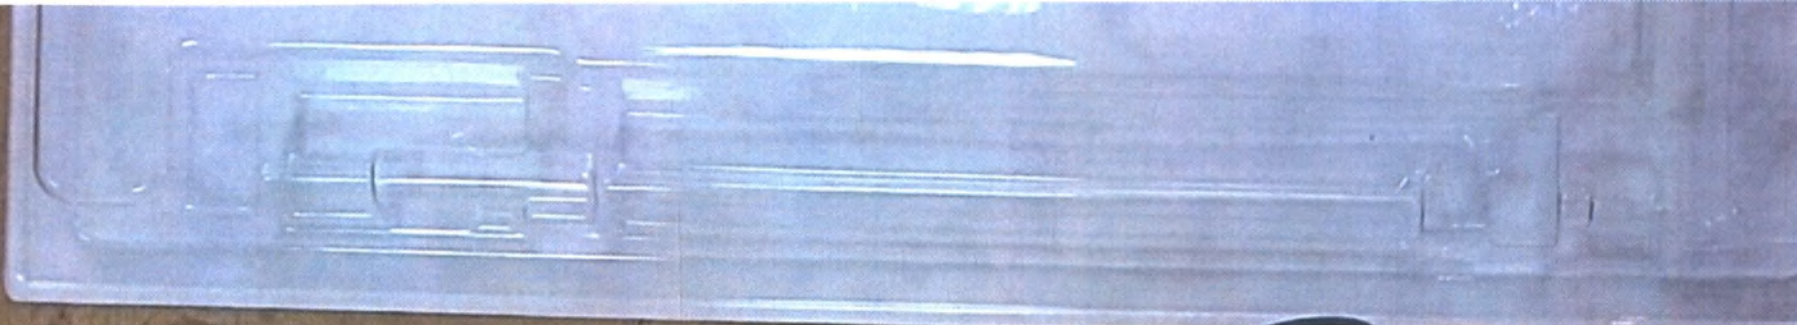

20000022
CONTENTS
1x10
MADE IN CHINA



BONSS
MEDICAL

**Radio Frequency
Plasma Surgical Electrode**

AC ~230V, 5A, 50Hz

Output: ~0-360V, 1A, 100KHz



JIANGSU BONSS
MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Building #7, No.898, China Medical
City Avenue, Hailing District, Taizhou
City, 225316 Jiangsu P.R. China

EC REP MedNet GmbH

Borkstrasse 10, 48163 Münster, Germany



0197

STERILE EO



Model: AC405

Ordering Code : 405Q3

Ref. Name: EZ-Blator90



6

927155 334054



20180824



20210823

LOT

A18082403

MADE IN CHINA



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью листа(ов)

Директор ООО «СМК-Трейд»

Жданюк А.С.

