



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
"РеалБест-Генетика UGT1A1"
серия 3

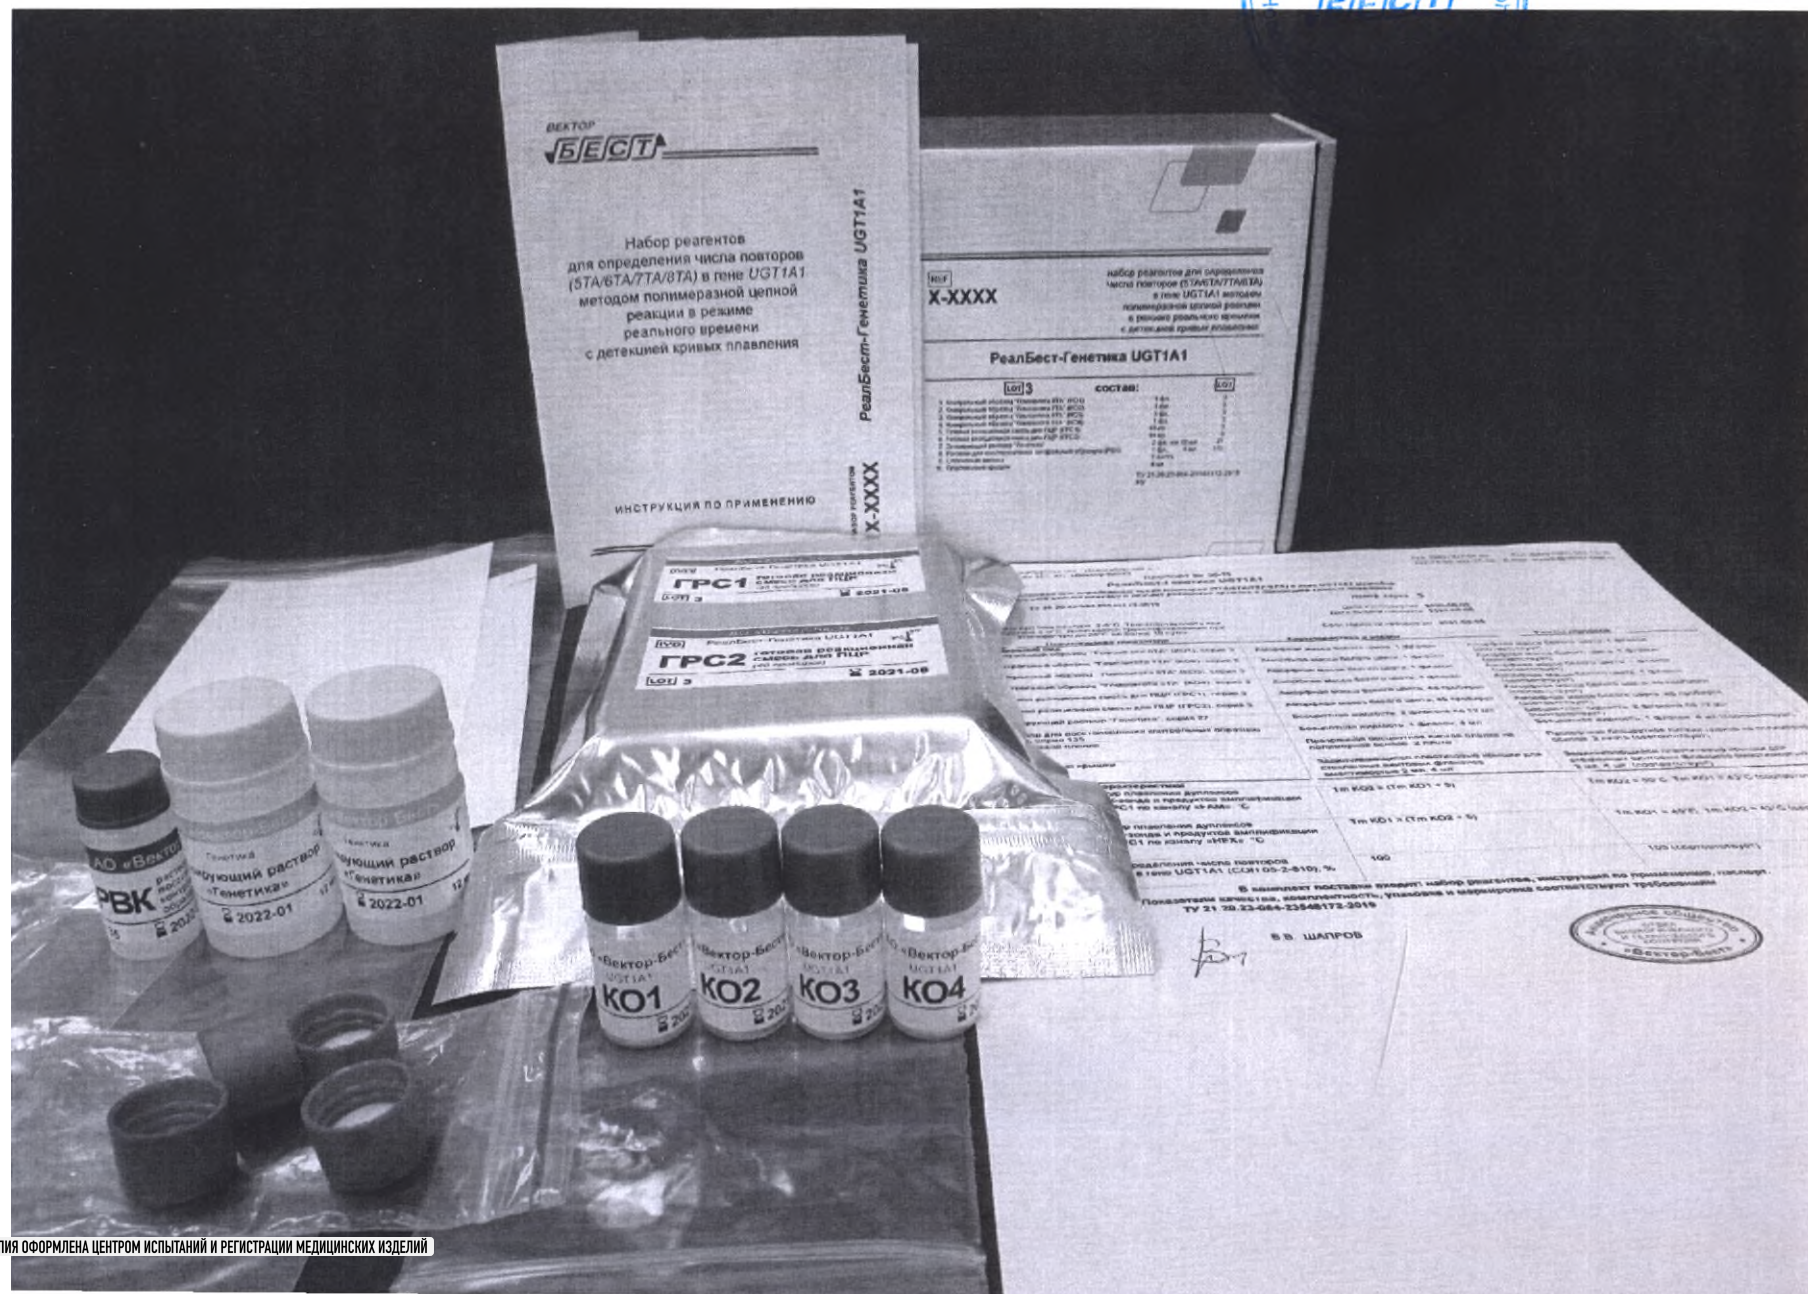


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"РеалБест-Генетика UGT1A1" №1
серия 3

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
2020 г.
М.П.

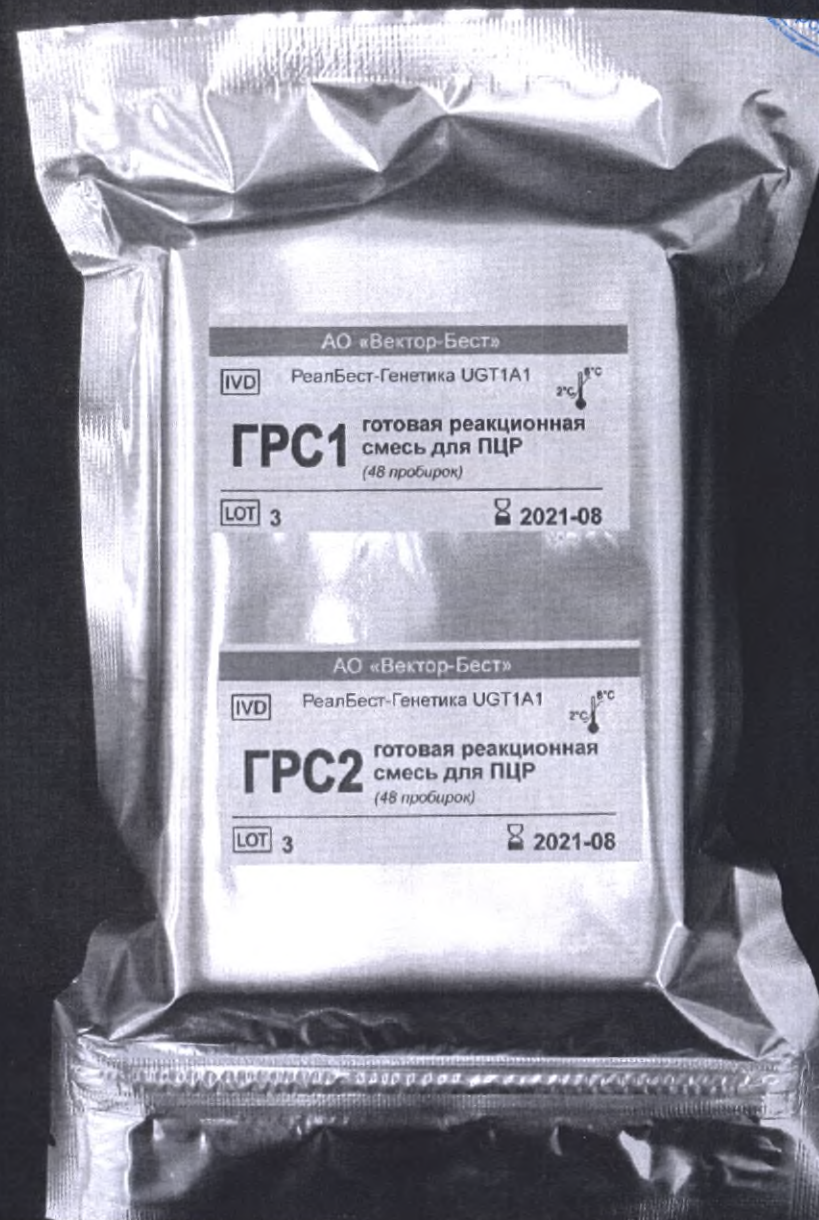


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“РеалБест-Генетика UGT1A1” №2
серия 3

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» М.Д. Хусаинов
2020 г.

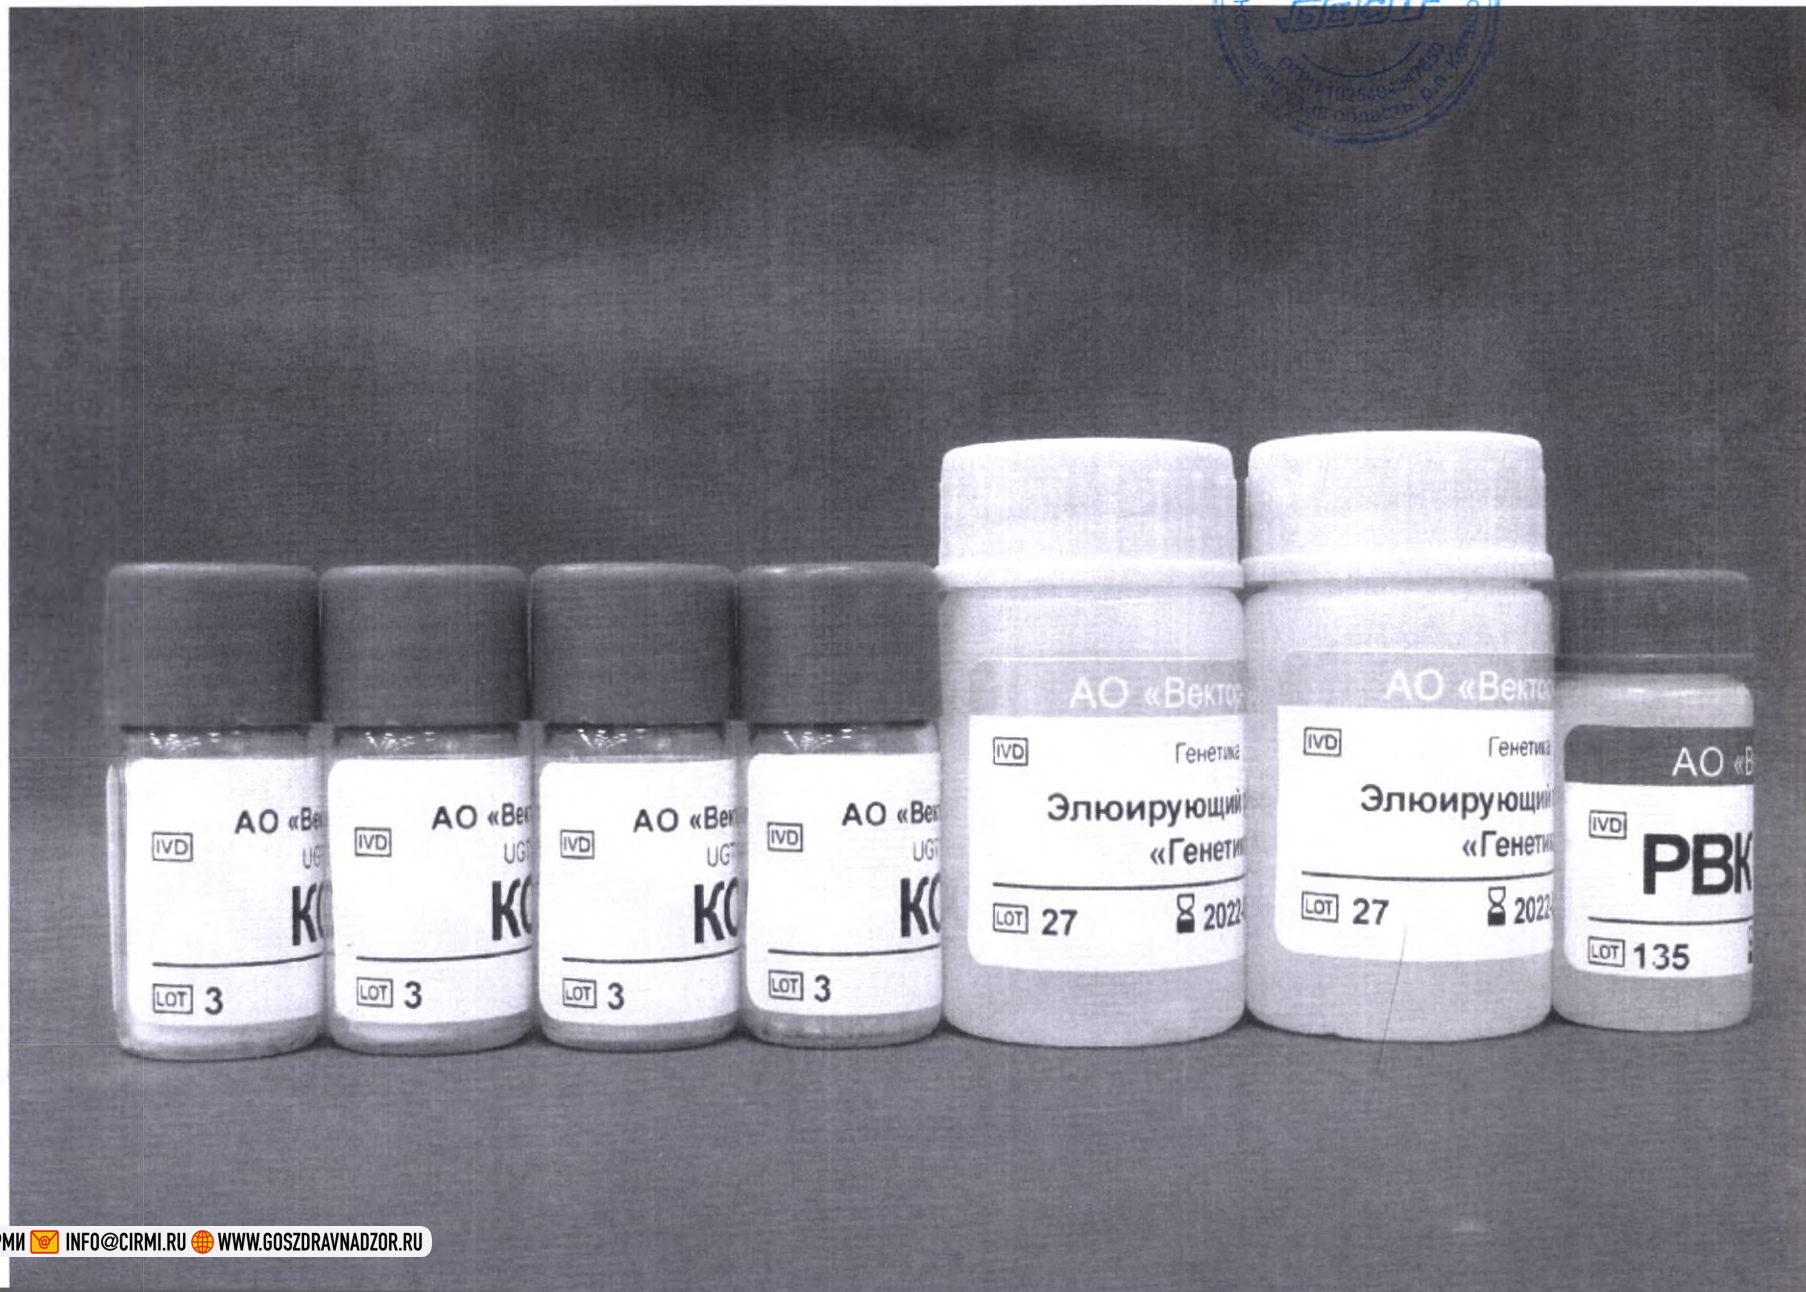



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“РеалБест-Генетика UGT1A1” №3
серия 3

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“Вектор-Бест” 2020 г.
М.П.

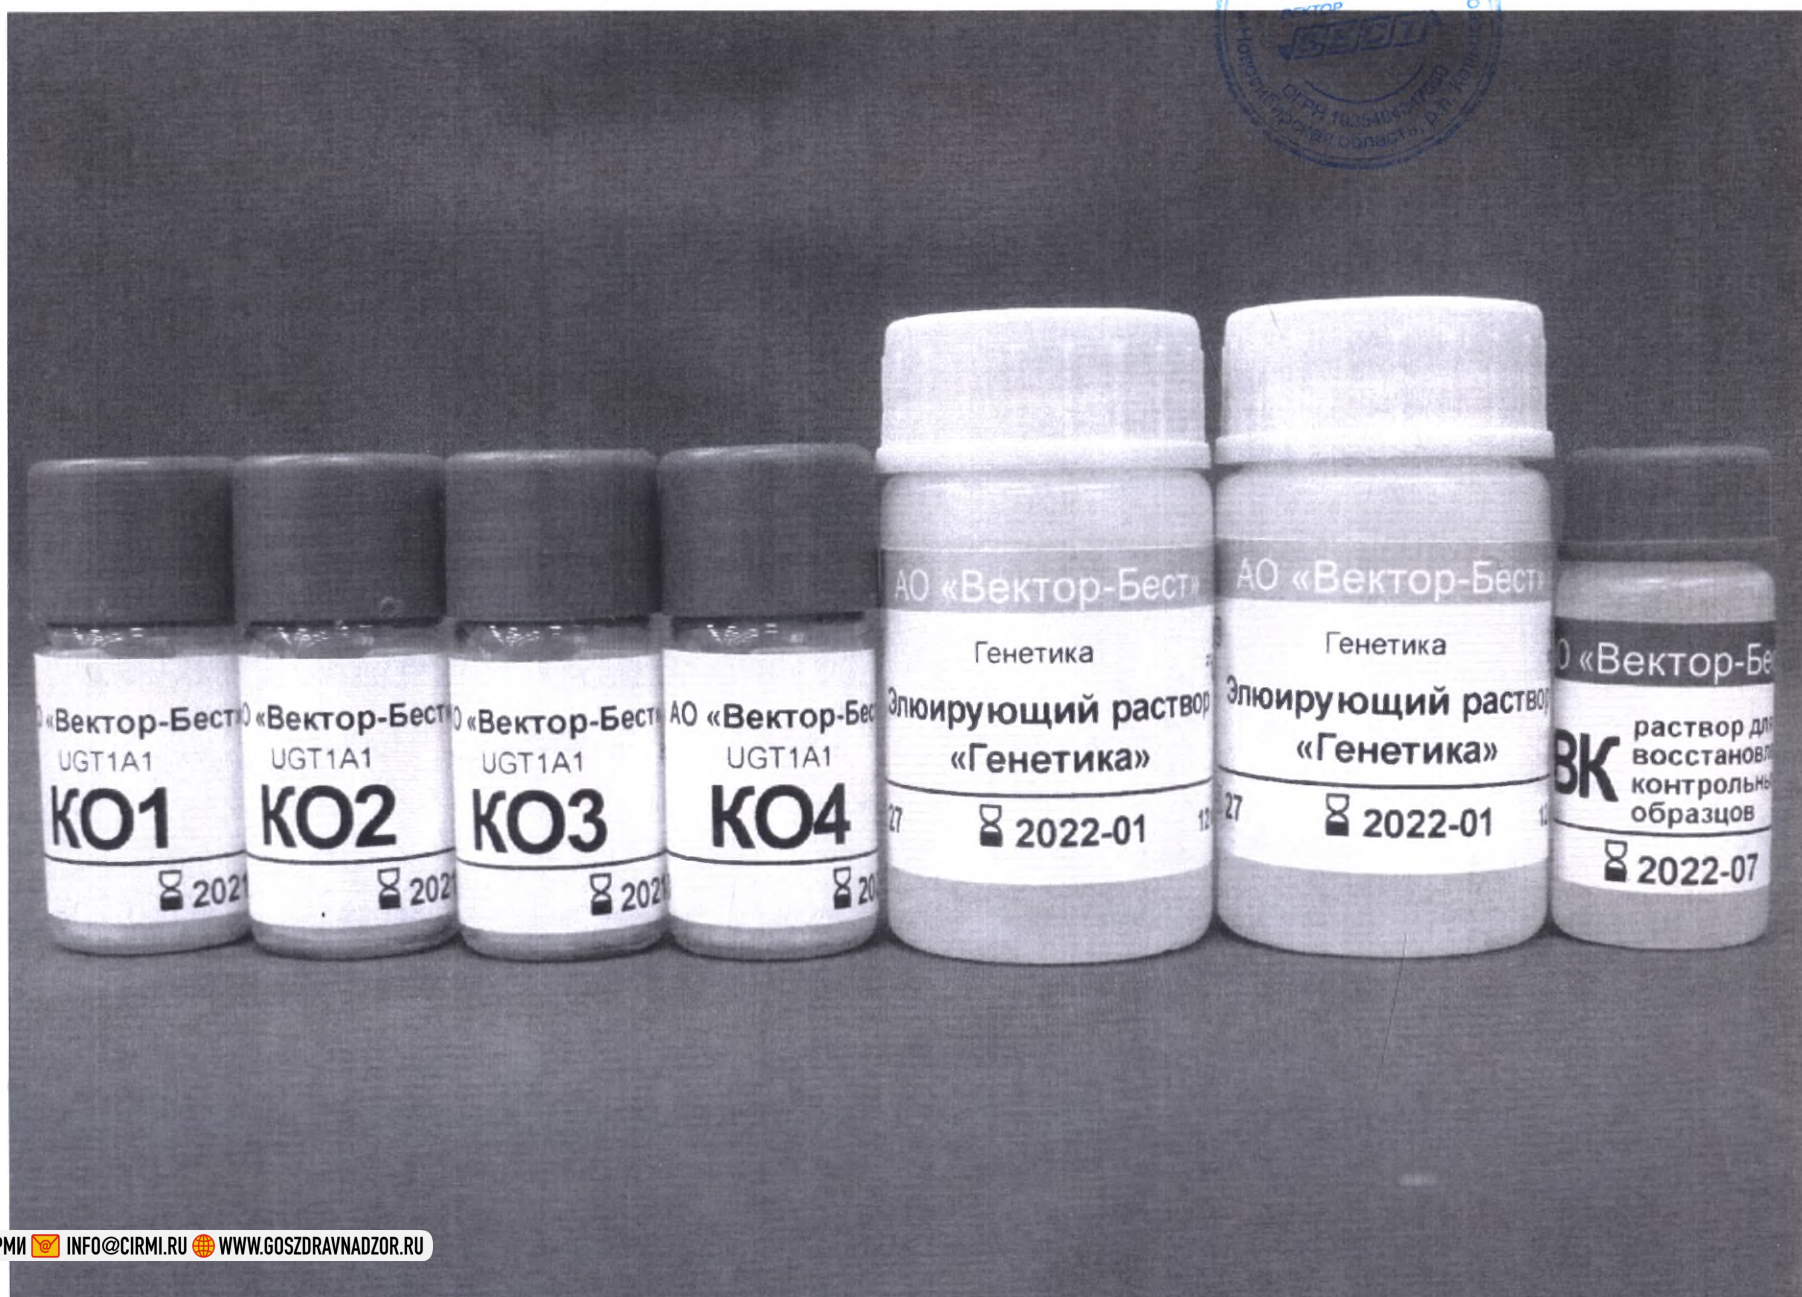

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«РеалБест-Генетика UGT1A1» №4
серия 3

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»  М.Д. Хусаинов
«Вектор-Бест» 2020 г.
М.П.

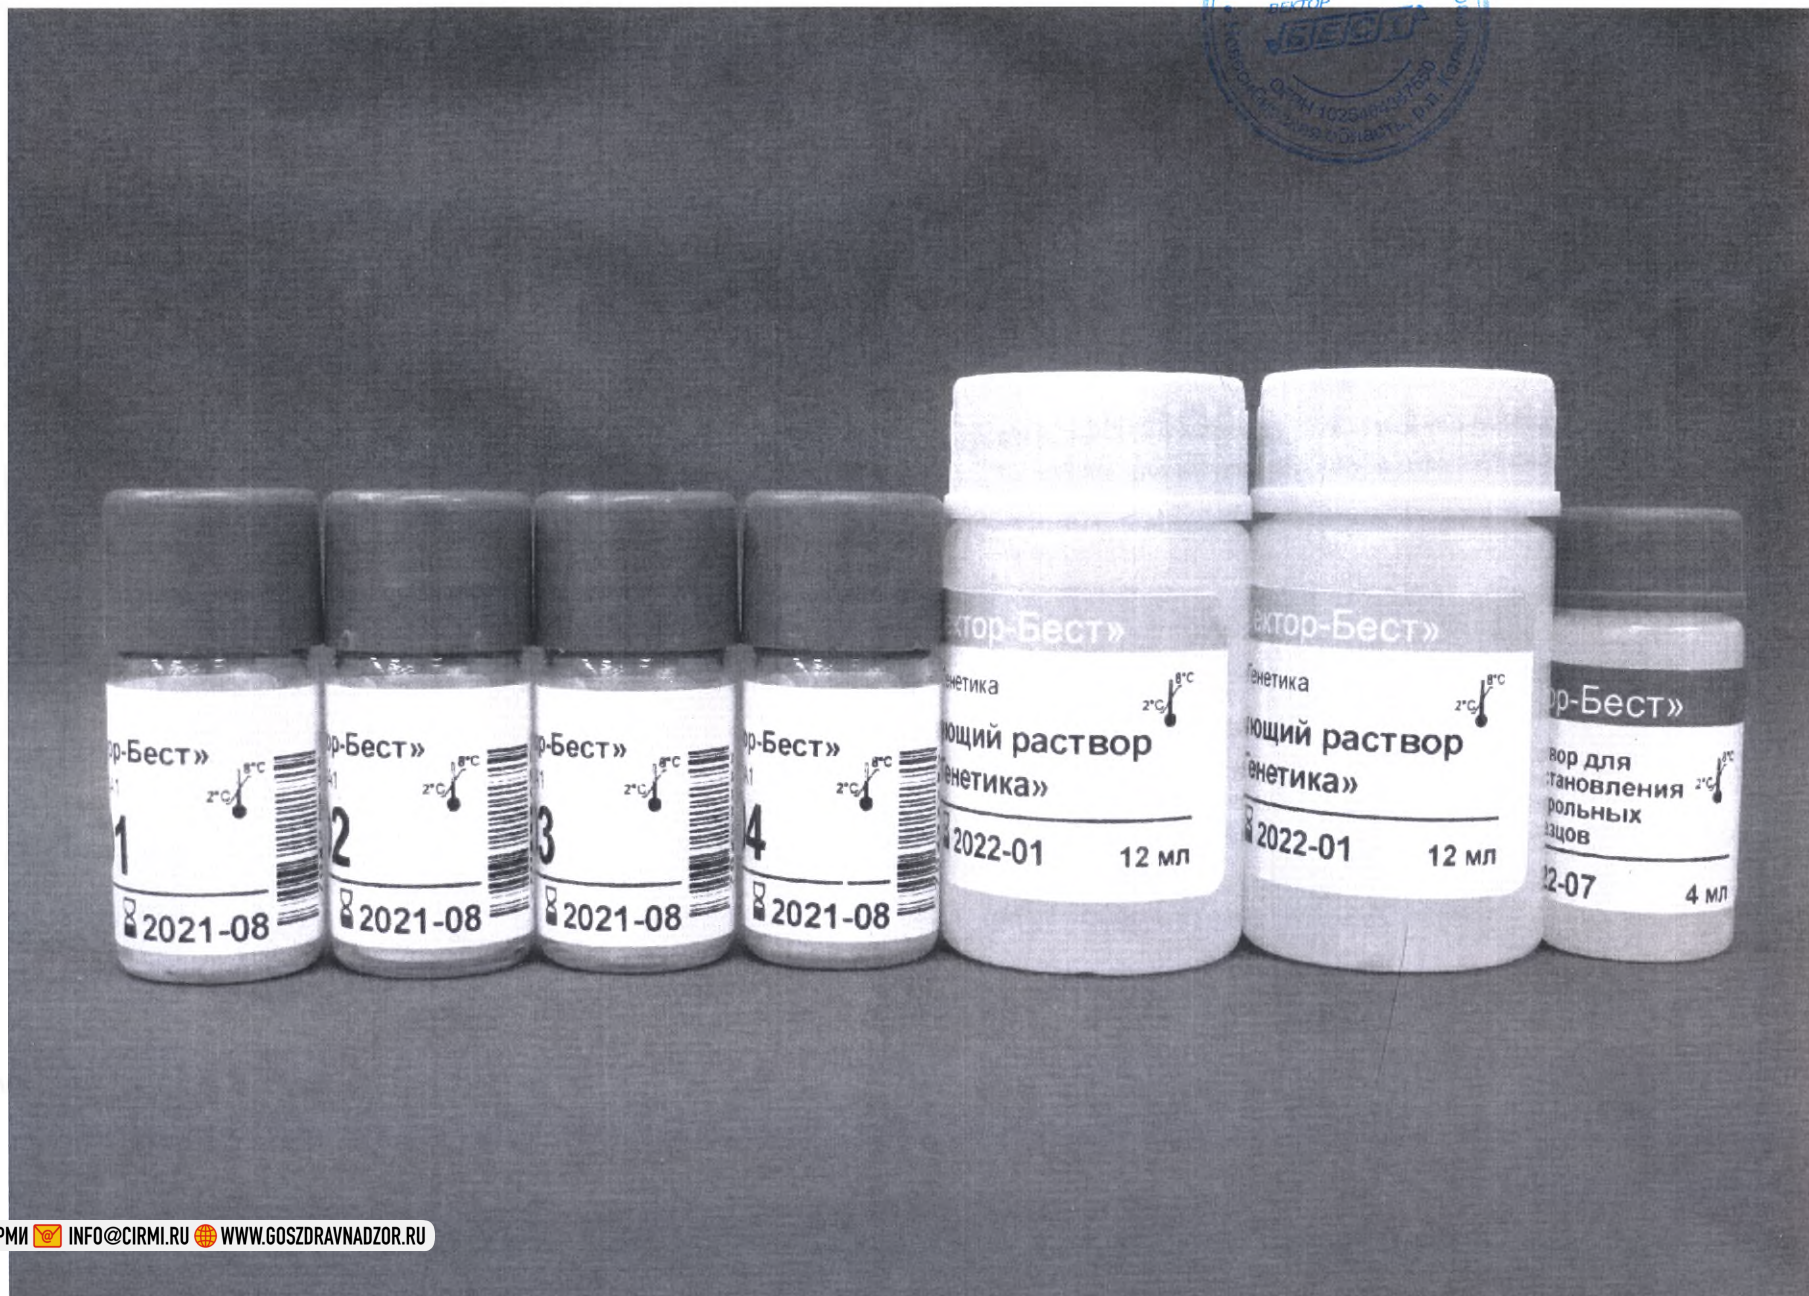

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“РеалБест-Генетика UGT1A1” №5
серия 3

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” _____ М.Д. Хусаинов
“25” _____ 2020 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"РеалБест-Генетика UGT1A1" №1
серия 3

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
2020 г.
М.П.

ВЕКТОР
БЕСТ

REF
X-XXXX

набор реагентов для определения
числа повторов (5ТА/6ТА/7ТА/8ТА)
в гене UGT1A1 методом
полимеразной цепной реакции
в режиме реального времени
с детекцией кривых плавления

РеалБест-Генетика UGT1A1

LOT 3

состав:


LOT

1. Контрольный образец "Гомозигота 6ТА" (КО1)	1 фл.	3
2. Контрольный образец "Гомозигота 7ТА" (КО2)	1 фл.	3
3. Контрольный образец "Гомозигота 8ТА" (КО3)	1 фл.	3
4. Контрольный образец "Гомозигота 5ТА" (КО4)	1 фл.	3
5. Готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС1)	48 пр.	3
6. Готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС2)	48 пр.	3
7. Элюирующий раствор "Генетика"	2 фл. по 12 мл	27
8. Раствор для восстановления контрольных образцов (РВК)	1 фл., 4 мл	135
9. Оптическая пленка	2 листа	
10. Пластиковые крышки	4 шт.	


ТУ 21.20.23-064-23548172-2019
РУ

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"РеалБест-Генетика UGT1A1" №2
серия 3

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
"20" 11 2020 г.
М.П.

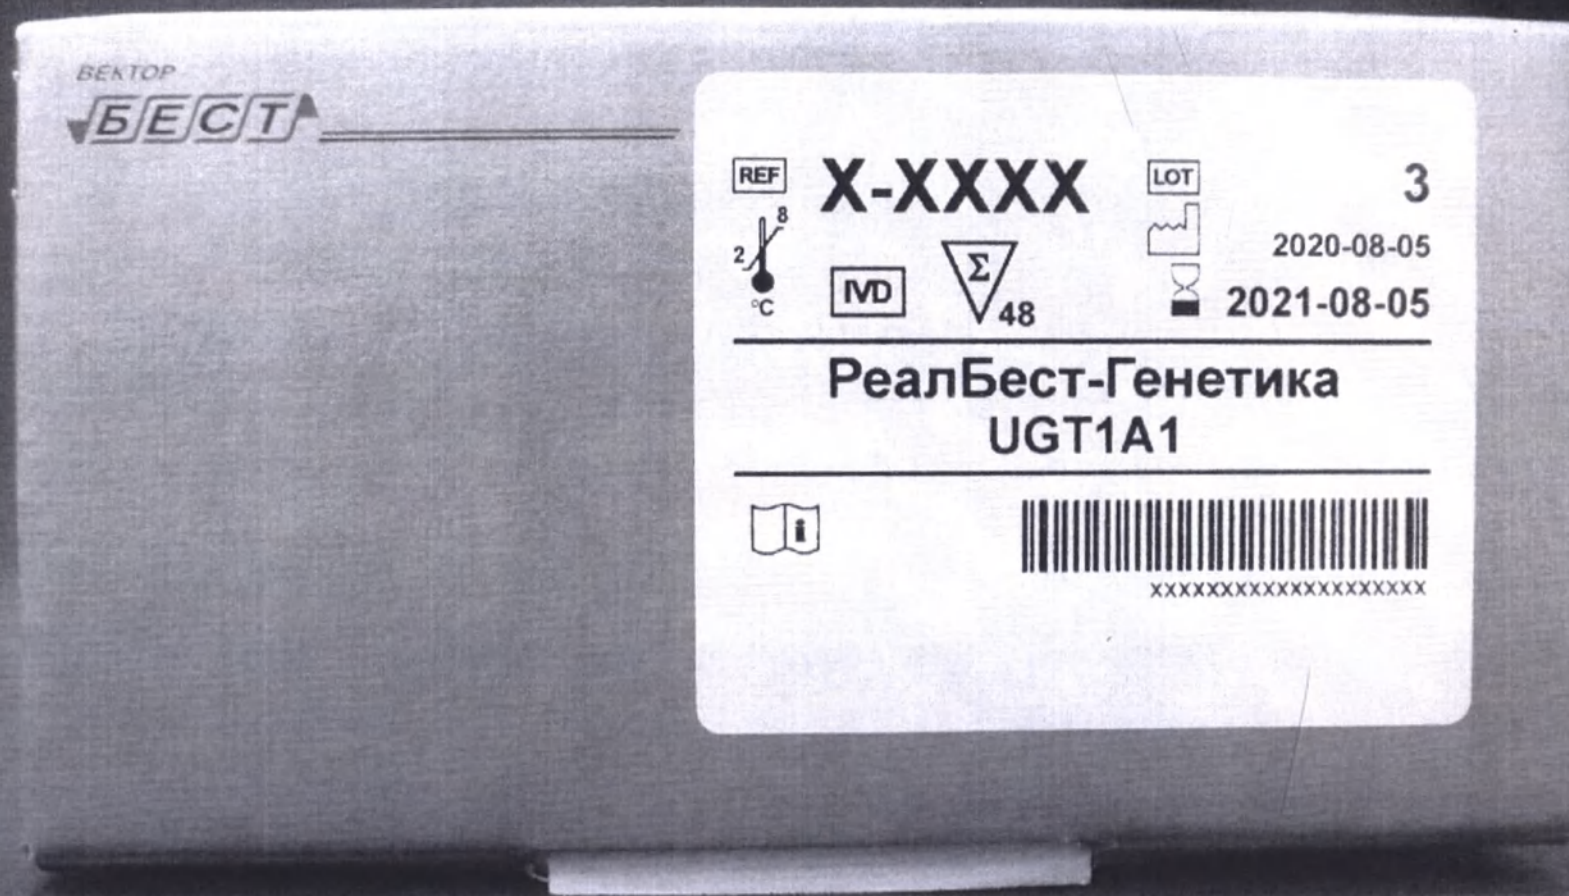

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"РеалБест-Генетика UGT1A1" №3
серия 3

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест"  М.Д. Хусаинов
"15" 11 2020 г.



АО «Вектор-Бест»


Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52

E-mail: vbmarket@vector-best.ru

www.vector-best.ru


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
 “РеалБест-Генетика UGT1A1”
 серия 4

Генеральный директор
 АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
 “15” 4 2020 г.
 М.П.

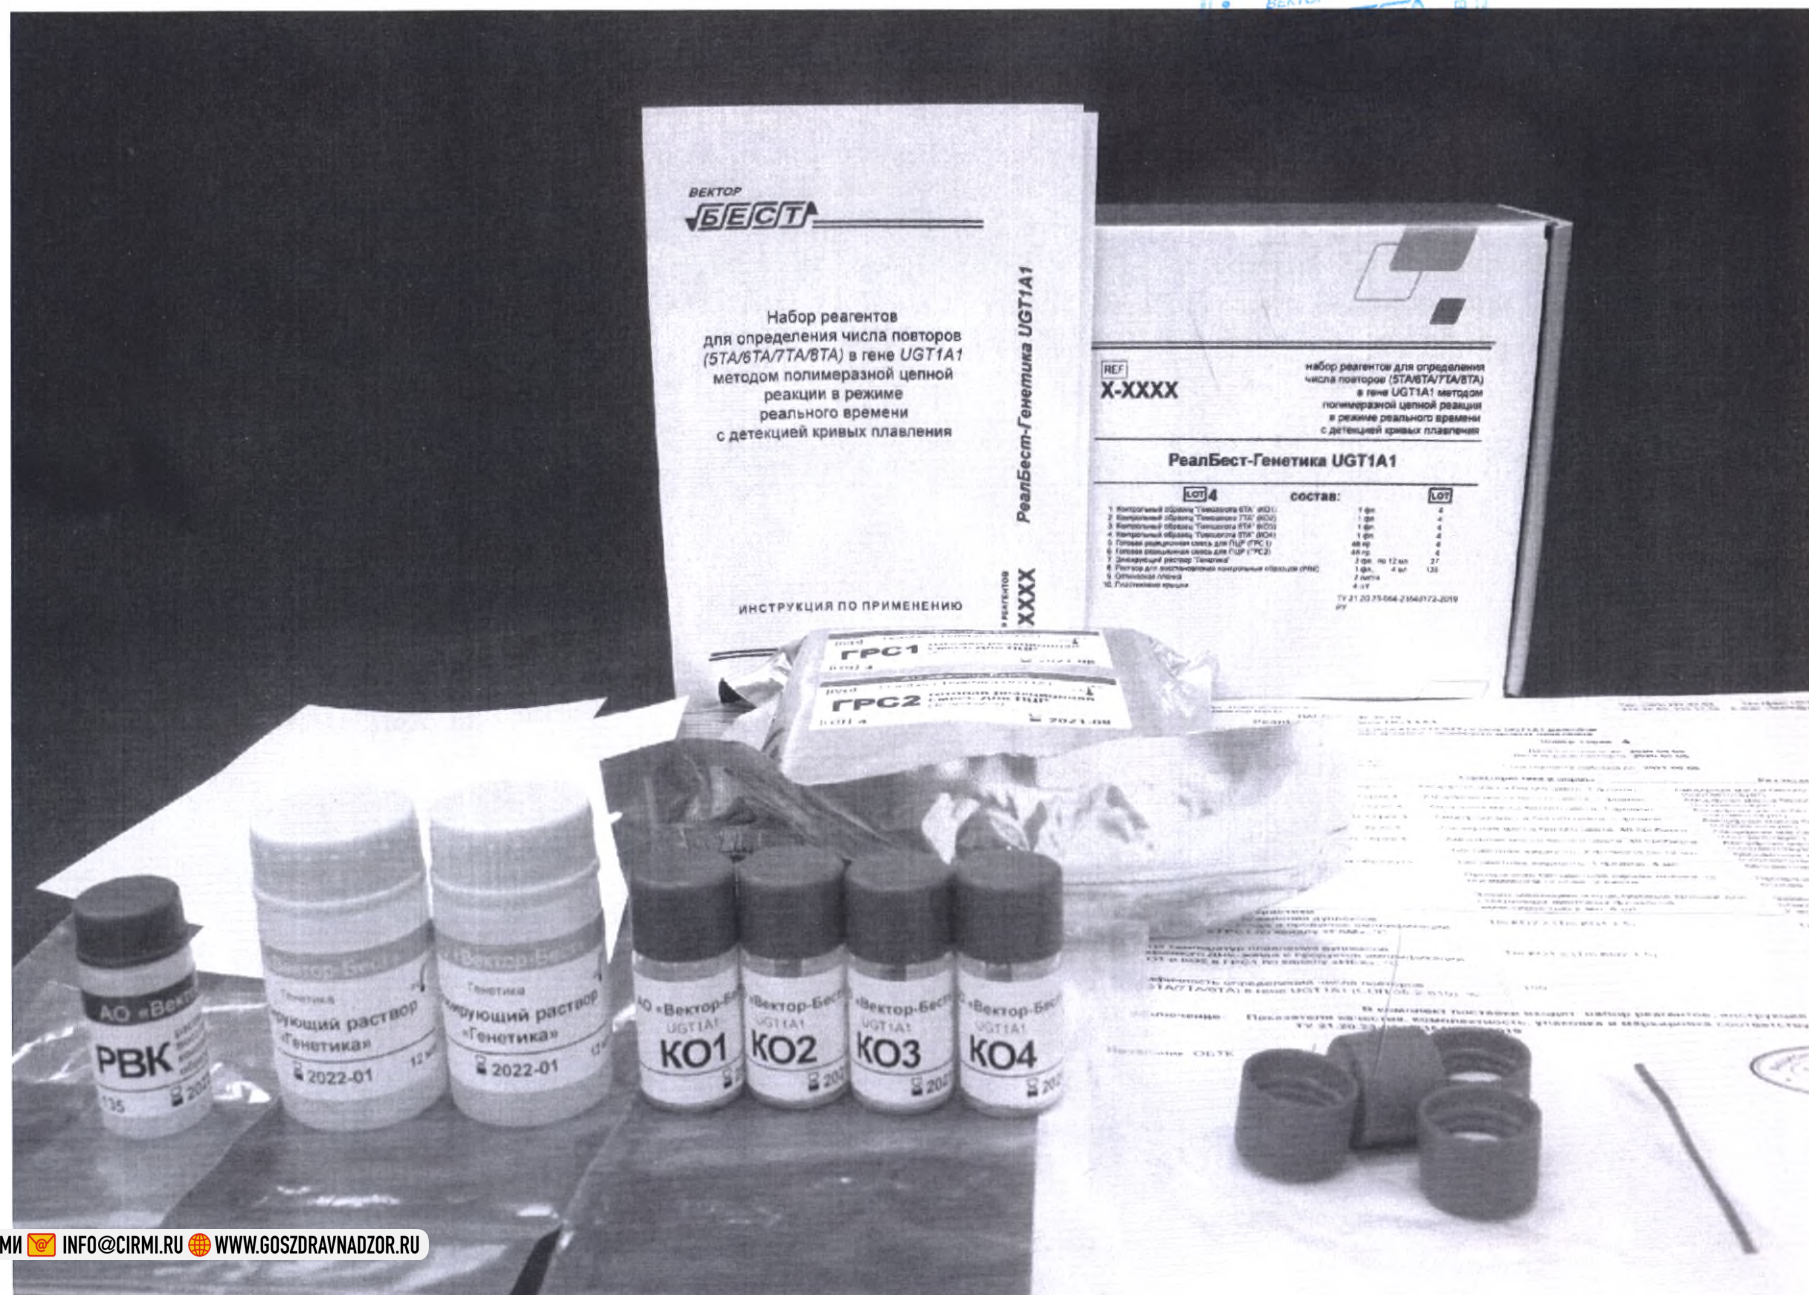


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“РеалБест-Генетика UGT1A1” №1
серия 4

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“20” 2020 г.
М.П.

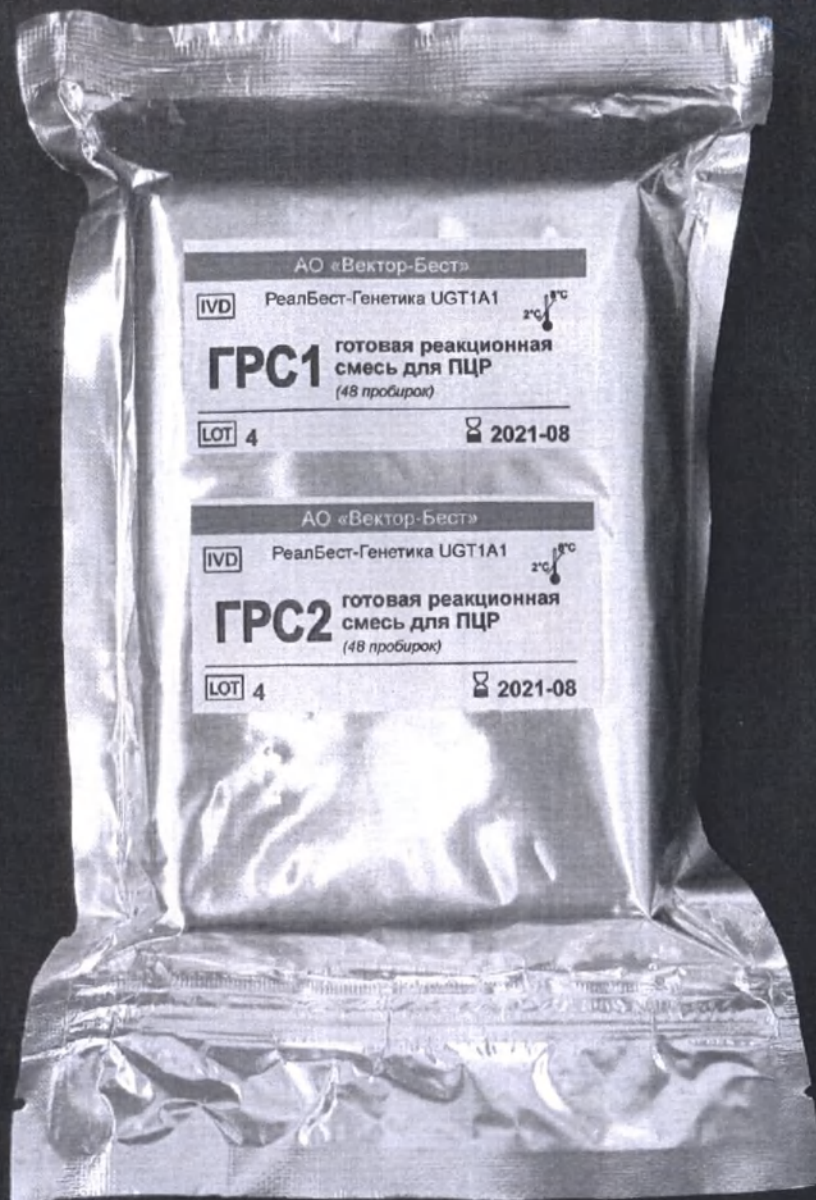


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“РеалБест-Генетика UGT1A1” №2
серия 4

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“25” 10 2020 г.
М.П. ВЕКТОР


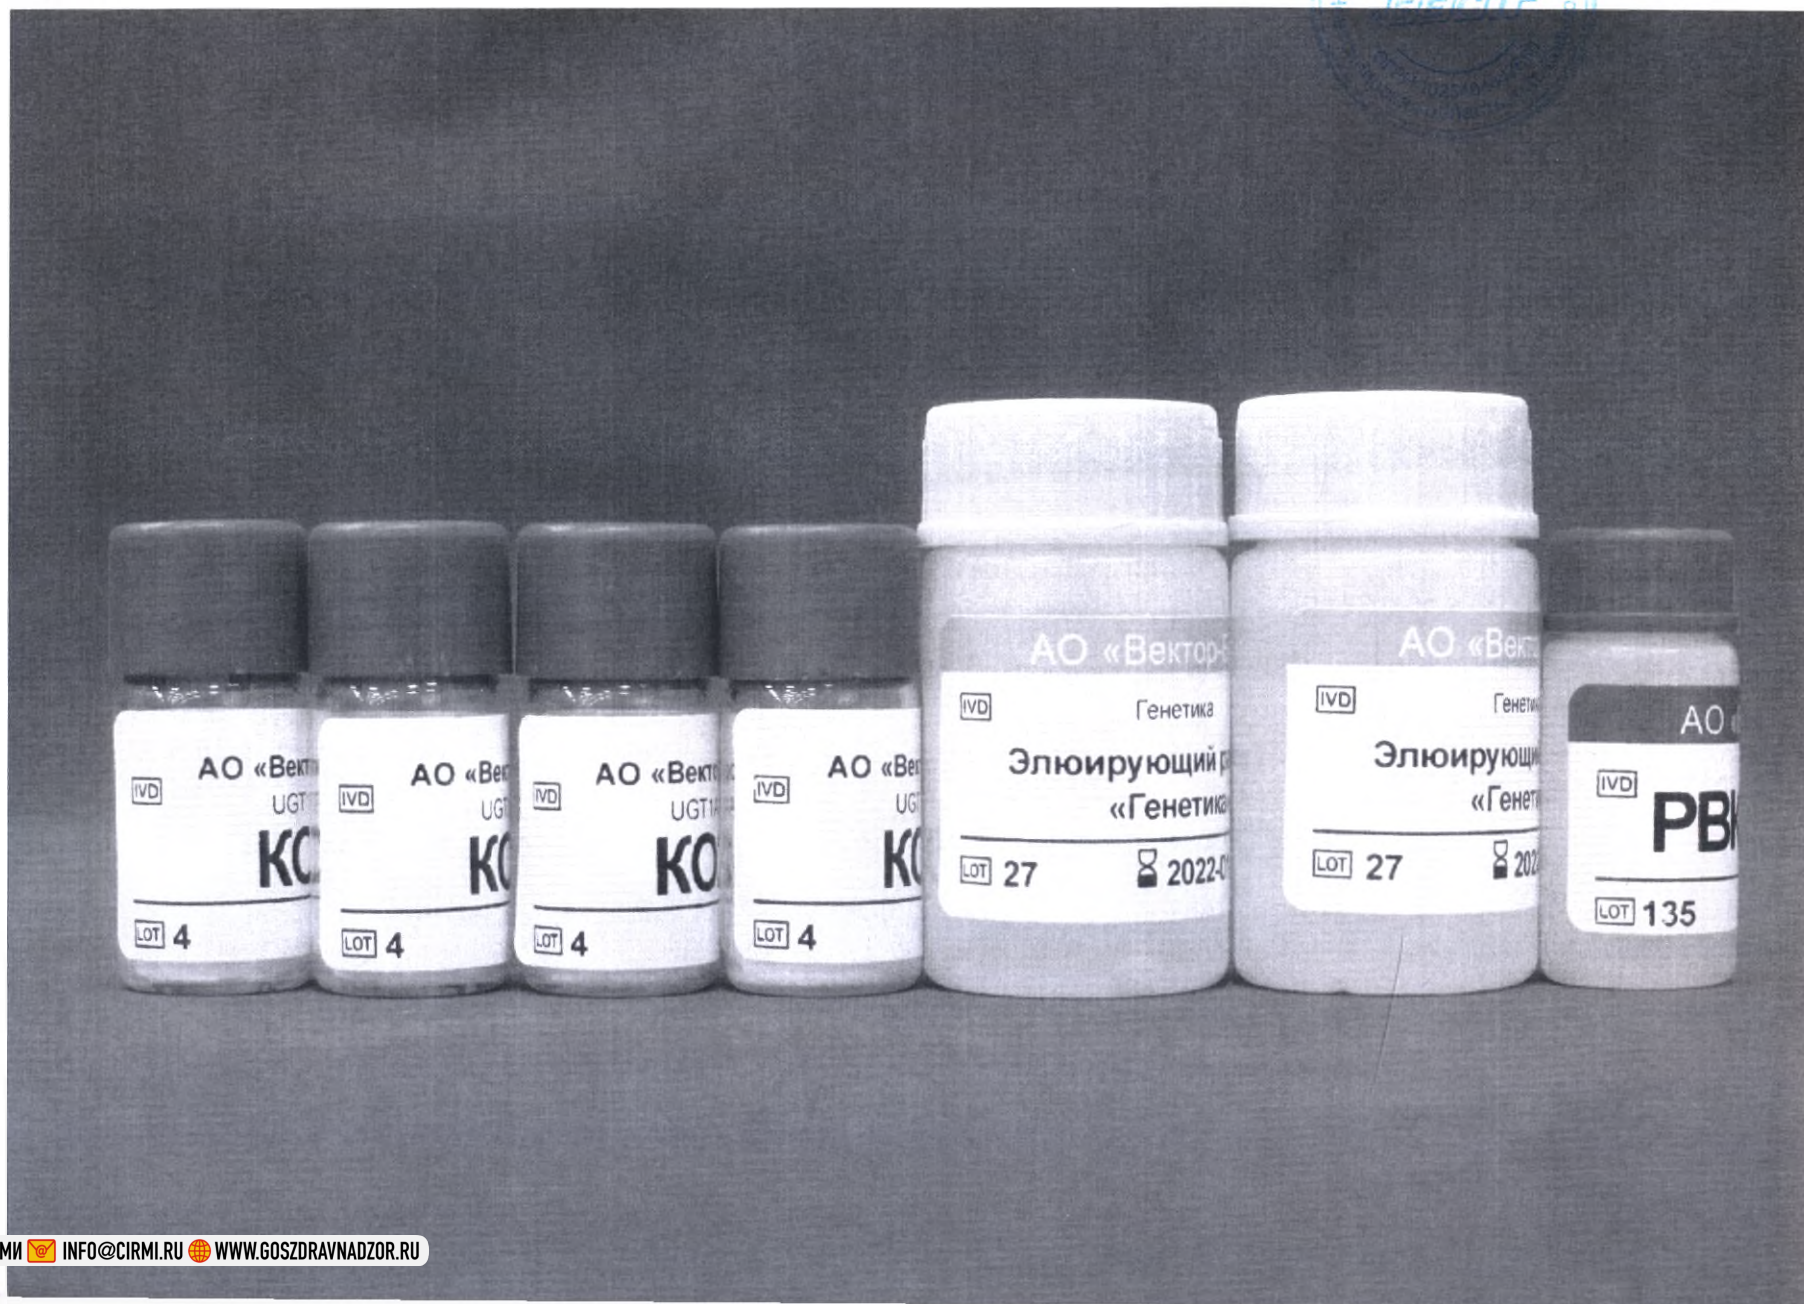



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“РеалБест-Генетика UGT1A1” №3
серия 4

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” _____ М.Д. Хусаинов
“25” _____ 2020 г.
М.П. _____

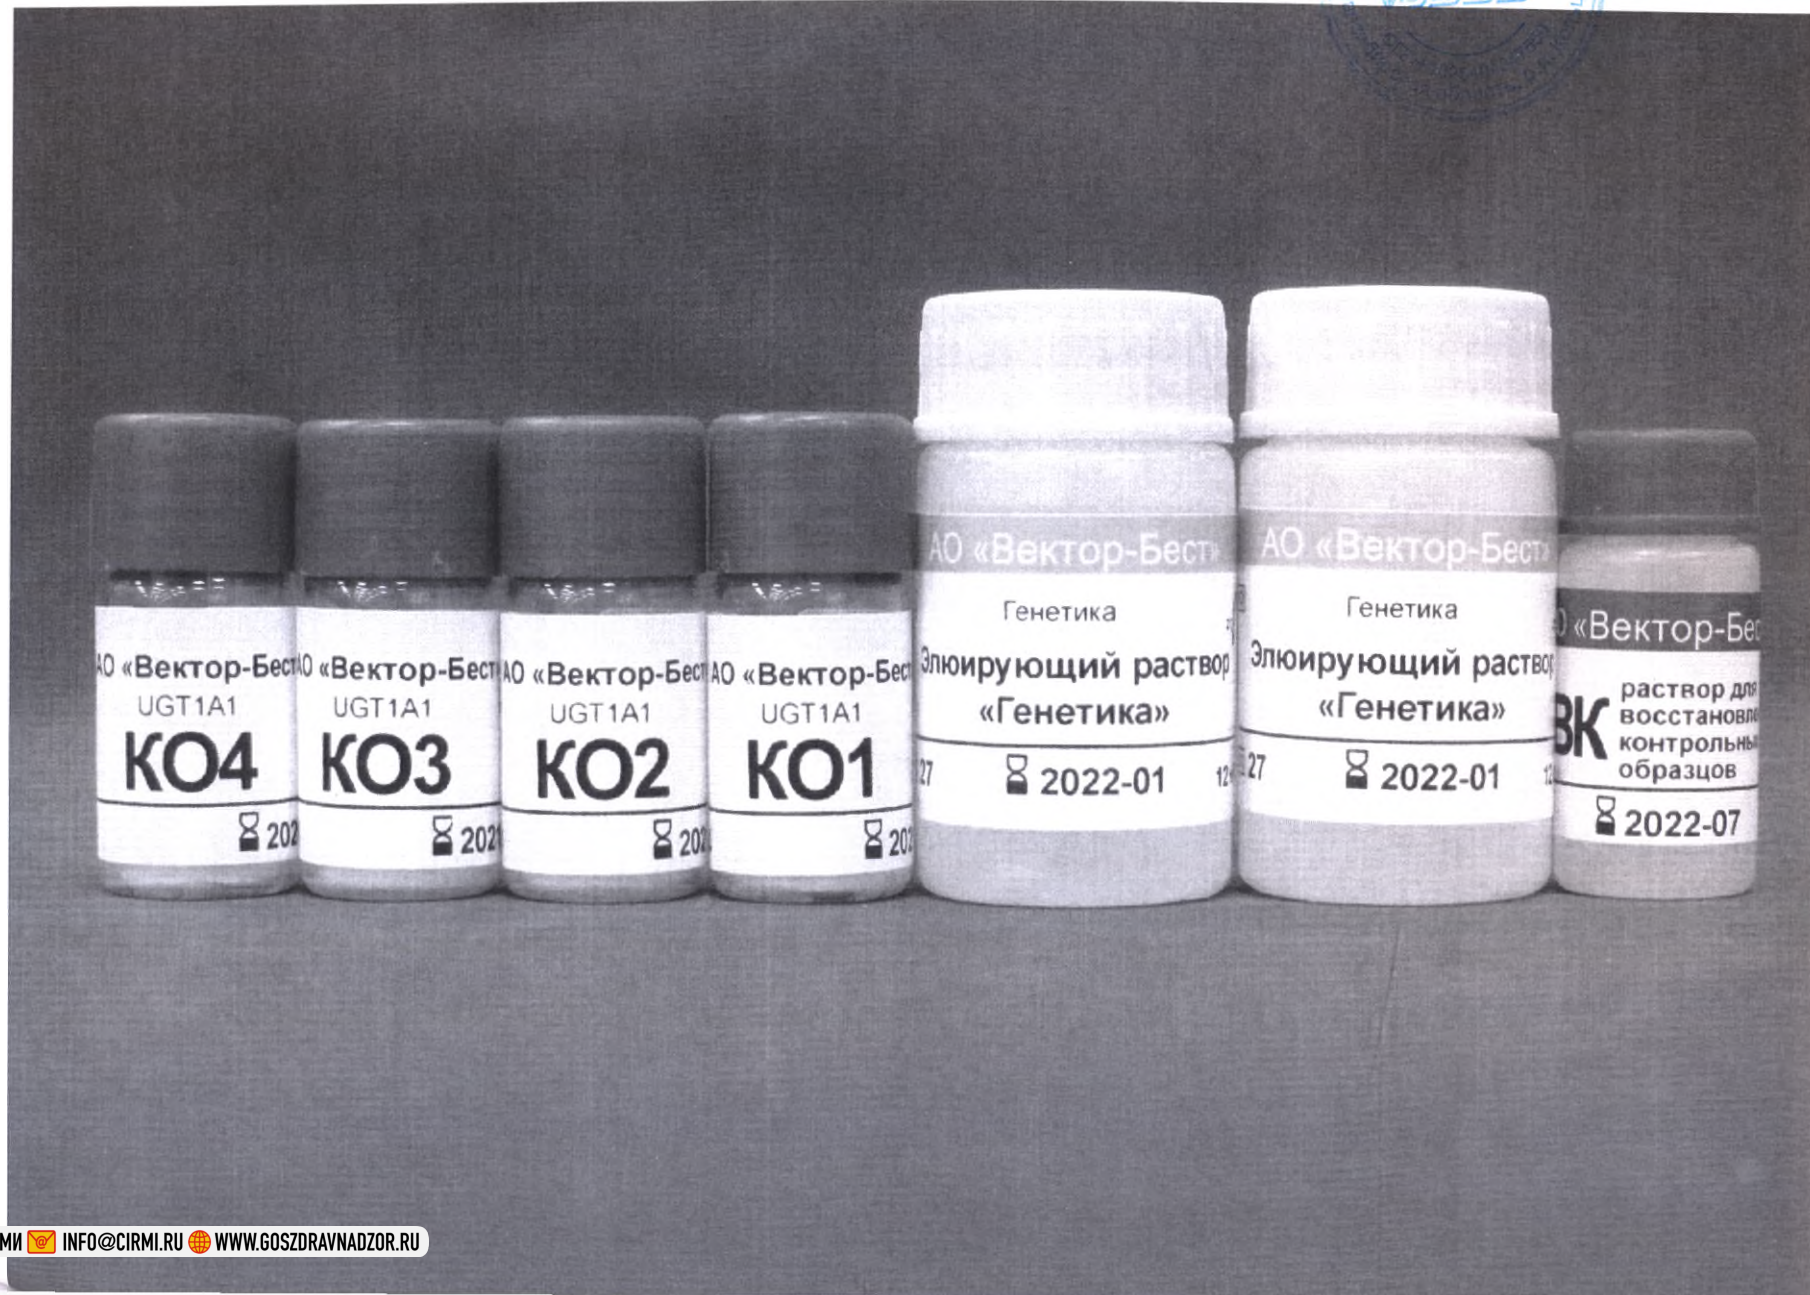


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“РеалБест-Генетика UGT1A1” №4
серия 4

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”  М.Д. Хусаинов
“25”  2020 г.
М.П.

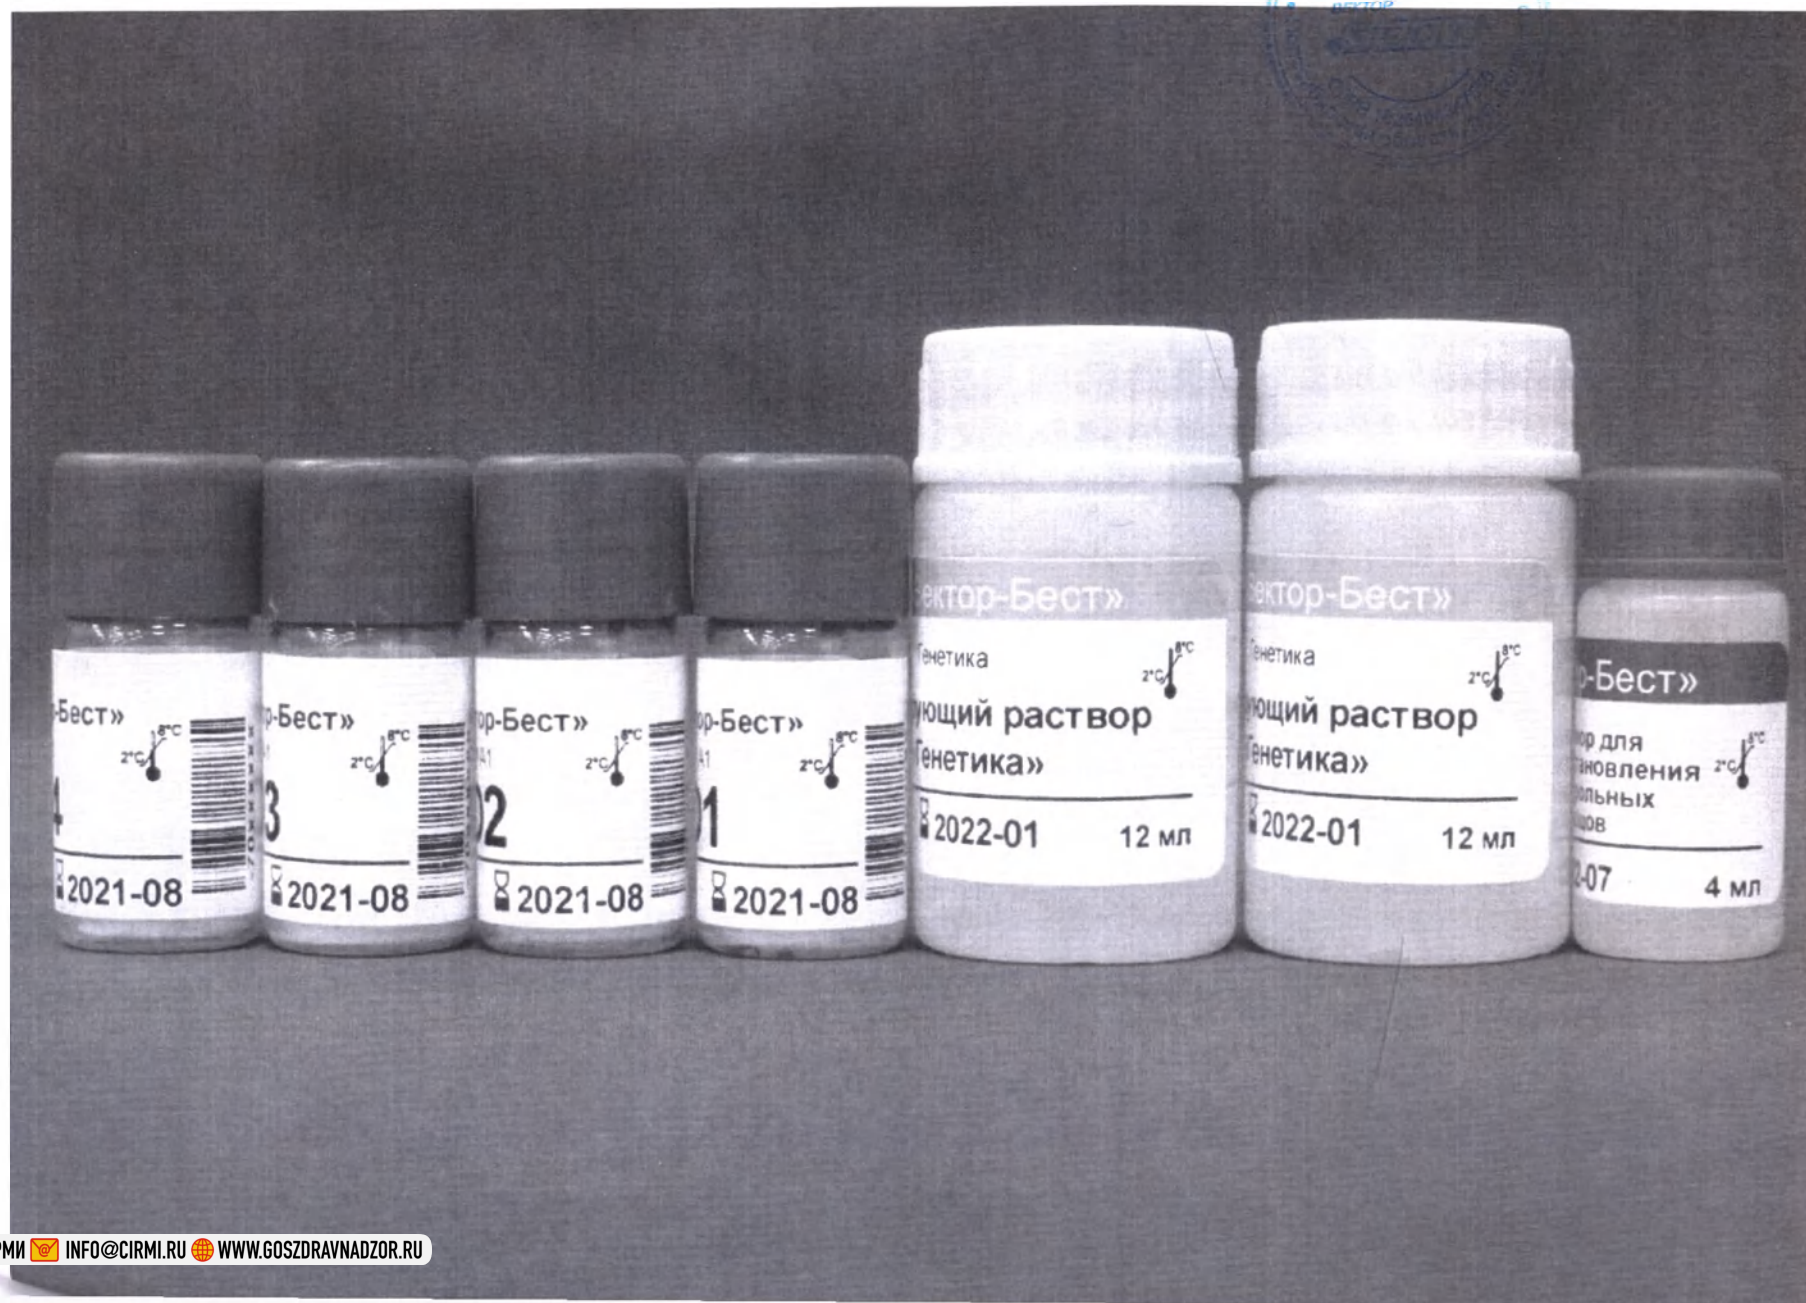

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“РеалБест-Генетика UGT1A1” №5
серия 4

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”  М.Д. Хусаинов
“ 25 ” 12 2020 г.
М.П.



ВЕКТОР
БЕСТ

REF
X-XXXX

набор реагентов для определения
числа повторов (5TA/6TA/7TA/8TA)
в гене UGT1A1 методом
полимеразной цепной реакции
в режиме реального времени
с детекцией кривых плавления

РеалБест-Генетика UGT1A1

LOT 4	состав:	LOT
1. Контрольный образец "Гомозигота 6TA" (КО1)	1 фл.	4
2. Контрольный образец "Гомозигота 7TA" (КО2)	1 фл.	4
3. Контрольный образец "Гомозигота 8TA" (КО3)	1 фл.	4
4. Контрольный образец "Гомозигота 5TA" (КО4)	1 фл.	4
5. Готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС1)	48 пр.	4
6. Готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС2)	48 пр.	4
7. Элюирующий раствор "Генетика"	2 фл. по 12 мл	27
8. Раствор для восстановления контрольных образцов (РВК)	1 фл., 4 мл	135
9. Оптическая пленка	2 листа	
10. Пластиковые крышки	4 шт.	

ТУ 21.20.23-064-23548172-2019
РУ

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"РеалБест-Генетика UGT1A1" №2
серия 4

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест"  М.Д. Хусаинов
"25" 2020 г.
М.П. ВЕКТОР

ВЕКТОР


БЕСТ

REF


X-XXXX

LOT

4



MD



2020-08-06



2021-08-06

**РеалБест-Генетика
UGT1A1**



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"РеалБест-Генетика UGT1A1" №3
серия 4

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест"  М.Д. Хусаинов
"25"  2020 г.
М.П. ВЕКТОР



АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52

E-mail: vbmarket@vector-best.ru

www.vector-best.ru