

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ГЕМАТОЛОГ»



Митерев Г.Ю.
2020 г.

Фотографические изображения медицинского изделия
АНТИ- $\text{rh}'(\text{C})$ моноклональный реагент
для определения С антигена системы Резус на эритроцитах человека
(ЭРИТРОТЕСТ™-Цоликлон Анти-С Супер)

по ТУ 9398-003-27575295-2004

Варианты исполнения:

- 5 мл во флаконе, флаконы из нейтрального стекла со стеклянными капельницами – 10 флаконов стр. 2-3
- 10 мл во флаконе, флаконы из нейтрального стекла со стеклянными капельницами – 10 флаконов стр. 4-5
- 5 мл во флаконе, пластиковые флаконы-капельницы – 10 флаконов стр. 6-7
- 10 мл во флаконе, пластиковые флаконы-капельницы – 10 флаконов стр. 8-9



ООО «ГЕМАТОЛОГ»

Москва, 125167
Новый Зыковский пр-д, д. 4, стр. 1
тел: 8-800-777-07-72
тел: (495) 504-90-98

Хранить при 2-8°С
Только для in vitro диагностики

АНТИ-rh(C) моноклональный реагент для
определения С антигена системы резус на
эритроцитах человека

**ЭРИТРОТЕСТ™-Цоликлон
Анти-С Супер**
ТУ 9398-003-27575295-2004

10 флаконов по 5 мл Серия: 021
Дата изготовл.: 05.03.2020
Годен до: 05.03.2022
⚠ 0,1% азид натрия
Для профессионального применения

РУ № ФСР 2009/05553
От 16.08.2009 г.



АНТИ- $\text{rh}'(\text{C})$ моноклональный реагент для определения С антигена системы Резус на эритроцитах человека (ЭРИТРОТЕСТ™-Цоликлон Анти-С Супер),

10 флаконов по 5 мл в стеклянный флакон объемом 10 мл



ООО «ГЕМАТОЛОГ»

Москва, 125167
Новый Зыковский пр-д, д. 4, стр. 1
тел: 8-800-777-07-72
тел: (495) 504-90-98

Хранить при 2-8°C
Только для in vitro диагностики

АНТИ- $\text{Hb}(\text{C})$ моноклональный реагент для
определения С-антигена системы резус на
эритроцитах человека

ЭРИТРОТЕСТ™-Цоликлон
Анти-С Супер
ТУ 9398-003-27575295-2004

10 флаконов по 10 мл Серия: 022
Дата изготовл.: 05.03.2020
Годен до: 05.03.2022
⚠ 0,1% азид натрия
Для профессионального применения

Р/№ ФСР 2009/05553
От 18.08.2009 г.

ЭРИТРОТЕСТ™-Цоликлон
Анти-С Супер
Только для in vitro диагностики
0,1% азид натрия
Хранить при 2-8°C
ООО «ГЕМАТОЛОГ»



АНТИ-rh'(C) моноклональный реагент для определения С антигена системы Резус на эритроцитах человека (ЭРИТРОТЕСТ™-Цоликлон Анти-С Супер),

10 флаконов по 10 мл в стеклянный флакон объемом 10 мл



ООО «ГЕМАТОЛОГ»

Москва, 125167
Новый Зыковский пр-д, д. 4, стр. 1
тел: 8-800-777-07-72,
тел: 8 (495) 504-90-98

Хранить при 2-8°C
Только для in vitro диагностики

АНТИ-rh'(C) моноклональный реагент для
определения C антигена системы резус на
эритроцитах человека

ЭРИТРОТЕСТ™-Цоликлон
Анти-С Супер
ТУ 9398-003-27575295-2004

10 флаконов по 5 мл Серия: 023
Дата изготовл.: 05.03.2020
Годен до: 05.03.2022
⚠ 0,1% азид натрия
Для профессионального применения

РУ № ФСР 2009/05553
От 18.08.2009 г.





АНТИ- Rh^{C} (С) моноклональный реагент для определения С антигена системы Резус на эритроцитах человека (ЭРИТРОТЕСТ™-Цоликлон Анти-С Супер),

10 флаконов по 5 мл в ФКП объемом 5 мл



ООО «ГЕМАТОЛОГ»

Москва, 125167
Новый Зыковский пр-д, д. 4, стр. 1
тел: 8-800-777-07-72
тел: (495) 504-90-98

Хранить при 2-8°C
Только для in vitro диагностики



ЭРИТРОТЕСТ™-Цоликлон
Анти-С Супер
Только для in vitro диагностики
0,1% азид натрия
Хранить при 2-8°C
ООО «ГЕМАТОЛОГ»

АНТИ-ru(C) моноклональный реагент для
определения С антигена системы резус на
эритроцитах человека

ЭРИТРОТЕСТ™-Цоликлон
Анти-С Супер
ТУ 9398-003-27575295-2004

10 флаконов по 10 мл Серия: 024
Дата изготовл.: 05.03.2020
Годен до: 05.03.2022
⚠ 0,1% азид натрия
Для профессионального применения

Р/У № ФСР 2009/05553
От 18.08.2009 г.



АНТИ-г^h(С) моноклональный реагент для определения С антигена системы Резус на эритроцитах человека (ЭРИТРОТЕСТ™-Цоликлон Анти-С Супер),
10 флаконов по 10 мл в ФКП объёмом 10 мл

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ГЕМАТОЛОГ»



Мухомов Г.Ю.


2021 г.

Фотографические изображения медицинского изделия
АНТИ-rh(C) моноклональный реагент
для определения С антигена системы Резус на эритроцитах человека
(ЭРИТРОТЕСТ™-Цоликлон Анти-С Супер),

по ТУ 9398-003-27575295-2004


Варианты исполнения:

- 5 мл во флаконе, флаконы из нейтрального стекла со стеклянными капельницами – 10 флаконов стр. 2-3
- 10 мл во флаконе, флаконы из нейтрального стекла со стеклянными капельницами – 10 флаконов стр. 4-5
- 5 мл во флаконе, пластиковые флаконы-капельницы – 10 флаконов стр. 6-7
- 10 мл во флаконе, пластиковые флаконы-капельницы – 10 флаконов стр. 8-9

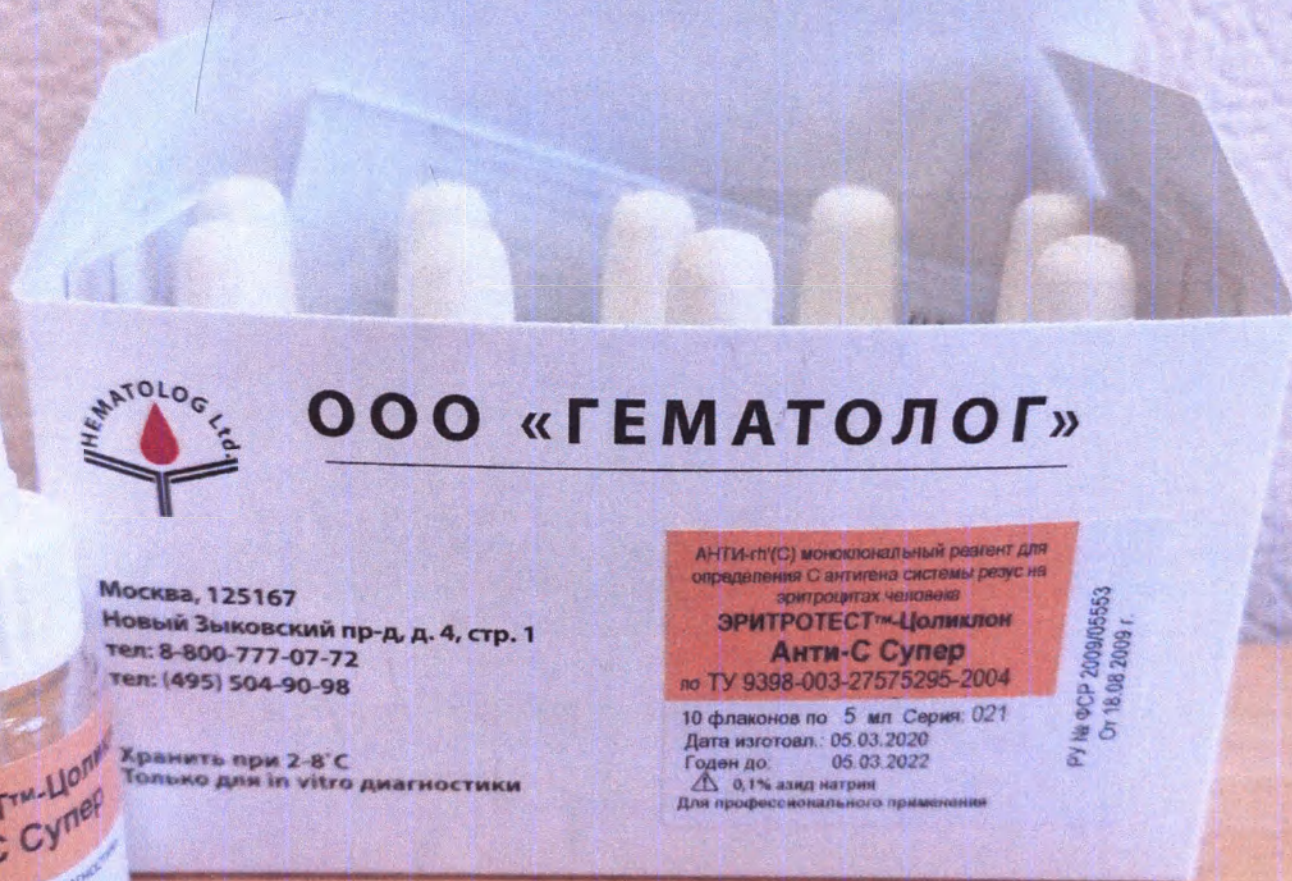



АНТИ-rh'(C) моноклональный реагент для определения С антигена системы Резус на эритроцитах человека (ЭРИТРОТЕСТ™-Цоликлон Анти-С Супер),
10 флаконов по 5 мл в стеклянный флакон объёмом 10 мл

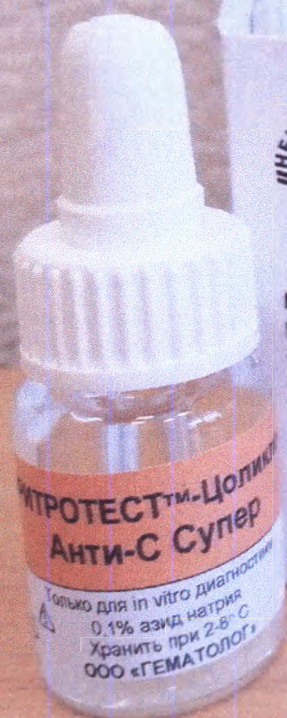

ООО «ГЕМАТОЛОГ»

Москва, 125167
Новый Зыковский пр-д, д. 4, стр. 1
тел: 8-800-777-07-72
тел: (495) 504-90-98


Хранить при 2-8°C
Только для in vitro диагностики

АНТИ-m(C) моноклональный реагент для
определения C антигена системы резус на
эритроцитах человека

ЭРИТРОТЕСТ™-Цоликлон
Анти-С Супер
по ТУ 9398-003-27575295-2004

10 флаконов по 10 мл Серия: 022
Дата изготовл. 05.03.2020
Годен до: 05.03.2022
⚠ 0,1% азид натрия
Для профессионального применения

РУ № ФСР 2009/05553
От 18.08.2009 г.

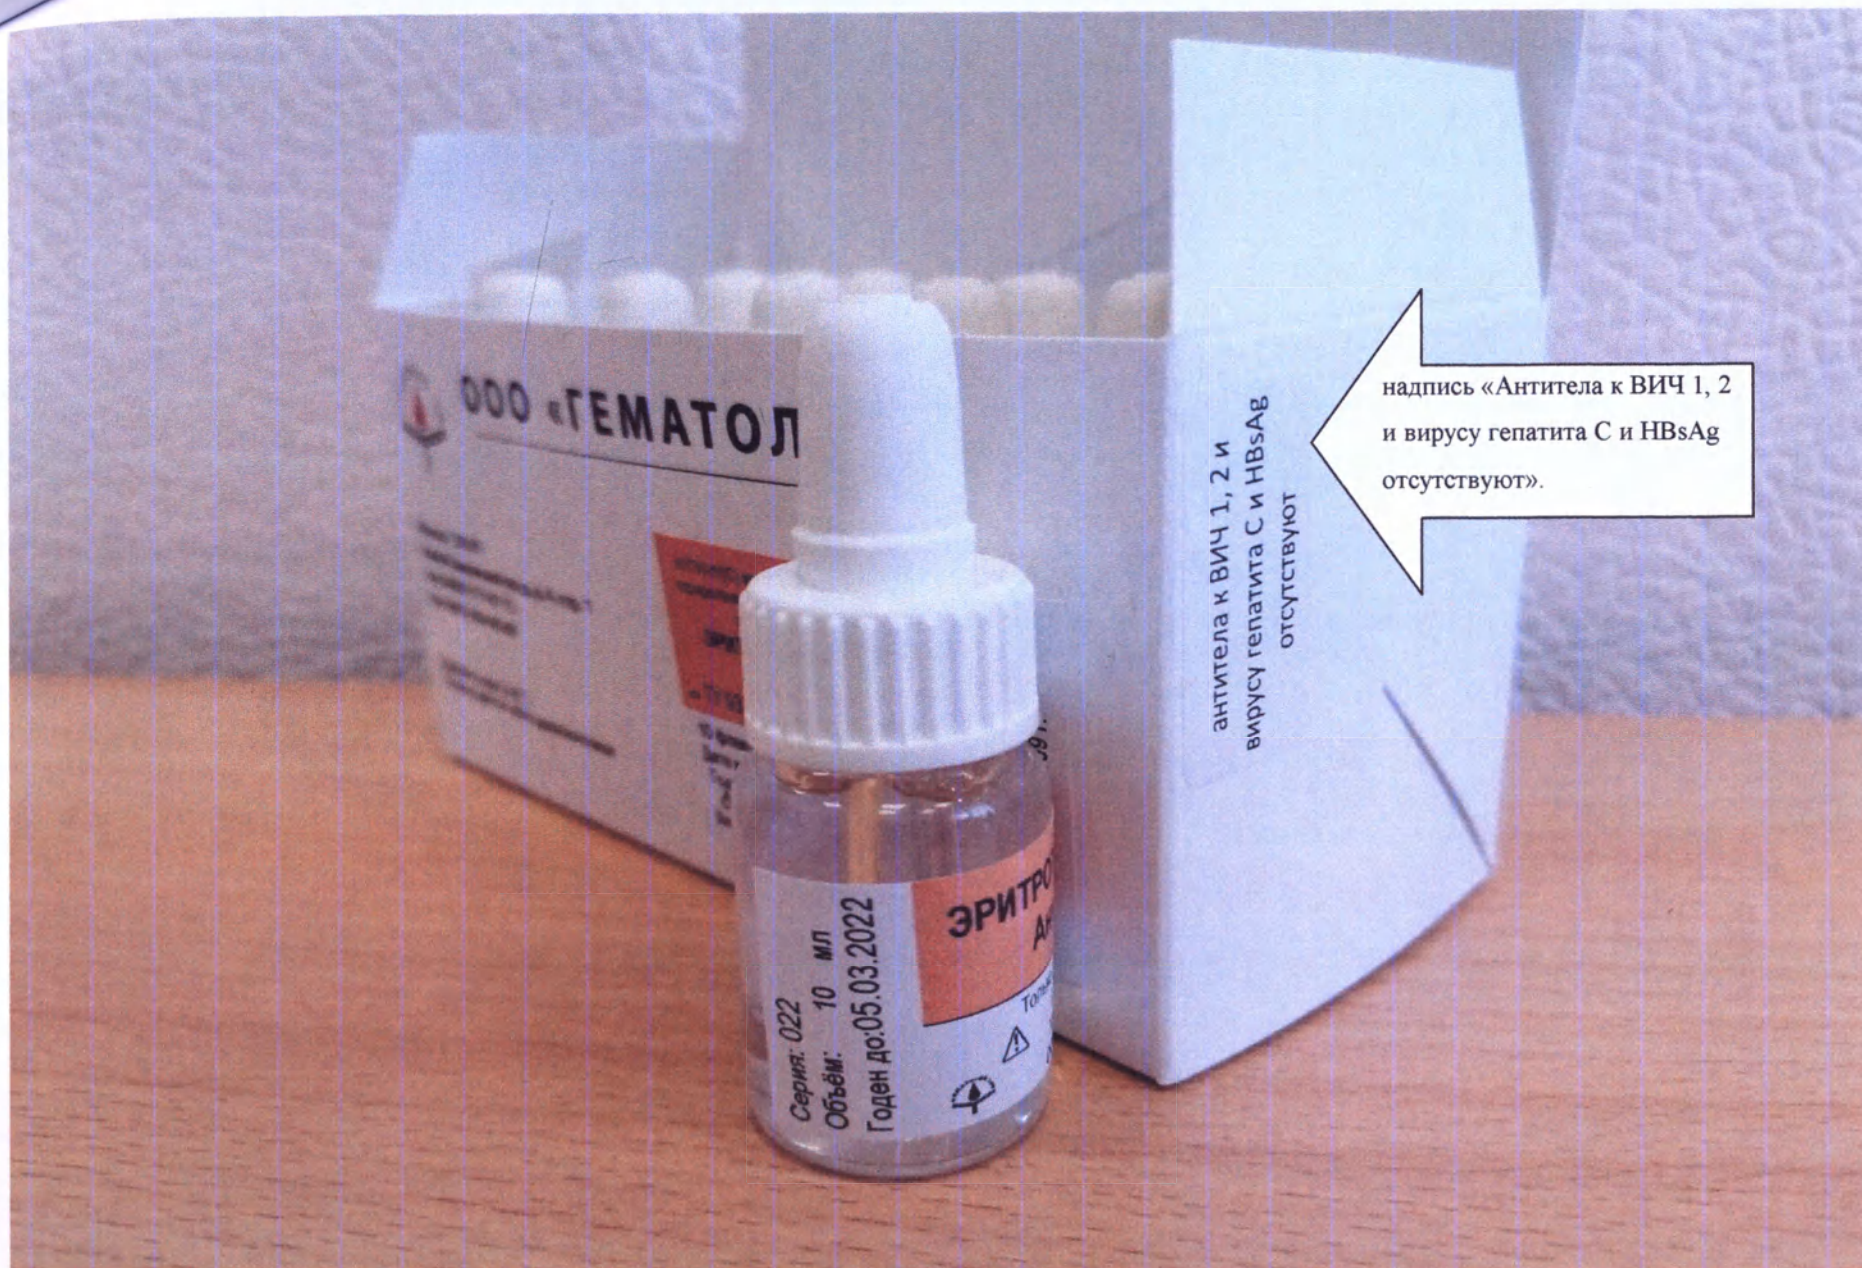

АНТИ-rh'(C) моноклональный реагент для определения С антигена системы Резус на эритроцитах человека (ЭРИТРОТЕСТ™-Цоликлон Анти-С Супер),
10 флаконов по 10 мл в стеклянный флакон объемом 10 мл



ООО «ГЕМАТОЛОГ»

Москва, 125167
Новый Зыковский пр-д, д. 4, стр. 1
тел: 8-800-777-07-72,
тел: 8 (495) 504-90-98

Хранить при 2-8°C
Только для in vitro диагностики

АНТИ-гп(C) моноклональный реагент для
определения С антигена системы резус на
эритроцитах человека

ЭРИТРОТЕСТ™-Цоликлон
Анти-С Супер

по ТУ 9398-003-27575295-2004

10 флаконов по 5 мл Серия: 023

Дата изготовл.: 05.03.2020

Годен до: 05.03.2022

⚠ 0,1% азид натрия
Для профессионального применения

РУ № ФСР 2009/05553
От 18.08.2009 г.





АНТИ-rh'(C) моноклональный реагент для определения С антигена системы Резус на эритроцитах человека (ЭРИТРОТЕСТ™-Цоликлон Анти-С Супер),
10 флаконов по 5 мл в ФКП объемом 5 мл



ООО «ГЕМАТОЛОГ»

Москва, 125167
Новый Зыковский пр-д, д. 4, стр. 1
тел: 8-800-777-07-72
тел: (495) 504-90-98

Хранить при 2-8°C
Только для in vitro диагностики

АНТИ-П(C) моноклональный реагент для
определения С антигена системы резус на
эритроцитах человека

ЭРИТРОТЕСТ™-Цоликлон
Анти-С Супер

по ТУ 9398-003-27575295-2004

10 флаконов по 10 мл Серия: 024

Дата изготовл.: 05.03.2020

Годен до: 05.03.2022

⚠ 0,1% азид натрия
Для профессионального применения

Р/ № ФСР 2009/05553
От 18.08.2009 г.

ЭРИТРОТЕСТ™-Цоликлон
Анти-С Супер

Только для in vitro диагностики
0,1% азид натрия
Хранить при 2-8°C
ООО «ГЕМАТОЛОГ»



АНТИ-rh'(C) моноклональный реагент для определения С антигена системы Резус на эритроцитах человека (ЭРИТРОТЕСТ™-Цоликлон Анти-С Супер), 10 флаконов по 10 мл в ФКП объёмом 10 мл

Прошито и пронумеровано
листов
Директор ООО «ГЕМАТОЛОГ»
Митерев Г.Ю

