

« УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Гематолог»

Г.Ю.Митерев

«28» апреля 2020 г.




МАКЕТ МАРКИРОВКИ

**АНТИ-Rh₀(D) IgM моноклональный реагент для определения
резус-принадлежности крови человека
(ЭРИТРОТЕСТ™- Цоликлон Анти-D Супер)
по ТУ 9398-002-27575295-2004**

Маркировка флаконов



Маркировка коробок

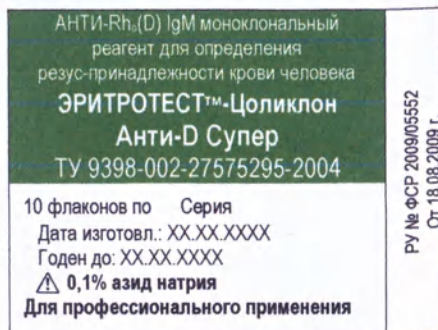

антитела к ВИЧ 1, 2 и
вирусу гепатита С и HBsAg
отсутствуют



ООО «ГЕМАТОЛОГ»

Москва, 125167
Новый Зыковский пр-д, д. 4, стр. 1
тел: 8-800-777-07-72
тел: (495) 504-90-98

Хранить при 2-8°C
Только для in vitro диагностики

Прошито и пронумеровано

2 листов

Директор ООО «ГЕМАТОЛОГ»


Митерев Г.Ю.





МАКЕТ МАРКИРОВКИ
АНТИ-Rh₀(D) IgM моноклональный реагент для определения
резус-принадлежности крови человека
(ЭРИТРОТЕСТ™- Цоликлон Анти-D Супер),
по ТУ 9398-002-27575295-2004


Этикетка на флакон

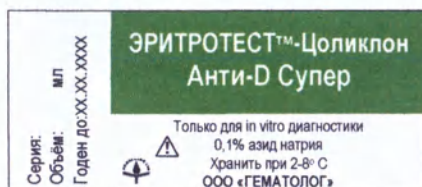


Этикетка на коробку



антитела к ВИЧ 1, 2 и
вирусу гепатита С и HBsAg
отсутствуют

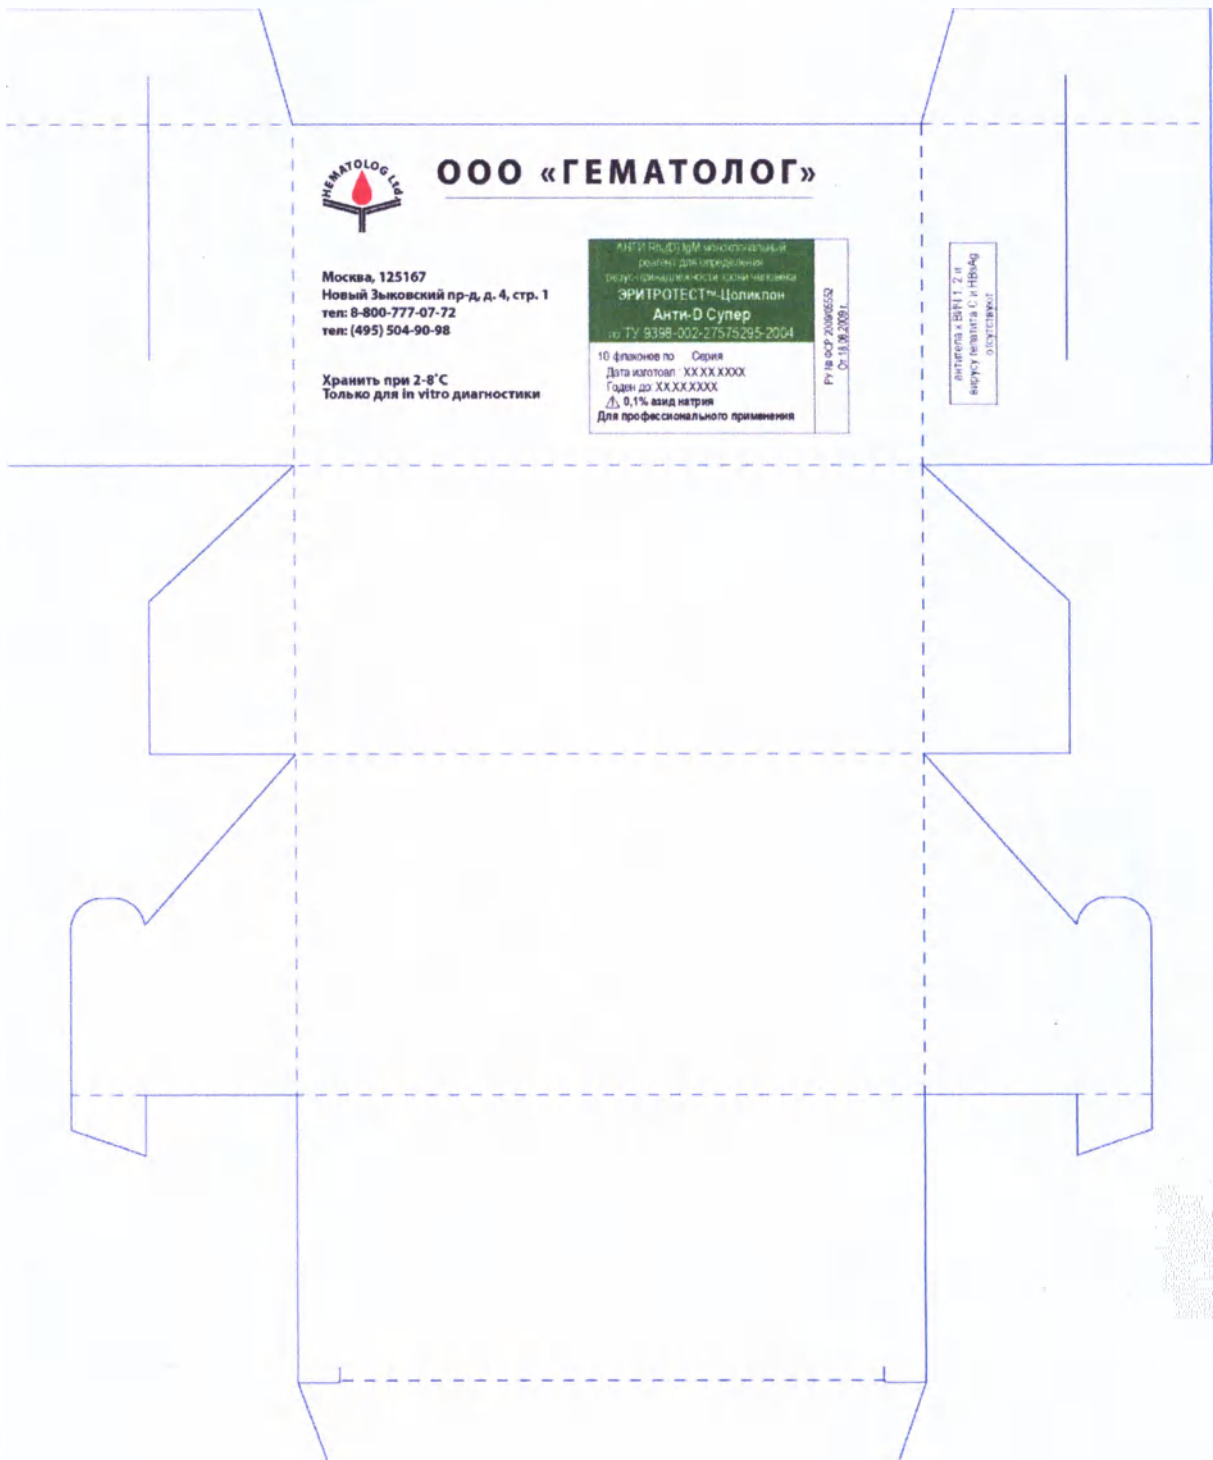

Маркировка транспортной тары



 +8°C +2°C	 Общество с ограниченной ответственностью "ГЕМАТОЛОГ" 125167 Москва, Новый Зыковский пр-д, д. 4 стр. 1. Тел. (495) 504-90-98, 8-800-777-07-72 АНТИ-Rh₀(D) IgM моноклональный реагент для определения резус-принадлежности крови человека (ЭРИТРОТЕСТ™ - Цоликлон Анти-D Супер) по ТУ 9398-002-27575295-2004
	Серия: Количество: Масса нетто: Масса брутто: Масса нетто потребительской упаковки:


 XXXX.XX

 XXXX.XX





Макет транспортной тары с маркировкой

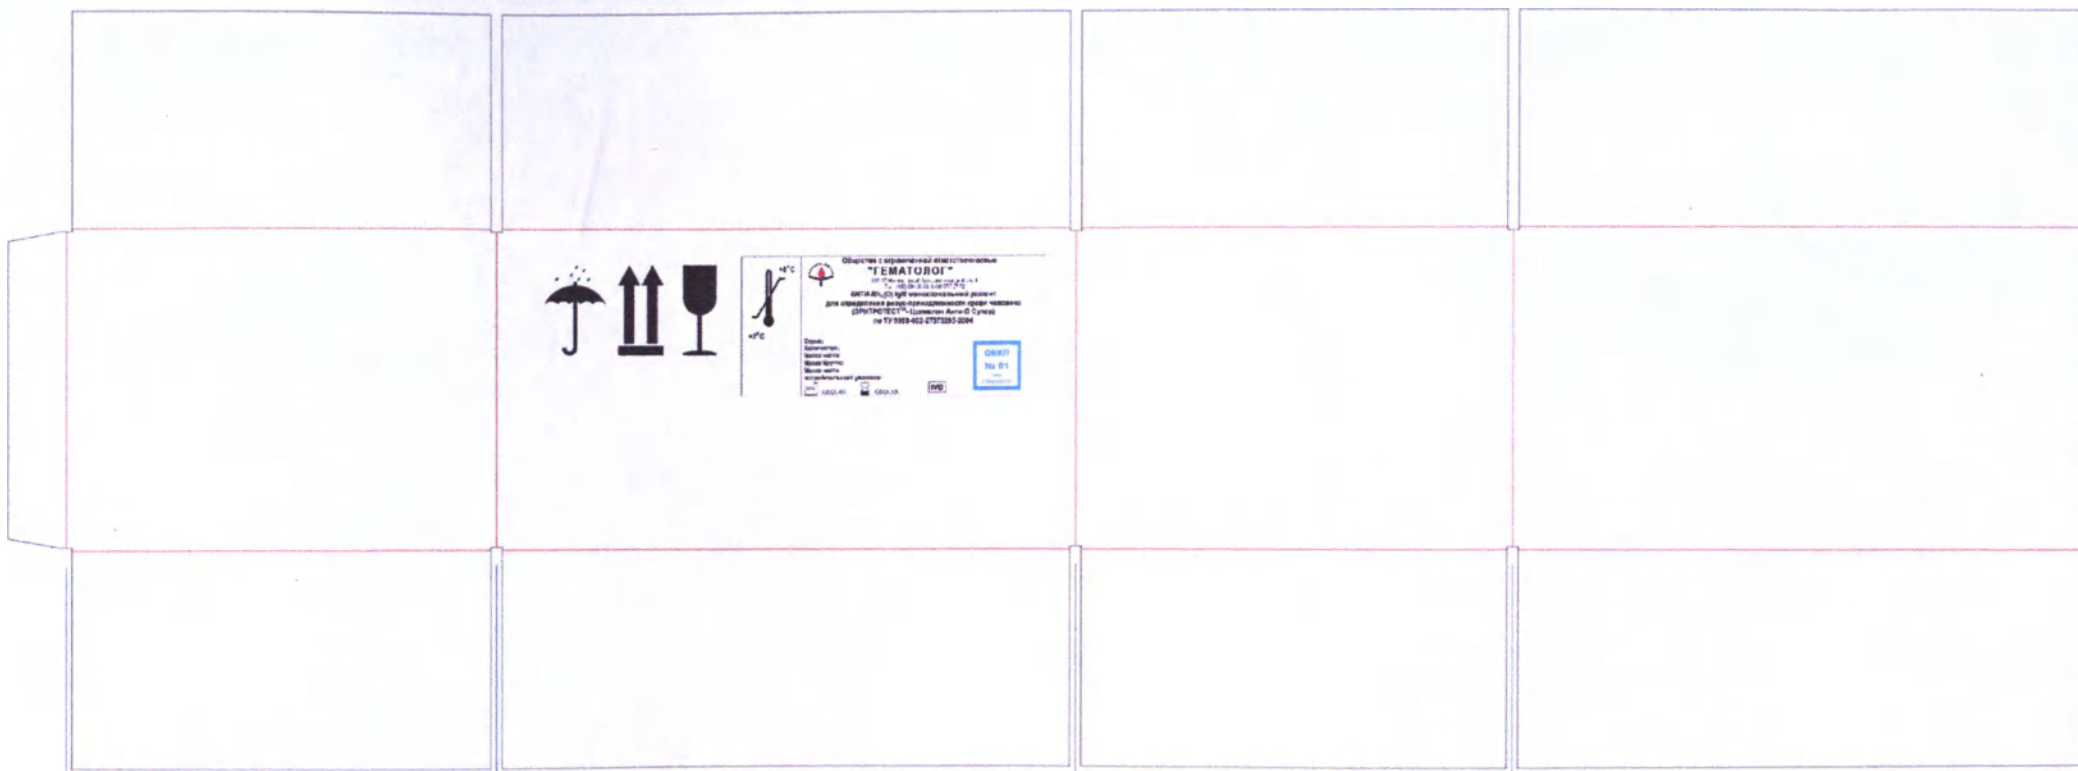

Продито и пронумеровано
листов
Директор ООО «ГЕМАТОЛОГ»



Митерев Г.Ю.



2020 г.

 ООО ЦИПМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



ООО «ГЕМАТОЛОГ»

Москва, 125167
Новый Зыковский пр-д, д. 4, стр. 1
тел: 8-800-777-07-72
тел: (495) 504-90-98

Хранить при 2-8°C
только для in vitro диагностики

АНТИ-Rh (D) IgM моноклональный реагент
для определения резус-принадлежности
крови человека

ЭРИТРОТЕСТ™-Цоликлон

Анти-D Супер

ТУ 9398-002-27575295-2004

10 флаконов по 5 мл Серия: 021

Дата изготовл.: 03.03.2020

Годен до: 03.03.2022

⚠ 0,1% азид натрия
Для профессионального применения

РУ № ФСР 2009/05552
От 18.08.2009 г.





АНТИ-Rh₀(D) IgM моноклональный реагент для определения резус-принадлежности крови человека (ЭРИТРОТЕСТ™- Цоликлон Анти-D Супер),
10 флаконов по 5 мл в стеклянный флакон объемом 10 мл



ООО «ГЕМАТОЛОГ»

Москва, 125167
Новый Зыковский пр-д, д. 4, стр. 1
тел: 8-800-777-07-72
тел: (495) 504-90-98

Хранить при 2-8°С
Только для in vitro диагностики

АНТИ-Rh(D) IgM моноклональный реагент
для определения резус-принадлежности
крови человека

ЭРИТРОТЕСТ™-Цоликлон
Анти-D Супер
ТУ 9398-002-27575295-2004

10 флаконов по 10 мл Серия: 022
Дата изготовл.: 03.03.2020
Годен до: 03.03.2022
⚠ 0,1% азид натрия
Для профессионального применения

РУ № ФСР 200905552
От 18.08.2009 г.





АНТИ-Rh₀(D) IgM моноклональный реагент для определения резус-принадлежности крови человека (ЭРИТРОТЕСТ™- Цоликлон Анти-D Супер),
10 флаконов по 10 мл в стеклянный флакон объемом 10 мл



ООО «ГЕМАТОЛОГ»

Москва, 125167
Новый Зыковский пр-д, д. 4, стр. 1
тел: 8-800-777-07-72,
тел: 8 (495) 504-90-98

Хранить при 2-8°С
Только для in vitro диагностики

АНТИ-Rh (D) IgM моноклональный реагент
для определения резус-принадлежности
человека

ЭРИТРОТЕСТ™-Цоликлон
Анти-D Супер
ТУ 9398-002-27575295-2004

10 флаконов по 5 мл Серия: 023
Дата изготовл.: 04.03.2020
Годен до: 04.03.2022
⚠ 0,1% азид натрия
Для профессионального применения

РУ № ФСР 2009/05552
От 18.08.2009 г.



АНТИ-Rh₀(D) IgM моноклональный реагент для определения резус-принадлежности крови человека (ЭРИТРОТЕСТ™- Цоликлон Анти-D Супер),

10 флаконов по 5 мл в ФКП объемом 5 мл



ООО «ГЕМАТОЛОГ»

Москва, 125167
Новый Зыковский пр-д, д. 4, стр. 1
тел: 8-800-777-07-72,
тел: 8 (495) 504-90-98

Хранить при 2-8°C
Только для in vitro диагностики

АНТИ-Rh (D) IgM моноклональный реагент
для определения резус-принадлежности
человека

ЭРИТРОТЕСТ™-Цоликлон
Анти-D Супер
ТУ 9398-002-27575295-2004

20 флаконов по 5 мл Серия: 024
Дата изготовл.: 04.03.2020
Годен до: 04.03.2022
⚠ 0,1% азид натрия
Для профессионального применения

Рy № ФСР 2009/05552
От 18.08 2009 г.





АНТИ-Rh₀(D) IgM моноклональный реагент для определения резус-принадлежности крови человека (ЭРИТРОТЕСТ™- Цоликлон Анти-D Супер),

20 флаконов по 5 мл в ФКП объёмом 5 мл





АНТИ-Rh₀(D) IgM моноклональный реагент для определения резус-принадлежности крови человека (ЭРИТРОТЕСТ™- Цоликлон Анти-D Супер),
10 флаконов по 10 мл в ФКП объемом 10 мл



Прошито и пронумеровано
листов
Директор ООО «ГЕМАТОЛОГ»
_____ Митерев Г.Ю.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ГЕМАТОЛОГ»



Митерев Г.Ю.

2021 г.

Фотографические изображения медицинского изделия

**АНТИ-Rh₀(D) IgM моноклональный реагент для определения резус-принадлежности крови человека
(ЭРИТРОТЕСТ™- Цоликлон Анти-D Супер),**

по ТУ 9398-002-27575295-2004

Варианты исполнения:

- 5 мл во флаконе, флаконы из нейтрального стекла со стеклянными капельницами – 10 флаконов стр. 2-3
- 10 мл во флаконе, флаконы из нейтрального стекла со стеклянными капельницами – 10 флаконов стр. 4-5
- 5 мл во флаконе, пластиковые флаконы-капельницы – 10 флаконов стр. 6-7
- 5 мл во флаконе, пластиковые флаконы-капельницы – 20 флаконов стр. 8-9
- 10 мл во флаконе, пластиковые флаконы-капельницы – 10 флаконов стр. 10-11





надпись «Антитела к ВИЧ 1, 2
и вирусу гепатита С и HBsAg
отсутствуют».

АНТИ-Rh₀(D) IgM моноклональный реагент для определения резус-принадлежности крови человека (ЭРИТРОТЕСТ™- Цоликлон Анти-D Супер),
10 флаконов по 5 мл в стеклянный флакон объемом 10 мл





АНТИ-Rh₀(D) IgM моноклональный реагент для определения резус-принадлежности крови человека (ЭРИТРОТЕСТ™- Цоликлон Анти-D Супер),
10 флаконов по 10 мл в стеклянный флакон объемом 10 мл



ООО «ГЕМАТОЛОГ»

Москва, 125167
Новый Зыковский пр-д, д. 4, стр. 1
тел: 8-800-777-07-72,
тел: 8 (495) 504-90-98

Хранить при 2-8°С
Только для in vitro диагностики

АНТИ-Rh (D) IgM моноклональный реагент
для определения резус-принадлежности
крови человека

ЭРИТРОТЕСТ™-Цоликлон
Анти-D Супер
по ТУ 9398-002-27575295-2004

10 флаконов по 5 мл Серия: 023
Дата изготовл.: 04.03.2020
Годен до: 04.03.2022
⚠ 0,1% азид натрия
Для профессионального применения

РУ № ОСП 2009/05552
От 18.08.2009 г.



АНТИ-Rh₀(D) IgM моноклональный реагент для определения резус-принадлежности крови человека (ЭРИТРОТЕСТ™- Цоликлон Анти-D Супер),
10 флаконов по 5 мл в ФКП объёмом 5 мл



ООО «ГЕМАТОЛОГ»

Москва, 125167
Новый Зыковский пр-д, д. 4, стр. 1
тел: 8-800-777-07-72,
тел: 8 (495) 504-90-98

Хранить при 2-8°С
Только для in vitro диагностики

АНТИ-Rh (D) IgM моноклональный реагент
для определения резус-принадлежности
человека

ЭРИТРОТЕСТ™-Цоликлон
Анти-D Супер

по ТУ 9398-002-27575295-2004

20 флаконов по 5 мл Серия: 024

Дата изготовл.: 04.03.2020

Годен до: 04.03.2022

⚠ 0,1% азид натрия
Для профессионального применения

РУ № ФСР 2009/05552
От 18.08.2009 г.



АНТИ-Rh₀(D) IgM моноклональный реагент для определения резус-принадлежности крови человека (ЭРИТРОТЕСТ™- Цоликлон Анти-D Супер),
20 флаконов по 5 мл в ФКП объемом 5 мл



ООО «ГЕМАТОЛОГ»

Москва, 125167
Новый Зыковский пр-д, д. 4, стр. 1
тел: 8-800-777-07-72
тел: (495) 504-90-98

Хранить при 2-8°C
Только для in vitro диагностики

АНТИ-Rh (D) IgM моноклональный реагент
для определения резус-принадлежности
крови человека

ЭРИТРОТЕСТ™-Цоликлон
Анти-D Супер

по ТУ 9398-002-27575295-2004

10 флаконов по 10 мл Серия: 025

Дата изготовл.: 04.03.2020

Годен до: 04.03.2022

⚠ 0,1% азид натрия
Для профессионального применения

Р/№ ФСР 2009/05552
От 18.08.2009 г.





АНТИ-Rh₀(D) IgM моноклональный реагент для определения резус-принадлежности крови человека (ЭРИТРОТЕСТ™ - Цоликлон Анти-D Супер), 10 флаконов по 10 мл в ФКП объёмом 10 мл



Процито и пронумеровано
9 листов
Директор ООО «ГЕМАТОЛОГ»
Митерев Г.Ю.