

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Артрекс»

А.В. Паустьян

«17» декабря 2020г.



**Фотографические изображения
на медицинское изделие**

«Центрифуга лабораторная настольная HORIZON 24-АН в вариантах исполнения»,

производства «Друкер Диагностикс» Drucker Diagnostics,

200 Shadylane (Shady Ln) Drive Suite (Ste) 170 Philipsburg, Pennsylvania (PA) 16866, USA


I. Центрифуга лабораторная настольная HORIZON 24-АН, в составе:

- 1. Центрифуга;**
- 2. Кабель электропитания с источником питания;**
- 3. Держатели (бакеты) не более 6 шт.**
- 4. Руководство по эксплуатации.**


Центрифуга вид спереди




Центрифуга вид сзади

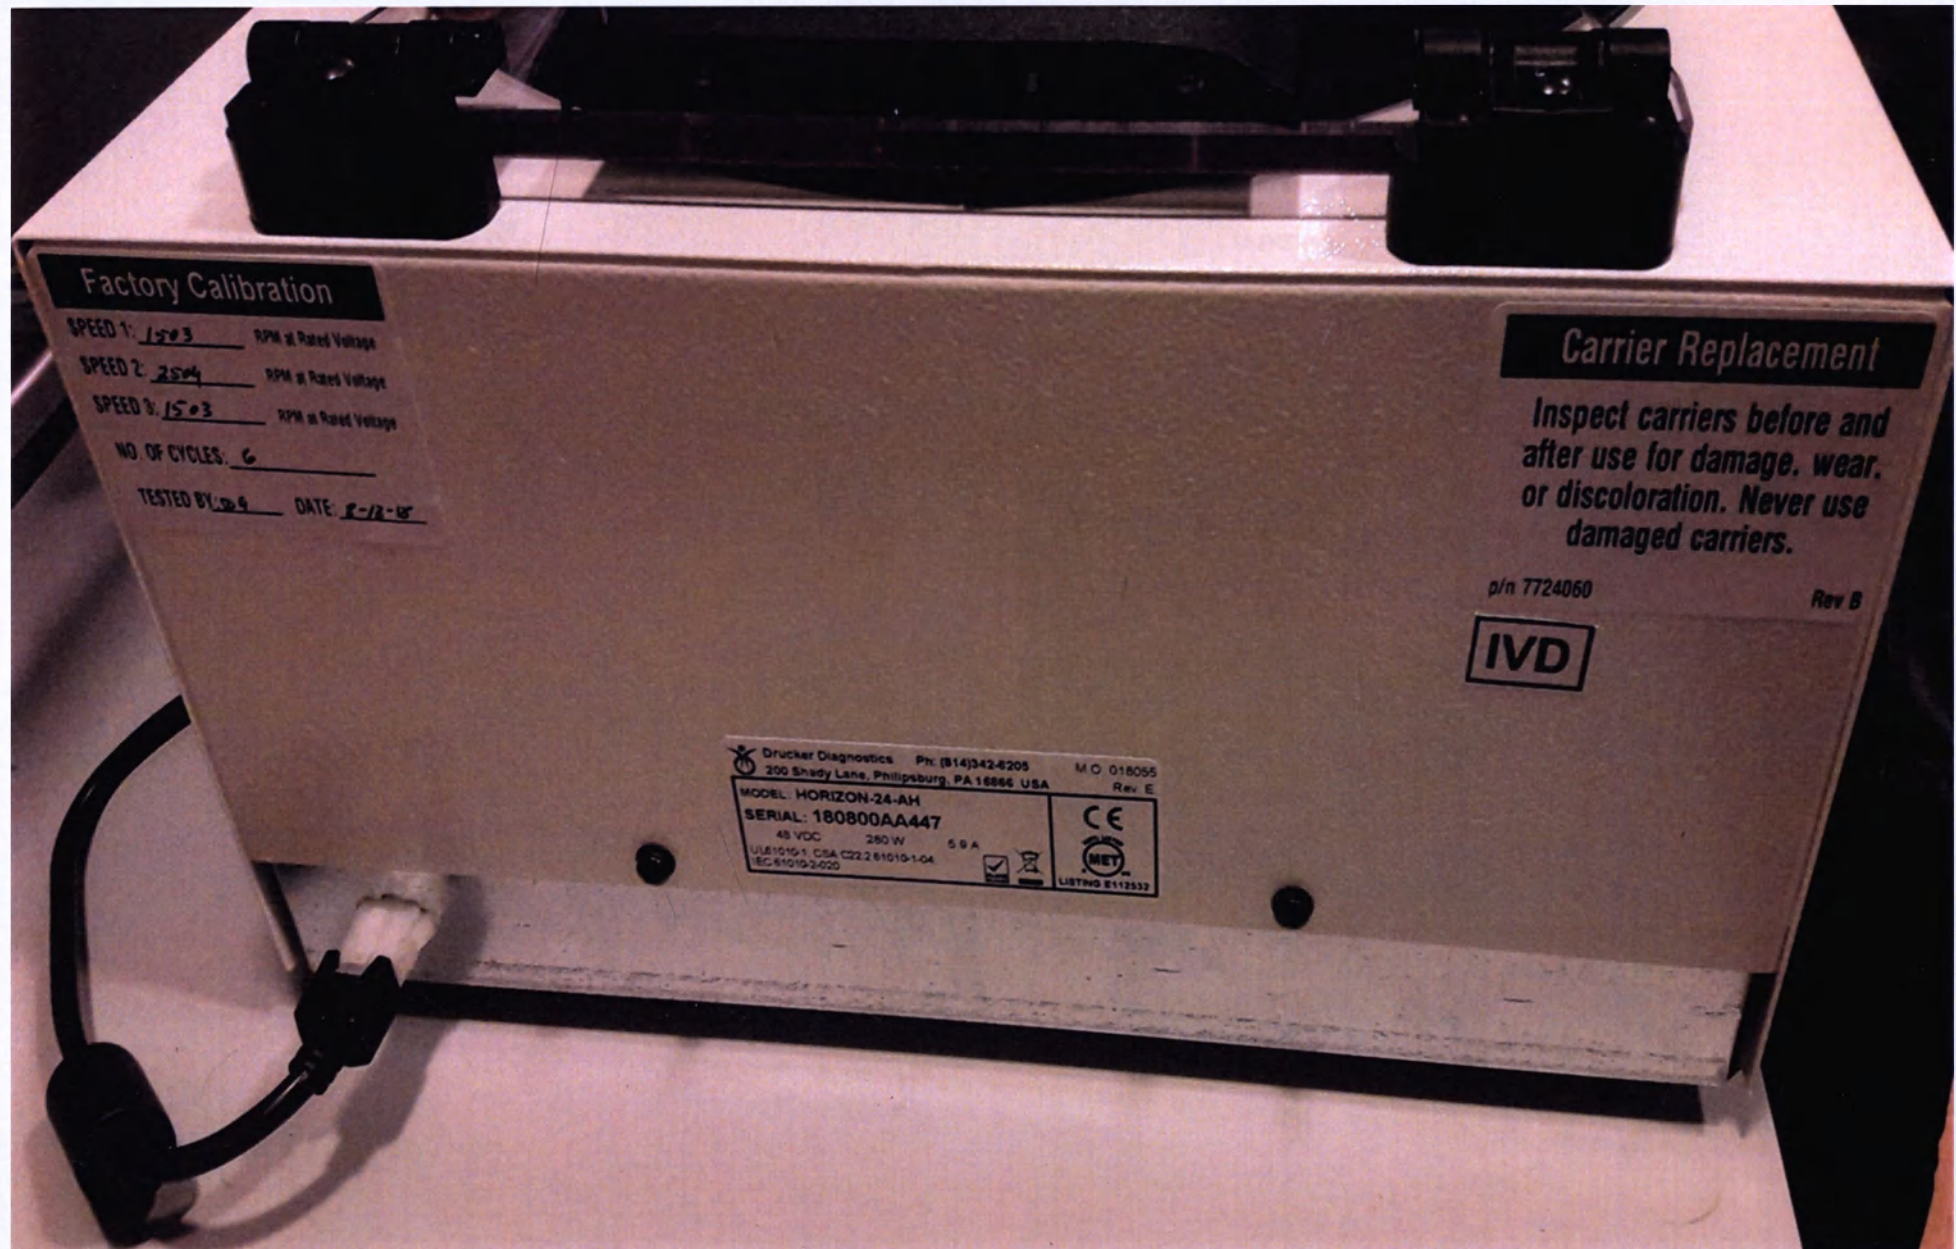


Центрифуга вид внутри, маркировка ротора

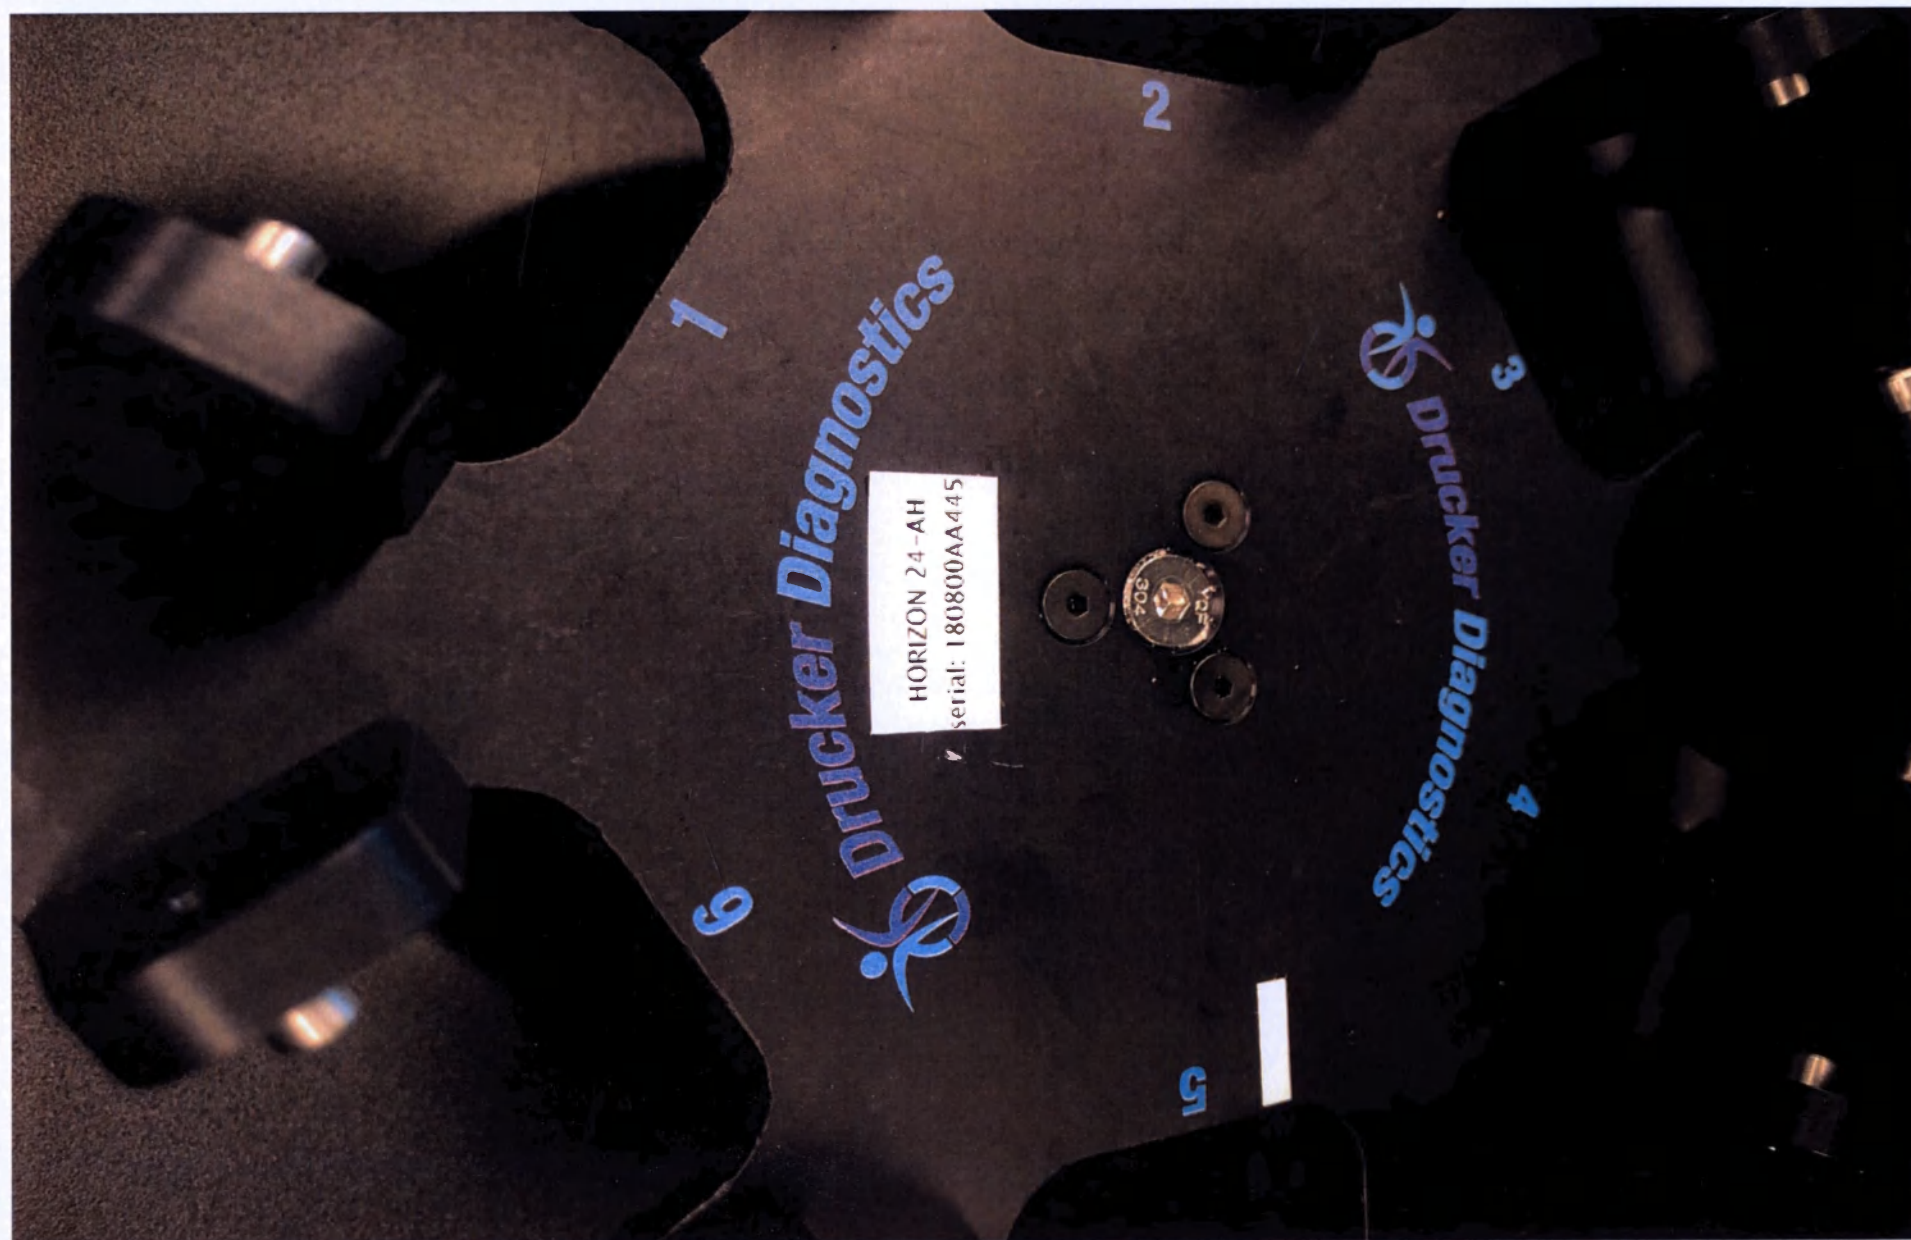

Кабель электропитания с источником питания

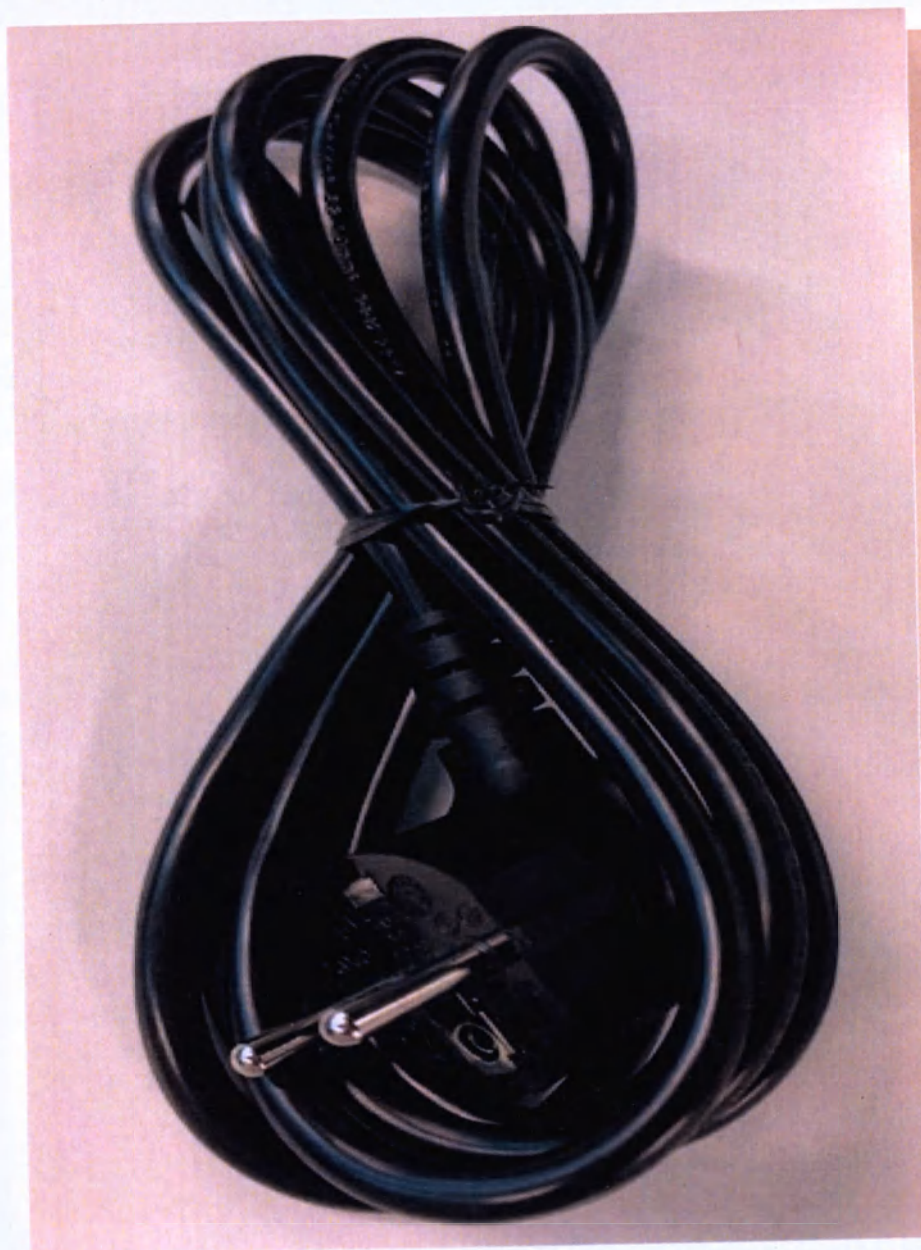


Держатели (бакеты) 6 шт.

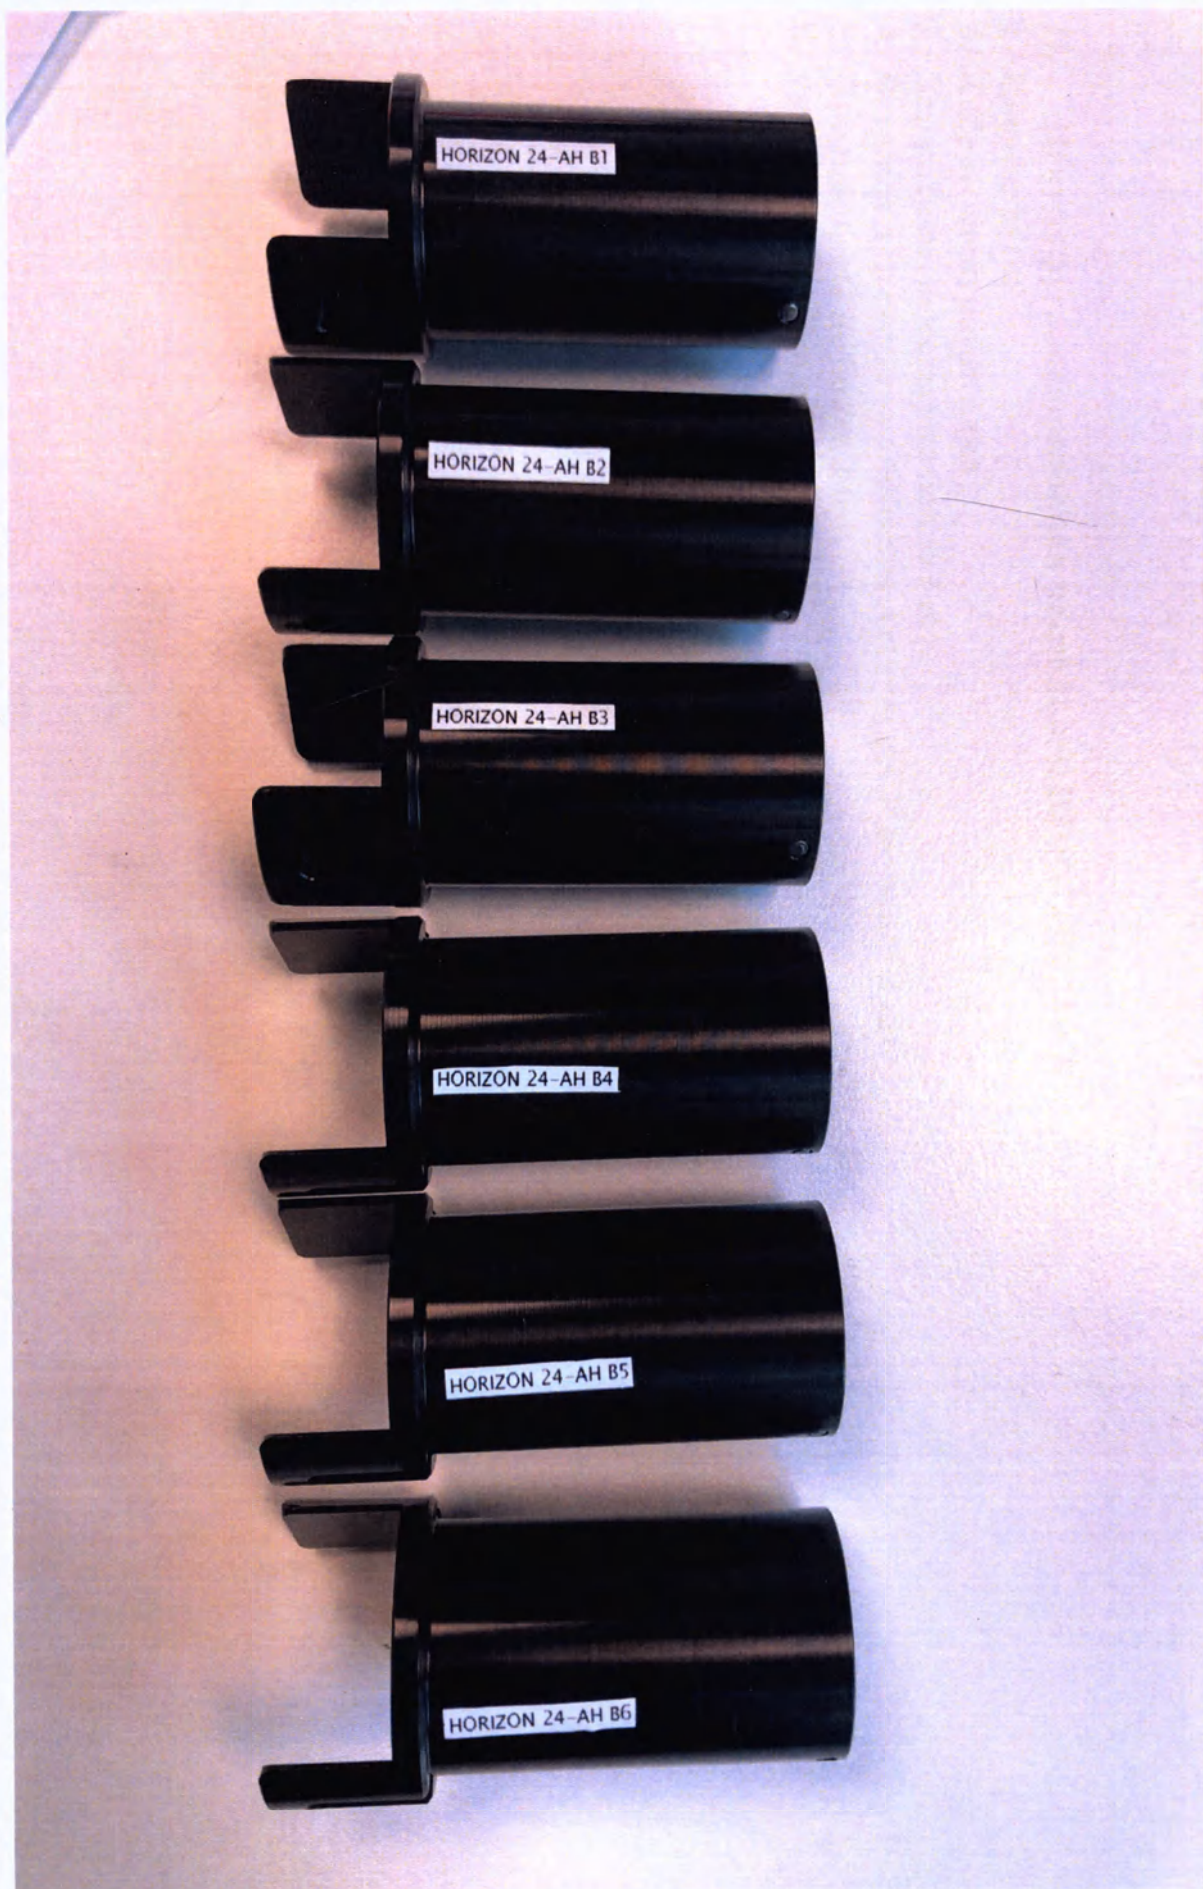


II. Центрифуга лабораторная настольная HORIZON 24-АН, в составе:

- 1. Центрифуга;**
- 2. Кабель электропитания;**
- 3. Держатели (бакеты) не более 2 шт.**
- 4. Вставки для шприца двойного Arthrex ACP не более 2 шт.**
- 5. Противовесы не более 2 шт.**
- 6. Руководство по эксплуатации.**

Центрифуга вид спереди

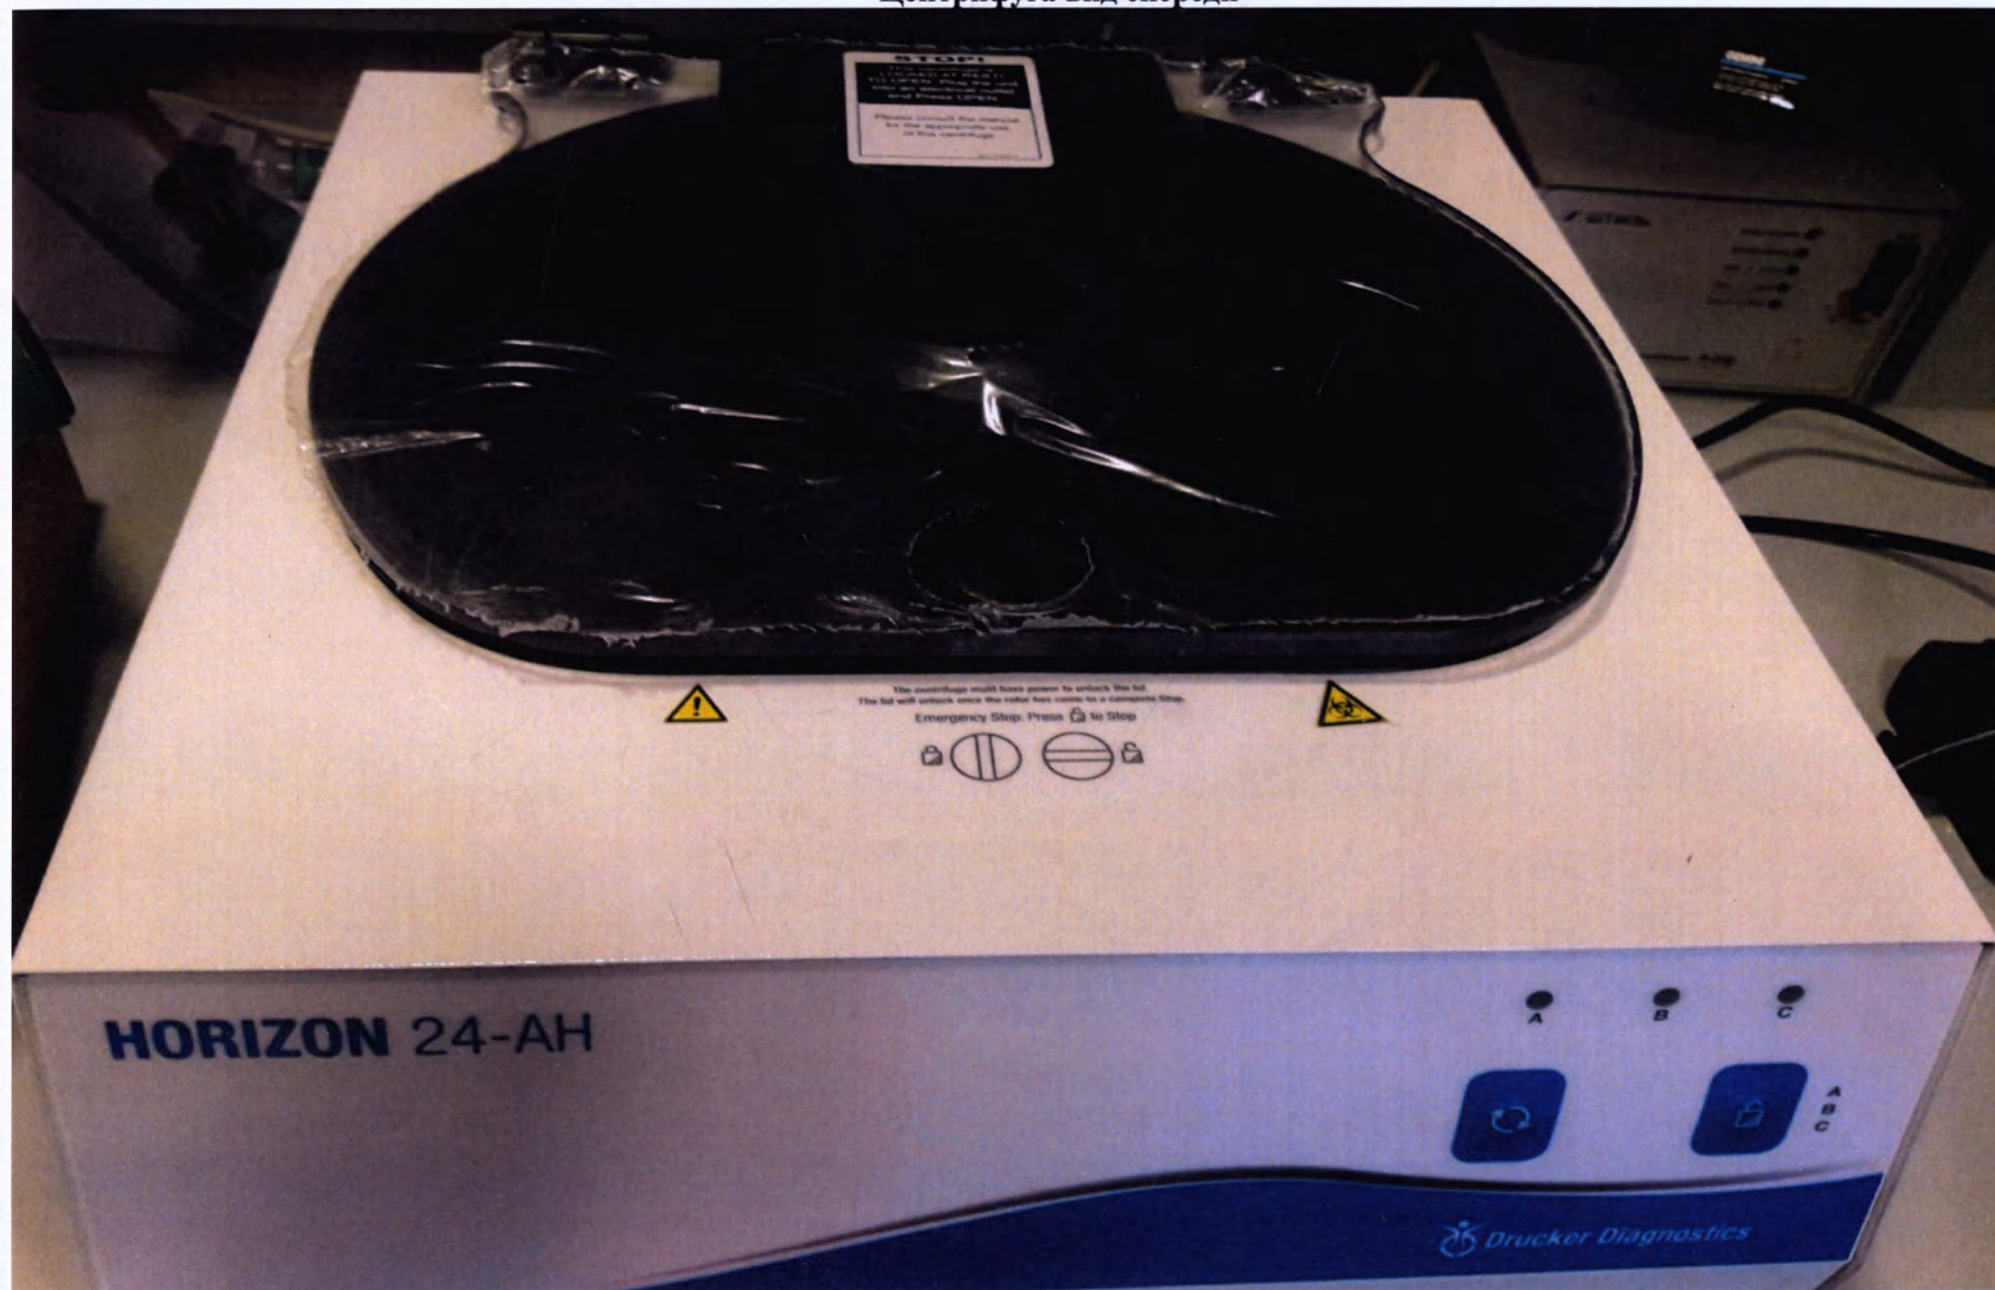


Центрифуга вид сзади

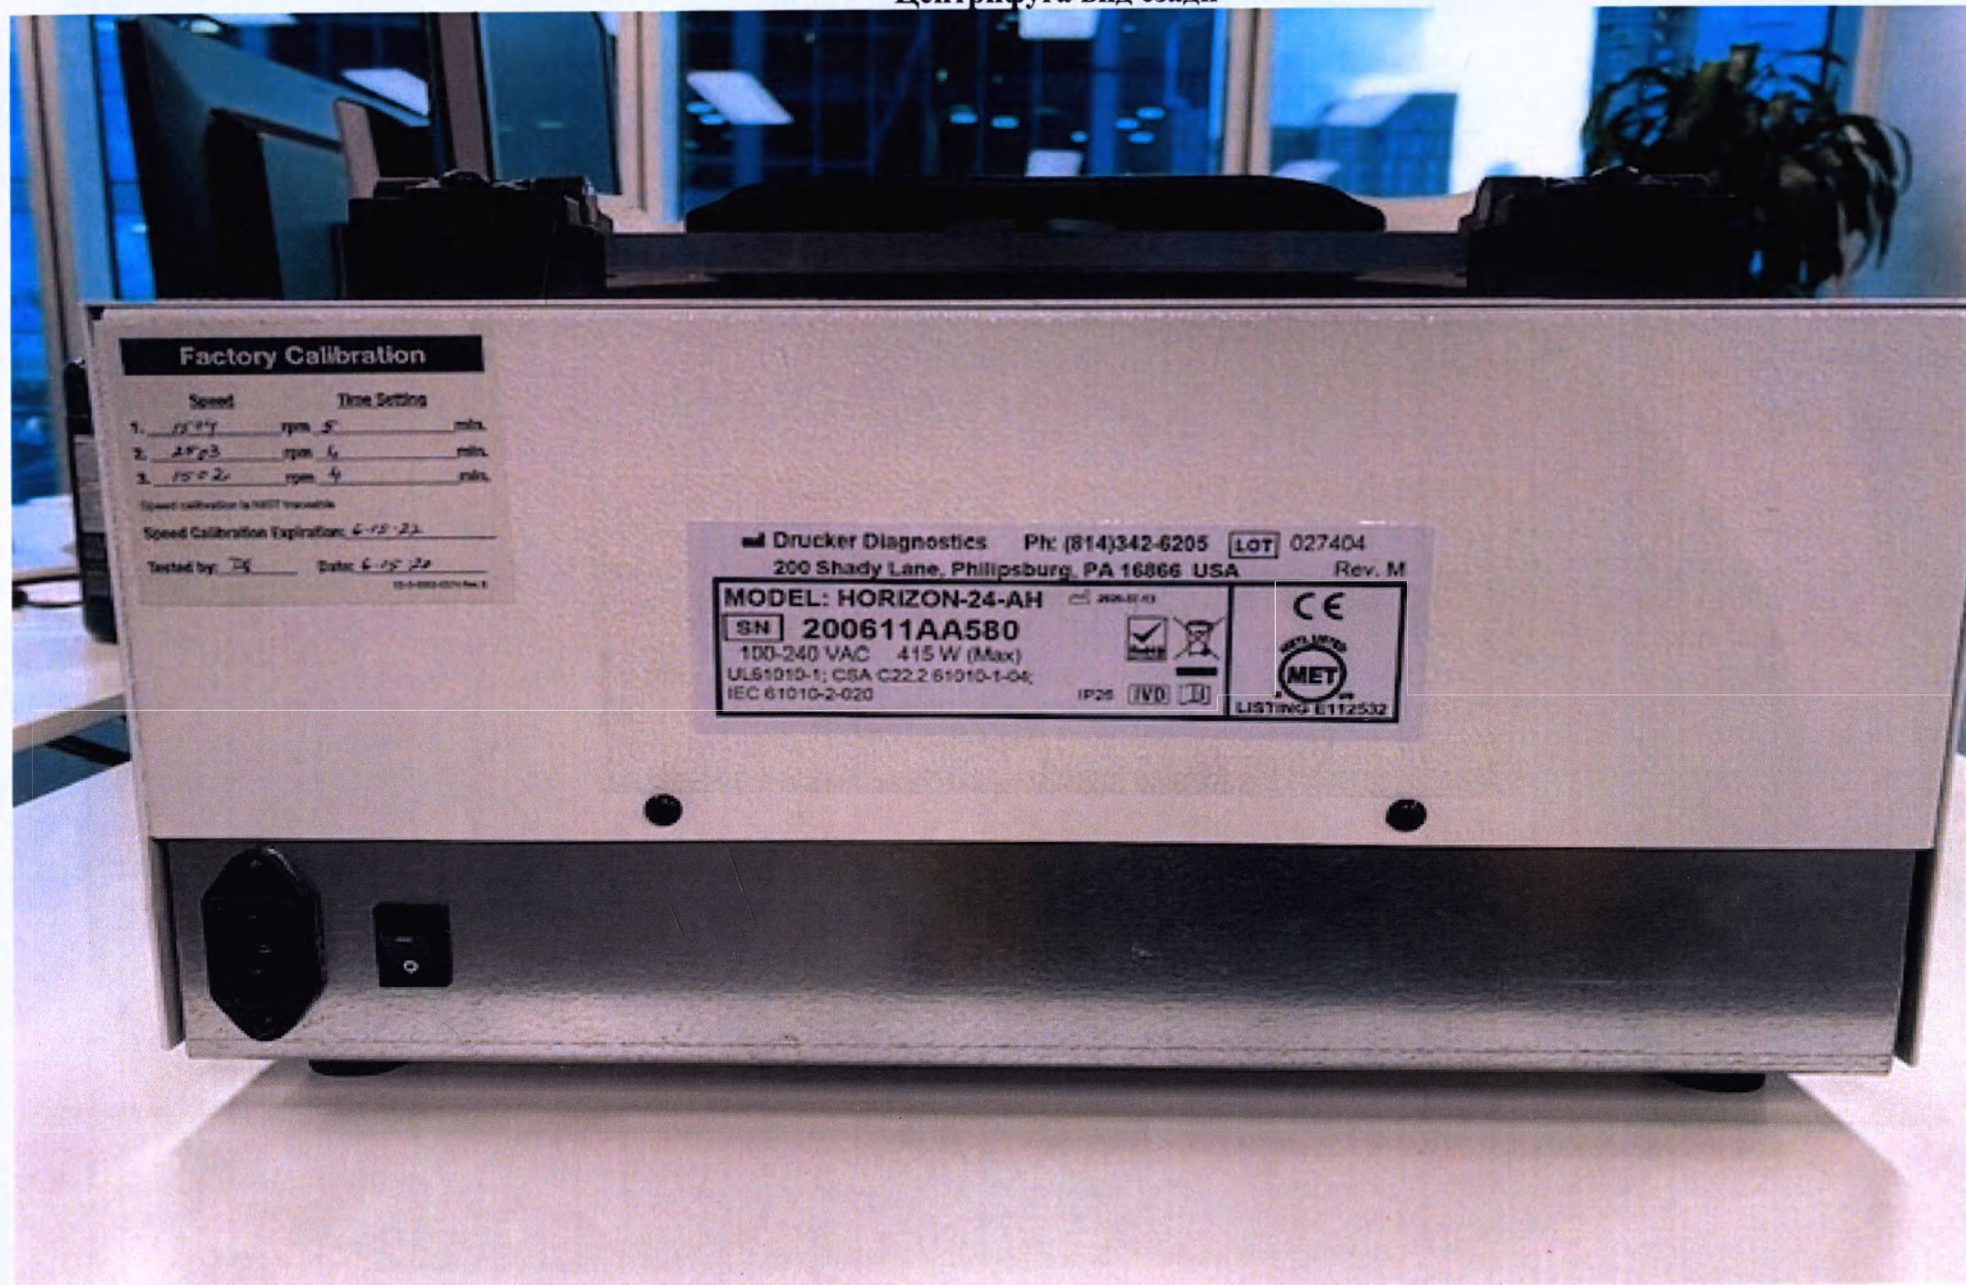


Центрифуга вид внутри, маркировка ротора



Кабель электропитания

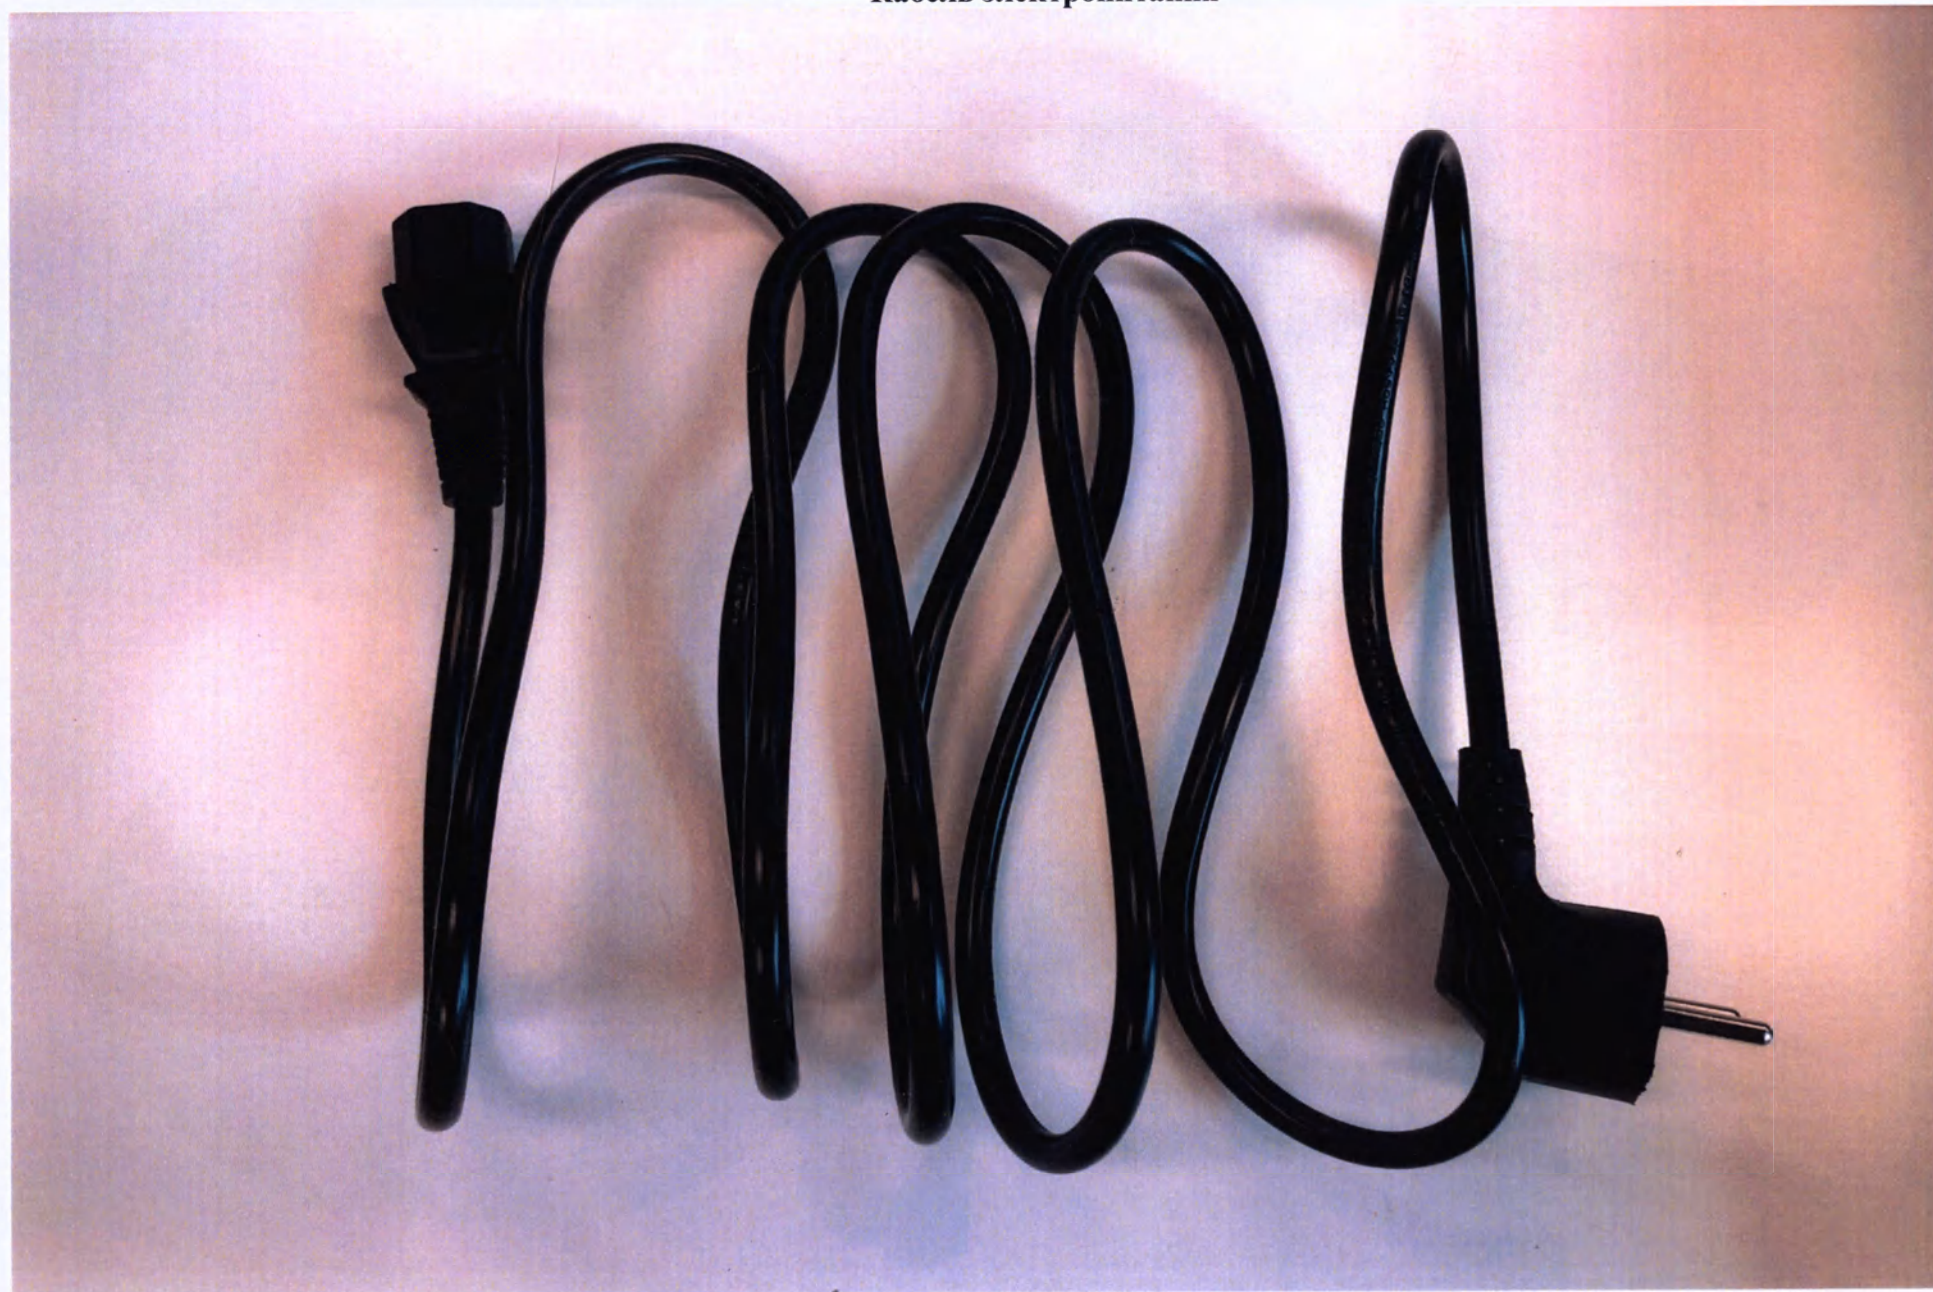

Держатели (бакеты) 2 шт.

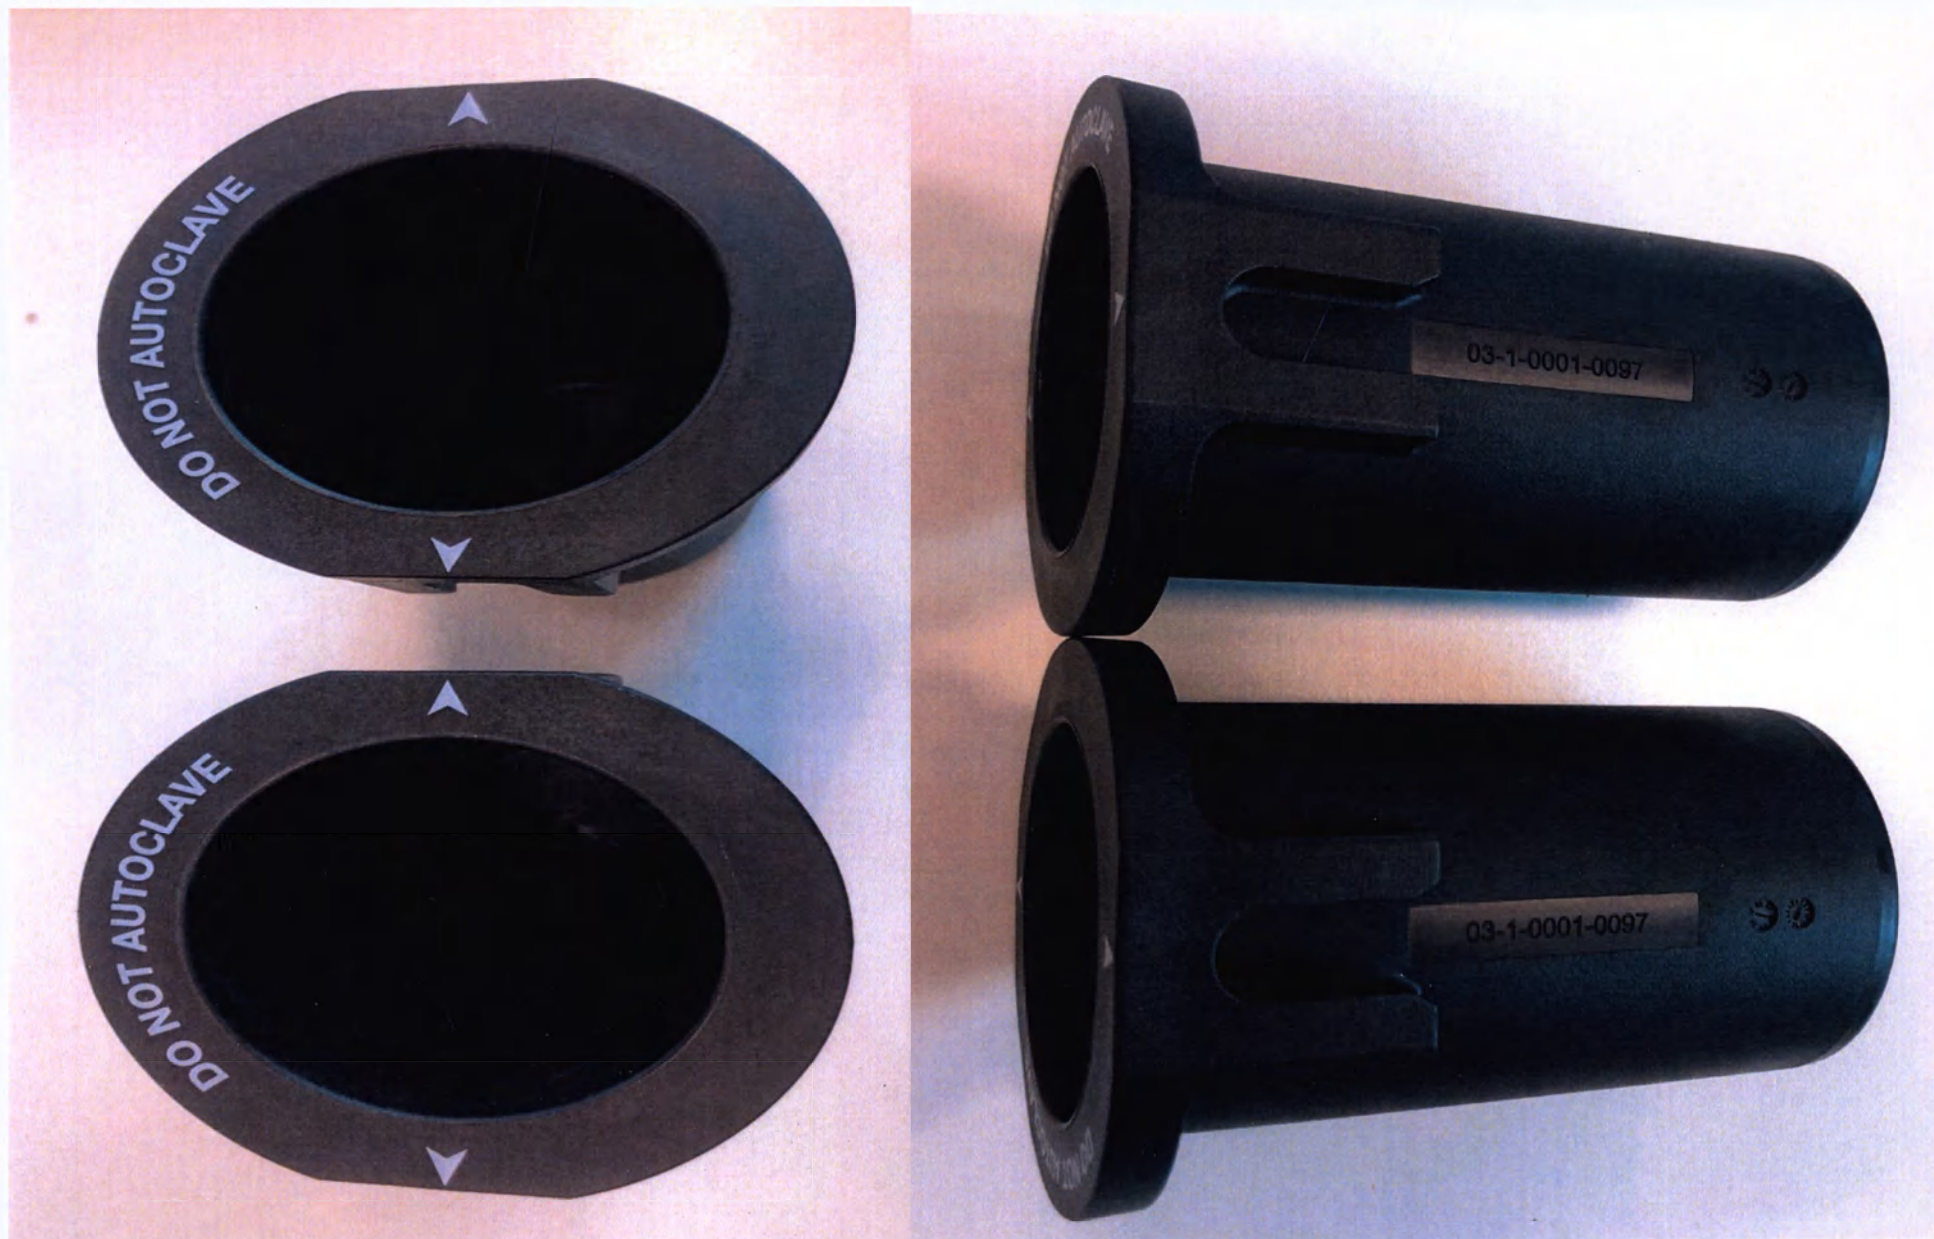

Вставки для шприца двойного Arthrex ACP 2 шт.



Противовесы 2 шт.



Проект маркировки МИ на русском языке

Центрифуга лабораторная настольная HORIZON 24-АН

Доп. инфо см. на упаковке

Производитель: Drucker Diagnostics, 200 Shadylane Drive Suite 170 Philipsburg, PA 16866, USA

Представитель производителя в РФ: ООО «Артрекс»

Юр. адрес: 123317, г. Москва, Пресненская наб., д.6, стр.2

Почтовый адрес: 123317, г. Москва, Пресненская наб., д.6, стр.2, а/я 67

Тел.: + 7 499 643 86 10, + 7 499 643 86 13,

адрес электронной почты: info@arthrex-russia.ru

Регистрационное удостоверение:

№РЗН 2020/10456 от XX.XX.XXXXг.

«Центрифуга лабораторная настольная HORIZON 24-АН в вариантах исполнения»

Срок годности: не ограничен



Руководство пользователя и описания оперативных техник см. на вебсайте:

www.arthrex.com и druckerdiagnostics.com

LCN xxxxx

Всего промито и
пропущено
16 листов



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Артрекс»

А.В. Паустьян



Фотографические изображения

медицинского изделия

«Центрифуга лабораторная настольная HORIZON 24-АН в вариантах исполнения»,


производства Drucker Diagnostics, 200 Shadylane (Shady Ln) Drive Suite (Ste) 170 Philipsburg, Pennsylvania (PA) 16866, USA

I. Центрифуга лабораторная настольная HORIZON 24-АН с ротором на 6 отсеков, в составе:


- 1. Центрифуга;**
- 2. Кабель электропитания с блоком питания;**
- 3. Держатели (бакеты) не более 6 шт.**
- 4. Руководство по эксплуатации.**

Центрифуга вид спереди




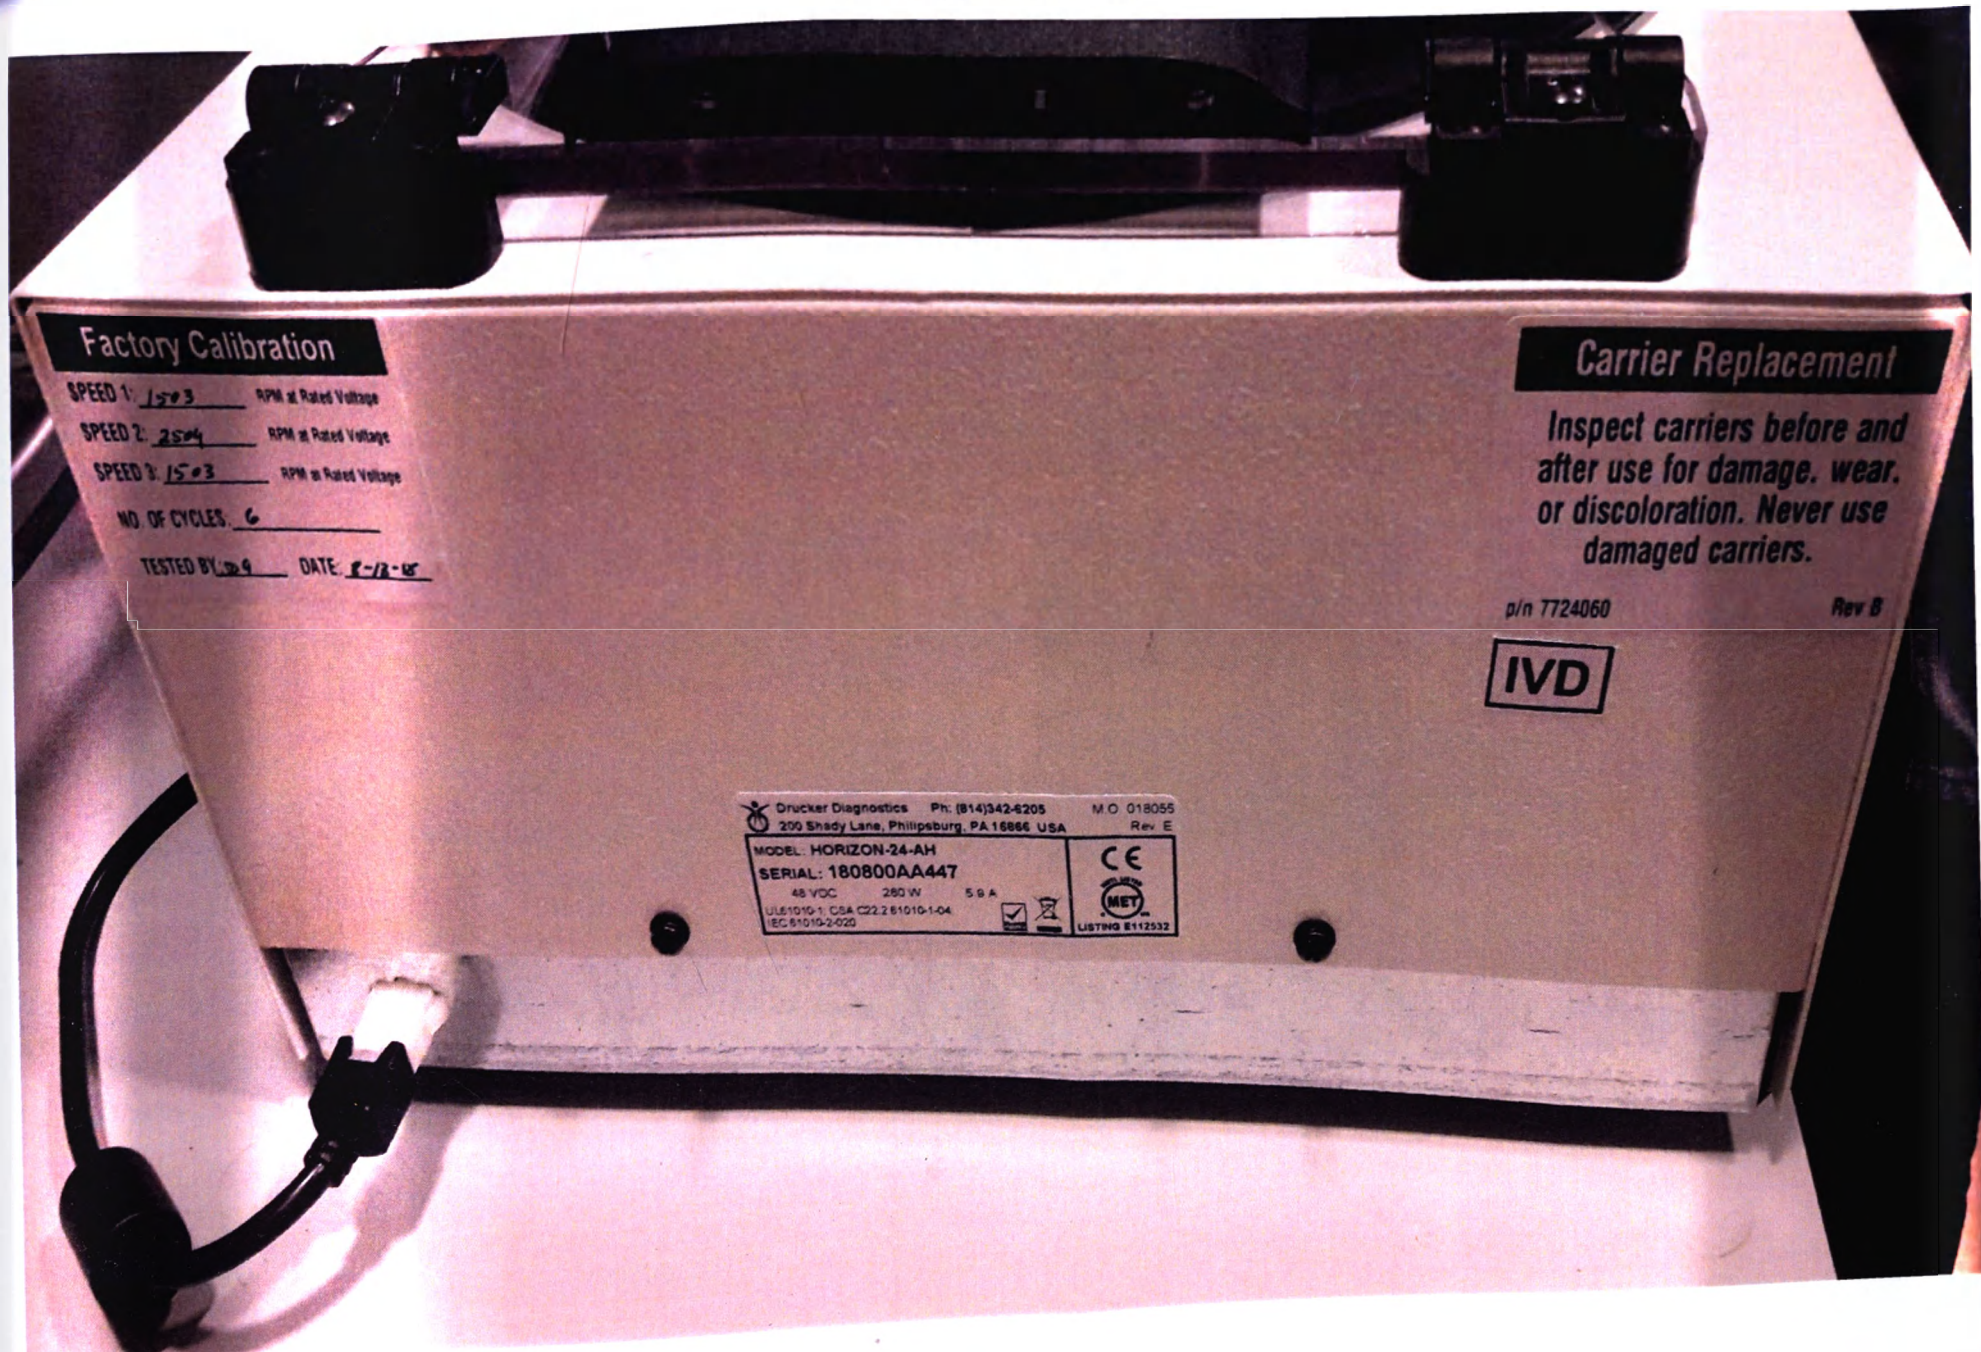

Центрифуга вид внутри, маркировка ротора

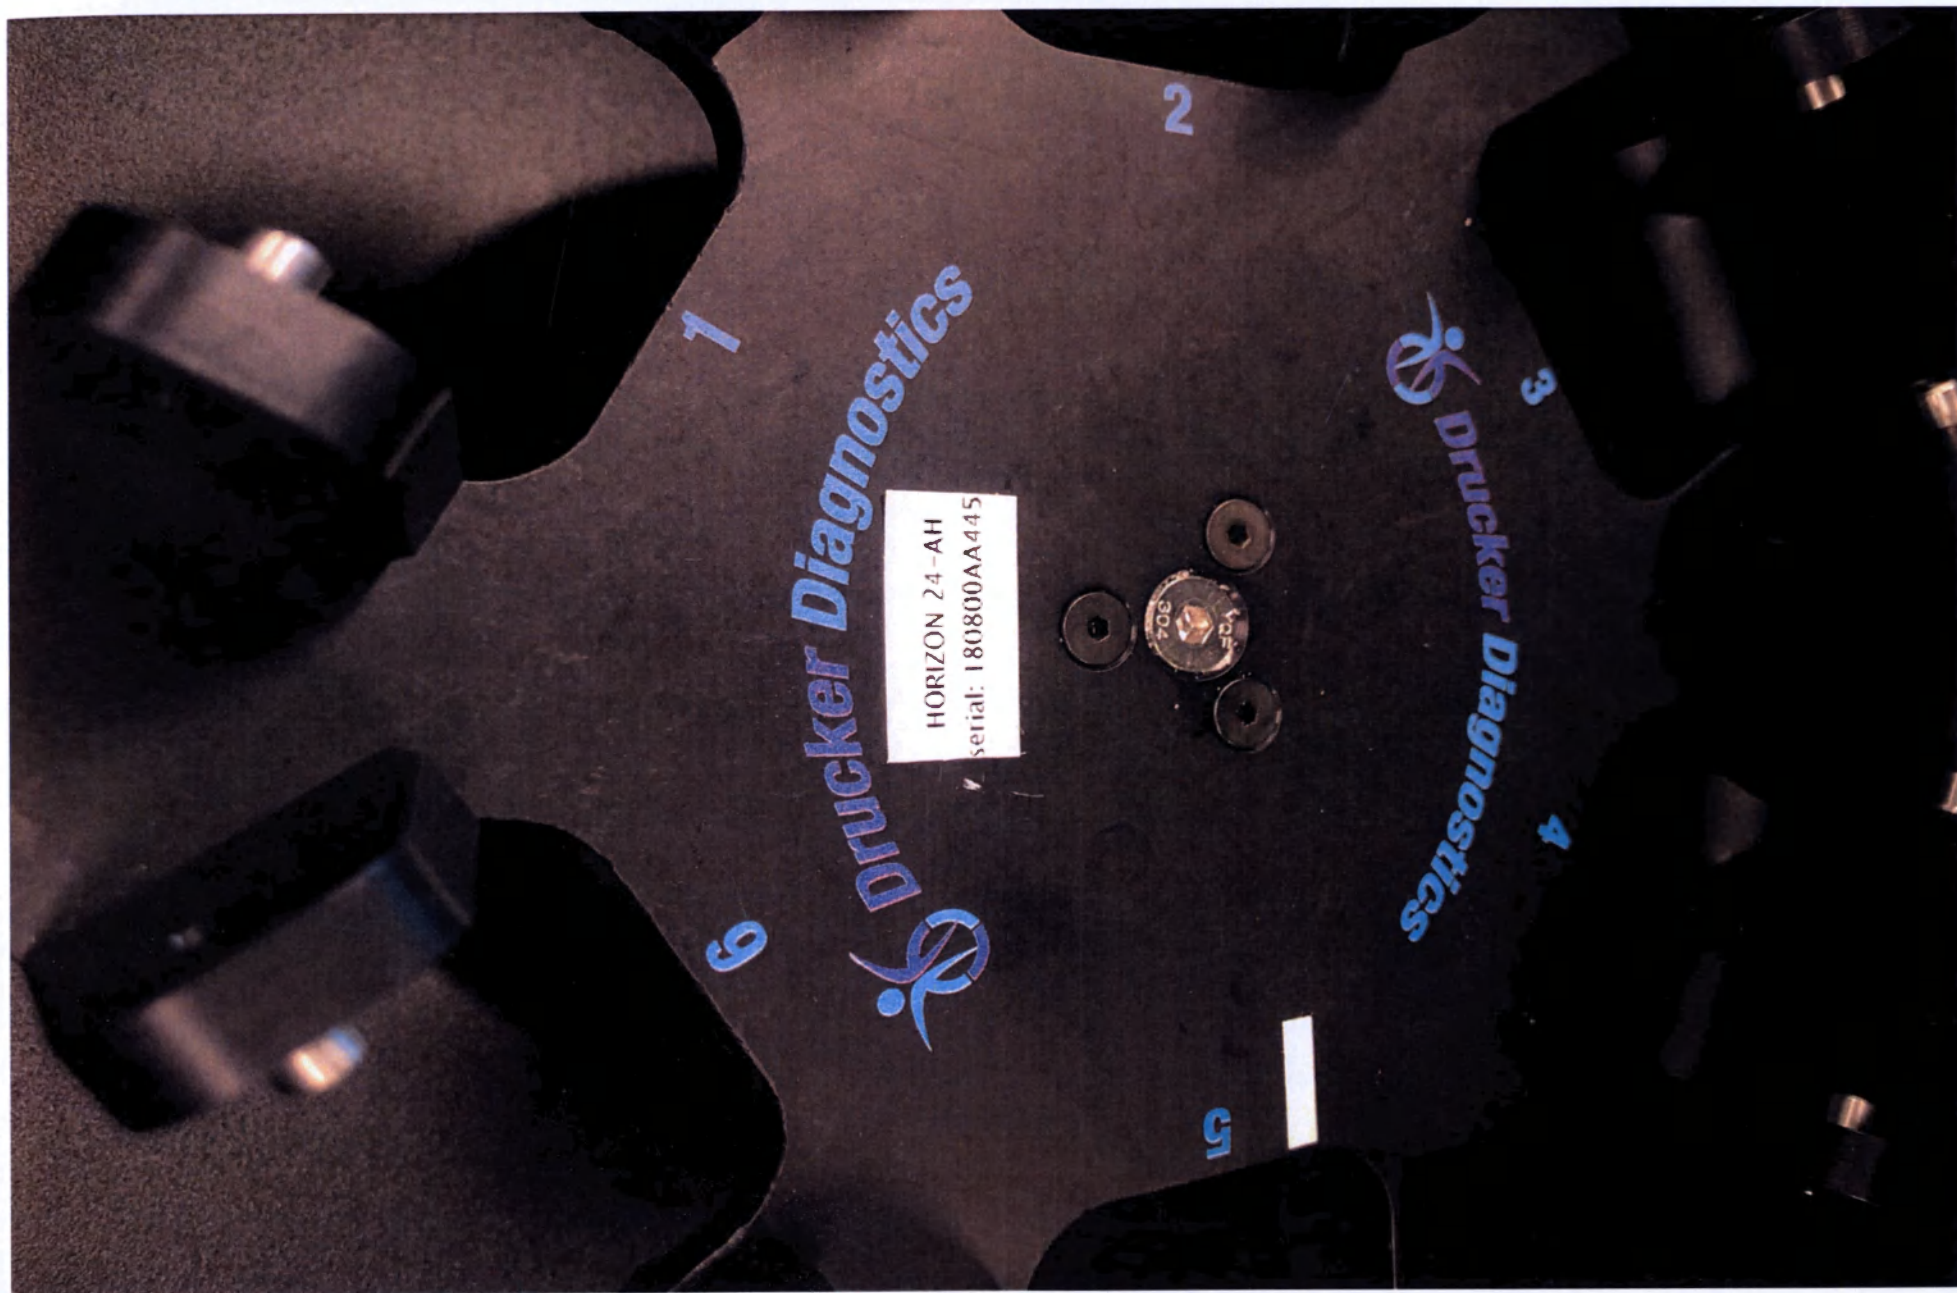

Кабель электропитания с блоком питания

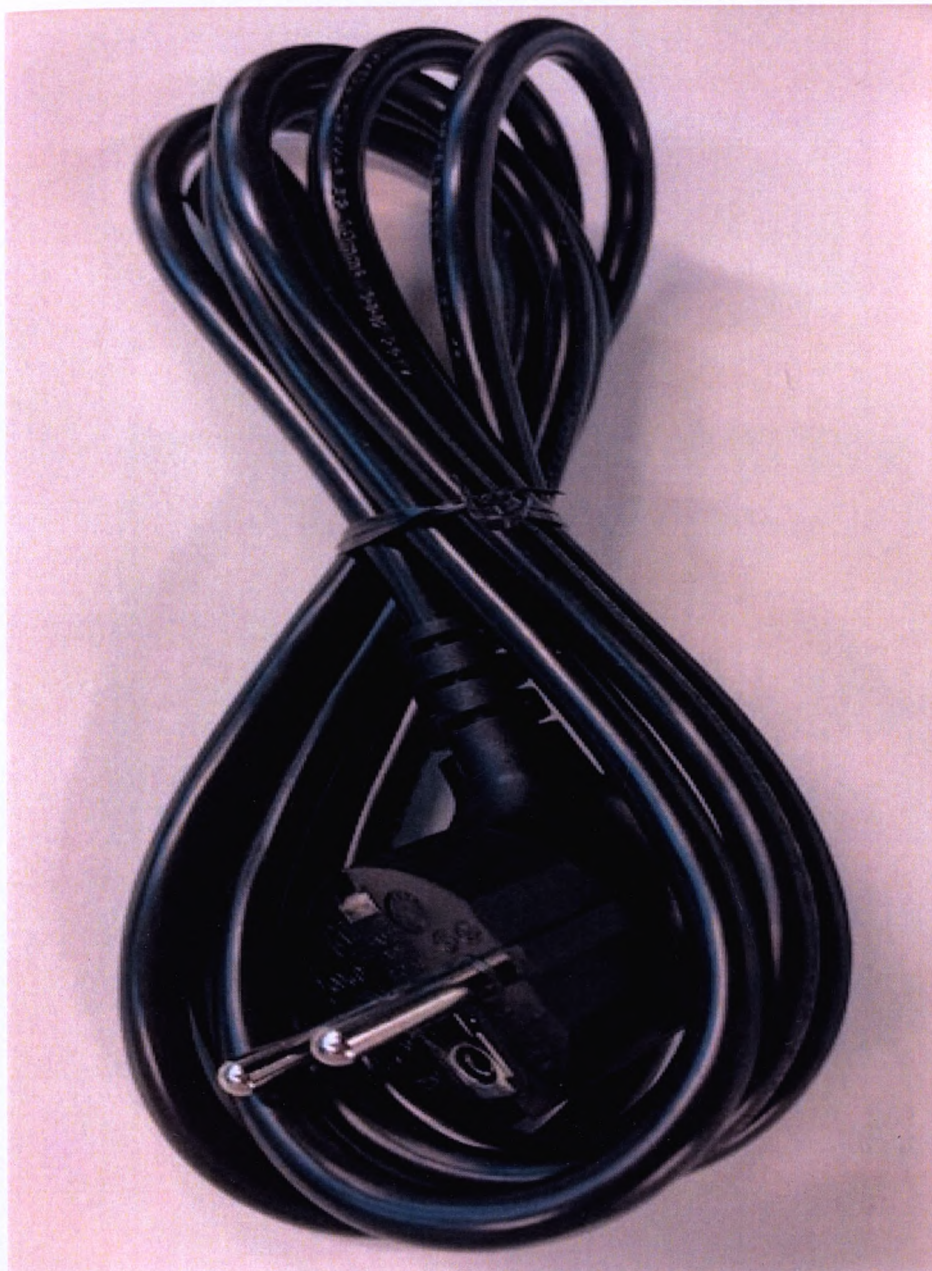



Маркировка упаковки на русском языке

Центрифуга лабораторная настольная HORIZON 24-АН с ротором на 6 отсеков

Доп. инфо см. на упаковке

Производитель: Drucker Diagnostics, 200 Shadylane Drive Suite 170 Philipsburg, PA 16866, USA

Представитель производителя в РФ: ООО «Артрекс»

Юр. адрес: 123317, г. Москва, Пресненская наб., д.6, стр.2

Почтовый адрес: 123317, г. Москва, Пресненская наб.,
д.6, стр.2, а/я 67

Тел.: + 7 499 643 86 10, + 7 499 643 86 13,

адрес электронной почты: info@arthrex-russia.ru

Регистрационное удостоверение:

№РЗН 2020/10456 от XX.XX.XXXXг.

«Центрифуга лабораторная настольная
HORIZON 24-АН в вариантах исполнения»

Срок годности: не ограничен



Руководство пользователя и описания оперативных техник см. на вебсайте:

www.arthrex.com и druckerdiagnostics.com


LCN xxxxx

II. Центрифуга лабораторная настольная HORIZON 24-АН с ротором на 4 отсека, в составе:

- 1. Центрифуга;**
- 2. Кабель электропитания;**
- 3. Держатели (бакеты) не более 2 шт.**
- 4. Вставки для шприца двойного Arthrex ACP не более 2 шт.**
- 5. Противовесы не более 2 шт.**
- 6. Руководство по эксплуатации.**

Центрифуга вид спереди




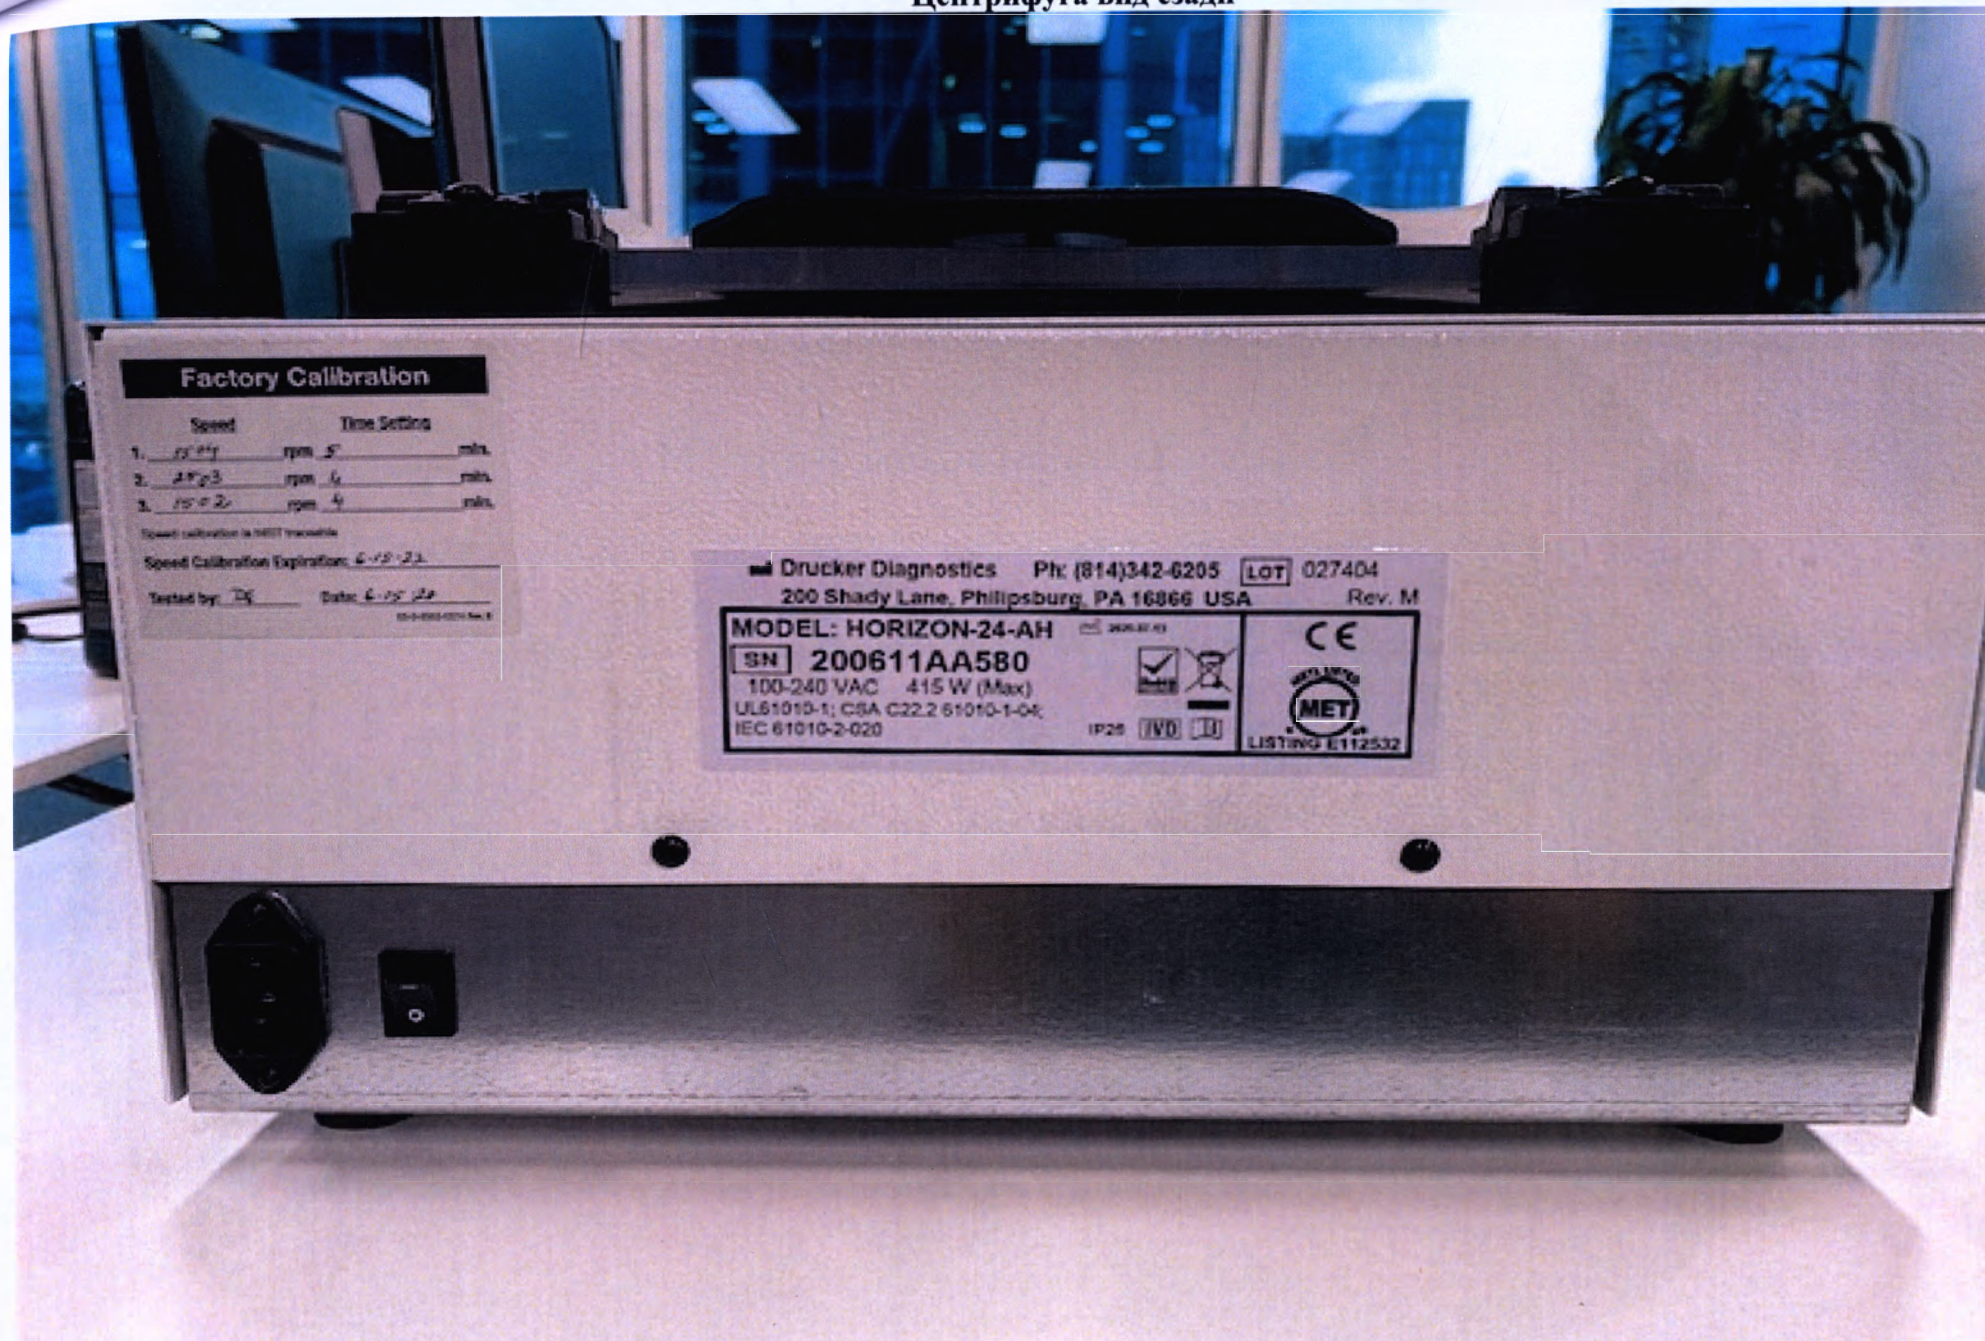


Центрифуга вид внутри, маркировка ротора



Кабель электропитания

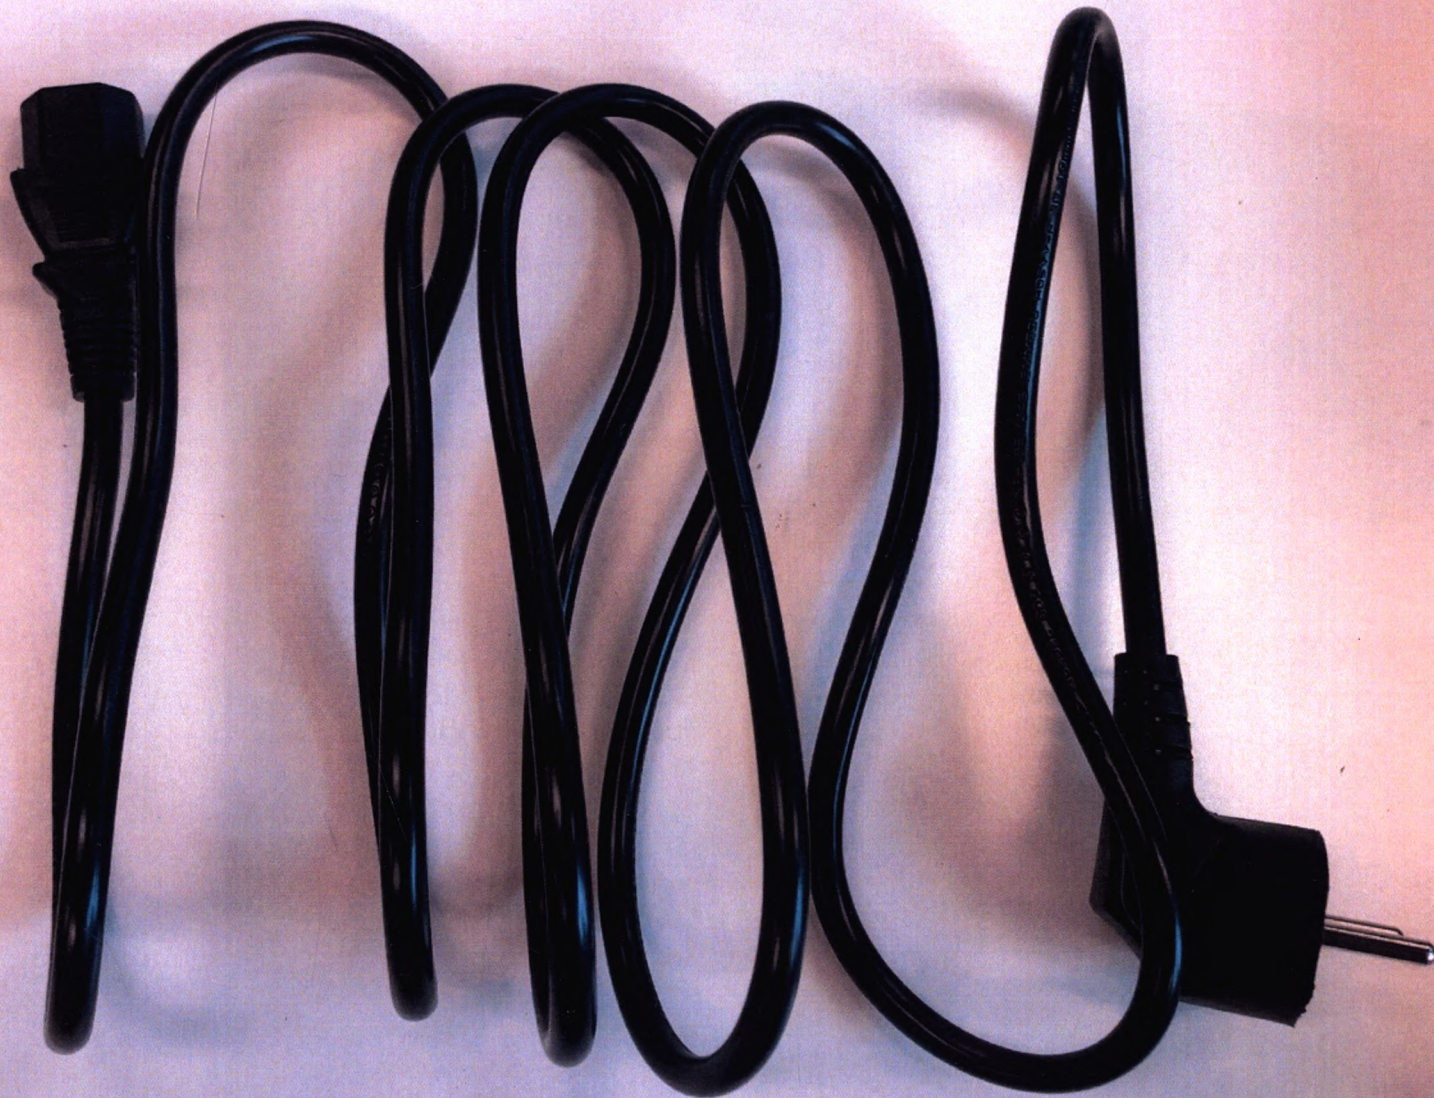

Держатели (бакеты) 2 шт.

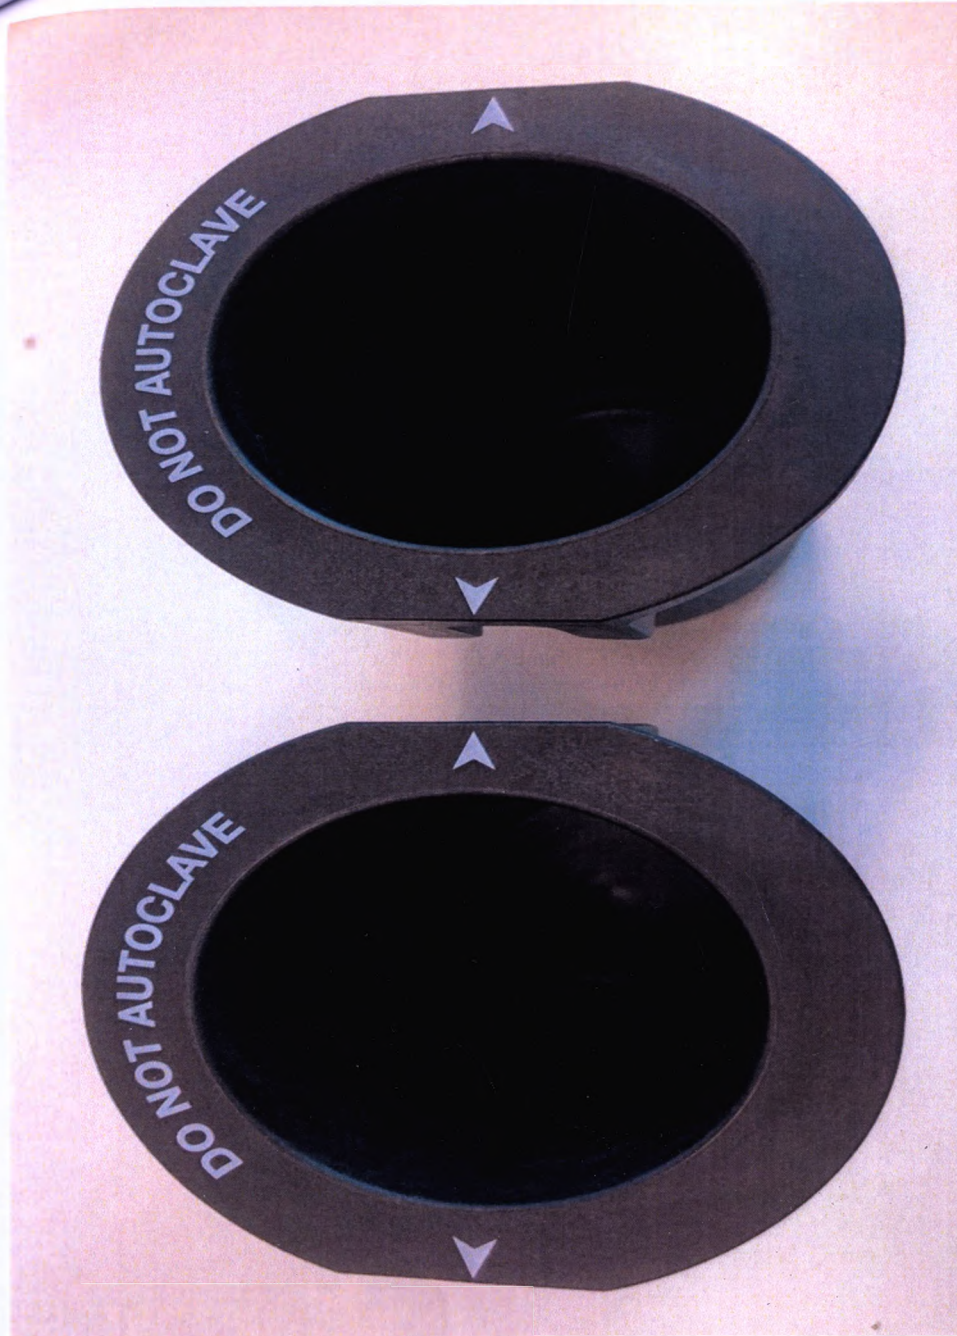

Вставки для шприца двойного Arthrex ACP 2 шт.



Противовесы 2 шт.



Маркировка упаковки на русском языке

Центрифуга лабораторная настольная HORIZON 24-AH с ротором на 4 отсека

Доп. инфо см. на упаковке

Производитель: Drucker Diagnostics, 200 Shadylane Drive Suite 170 Philipsburg, PA 16866, USA

Представитель производителя в РФ: ООО «Артрекс»

Юр. адрес: 123317, г. Москва, Пресненская наб., д.6, стр.2

Почтовый адрес: 123317, г. Москва, Пресненская наб.,
д.6, стр.2, а/я 67

Тел.: + 7 499 643 86 10, + 7 499 643 86 13,

адрес электронной почты: info@arthrex-russia.ru

Регистрационное удостоверение:

№РЗН 2020/10456 от XX.XX.XXXXг.

«Центрифуга лабораторная настольная
HORIZON 24-AH в вариантах исполнения»

Срок годности: не ограничен



Руководство пользователя и описания оперативных техник см. на вебсайте:

www.arthrex.com и druckerdiagnostics.com

LCN xxxxx

всего прошито и
прошито
17 листов

