



**Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия**

**Набор реагентов для определения уровня панкреатической амилазы
ферментным спектрофотометрическим методом (IFCC)
в сыворотке или плазме крови человека
на биохимических анализаторах Alinity с
«Амилаза Панкреатическая Реагенты
(Alinity с Pancreatic Amylase Reagent)»**

Фотографическое изображение МИ ИВД Амилаза Панкреатическая Реагенты (Alinity с Pancreatic Amylase Reagent), 2 картриджа по 100 тестов, упаковка, вид снаружи

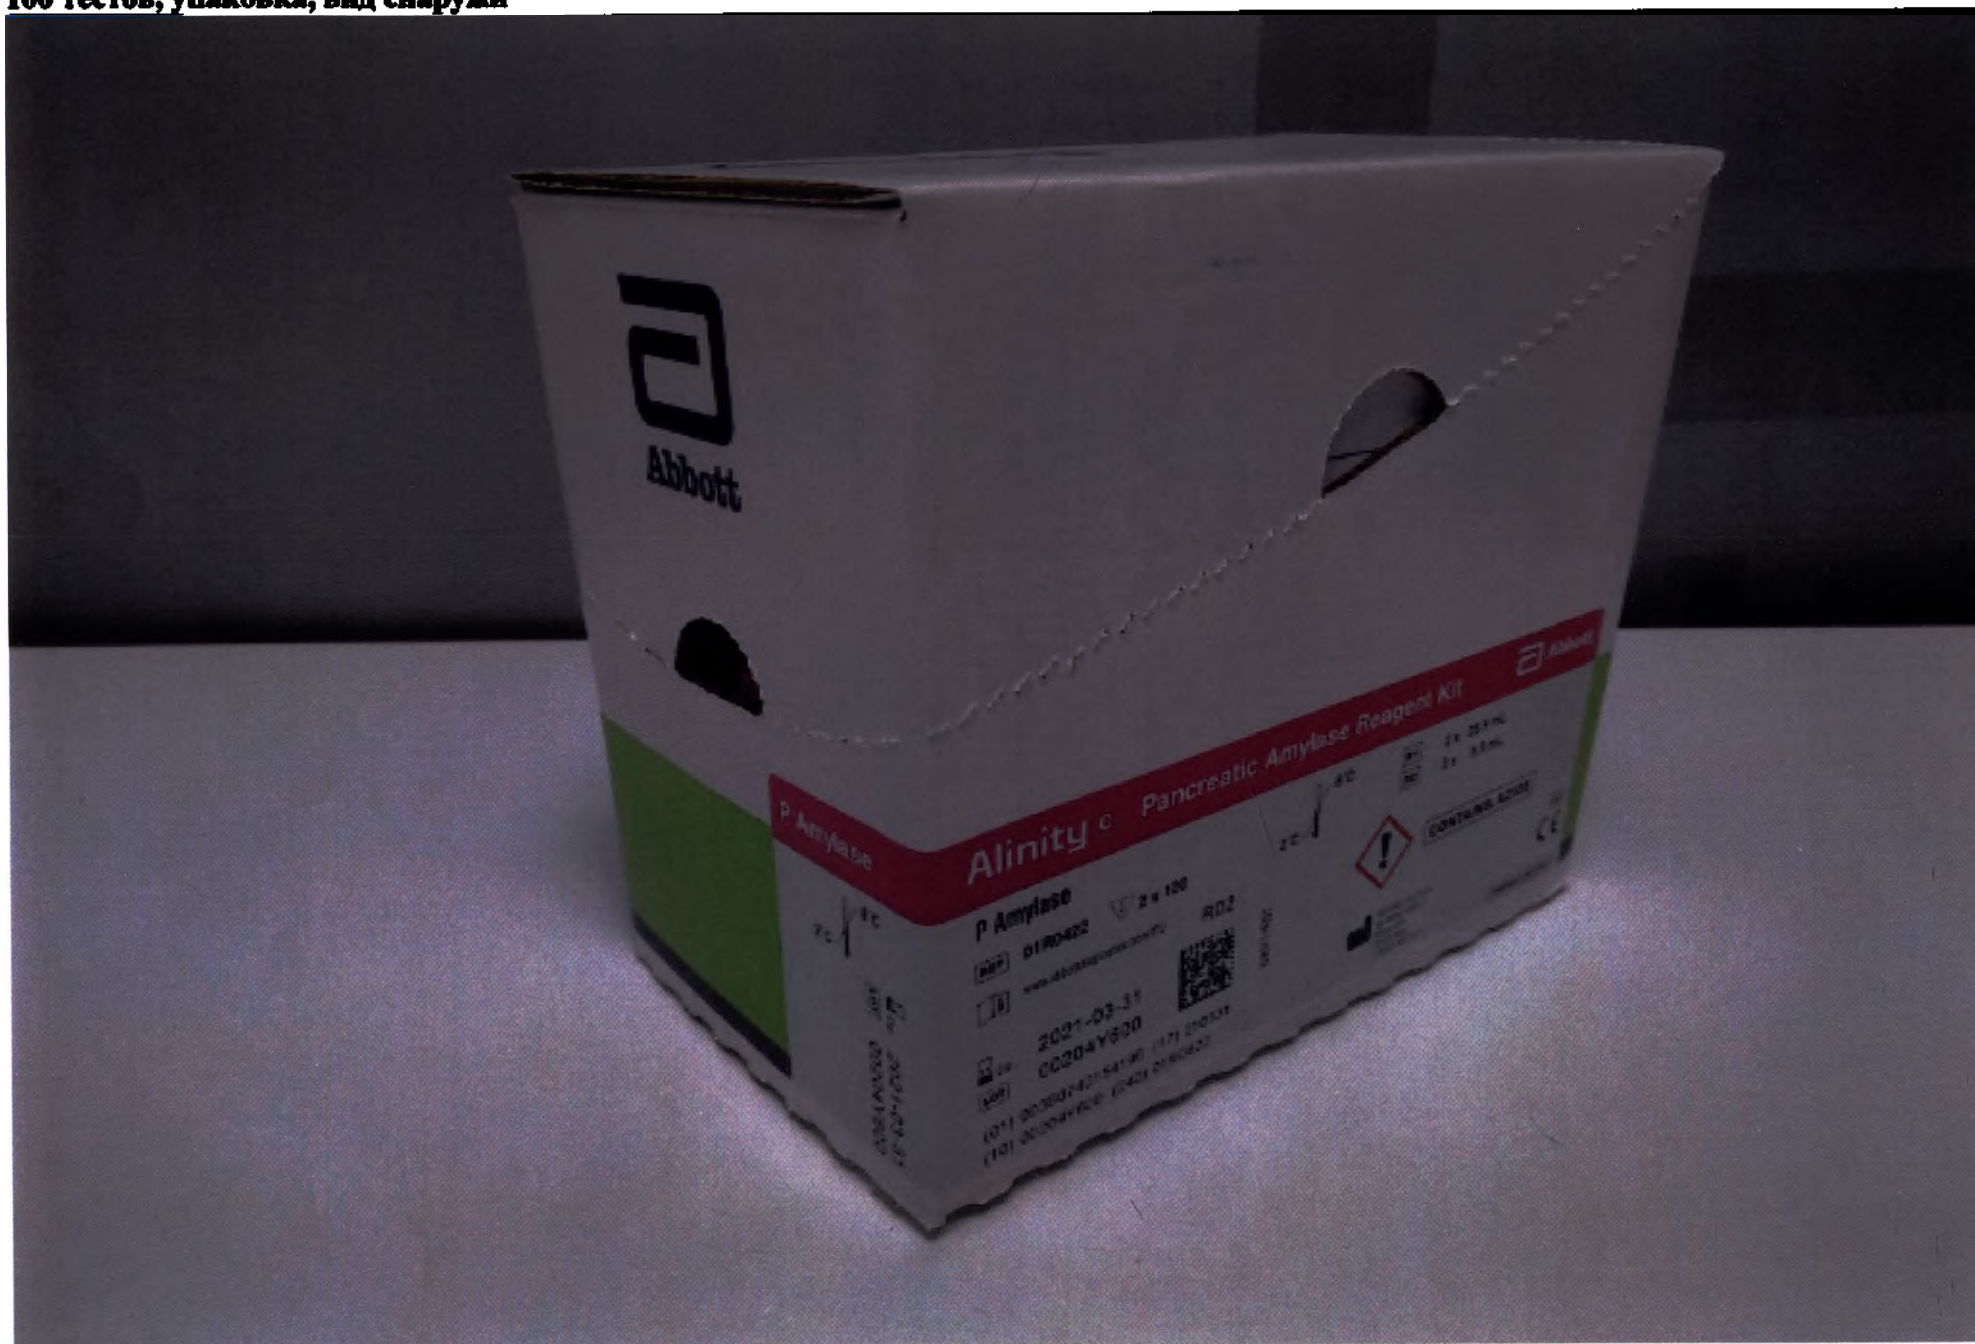

Фотографическое изображение МИ ИВД Амилаза Панкреатическая Реагенты (Alinity с Pancreatic Amylase Reagent), 2 картриджа по 100 тестов, упаковка, вид изнутри

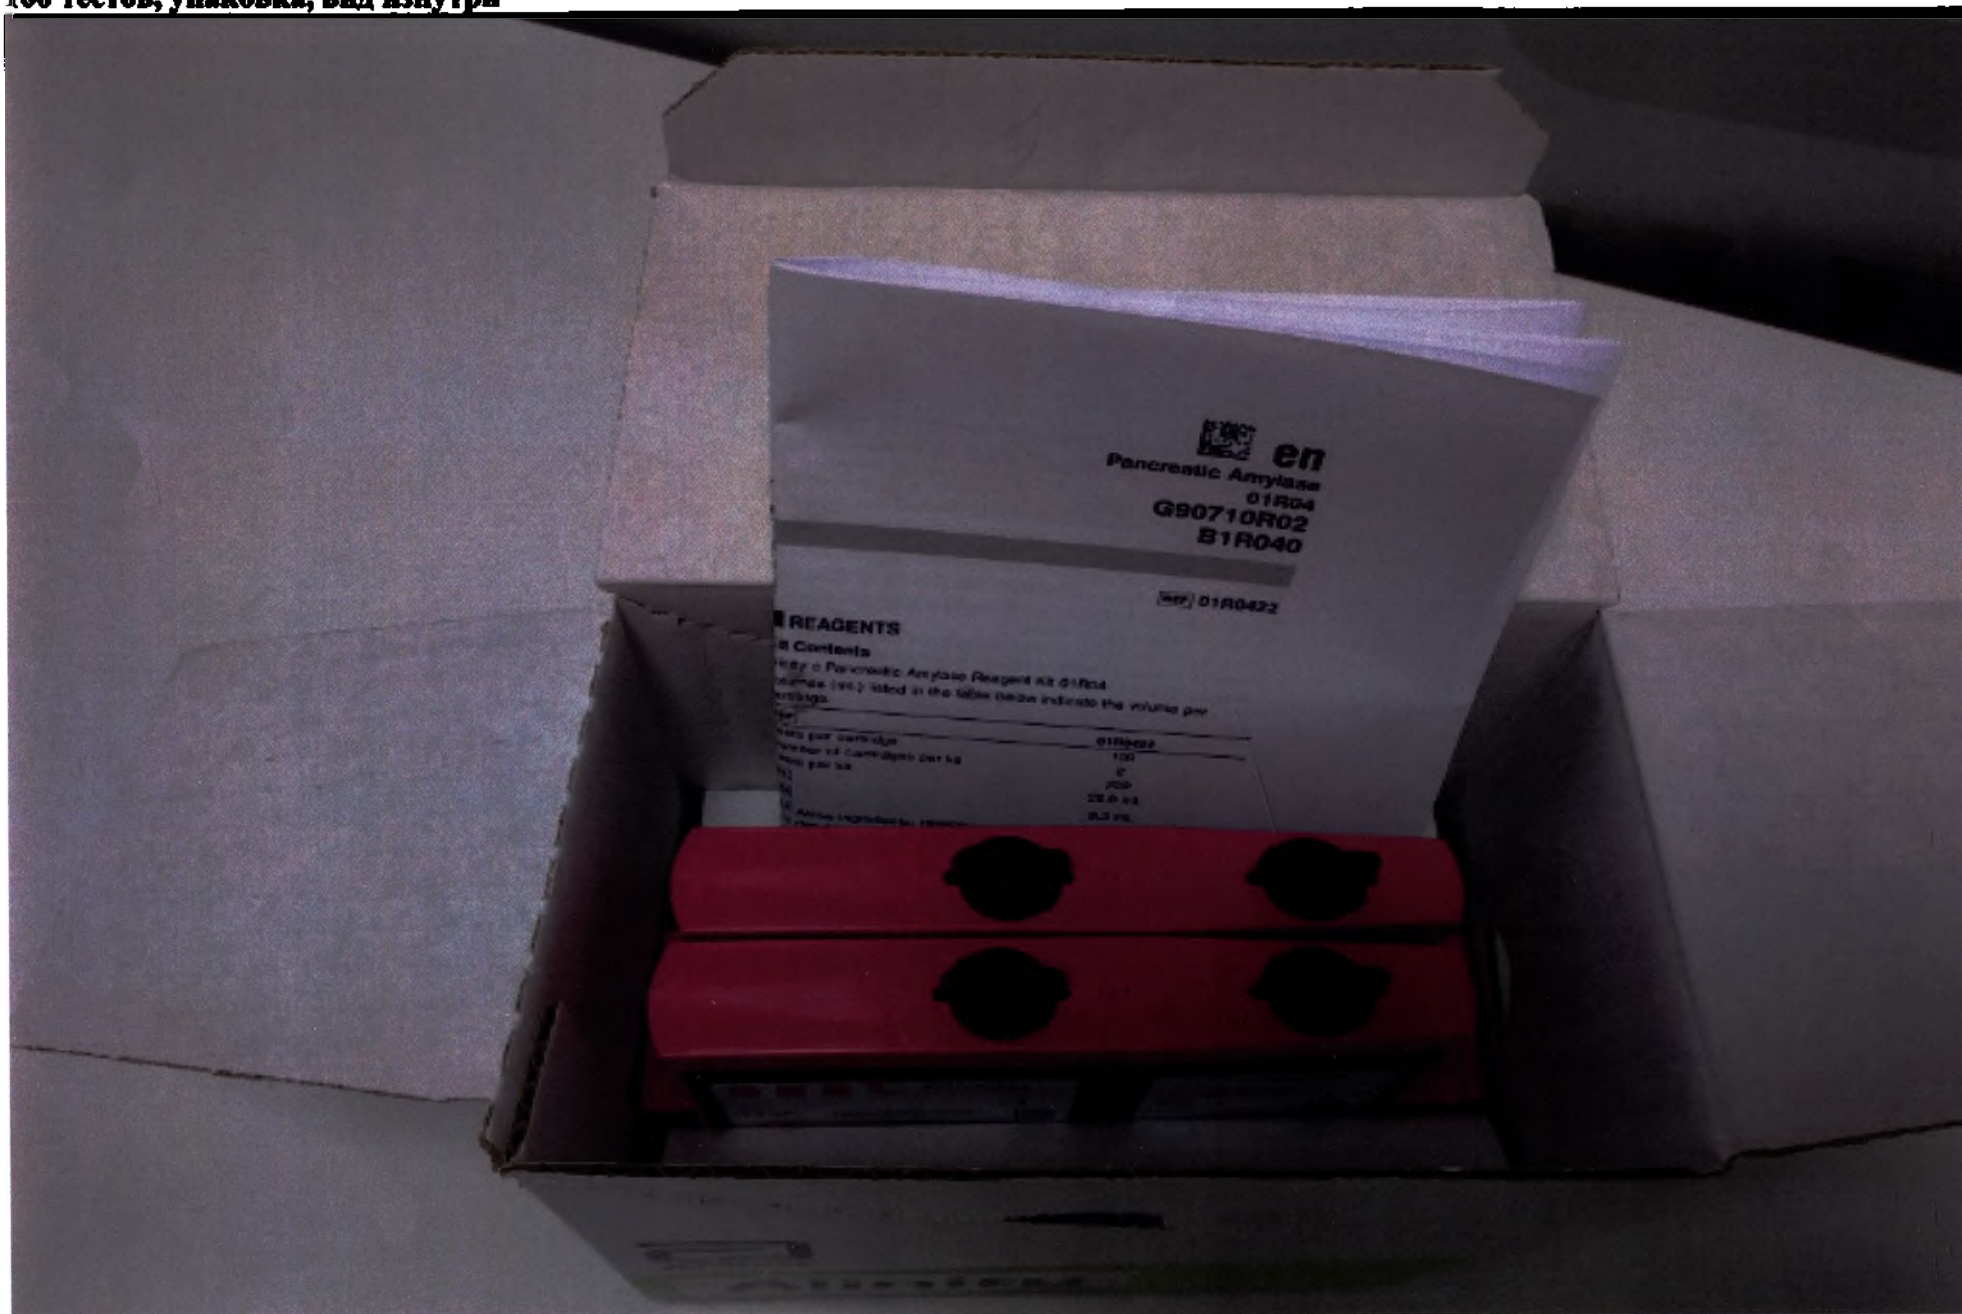

Фотографическое изображение МИ ИВД Амилаза Панкреатическая Реагенты (Alinity с Pancreatic Amylase Reagent), 2 картриджа по 100 тестов, упаковка, состав



Фотографическое изображение МИ ИВД Амилаза Панкреатическая Реагенты (Alinity с Pancreatic Amylase Reagent), картридж на 100 тестов



Всего прошито, пронумеровано

и скреплено печатью

листов



Подпись

Limited liability company
Abbott Laboratories

Макет маркировки на медицинское изделие

**Набор реагентов для определения уровня панкреатической амилазы
ферментным спектрофотометрическим методом (IFCC) в сыворотке
или плазме крови человека на биохимических анализаторах Alinity с**

**«Амилаза Панкреатическая Реагенты
(Alinity с Pancreatic Amylase Reagent Kit)»**

**Макет маркировки медицинского изделия для пользователей Российской Федерации,
вариант исполнения: 2 картриджа по 100 тестов**

REF

01R0422

IVD

Набор реагентов для определения уровня панкреатической амилазы ферментным спектрофотометрическим методом (IFCC) в сыворотке или плазме крови человека на биохимических анализаторах Alinity c

«Амилаза Панкреатическая Реагенты (Alinity c Pancreatic Amylase Reagent Kit)»

2 картриджа по 100 тестов в составе: Реагент 1 (Alinity c P Amylase R 1) – 2 x 25,9 мл; Реагент 2 (Alinity c P Amylase R 2) – 2 x 9,3 мл; Инструкция по применению / Производитель: СЕНТИНЕЛЬ К. С.п.А., SENTINEL CH. S.p.A., Via Robert Koch, 2, Milano (MI), 20152, Italy (Италия) / Место производства: SENTINEL CH. S.p.A., Via Robert Koch, 2, Milano (MI) 20152, Italy / Страна происхождения: Италия / РУ № ____/____ от ____г. / Инструкция по применению на русском языке: www.abbottdiagnostics.com/IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:
 ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1
 Тел.: +7 (495) 258 42 80; Факс: +7 (495) 258 42 81

Маркировка медицинского изделия Амилаза Панкреатическая Реагенты (Alinity c Pancreatic Amylase Reagent Kit), 2 картриджа по 100 тестов

P Amylase
Alinity c Pancreatic Amylase Reagent Kit

REF

01R0422

2 x 100

www.abbottdiagnostics.com/IFU

Exp

LOT

R1

2 x 25.9 mL

R2

2 x 9.3 mL

!

CONTAINS: AZIDE


IVD

PRODUCT OF ITALY

GSDT 11801

SENTINEL CH. S.p.A.
 Via Robert Koch, 2
 Milano (MI)
 20152, Italy
 +39 02 546 5141

Макет маркировки блока компонентов медицинского изделия Амлаза Панкреатическая Реагенты (Alinity с Pancreatic Amylase Reagent Kit), картридж на 100 тестов

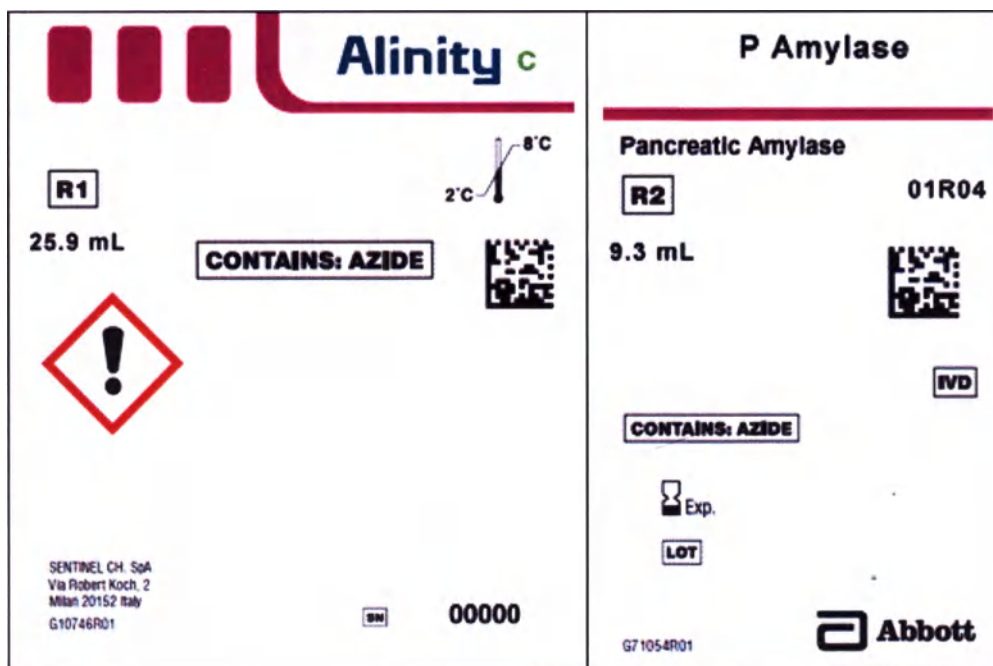

всего прошито, пронумеровано

и скреплено печатью

ЛИСТОВ



Подпись