



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Компания «БиВи»


Т.А. Носова

« 01 » июля 2021 г.

Фотографические изображения изделия:

Набор калибраторов для количественного определения С-пептида (C-Peptide Calibrators / C-Peptide CAL) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro

Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.
(Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.), Китай

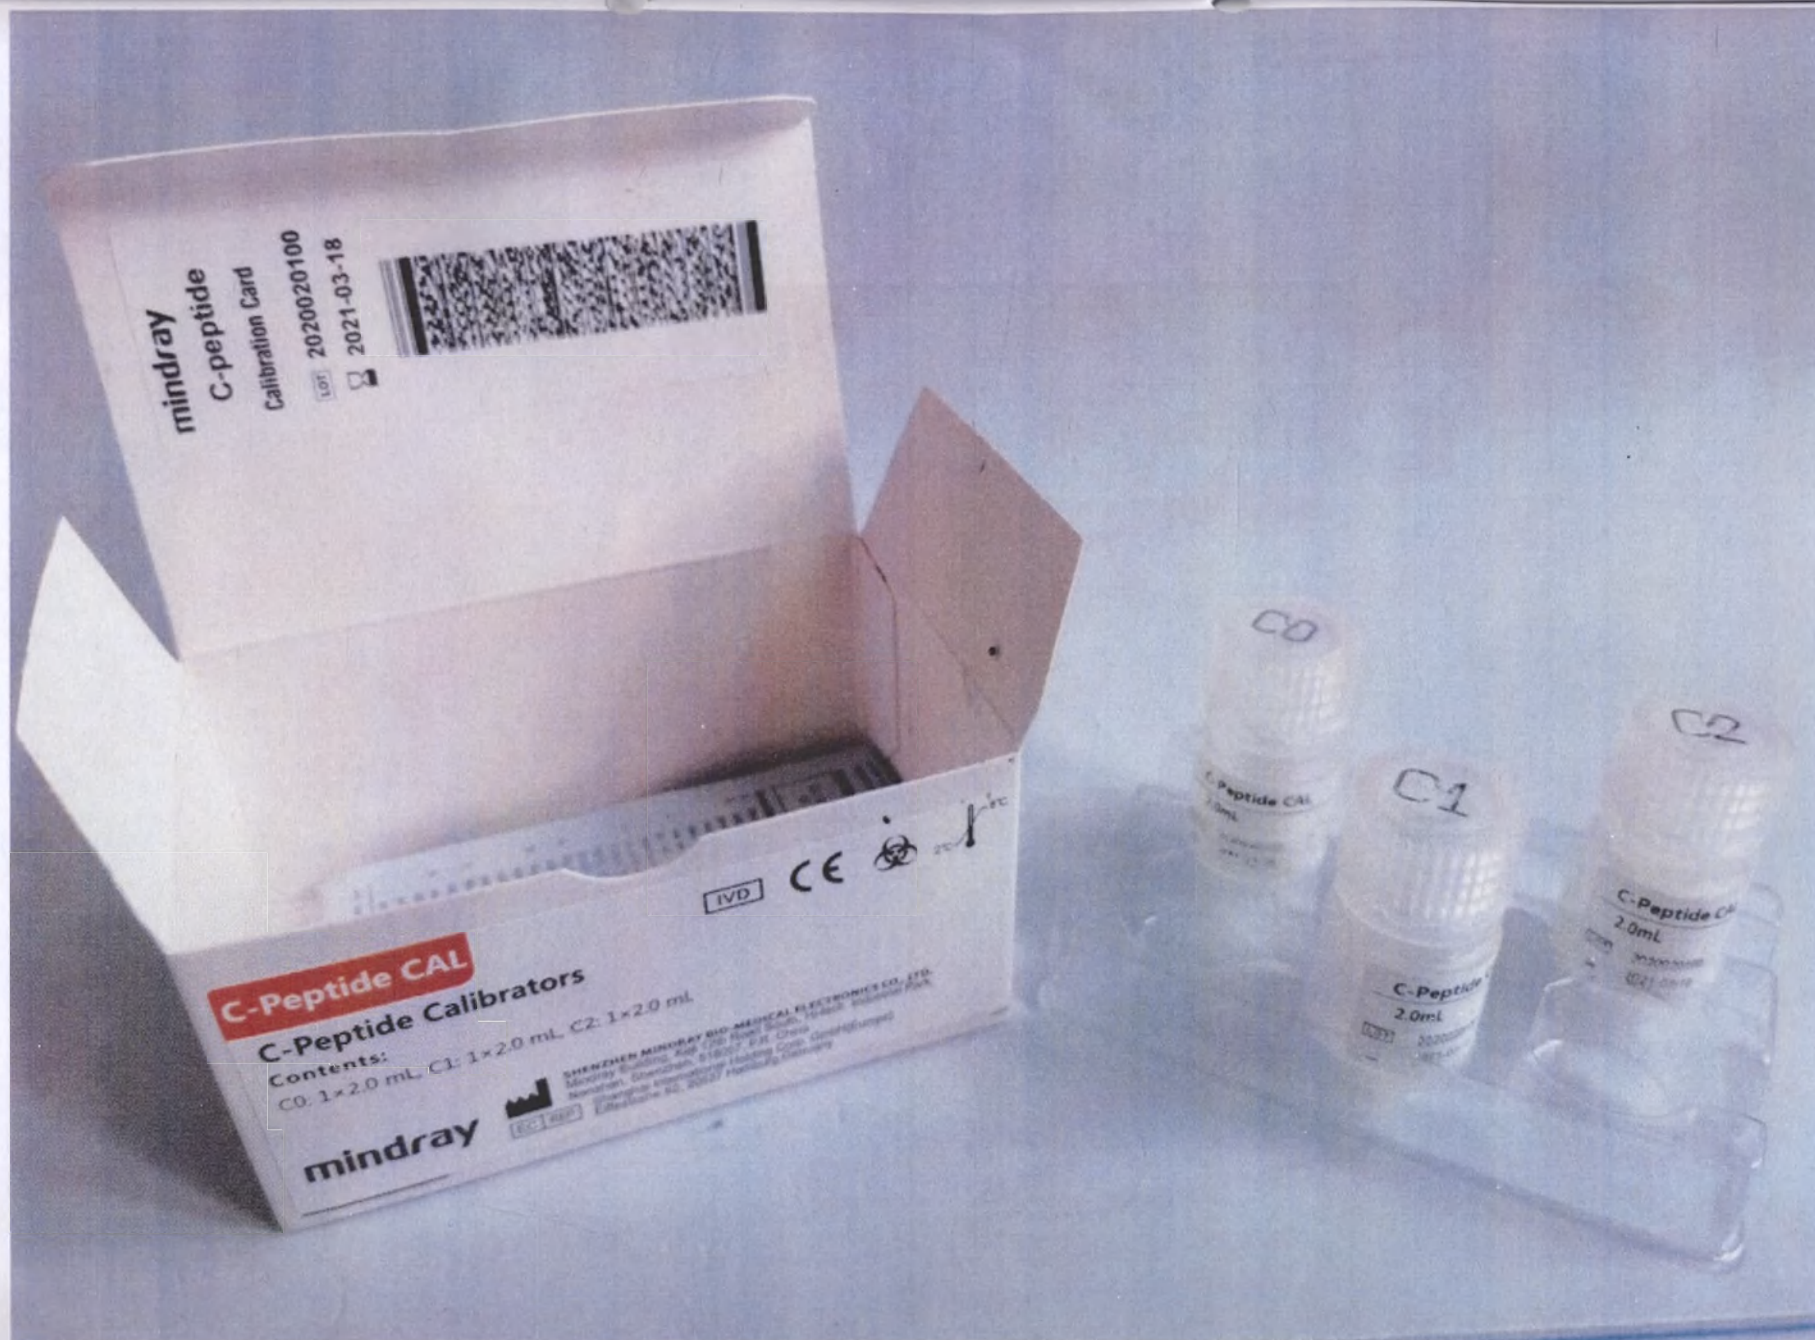

Общий вид медицинского изделия (Набор калибраторов для количественного определения С-пептида (C-Peptide Calibrators / C-Peptide CAL) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro)

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 2 листа (-ов)

Генеральный директор _____ / Носова Т.А.
М.П.

