

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Фотографии изделия



Рисунок 1. Образец 1 – Диализатор капиллярный полиэфирсульфоновый NF высокопоточный NF-15H, LOT 3022, срок годности 2021-06-07. Общий вид



Рисунок 2. Образец 1 – Диализатор капиллярный полиэфирсульфоновый NF высокопоточный NF-15H, LOT 3022, срок годности 2021-06-07. Маркировка изделия

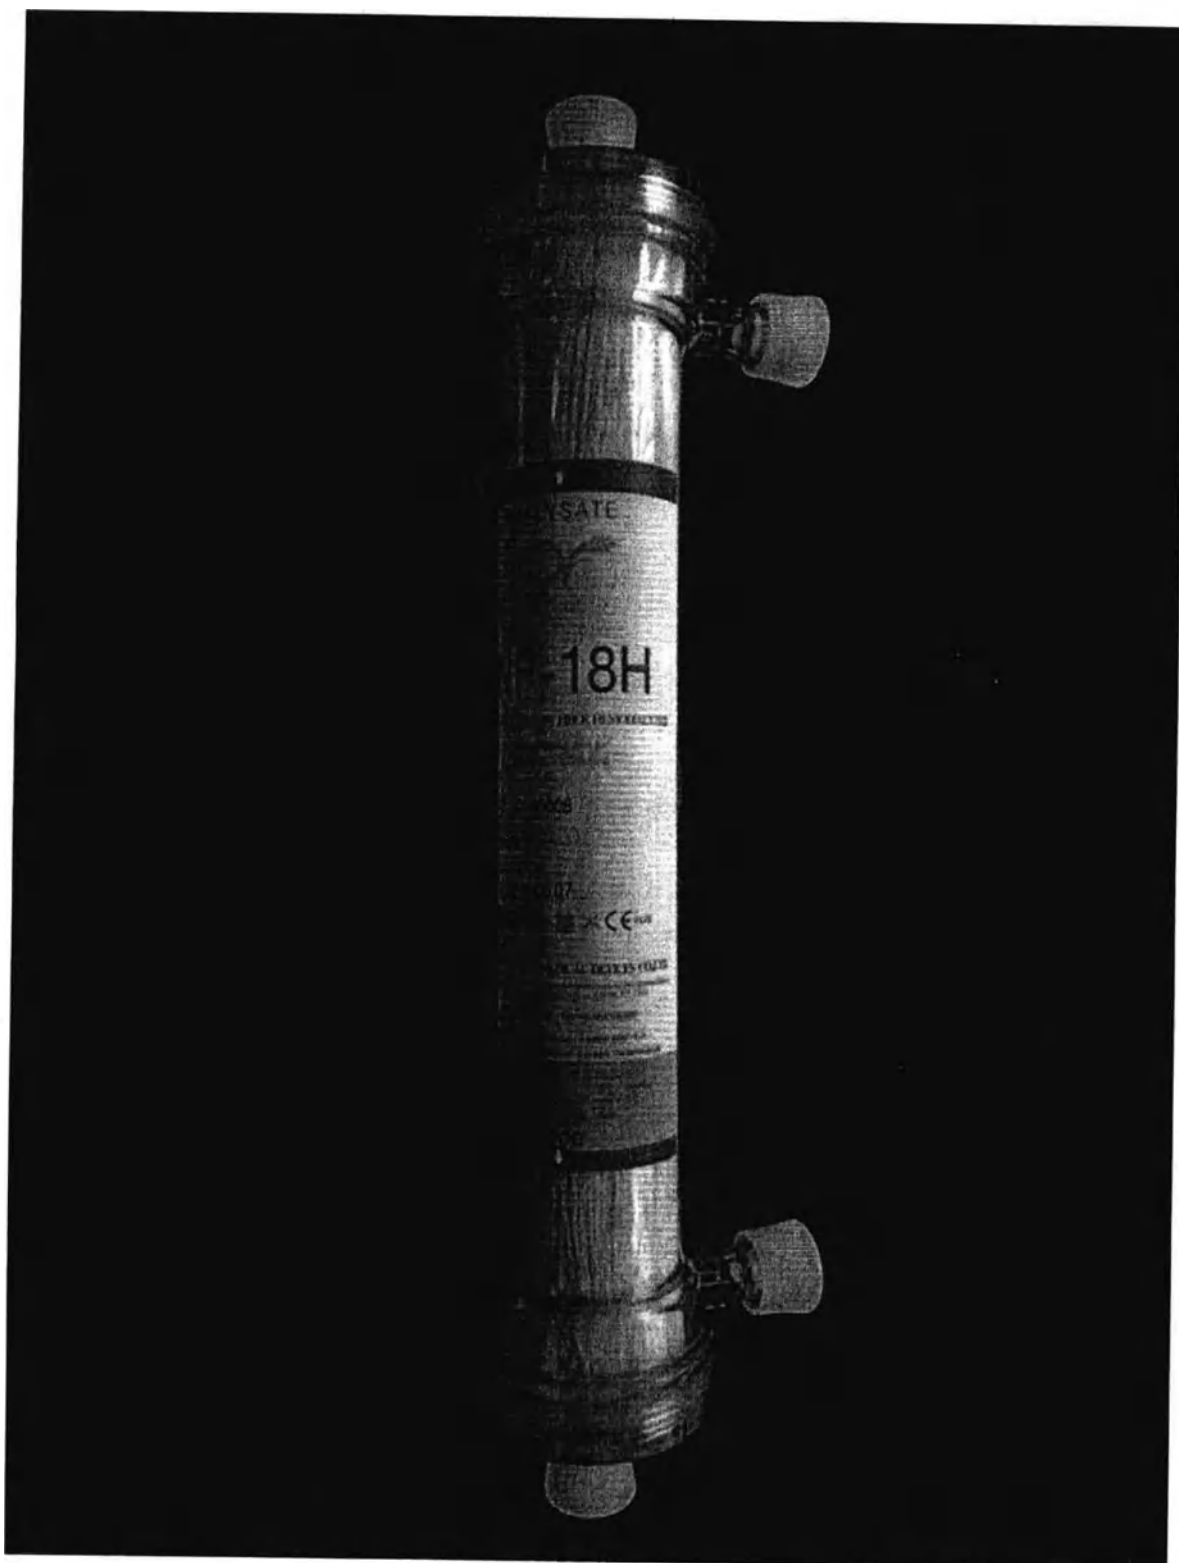


Рисунок 3. Образец 2 – Диализатор капиллярный полиэфирсульфоновый NF высокопоточный NF-18H, LOT 3022, срок годности 2021-06-07. Общий вид

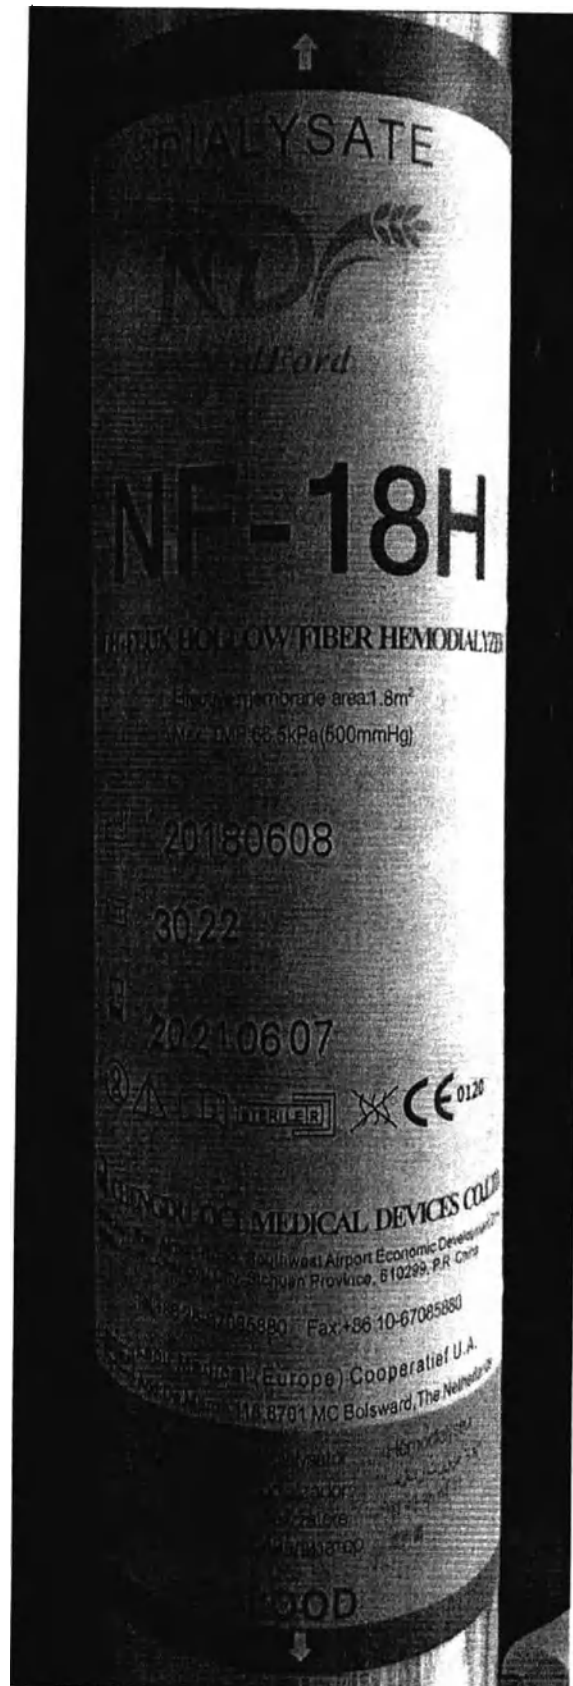


Рисунок 4. Образец 2 – Диализатор капиллярный полиэфирсульфоновый NF высокопоточный NF-18H, LOT 3022, срок годности 2021-06-07. Маркировка изделия

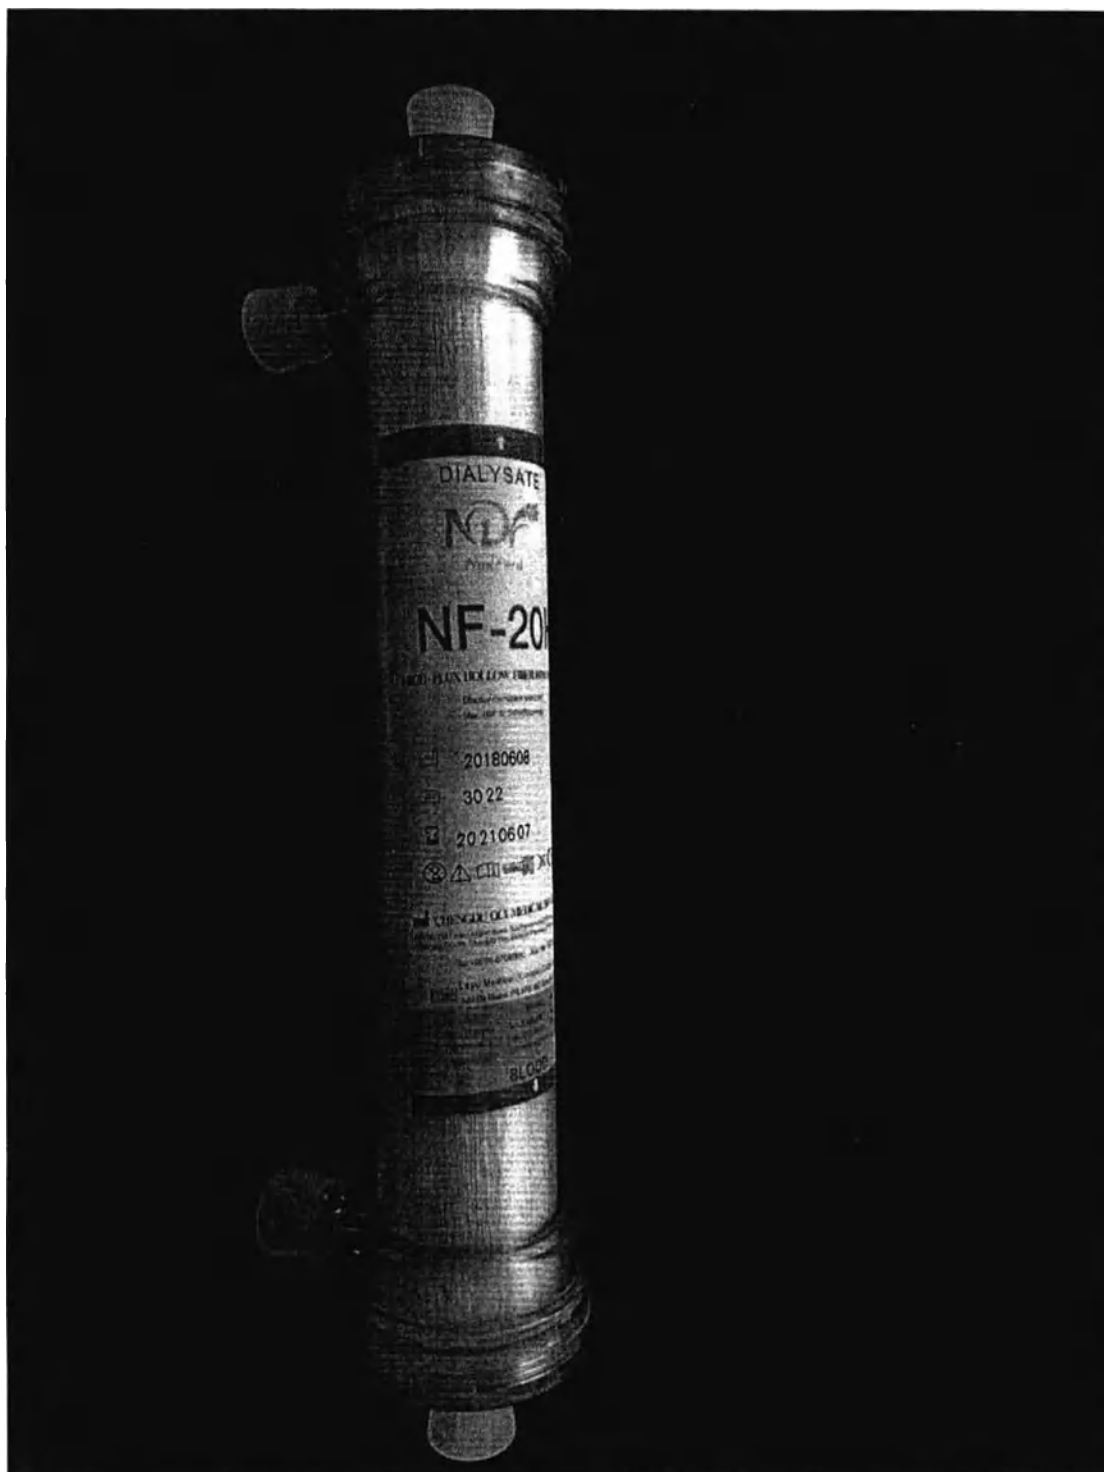


Рисунок 5. Образец 3 – Диализатор капиллярный полиэфирсульфоновый NF высокопоточный NF-20H, LOT 3022, срок годности 2021-06-07. Общий вид

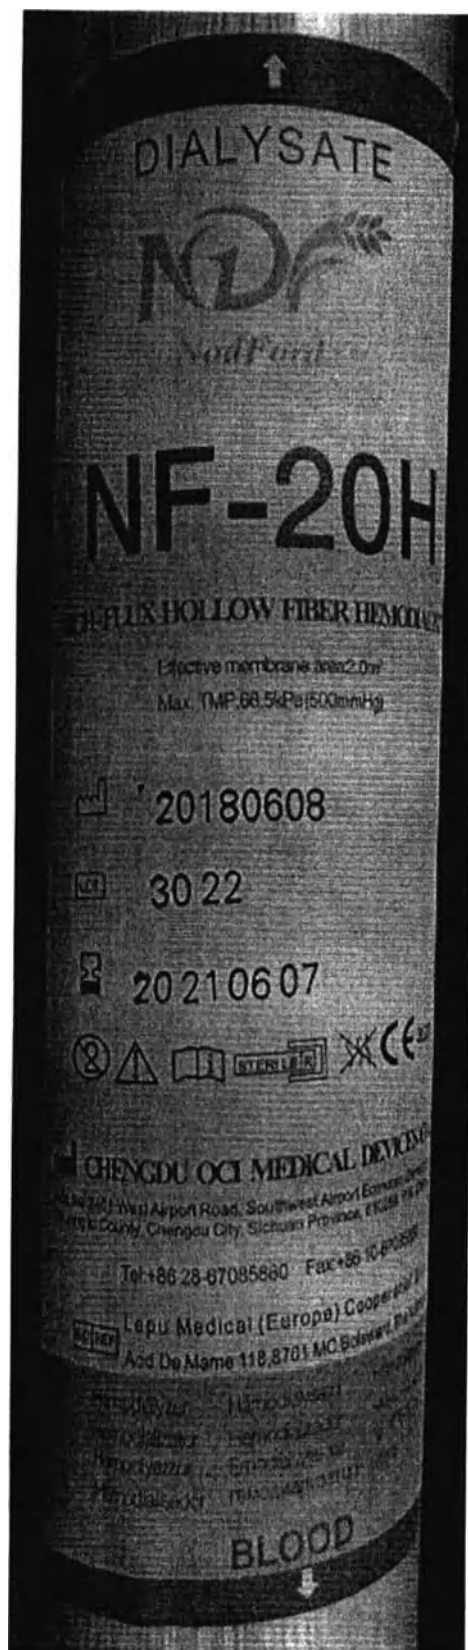


Рисунок 6. Образец 3 – Диализатор капиллярный полиэфирсульфоновый NF высокопоточный NF-20H, LOT 3022, срок годности 2021-06-07. Маркировка изделия



Рисунок 7. Образец 4 – Диализатор капиллярный полиэфирсульфоновый NF
низкопоточный NF-14L, LOT 3022, срок годности 2021-06-07. Общий вид



Рисунок 8. Образец 4 – Диализатор капиллярный полиэфирсульфоновый NF низкотоочный NF-14L, LOT 3022, срок годности 2021-06-07. Маркировка изделия



Рисунок 9. Образец 5 – Диализатор капиллярный полиэфирсульфоновый NF
низкопоточный NF-16L, LOT 3022, срок годности 2021-06-07. Общий вид

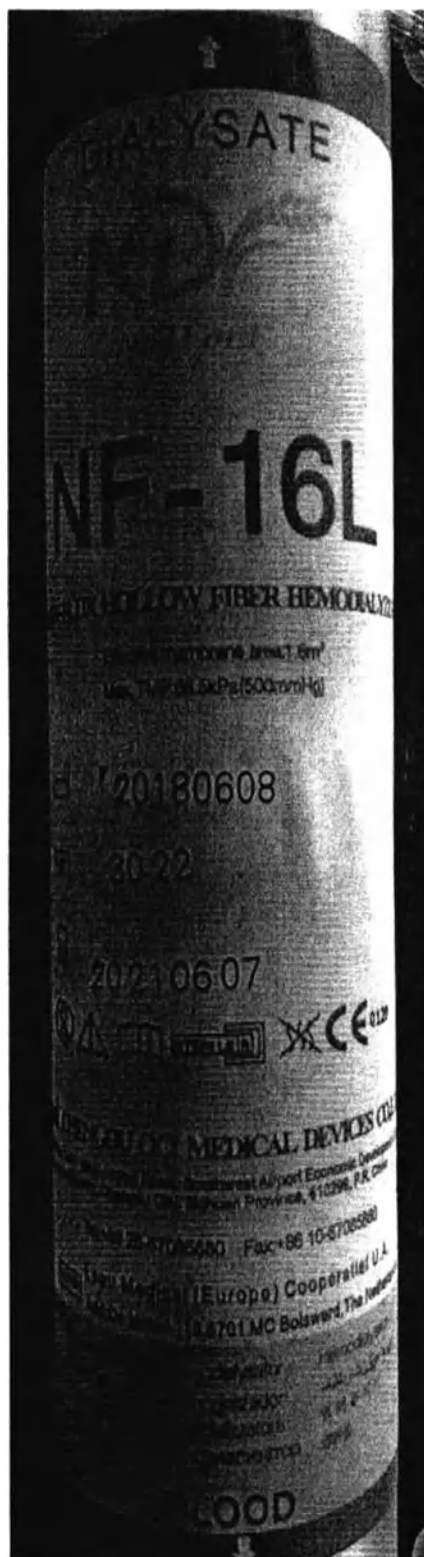


Рисунок 10. Образец 5 – Диализатор капиллярный полиэфирсульфоновый NF низкопоточный NF-16L, LOT 3022, срок годности 2021-06-07. Маркировка изделия



Рисунок 11. Образец 6 – Диализатор капиллярный полиэфирсульфоновый NF низкопоточный NF-18L, LOT 3022, срок годности 2021-06-07. Общий вид

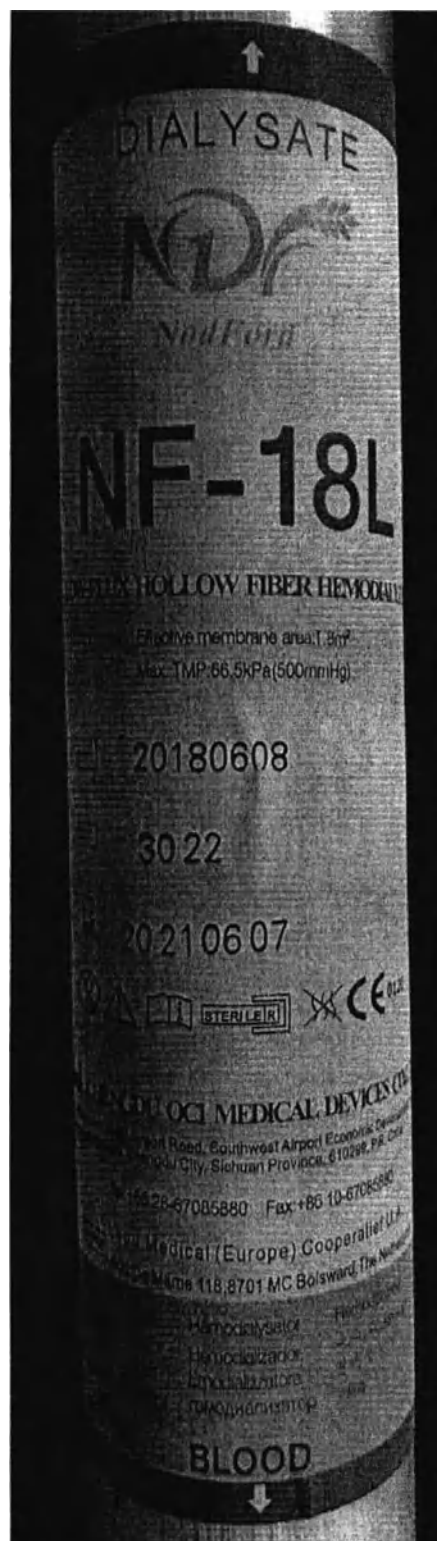


Рисунок 12. Образец 6 – Диализатор капиллярный полиэфирсульфоновый NF низкопоточный NF-18L, LOT 3022, срок годности 2021-06-07. Маркировка изделия

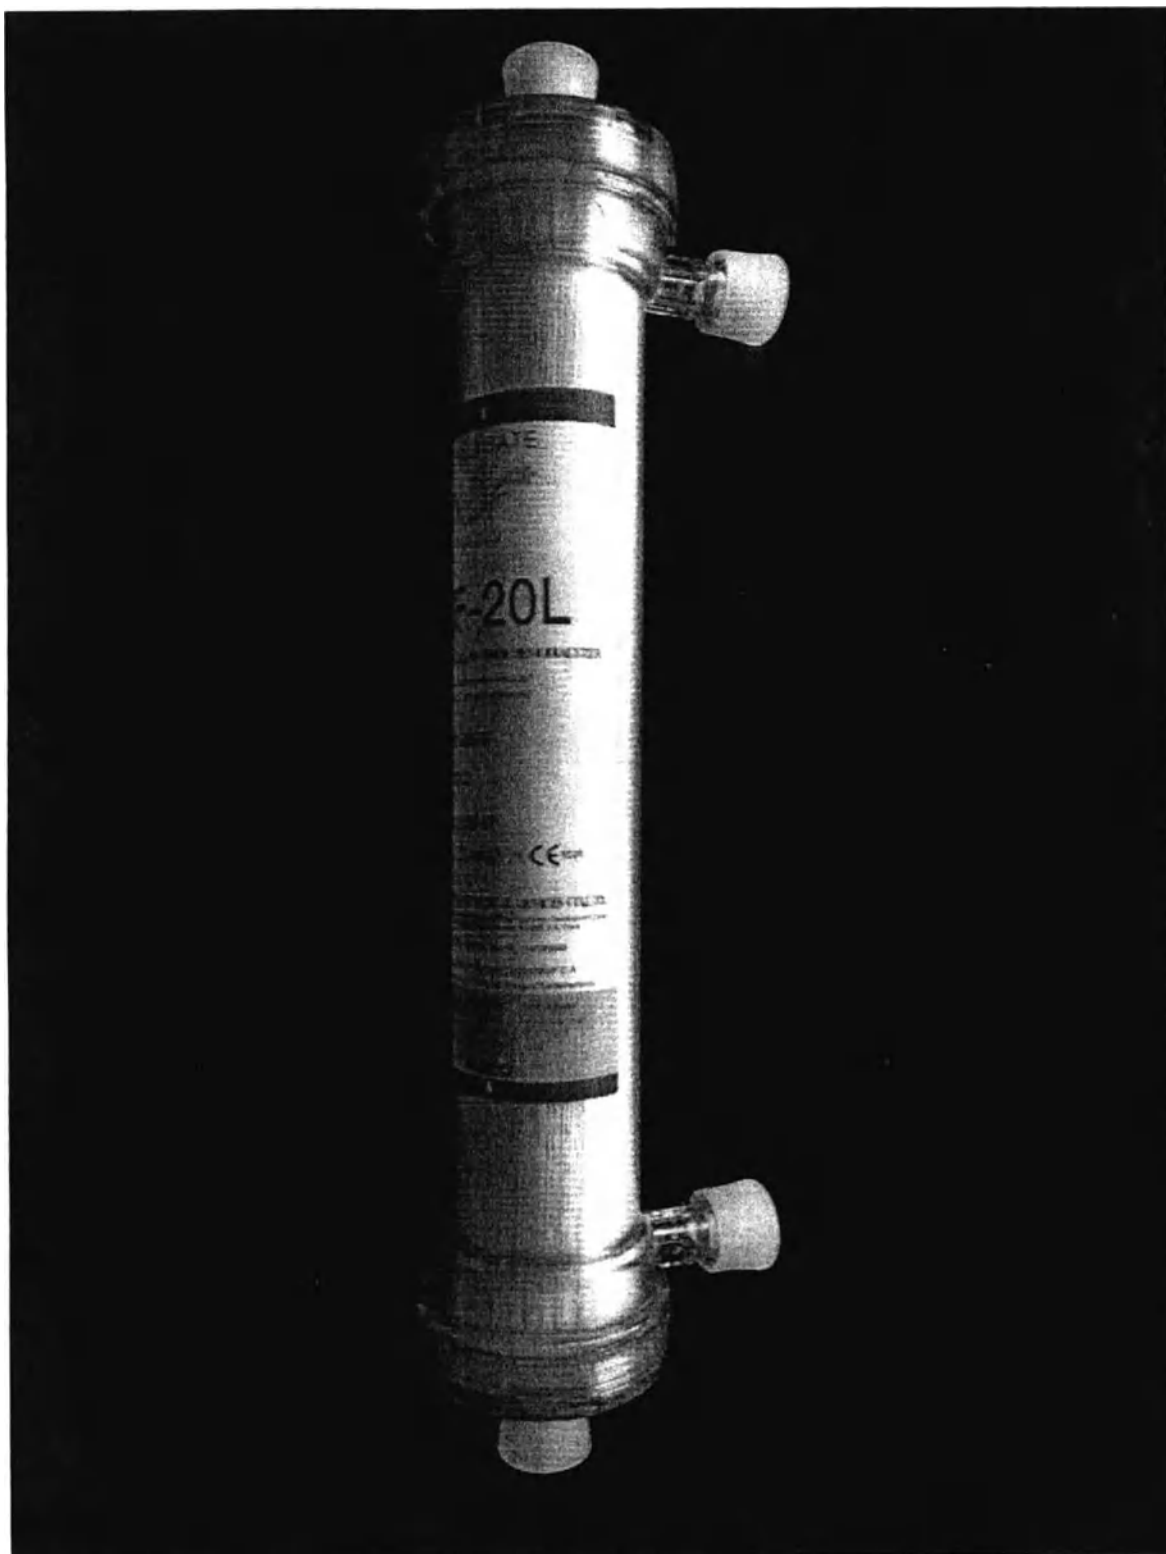


Рисунок 13. Образец 7 – Диализатор капиллярный полиэфирсульфоновый NF низкопоточный NF-20L, LOT 3022, срок годности 2021-06-07. Общий вид

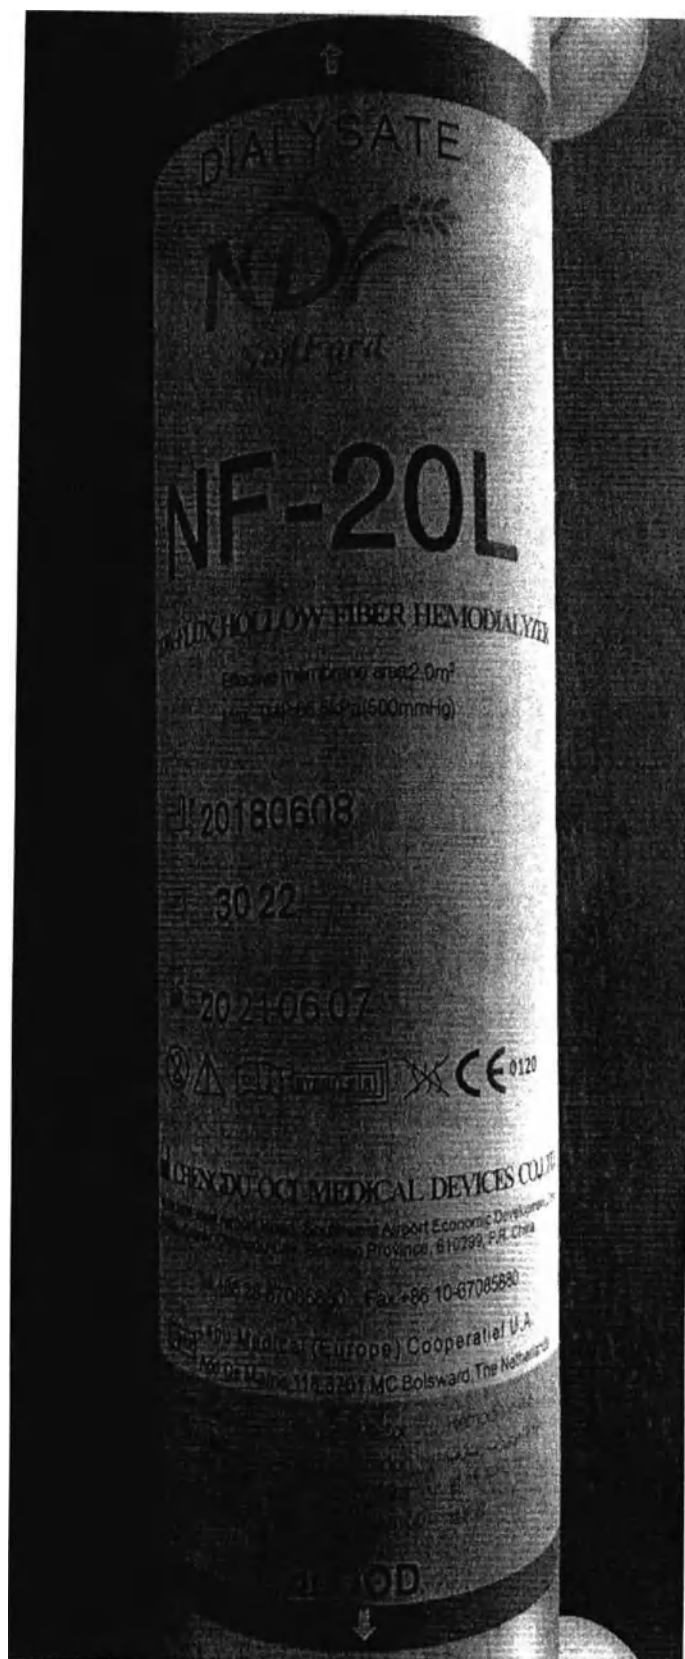


Рисунок 14. Образец 7 – Диализатор капиллярный полиэфирсульфоновый NF низкопоточный NF-20L, LOT 3022, срок годности 2021-06-07. Маркировка изделия

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

20 листов

Начальник ИЛ ТСБ ООО

«Электронтест»

С.М. Михалкин

