


Фотографии медицинского изделия
Аппарат флюорографический Р-600 «Флюоро»
производства ООО «ВКО Медпром», Россия

АППАРАТ ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИЙ Р-600 «ФЛЮОРО», ИСПОЛНЕНИЕ 1


ПРОИЗВОДСТВА ООО «ВКО МЕДПРОМ», РОССИЯ

Процедурная:

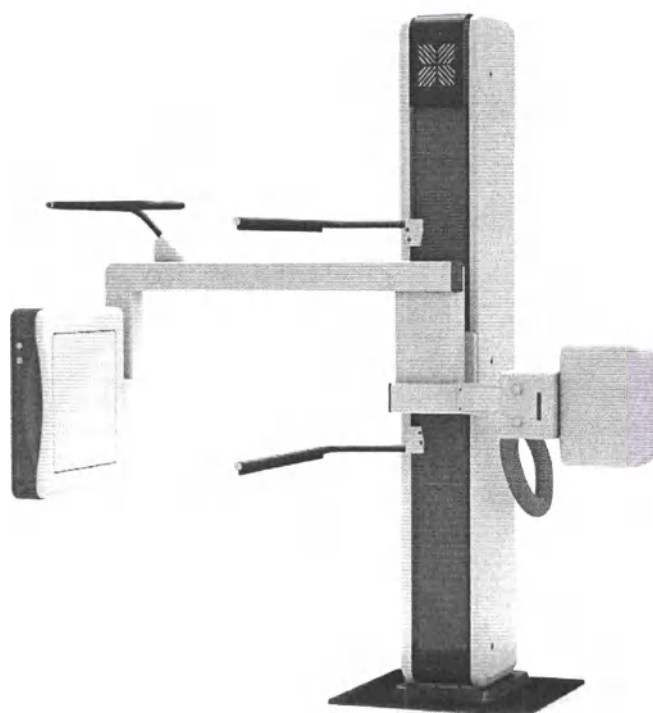

Штатив с кронштейном

Пультная:

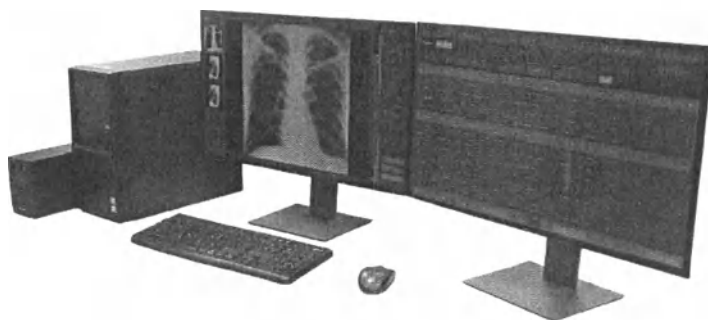


АРМ оператора

**АППАРАТ ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИЙ
Р-600 «ФЛЮОРО»,
ИСПОЛНЕНИЕ 2.1**

ПРОИЗВОДСТВА ООО «ВКО МЕДПРОМ», РОССИЯ

Процедурная:

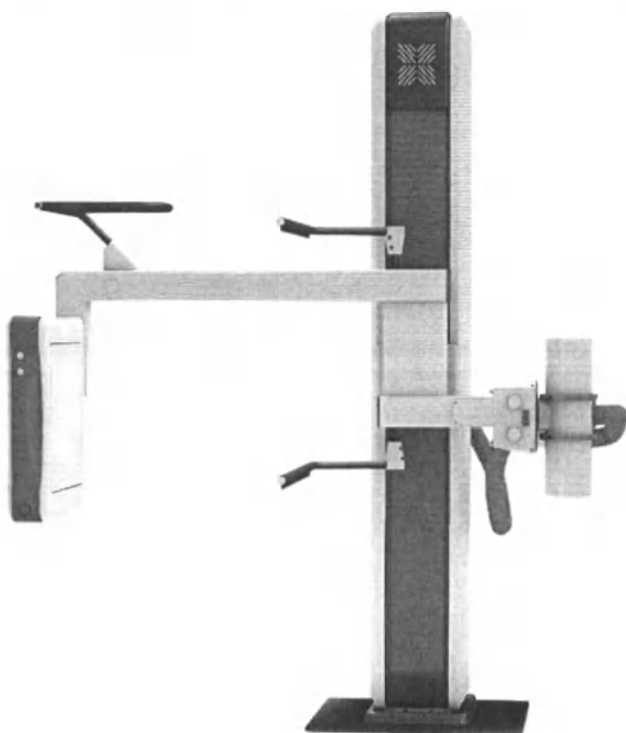


Штатив с кронштейном



РПУ

Пультовая:

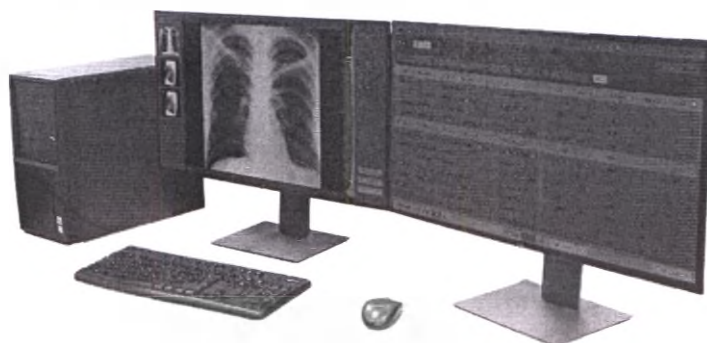


АРМ оператора


АППАРАТ ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИЙ Р-600 «ФЛЮОРО», ИСПОЛНЕНИЕ 2.2

ПРОИЗВОДСТВА ООО «ВКО МЕДПРОМ», РОССИЯ

Процедурная:

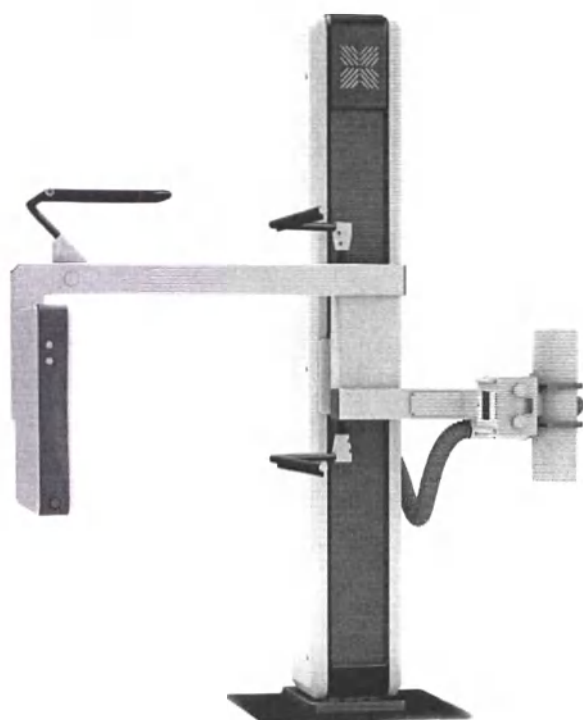

Штатив с кронштейном

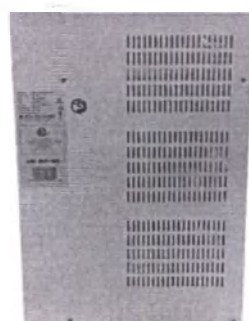

РПУ

Пультовая:




АРМ оператора


**АППАРАТ ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИЙ
Р-600 «ФЛЮОРО»,
ИСПОЛНЕНИЕ 3.1**

ПРОИЗВОДСТВА ООО «ВКО МЕДПРОМ», РОССИЯ

Процедурная:

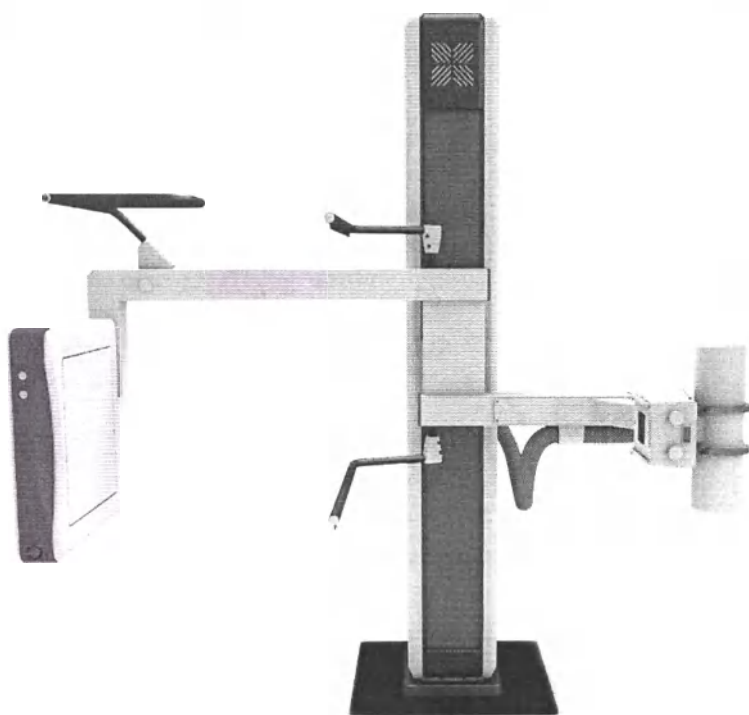


Штатив с кронштейном



РПУ

Пультная:

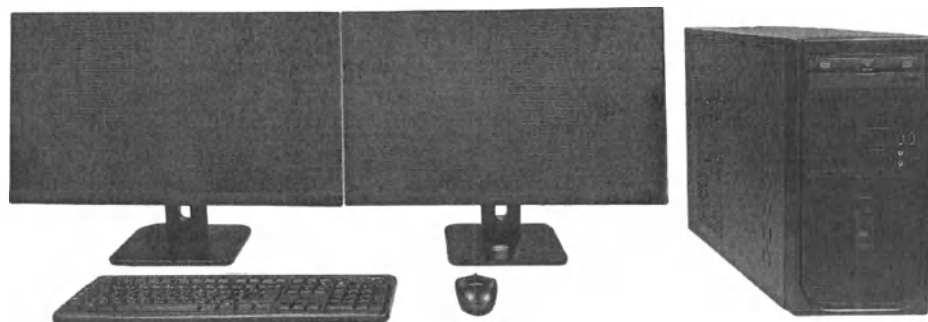

АРМ оператора




МЕДПРОМ


АППАРАТ ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИЙ Р-600 «ФЛЮОРО», ИСПОЛНЕНИЕ 3.2

ПРОИЗВОДСТВА ООО «ВКО МЕДПРОМ», РОССИЯ

Процедурная:

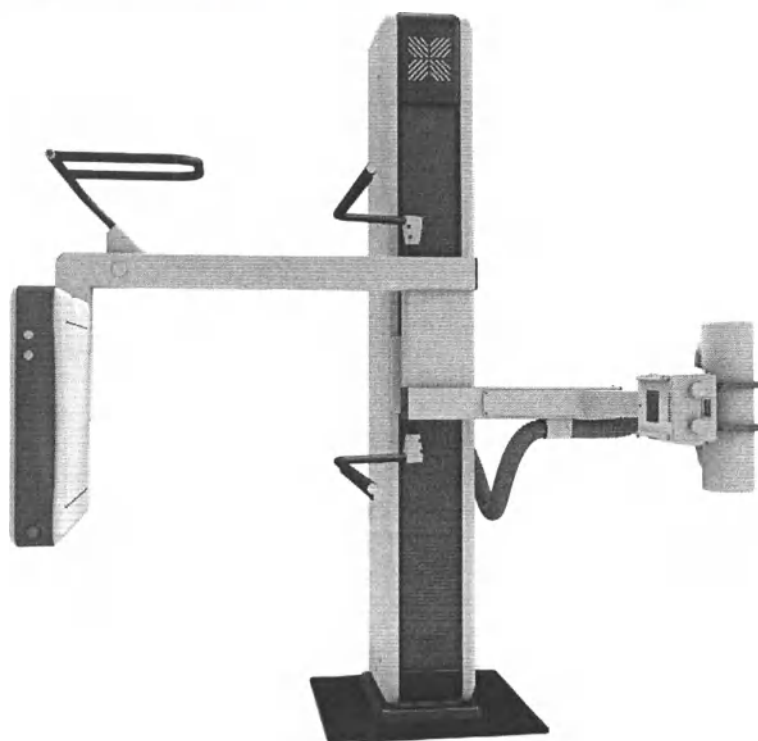


Штатив с кронштейном

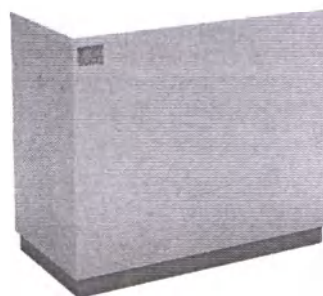


РПУ


Пультовая:

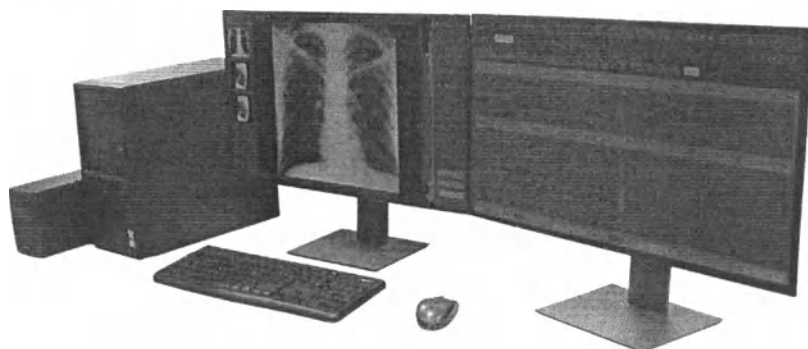


АРМ оператора

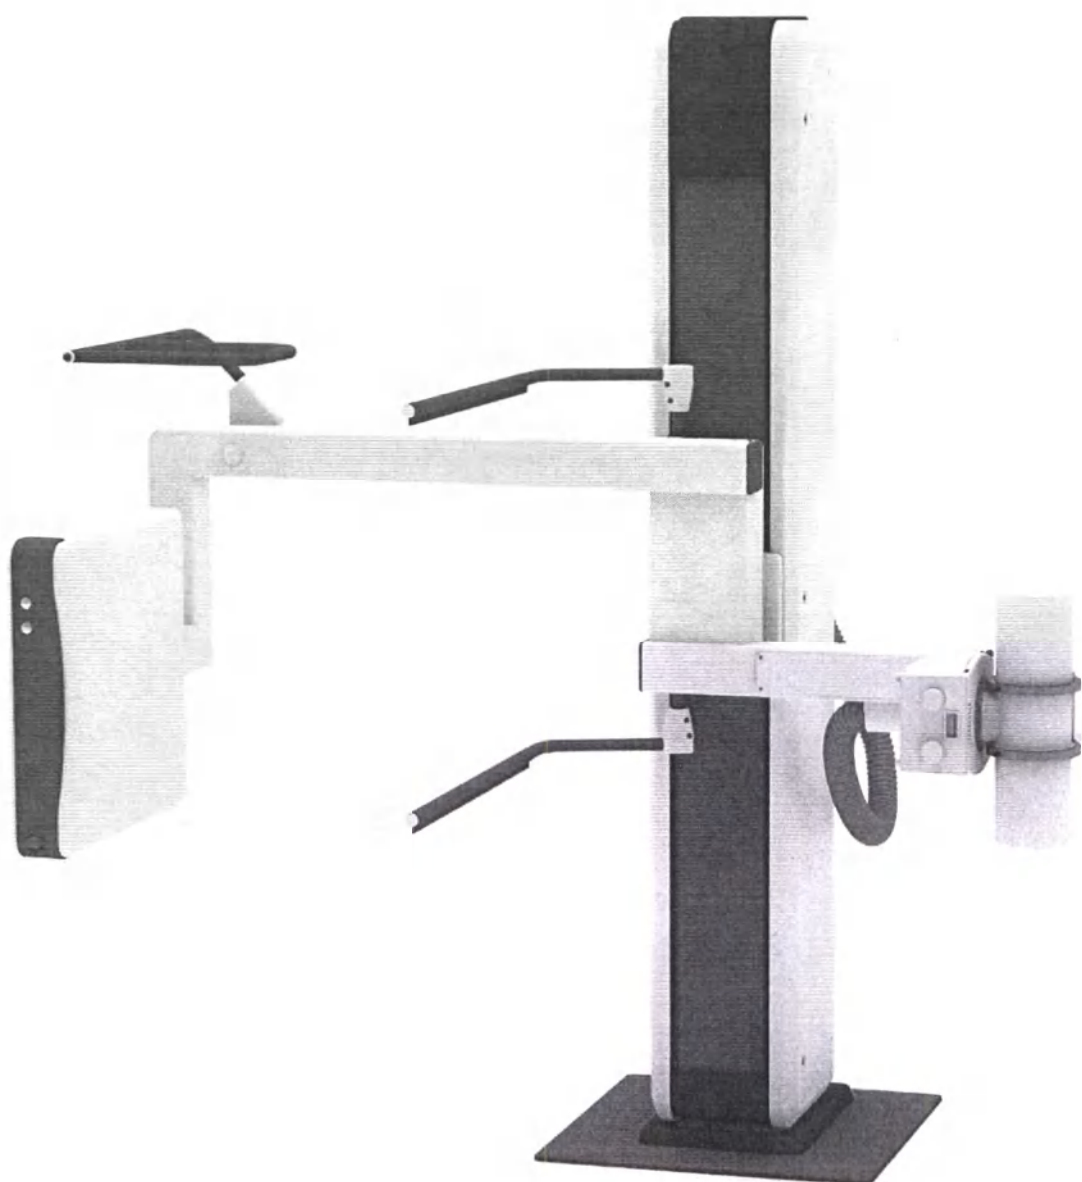


Штатив с кронштейном Y2-B0100 по спецификации, производства
ООО «ВКО Медпром», Россия

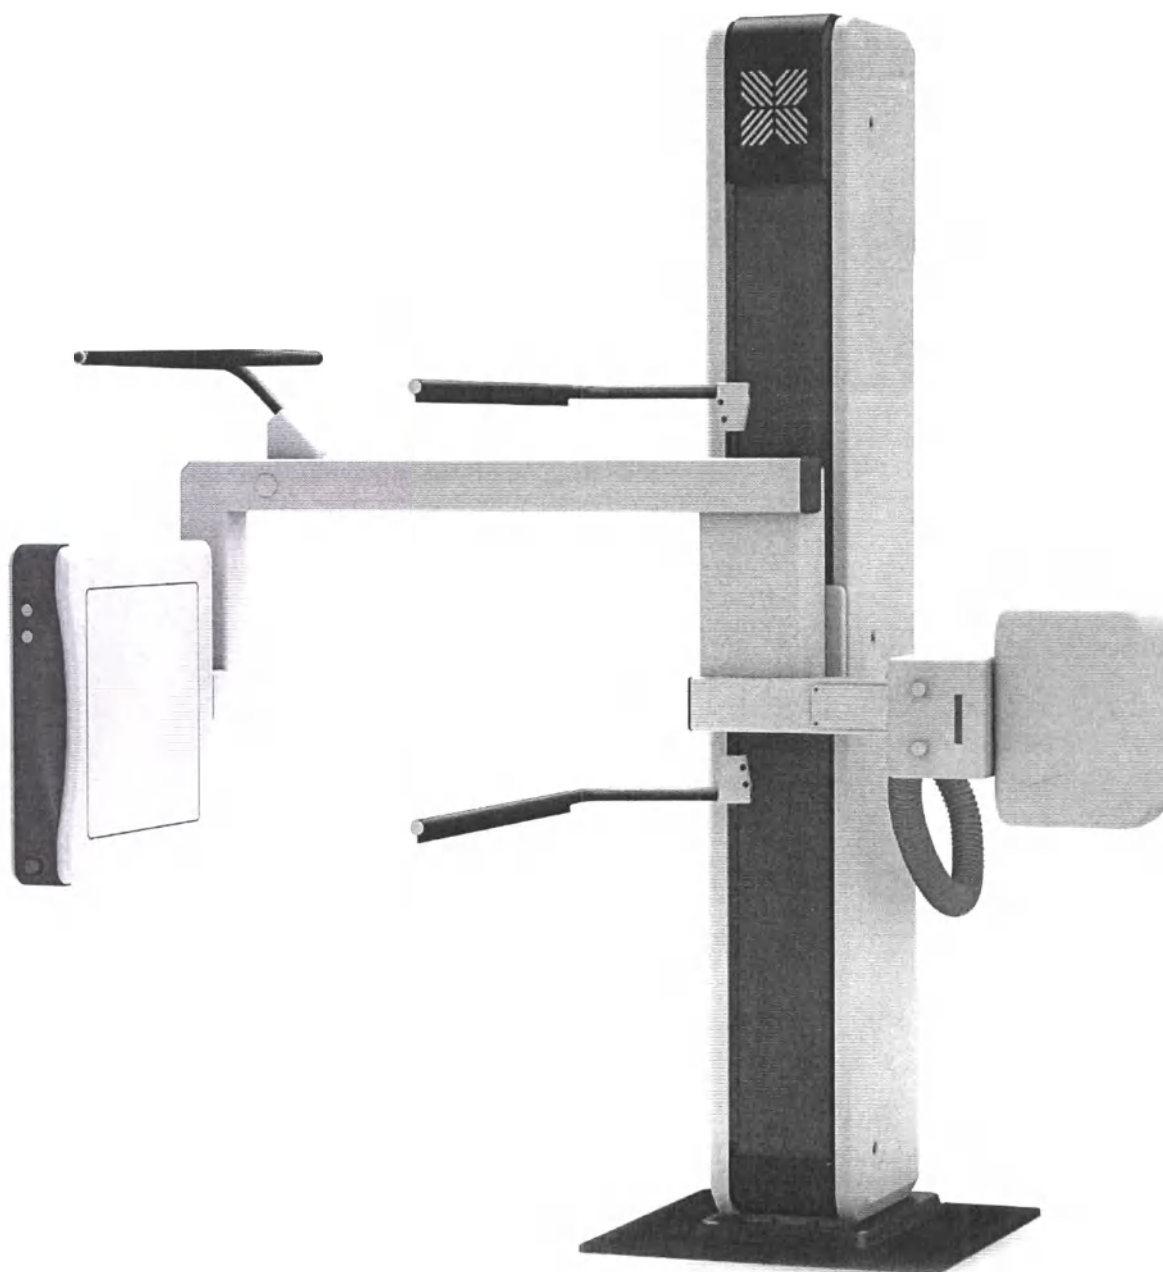


Штатив с кронштейном Y2-B0200 по спецификации, производства
ООО «ВКО Медпром», Россия

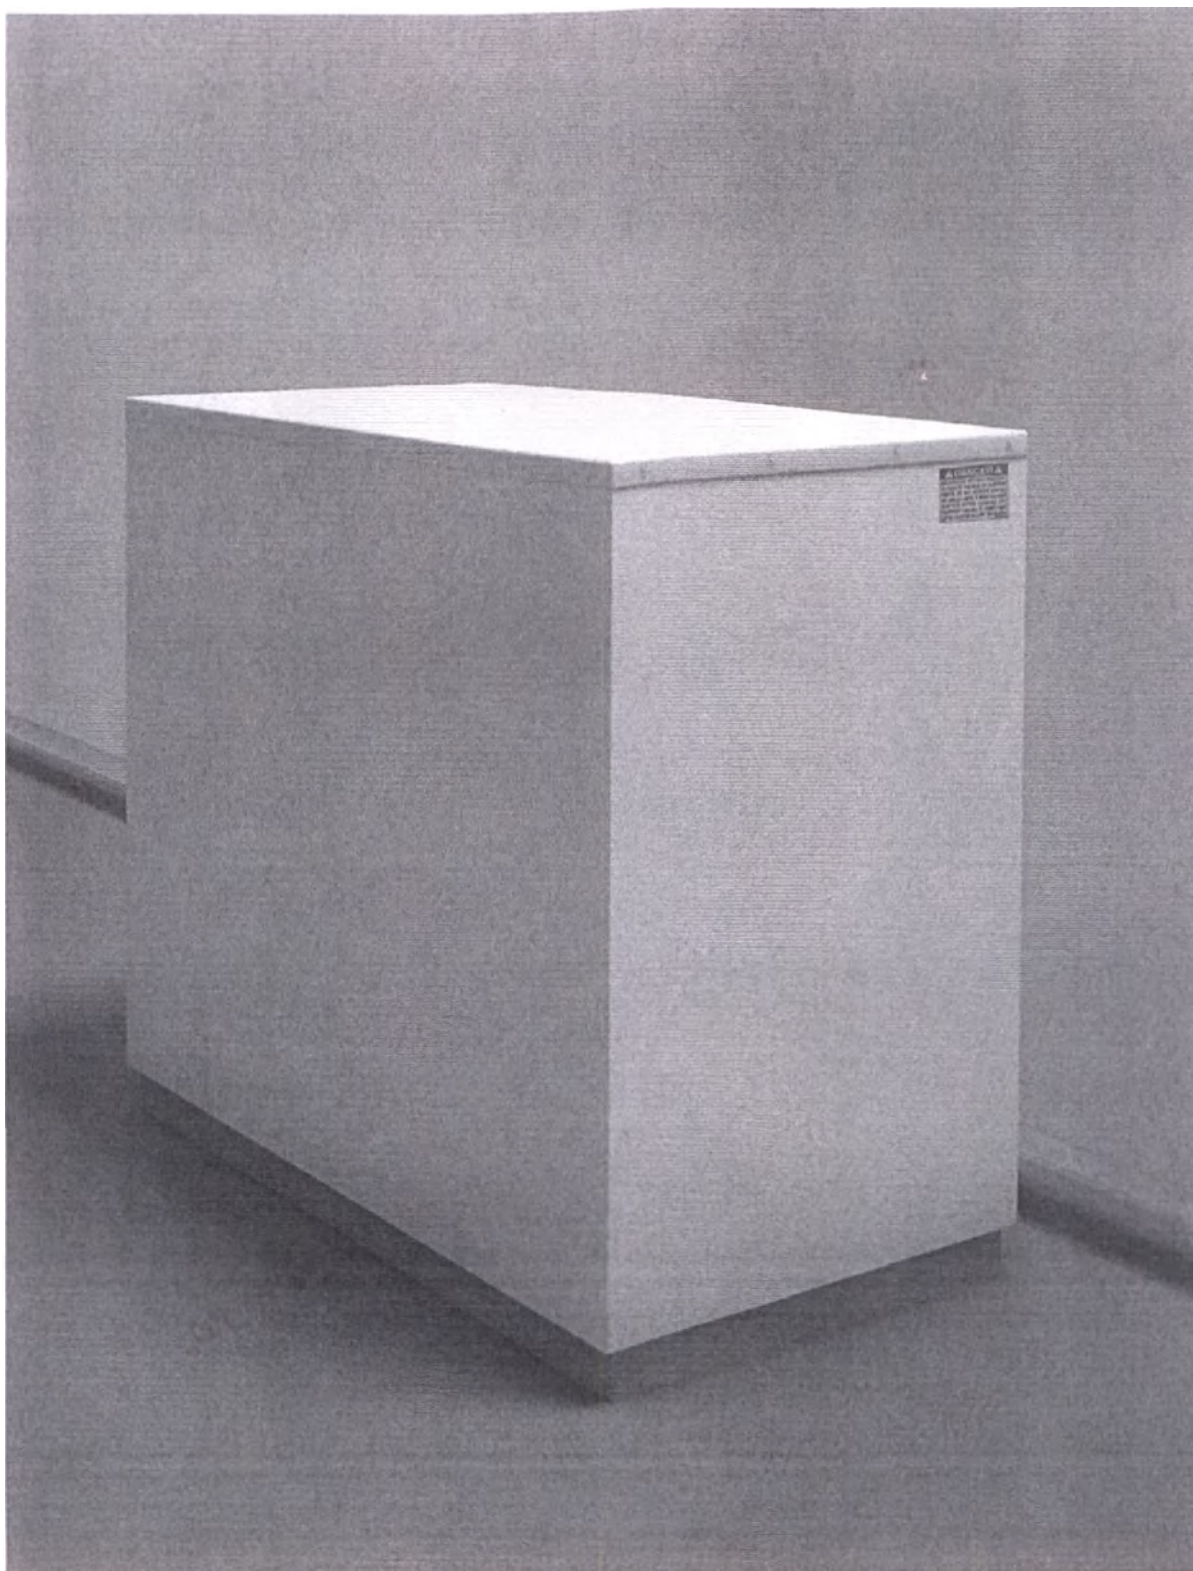


Рентгеновское питающее устройство (РПУ) серии ZR75PN40 или серии ZR75PN50 или серии ZR75PN65 или серии ZR75PN80, производства Spellman, США или Spellman High Voltage Electronics GmbH, Германия или Spellman High Voltage Electronics (SIP) Co., Ltd, Китай

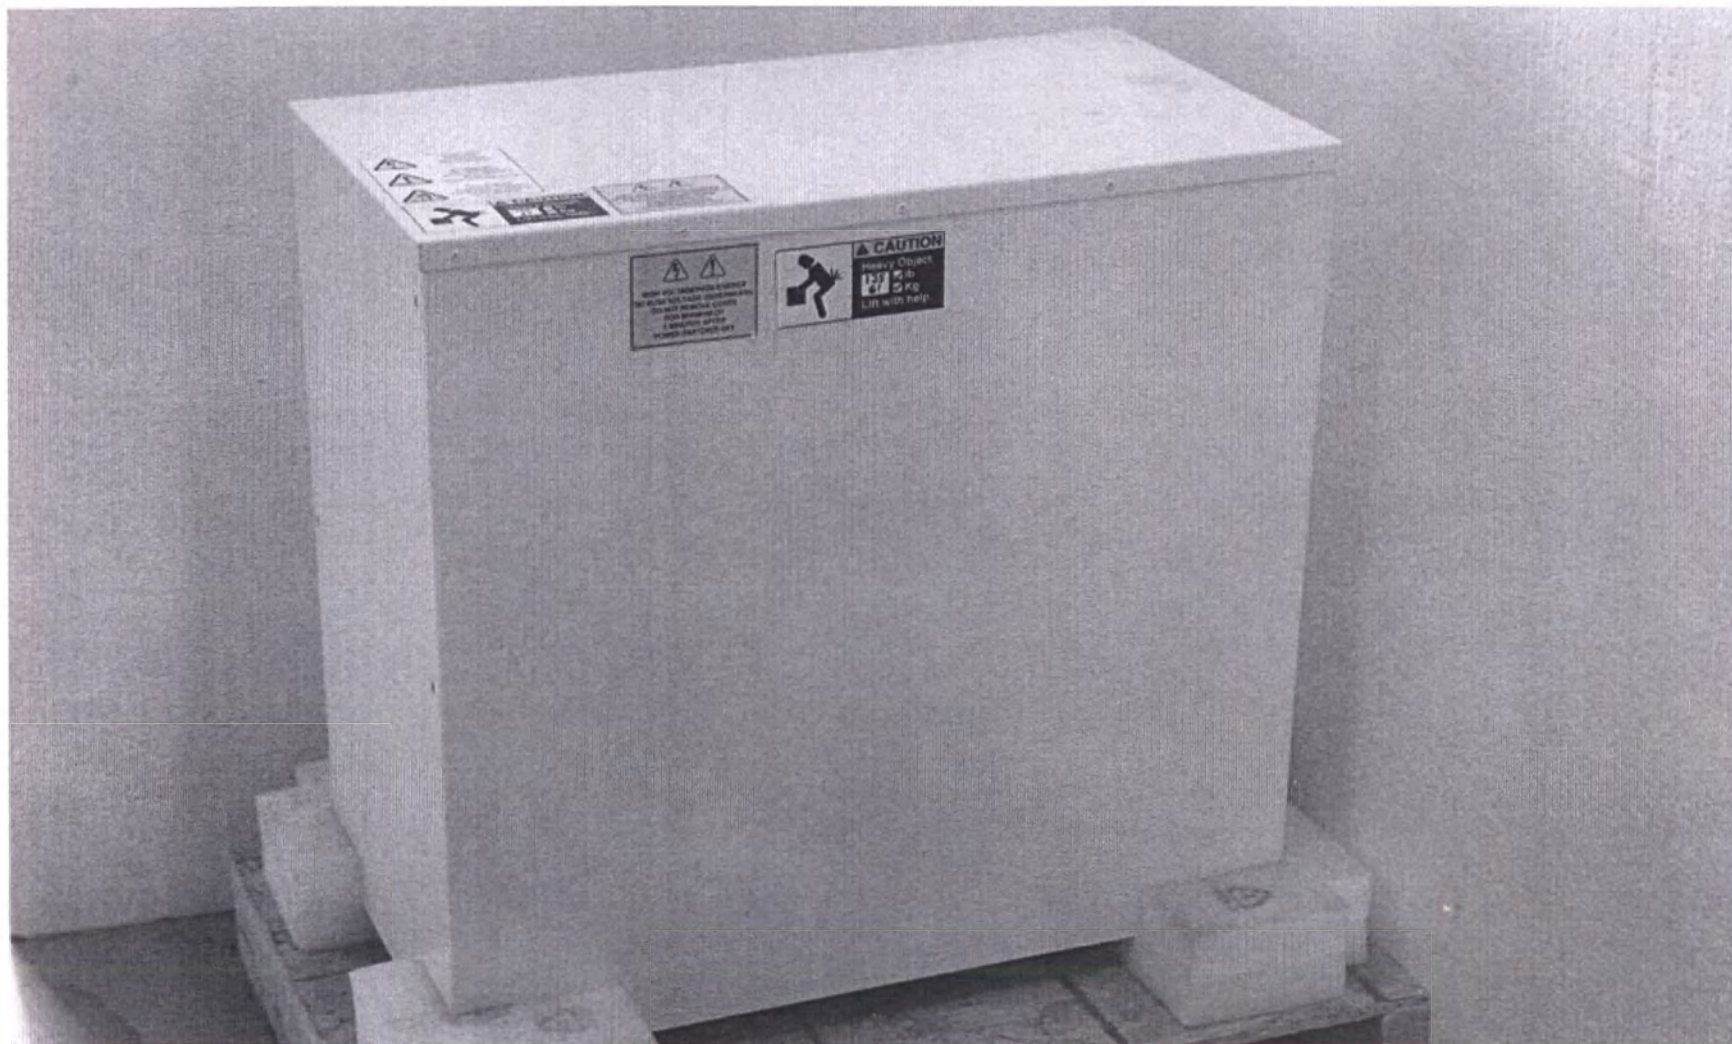


Рентгеновское питающее устройство (РПУ) серии CMP 200, производства Communications & Power Industries Canada Inc., Канада

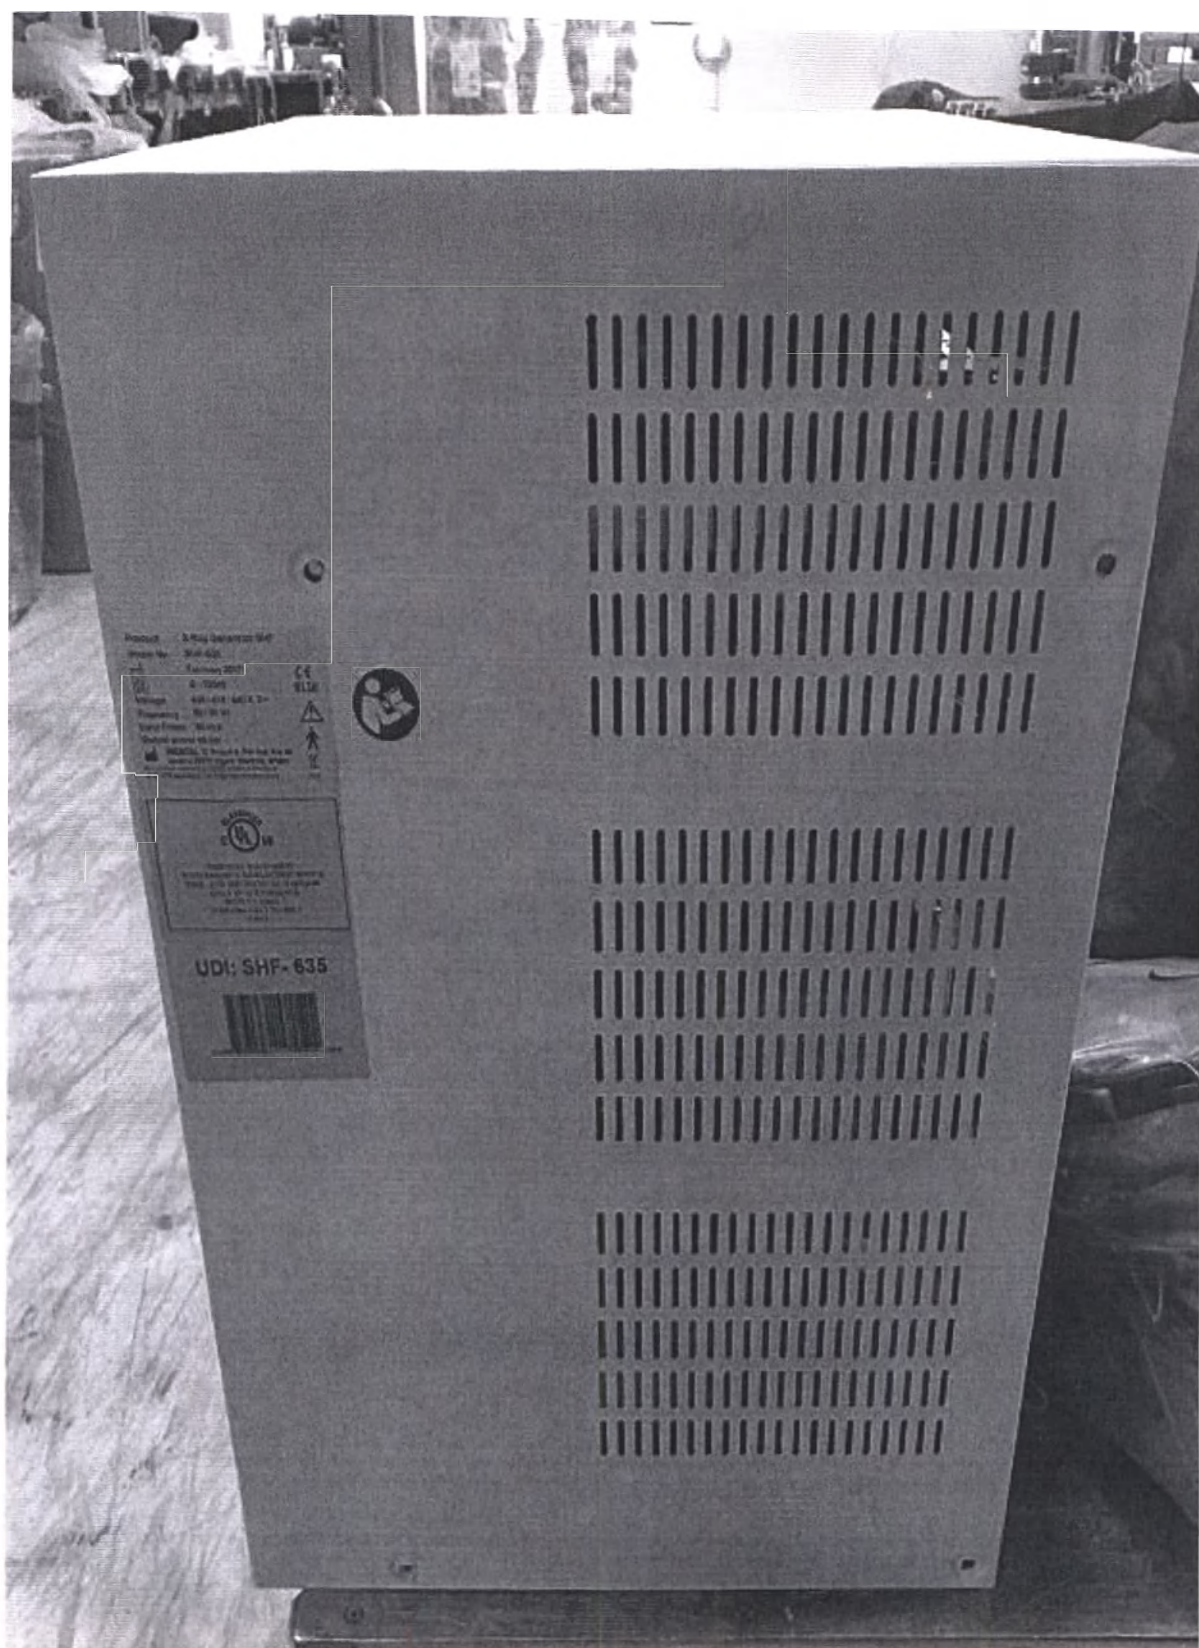

Рентгеновское питающее устройство (РПУ) SHF315-C или SHF415-C или SHF515-C, производства Sedecal S.A., Испания

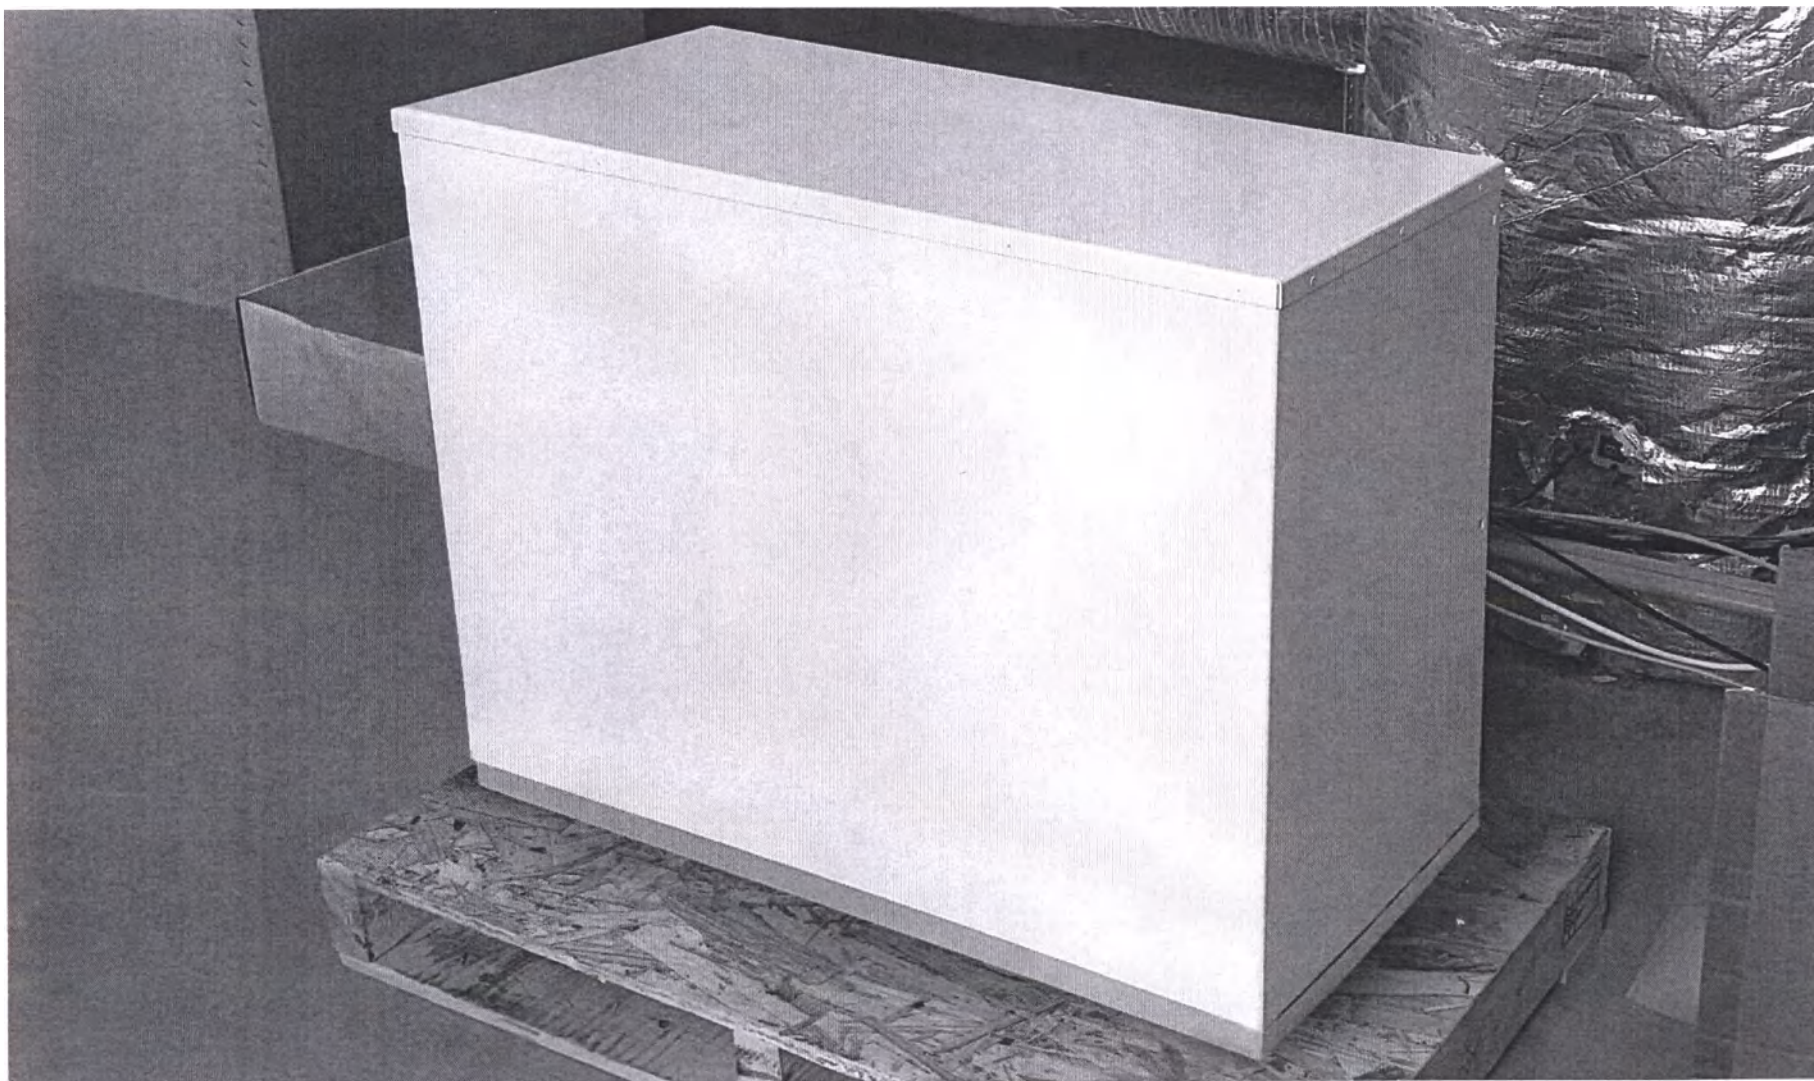


Рентгеновское питающее устройство (РПУ) X1-B0600 по спецификации или X1-B0700 по спецификации, производства ООО «ВКО Медпром», Россия

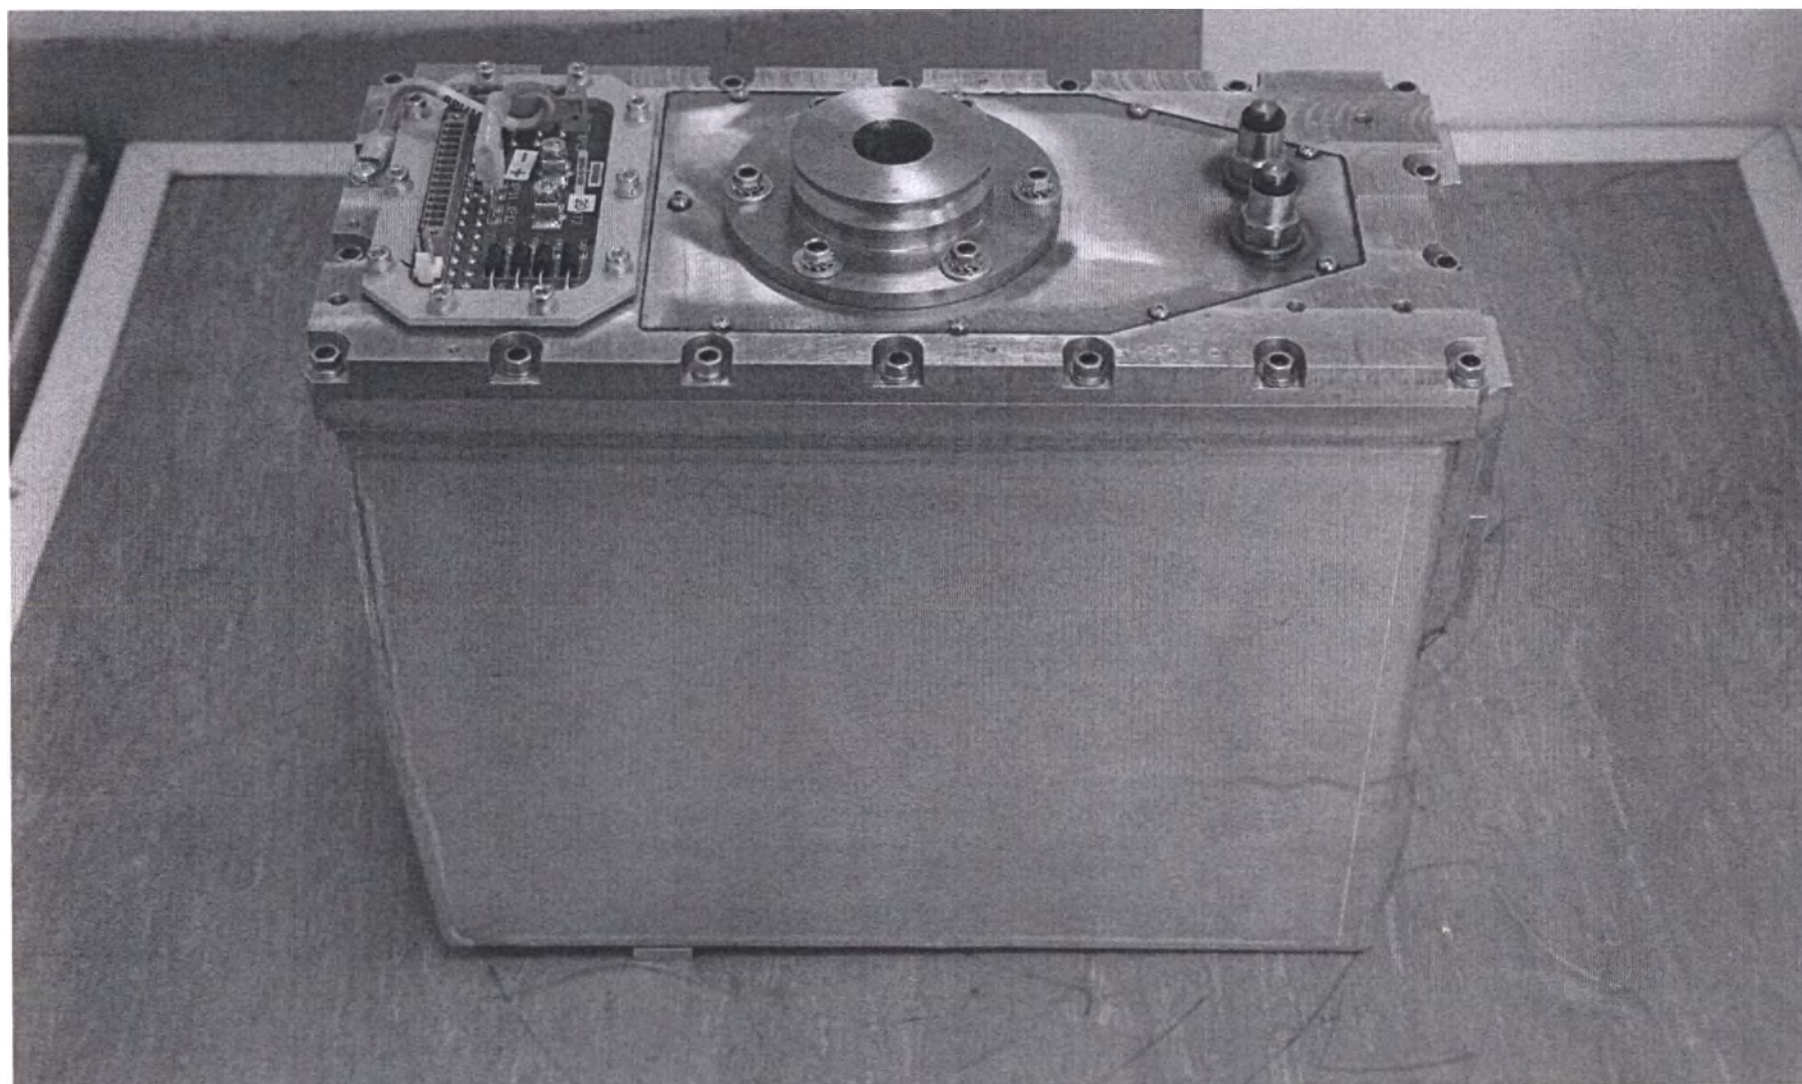


Рентгеновское питающее устройство (РПУ) X1-B0500 по спецификации, производства ООО «ВКО Медпром», Россия




Комплект (пара) кабелей высоковольтных с наконечниками производства Varex Imaging Nederland B.V., Нидерланды или Varex Imaging Corporation, США или Varex Imaging Corporation, Филиппины или Varex Imaging Corporation, Китай или Tianjin Wanbo Wire & Cable Co.,Ltd, Китай

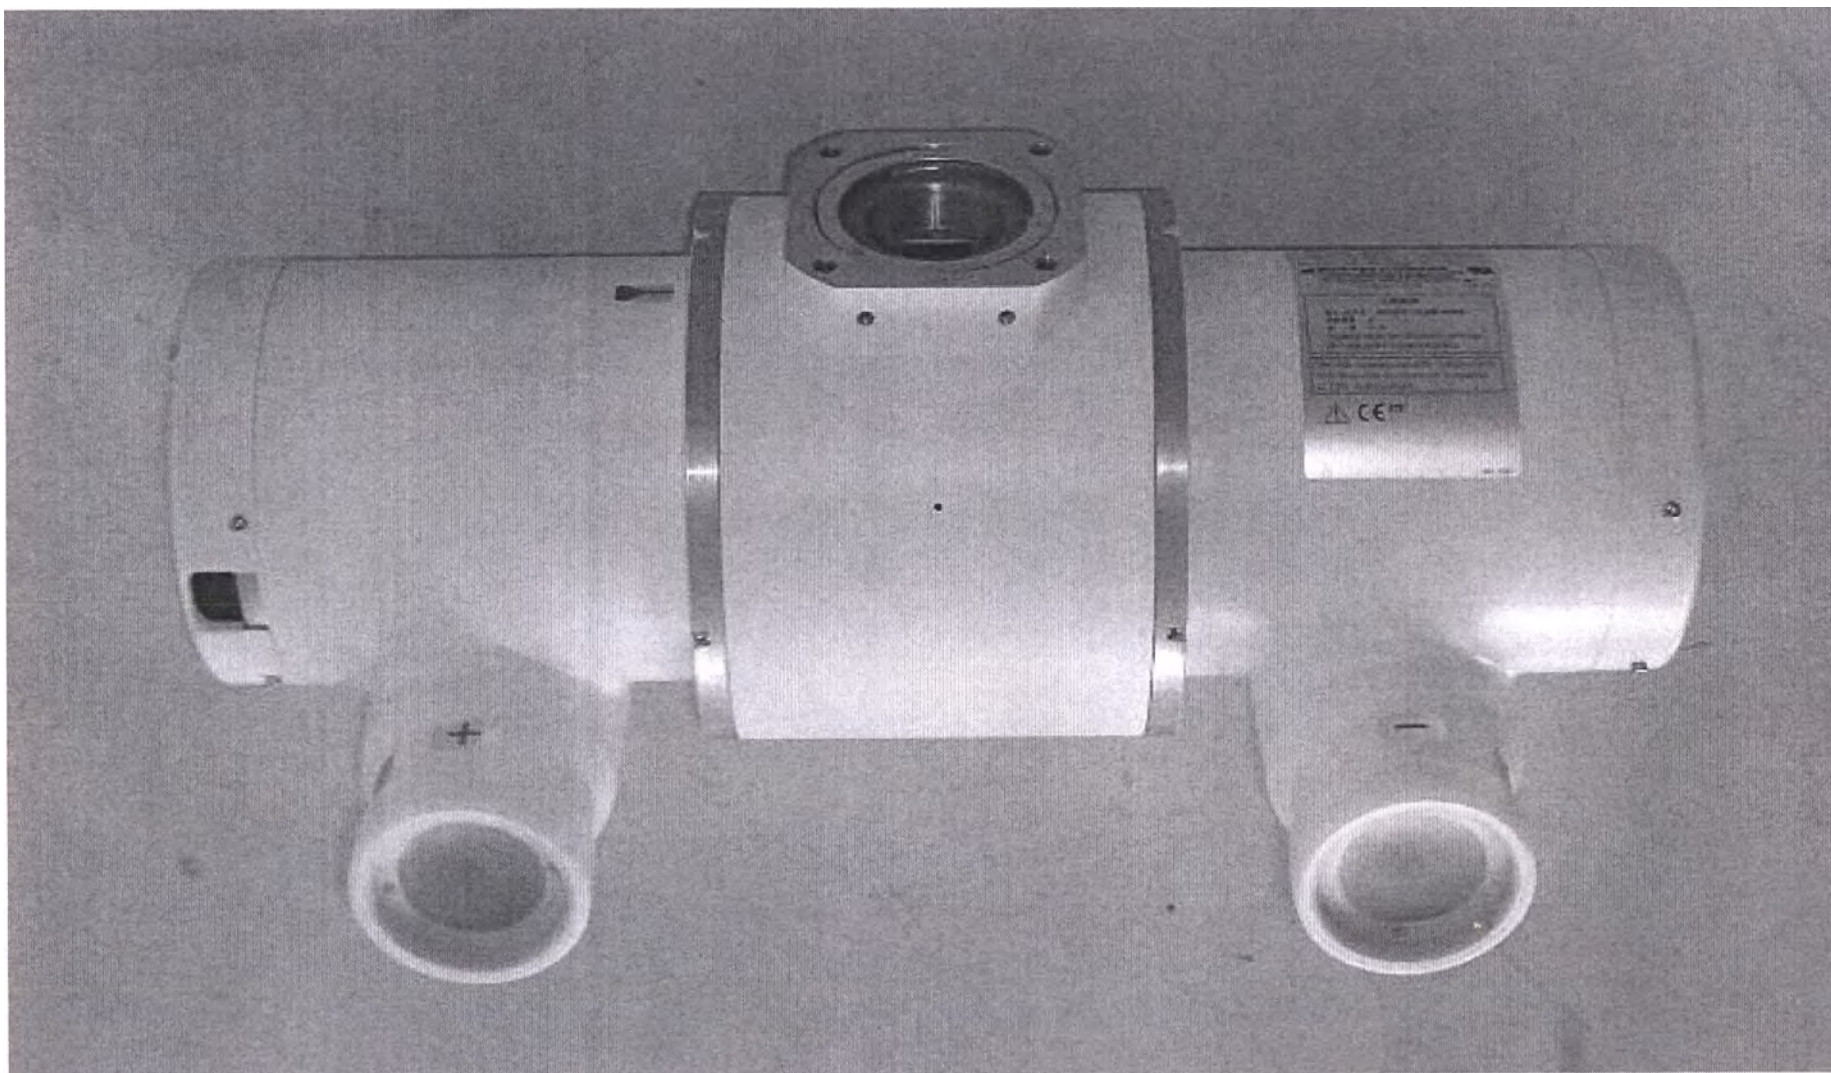

Излучатель рентгеновский с рентгеновской трубкой E7242 или E7252 или E7239, производства Canon Electron Tubes & Devices Co., Ltd, Япония

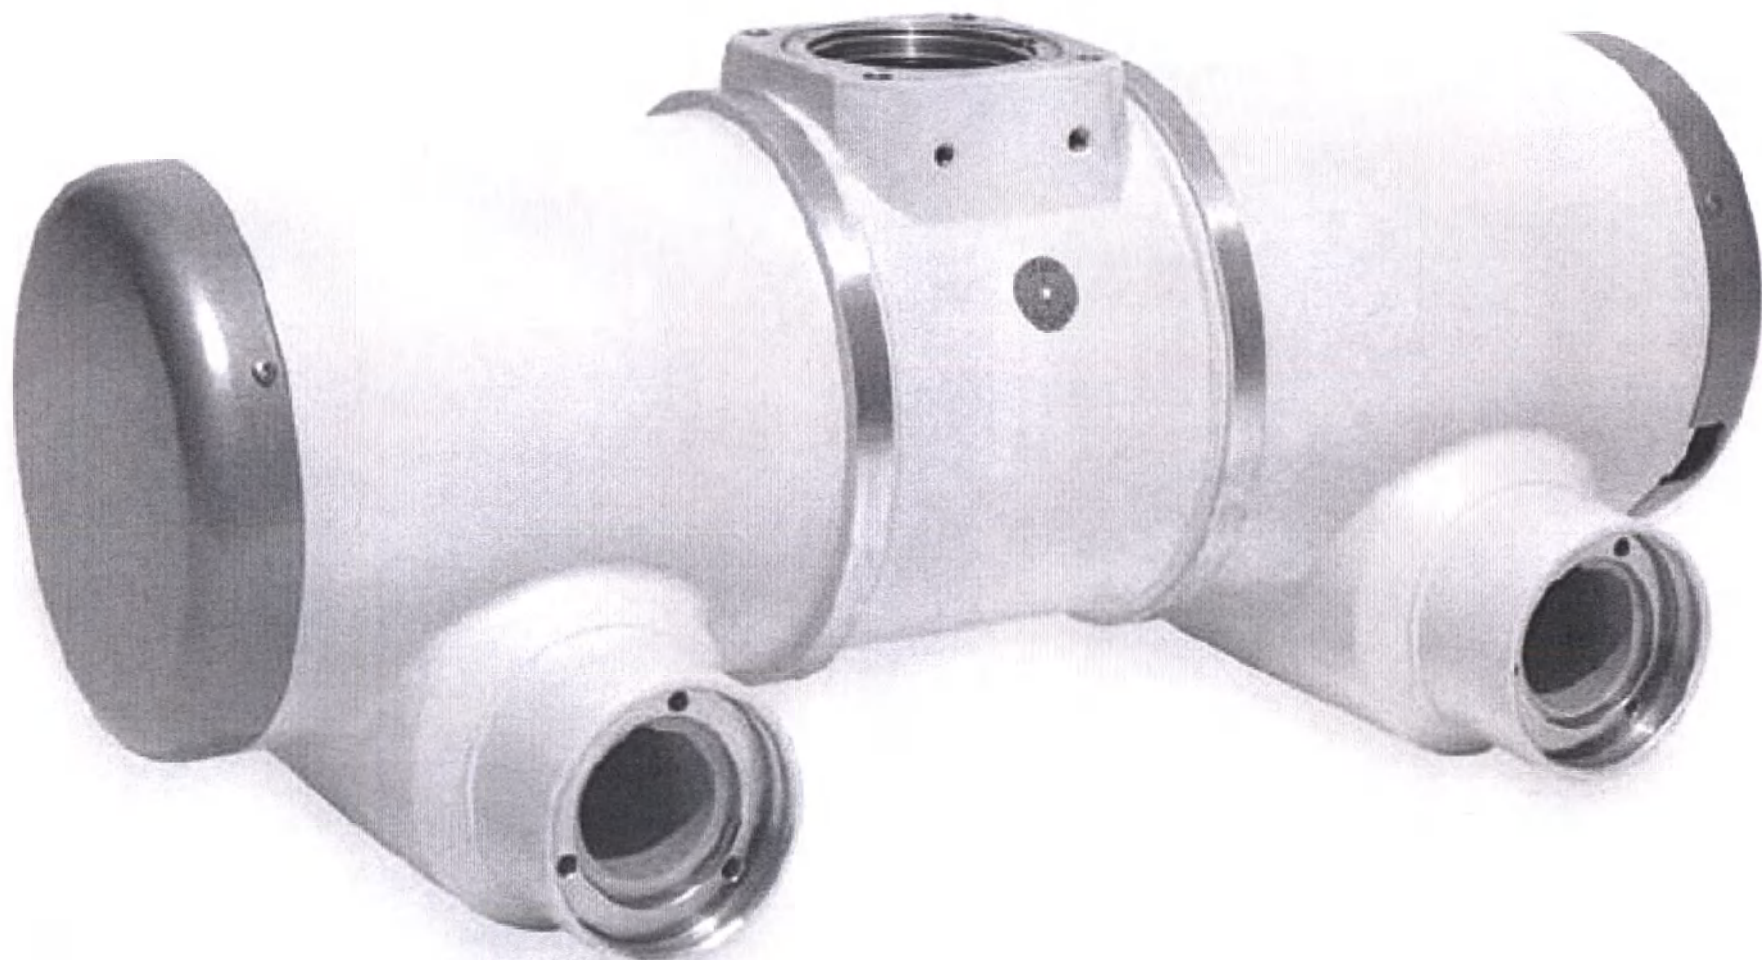

Излучатель рентгеновский с рентгеновской трубкой RAD 14/Leo, производства Varex Imaging Nederland B.V., Нидерланды или Varex Imaging Corporation, США или Varex Imaging Corporation, Филиппины

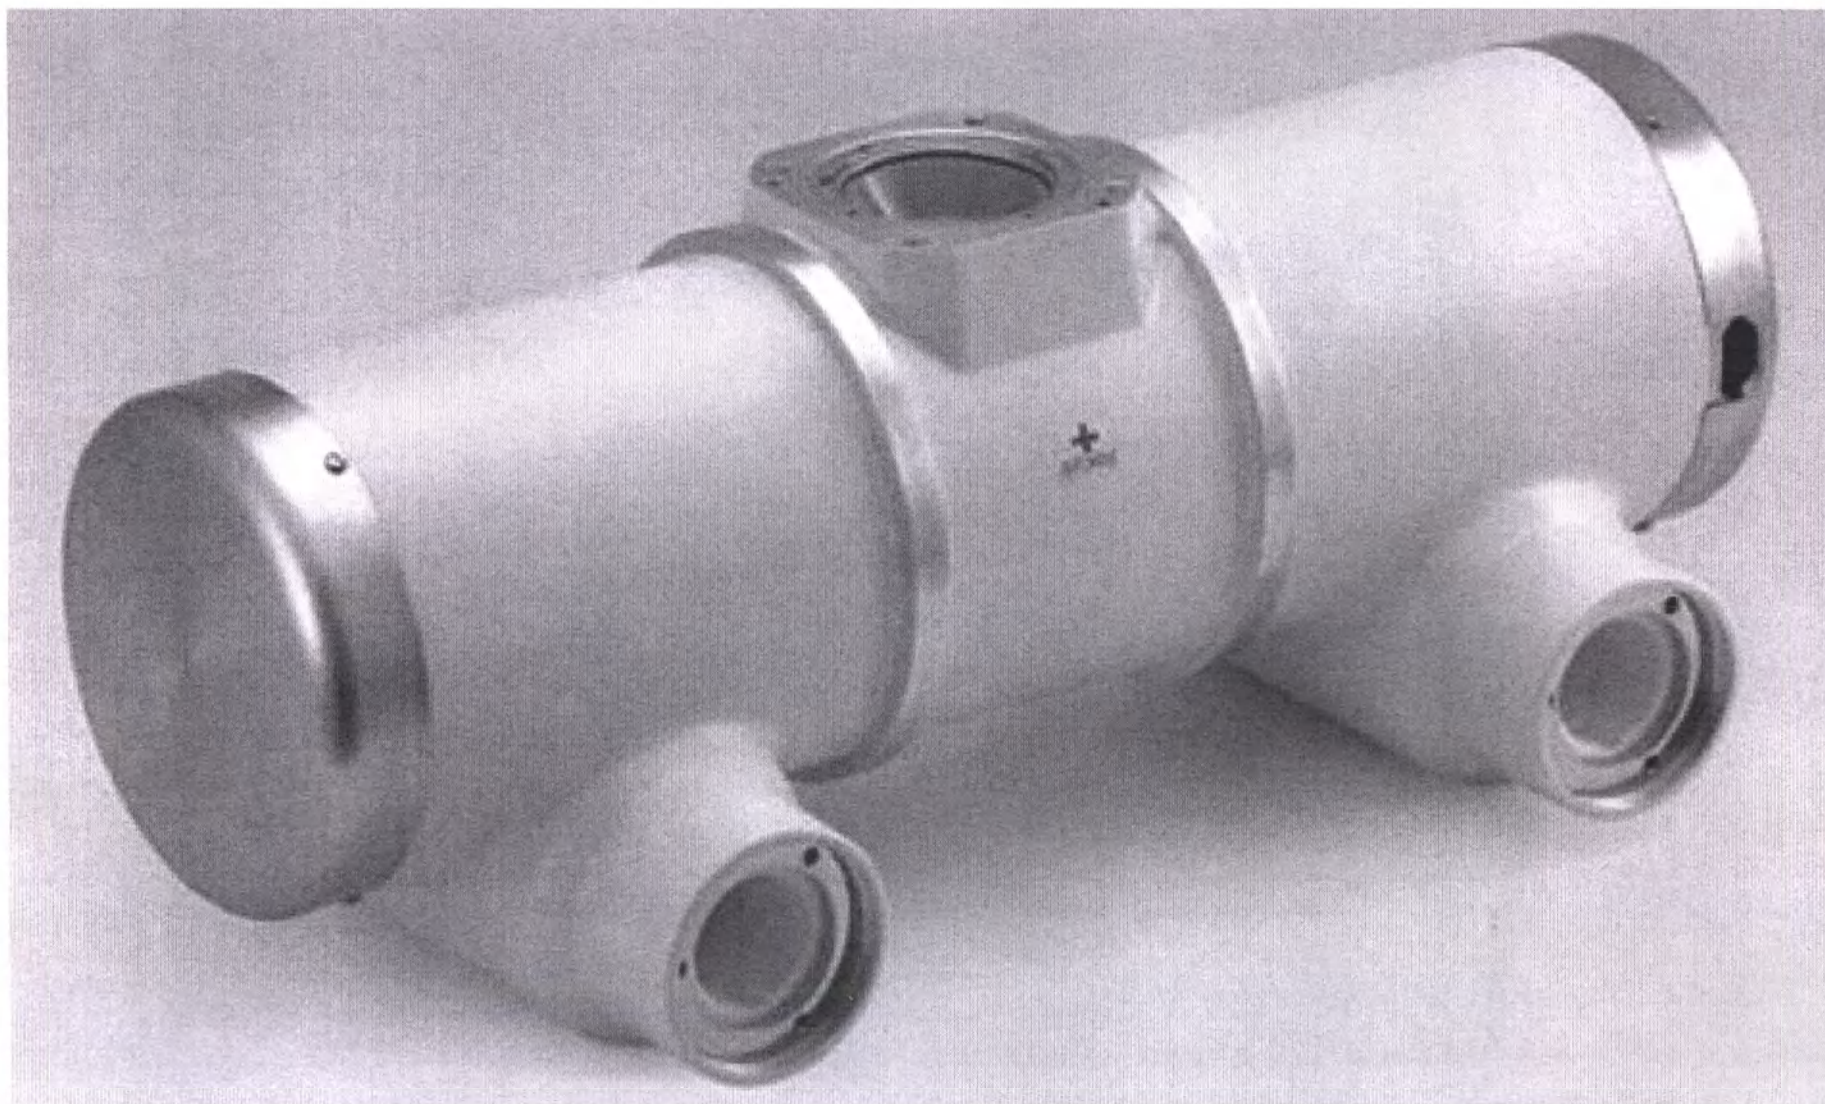


Излучатель рентгеновский с рентгеновской трубкой RAY-12 или RAY-14, производства Siemens, Германия




Коллиматор с соединительными элементами, с ручным или автоматическим управлением серии R 221, производства Ralco srl., Италия




Коллиматор с соединительными элементами, с ручным или автоматическим управлением R 225, производства Ralco srl., Италия

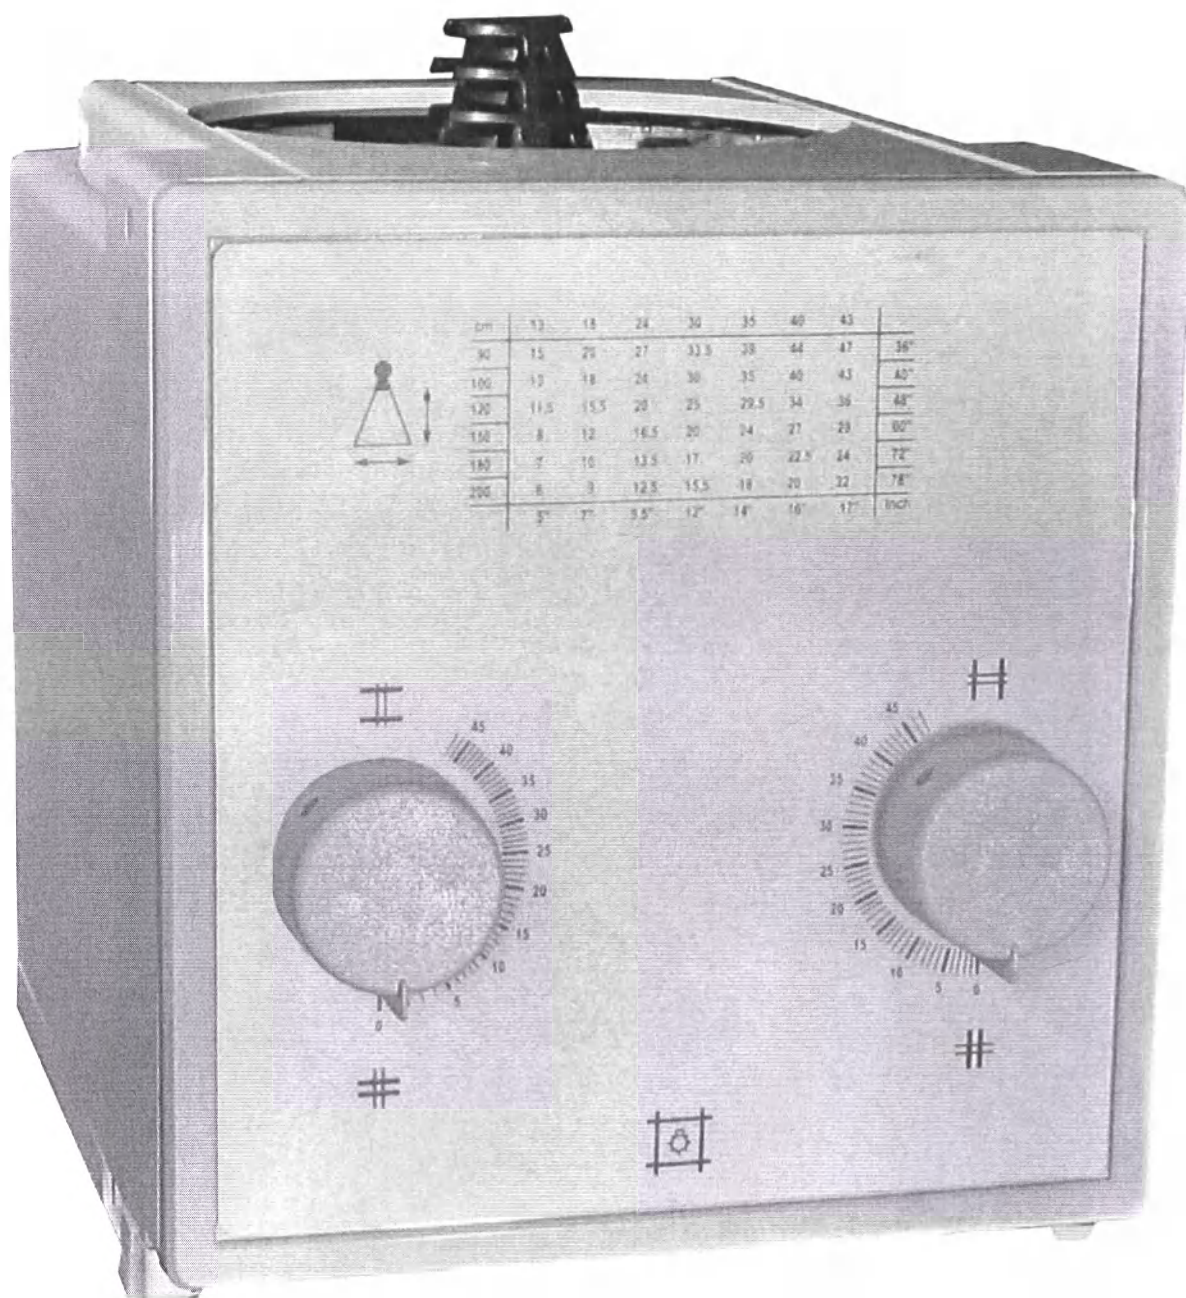


Коллиматор с соединительными элементами, с ручным или автоматическим управлением R 302, производства Ralco srl., Италия

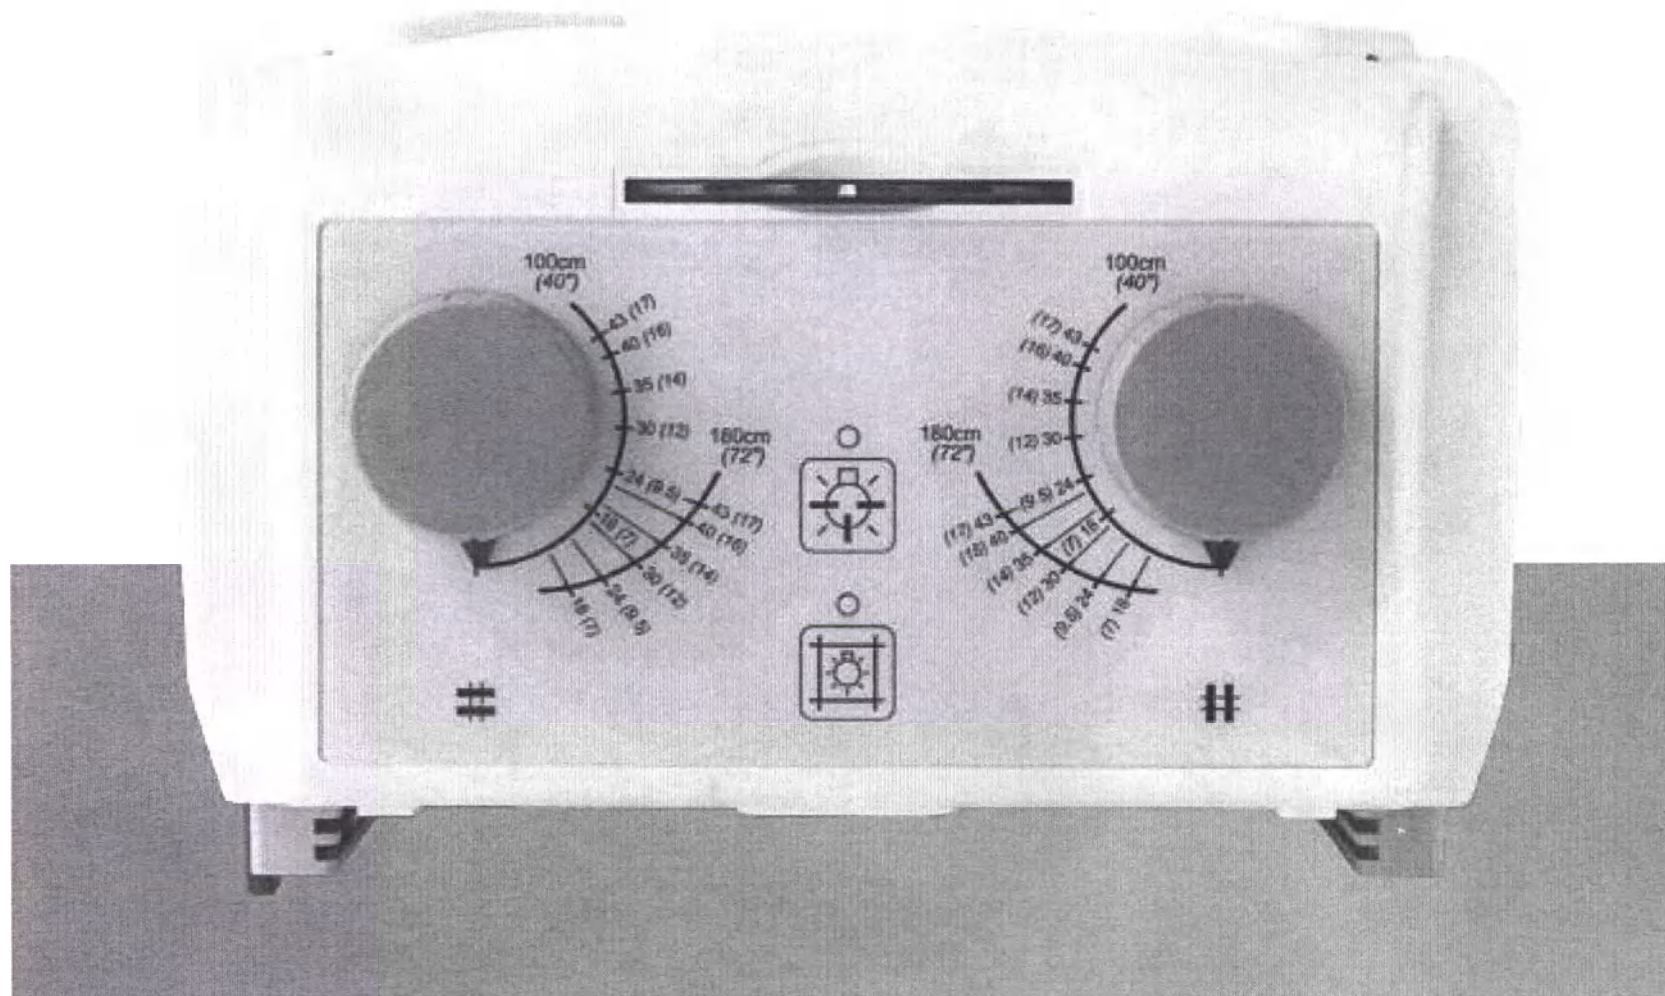


Коллиматор с соединительными элементами, с ручным или автоматическим управлением серии Optica 10 или серии Optica 20, производства Varex Imaging Nederland B.V., Нидерланды или Varex Imaging Corporation, США или Varex Imaging Corporation, Филиппины

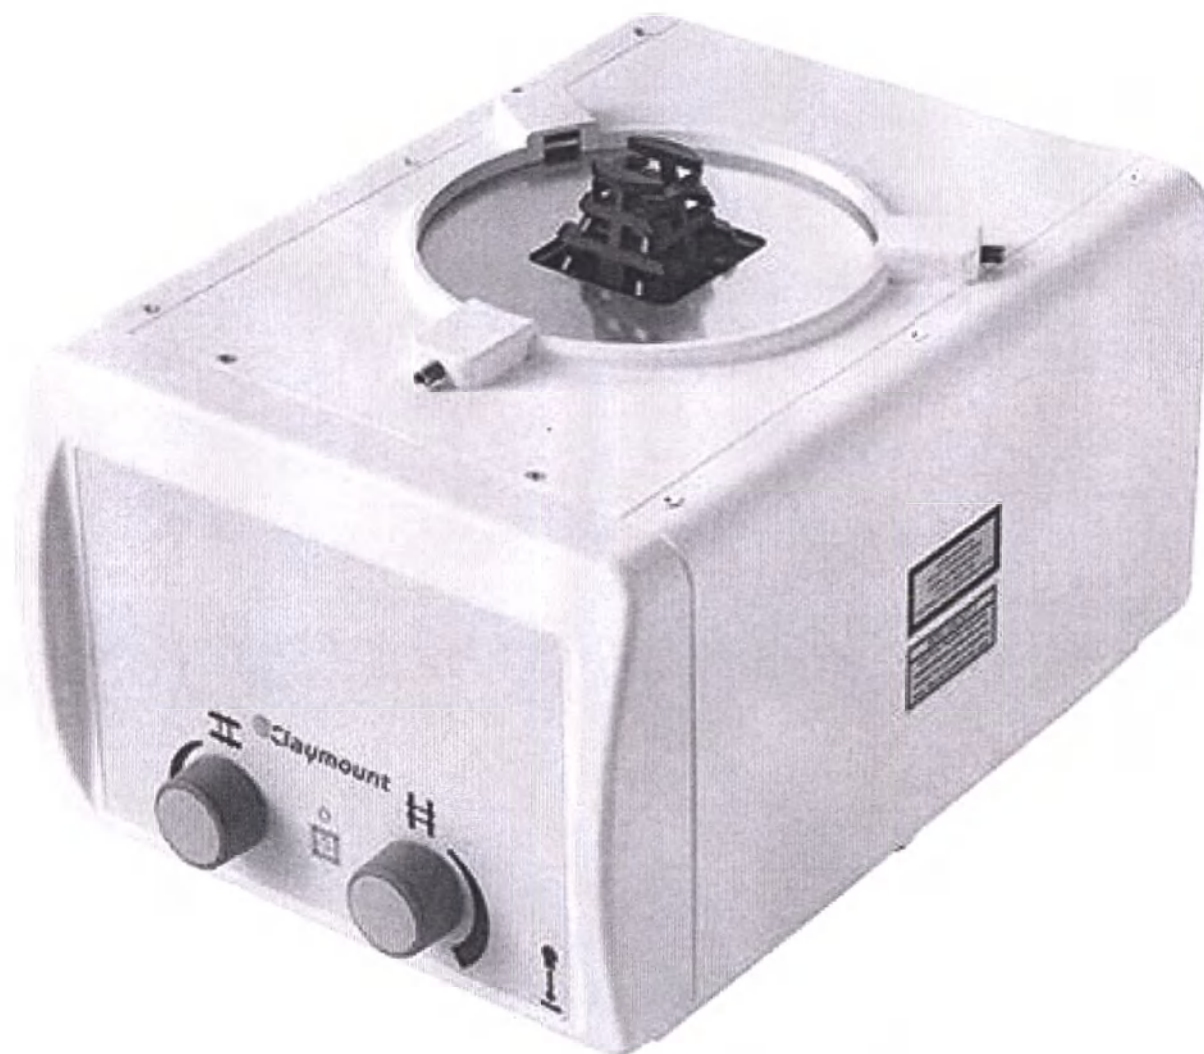

Коллиматор с соединительными элементами, с ручным или автоматическим управлением серии Optica 30, производства Varex Imaging Nederland B.V., Нидерланды или Varex Imaging Corporation, США или Varex Imaging Corporation, Филиппины

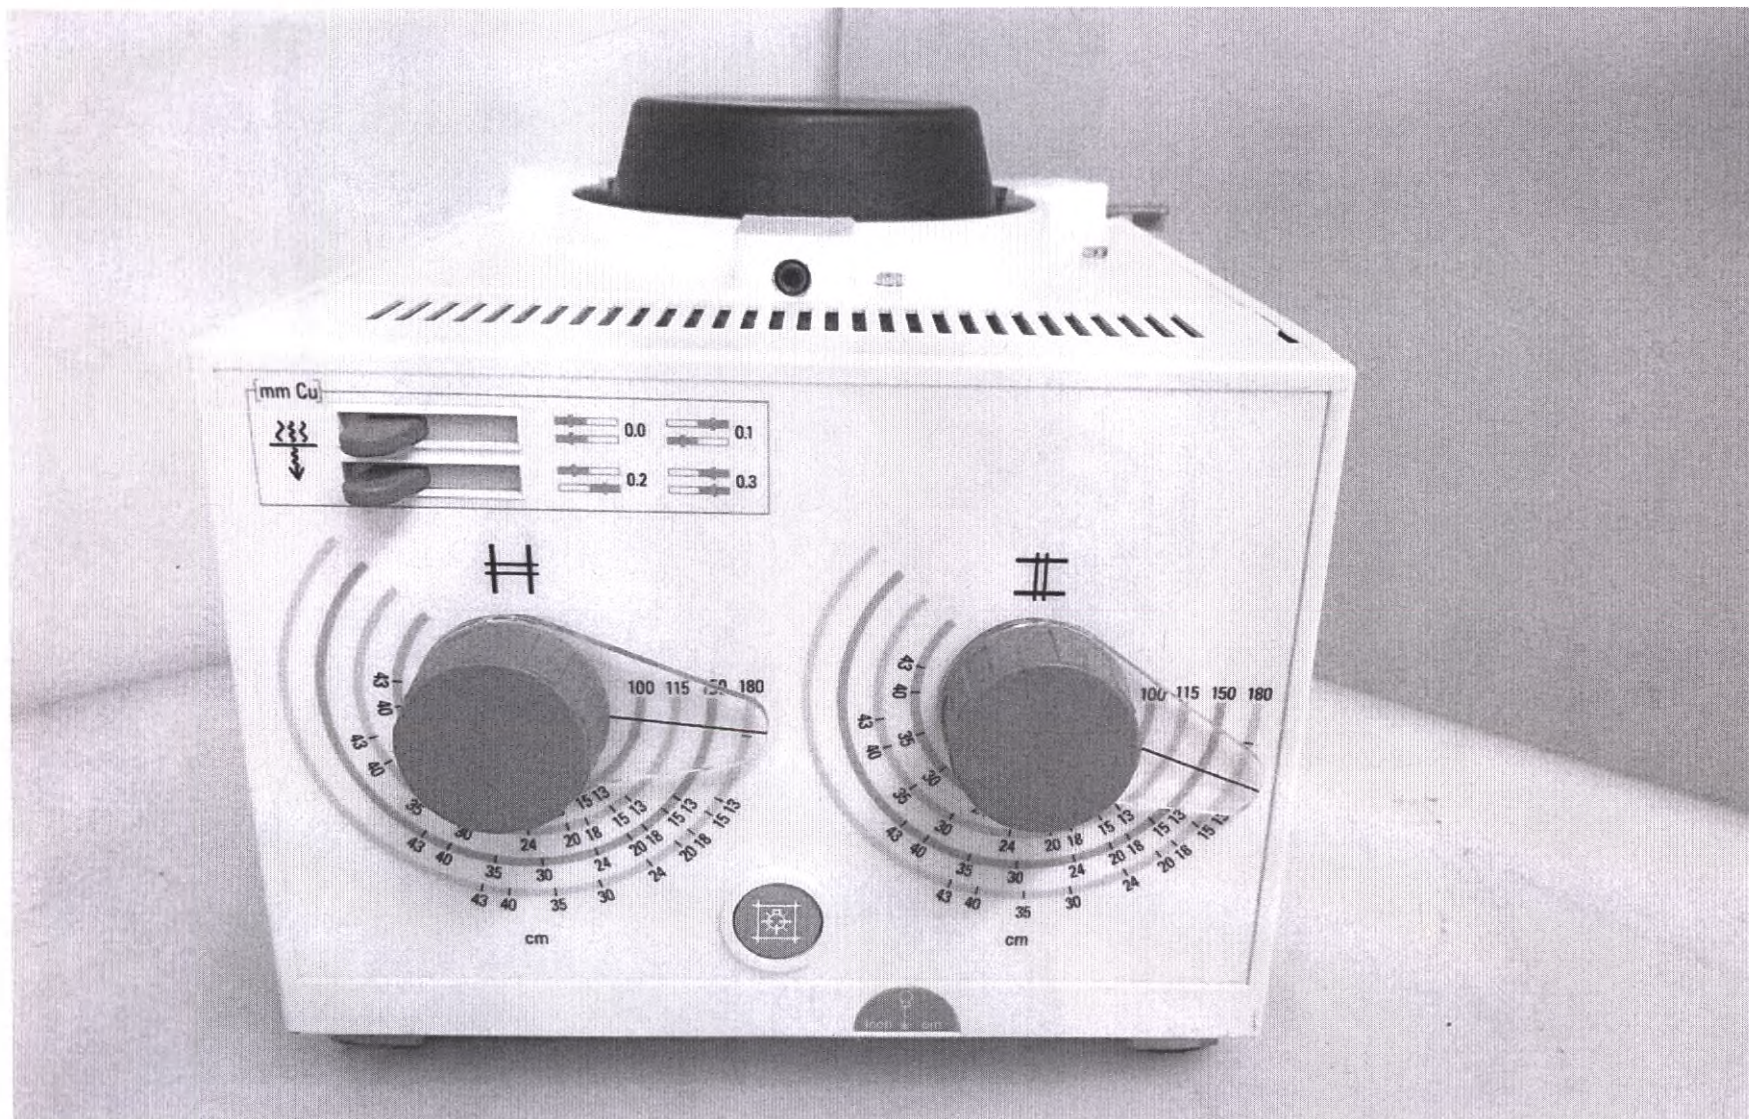


Коллиматор с соединительными элементами, с ручным или автоматическим управлением серии ML 01 II, производства Siemens, Германия

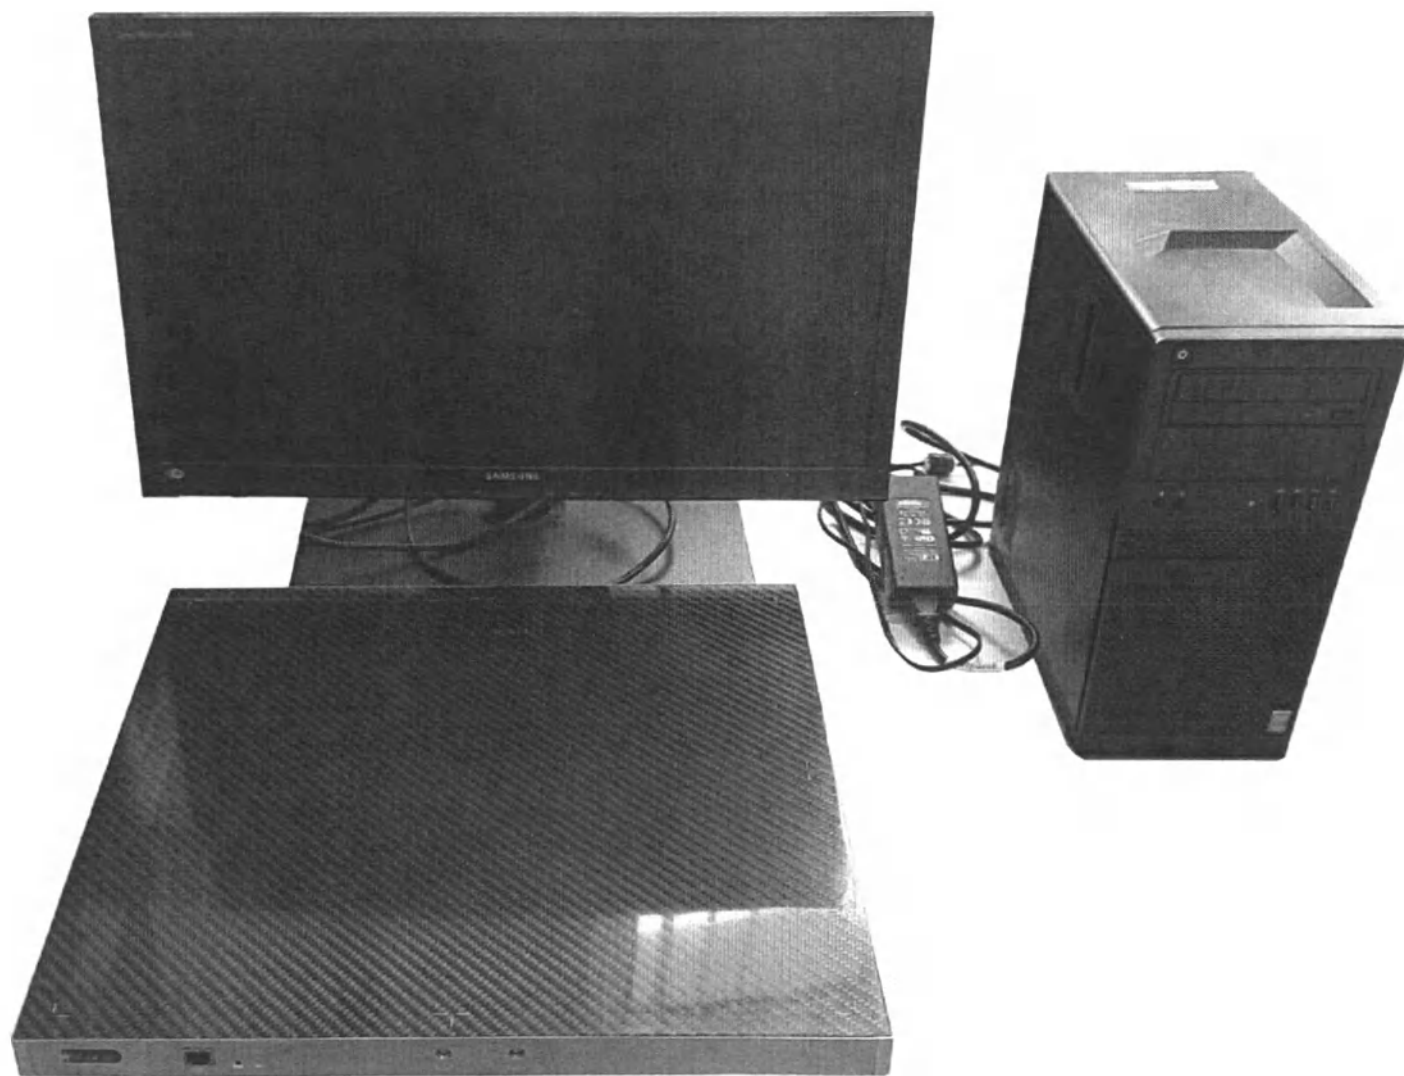


Комплекс аппаратно-программный для регистрации и обработки рентгеновских изображений
«СОЛО ДР-МТ», производства АО «МТЛ», Россия




Растр рентгеновский отсеивающий Lysholm, производства Gridline А.В., Швеция

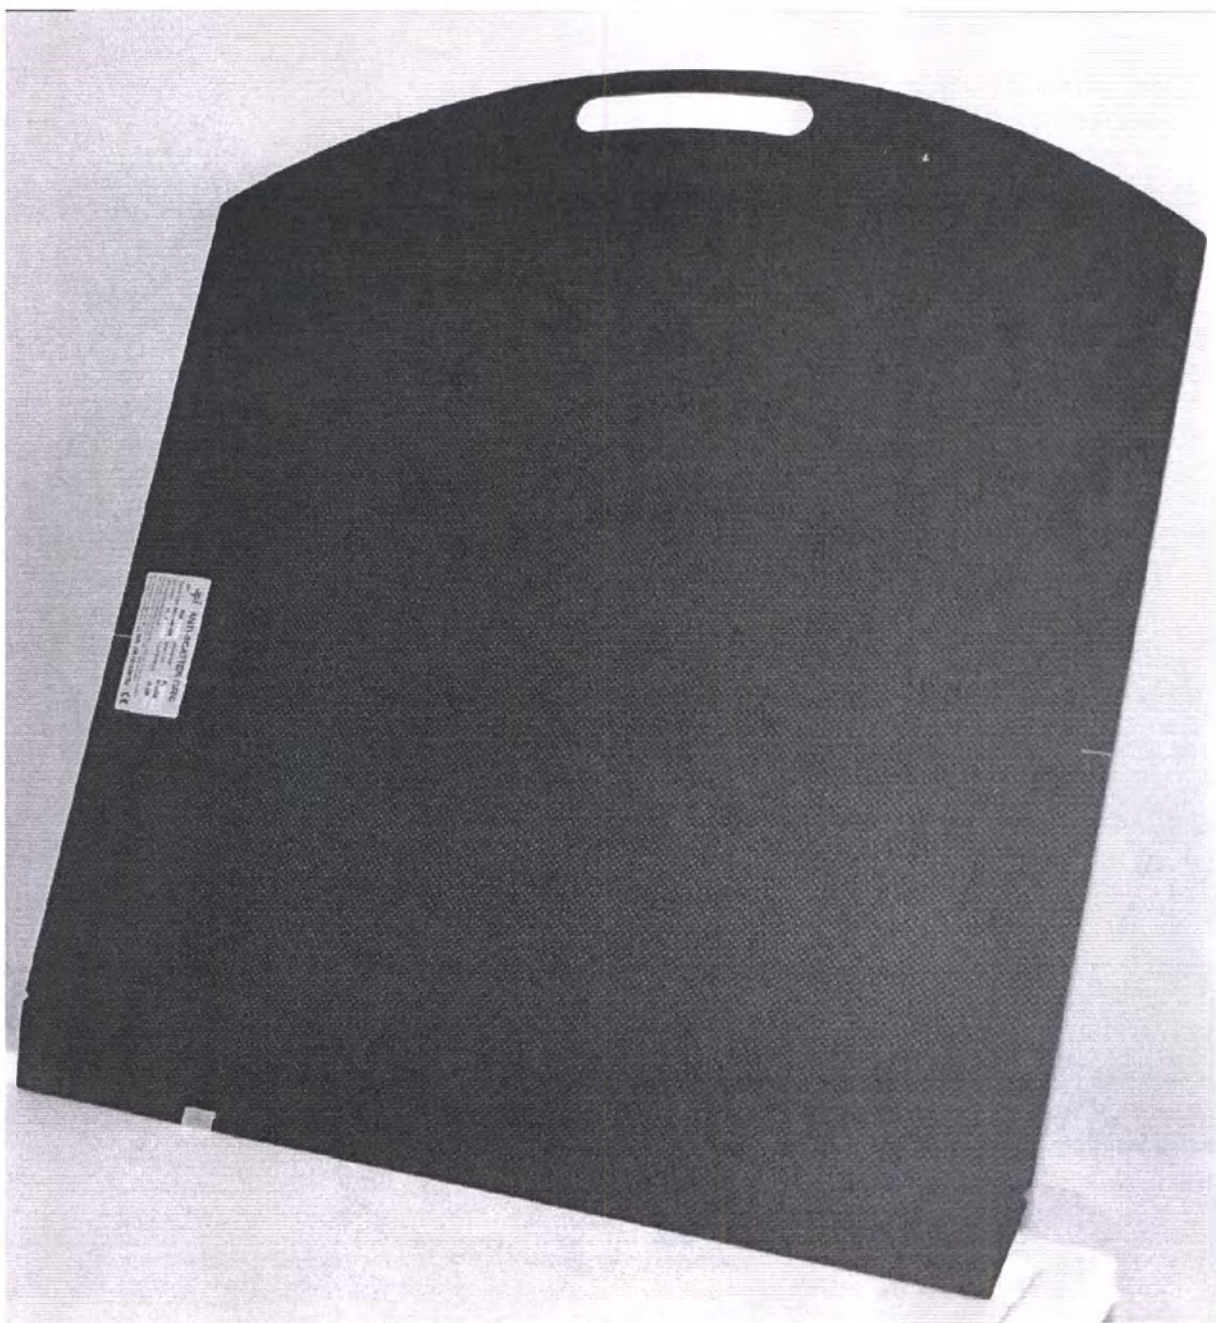


Растр рентгеновский отсеивающий JPI, производства Jungwon Precision Ind. Co., Ltd, Республика Корея

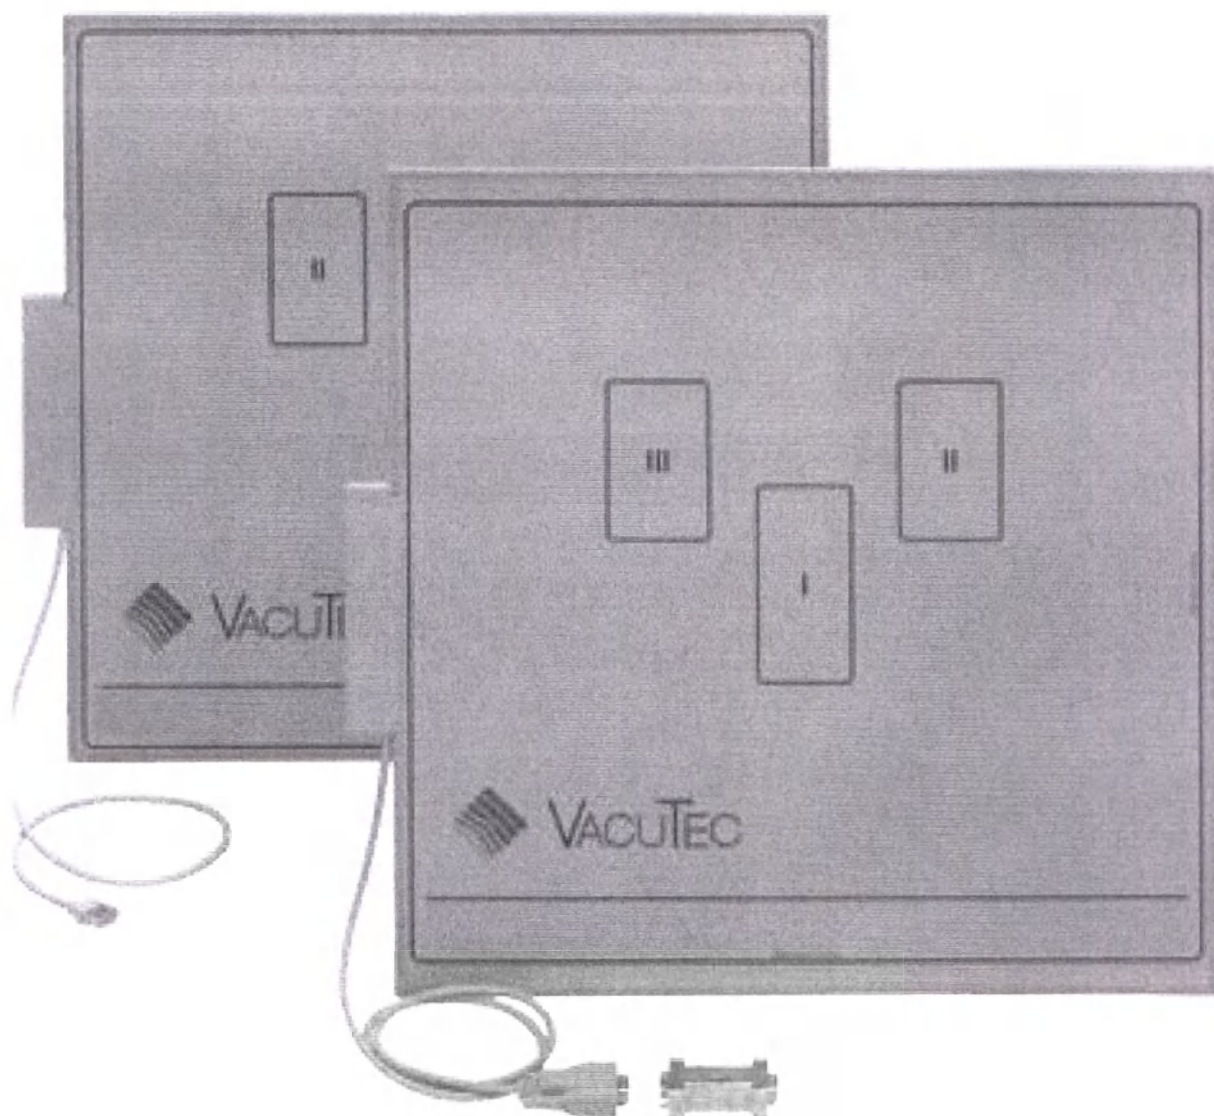


Ионизационная камера серии 70, производства VacuTec, Meßtechnik GmbH, Германия

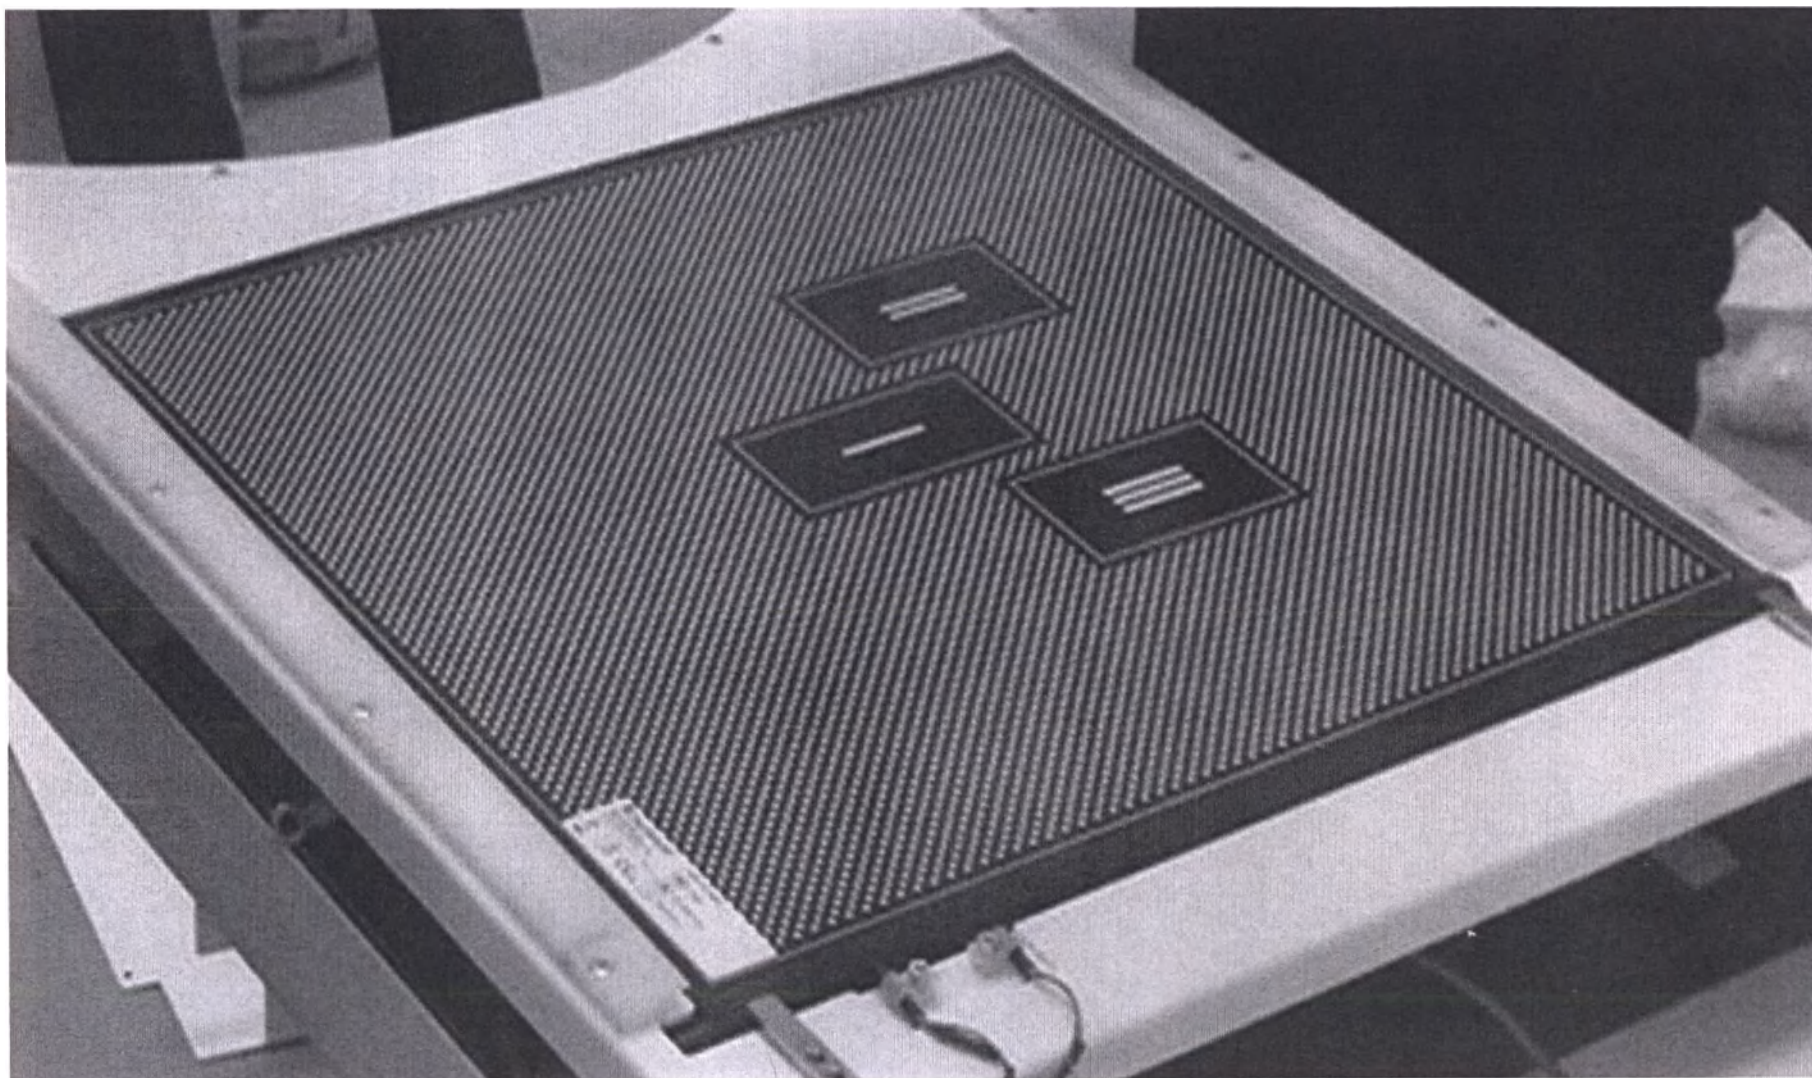

Ионизационная камера серии SSMC, производства Varex Imaging Nederland B.V., Нидерланды или Varex Imaging Corporation, США или Varex Imaging Corporation, Филиппины

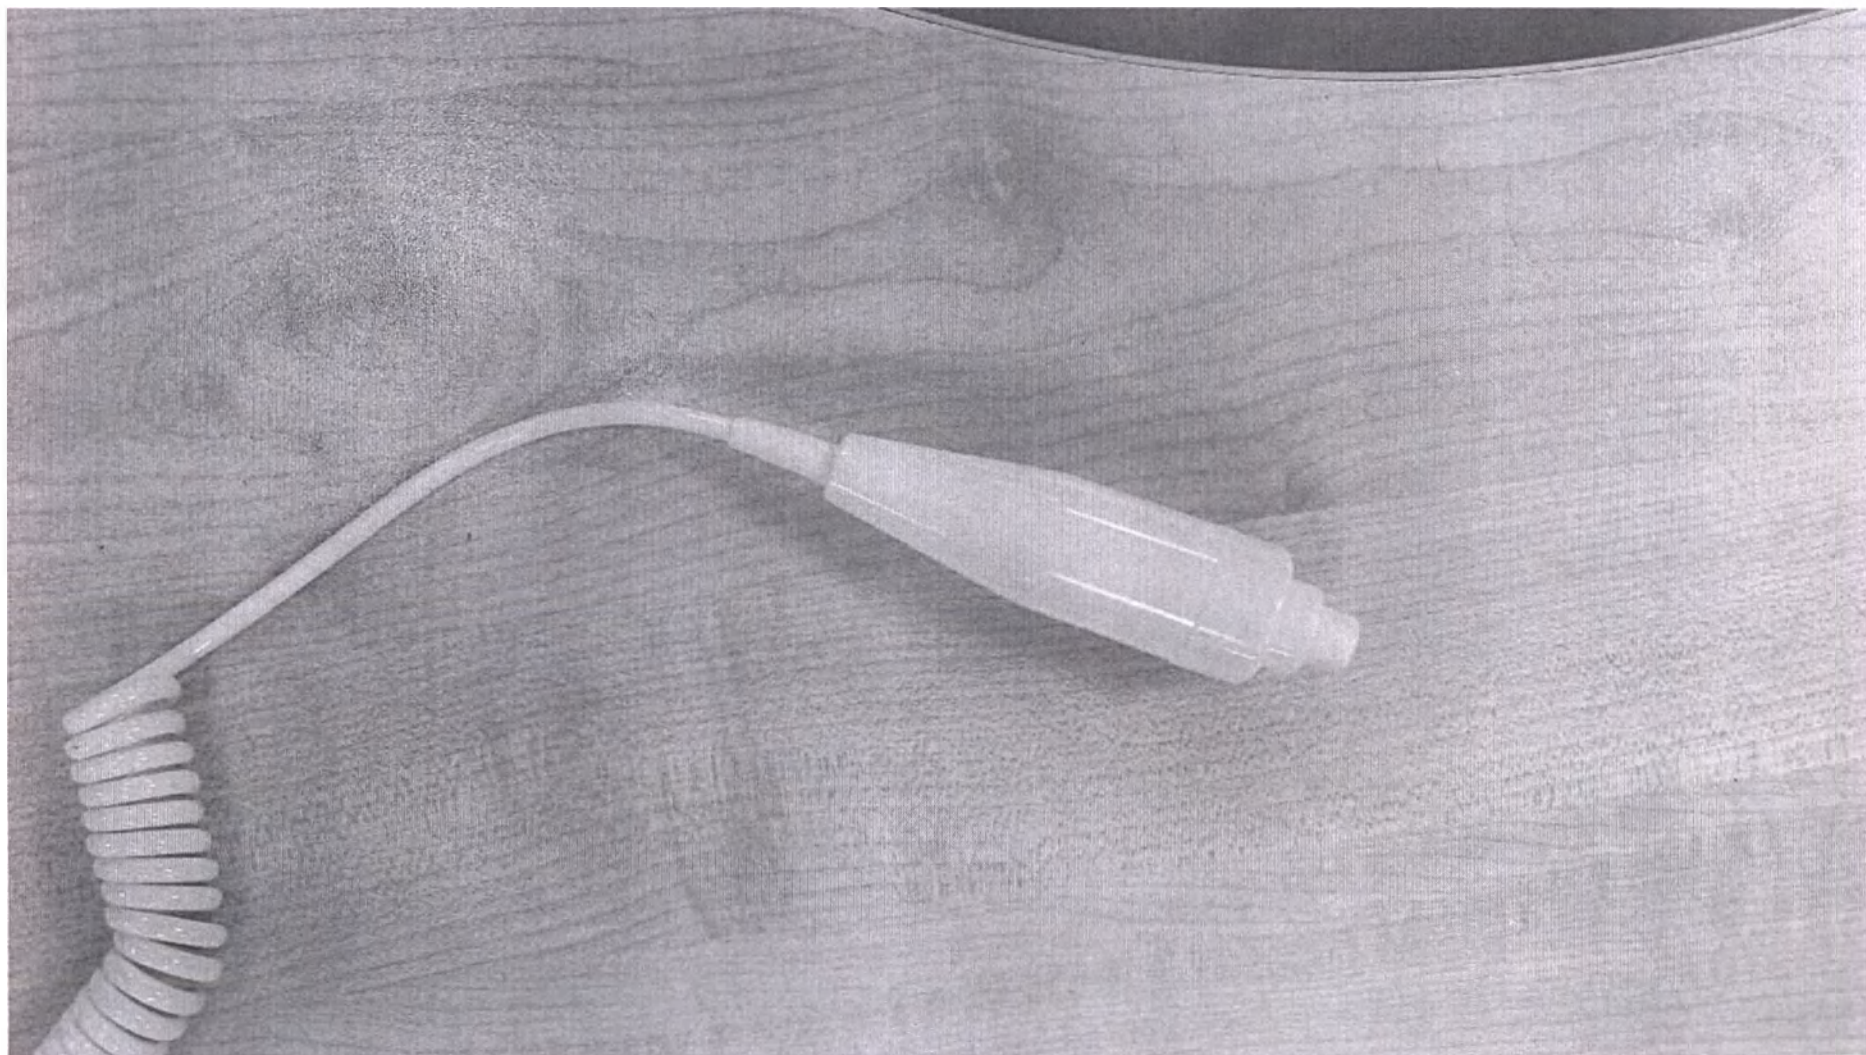


Устройство включения экспозиции, производства Dongzi Medical System Co., Китай или OMRON Corporation, Япония

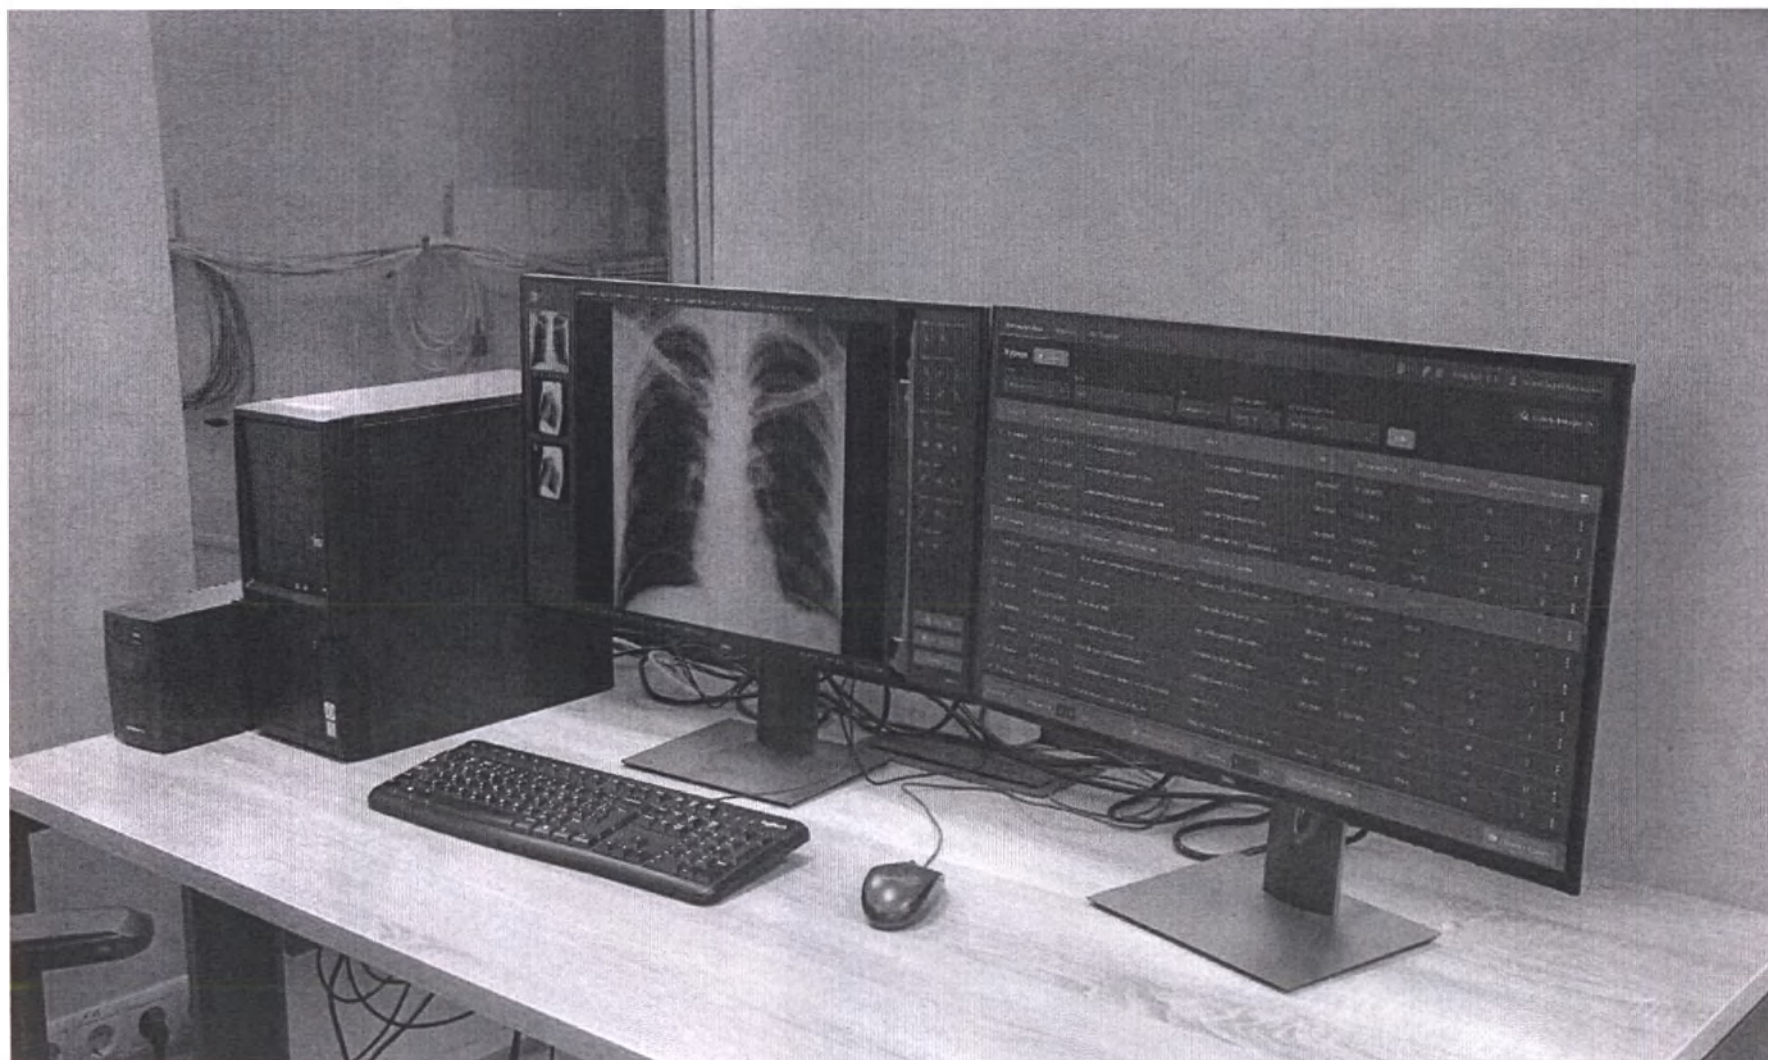

АРМ оператора МАК1-00 по спецификации и Станция рабочая РСТ1-00 по спецификации,
производства ООО «М.С.Корп», Россия



2. Монитор ЖК с диагональю от 19 до 32 дюймов серии EM, производства Tecnint HTE s.r.l., Италия

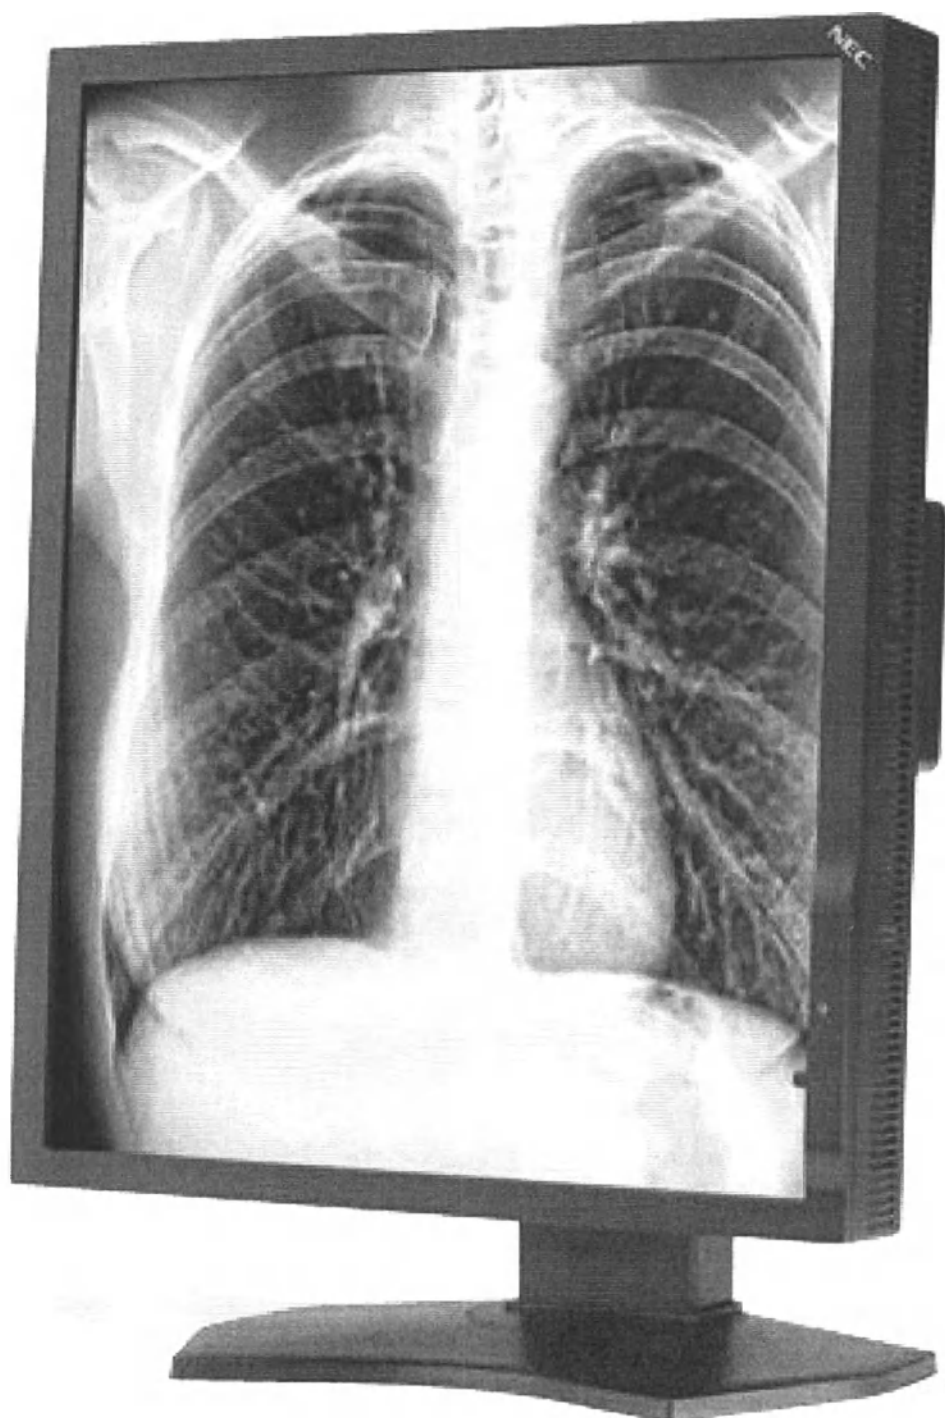


Монитор ЖК с диагональю от 19 до 32 дюймов NEC, производства NEC Display Solutions Ltd, Япония или Compal Electronics (China) Co., Ltd, Китай или Compal Display Electronics (Kunshan) Co., Ltd, Китай




Монитор ЖК с диагональю от 19 до 32 дюймов серии С или серии М или серии R, производства Nanjing Jusha Display Technology Co., Ltd, Китай




Монитор ЖК с диагональю от 19 до 32 дюймов серии Z, производства Hewlett-Packard Co., США или Wistron Corporation, Тайвань или Wistron Mexico S.A. de C.V, Мексика или Wistron InfoComm (Zhongshan) Corporation, Китай или All Technology (Zhongshan) Co. Ltd, Китай или Wistron InfoComm (Czech) s.r.o., Чешская Республика (на фото изображен монитор ЖК с диагональю 24 дюйма серии Z, производства Hewlett-Packard Co., США)

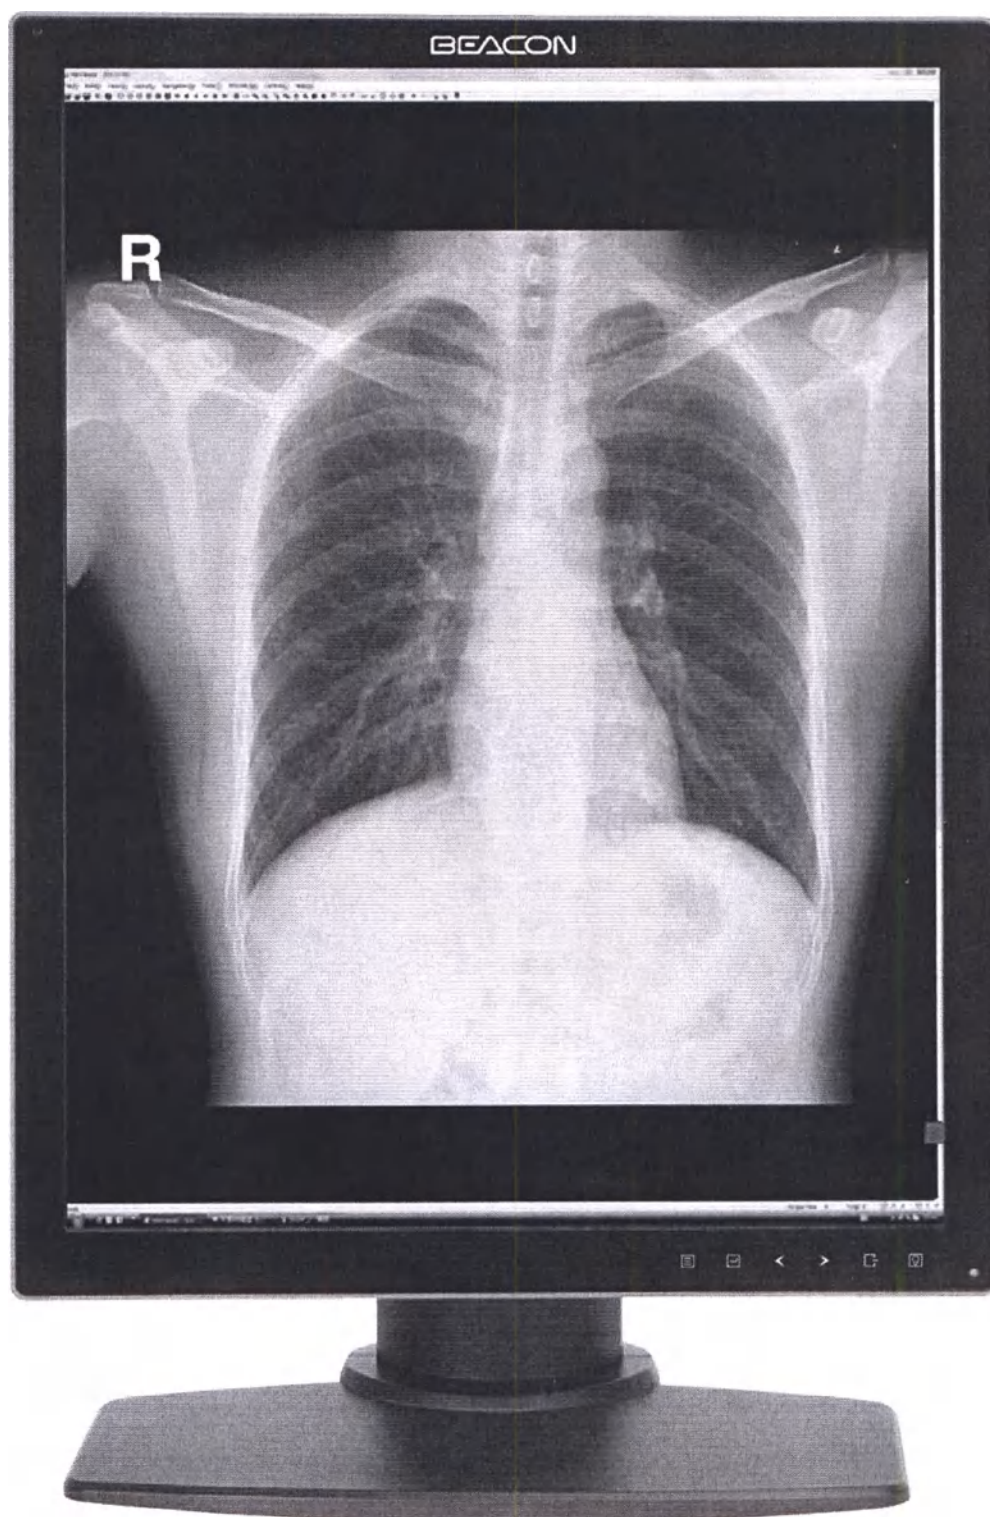


Монитор ЖК с диагональю от 19 до 32 дюймов Beacon,
производства Shenzhen Beacon Display Technology Co., Ltd, Китай

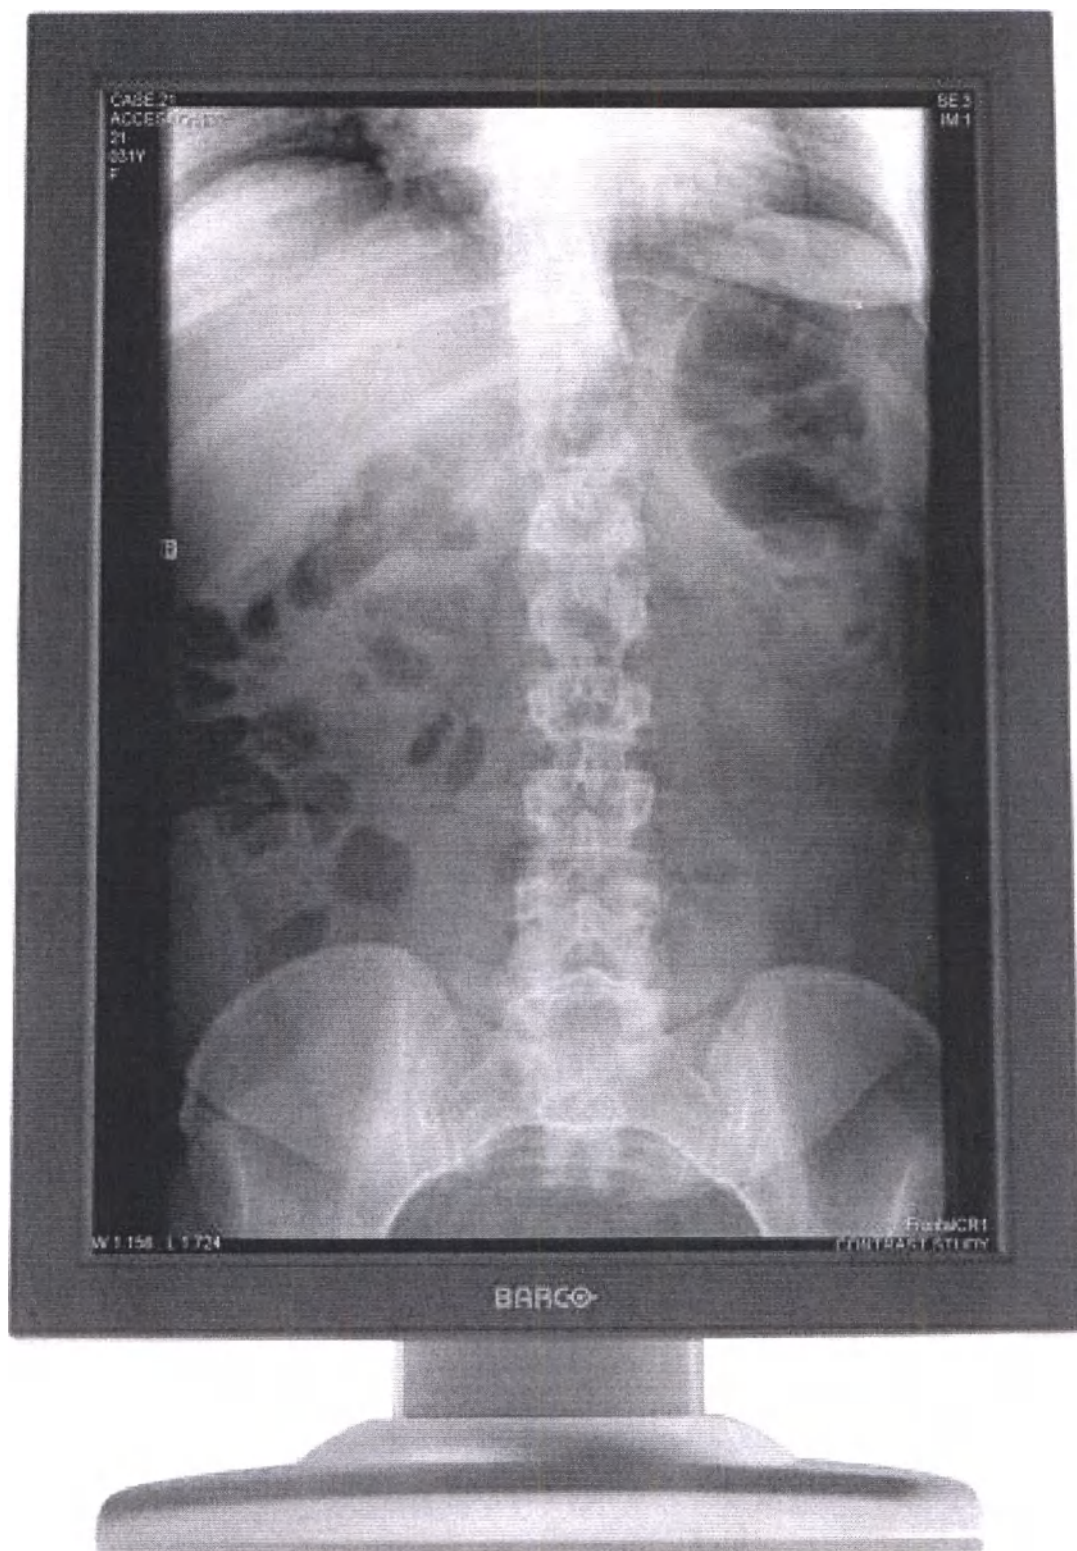


Монитор ЖК с диагональю от 19 до 32 дюймов Barco, производства Barco N.V., Бельгия

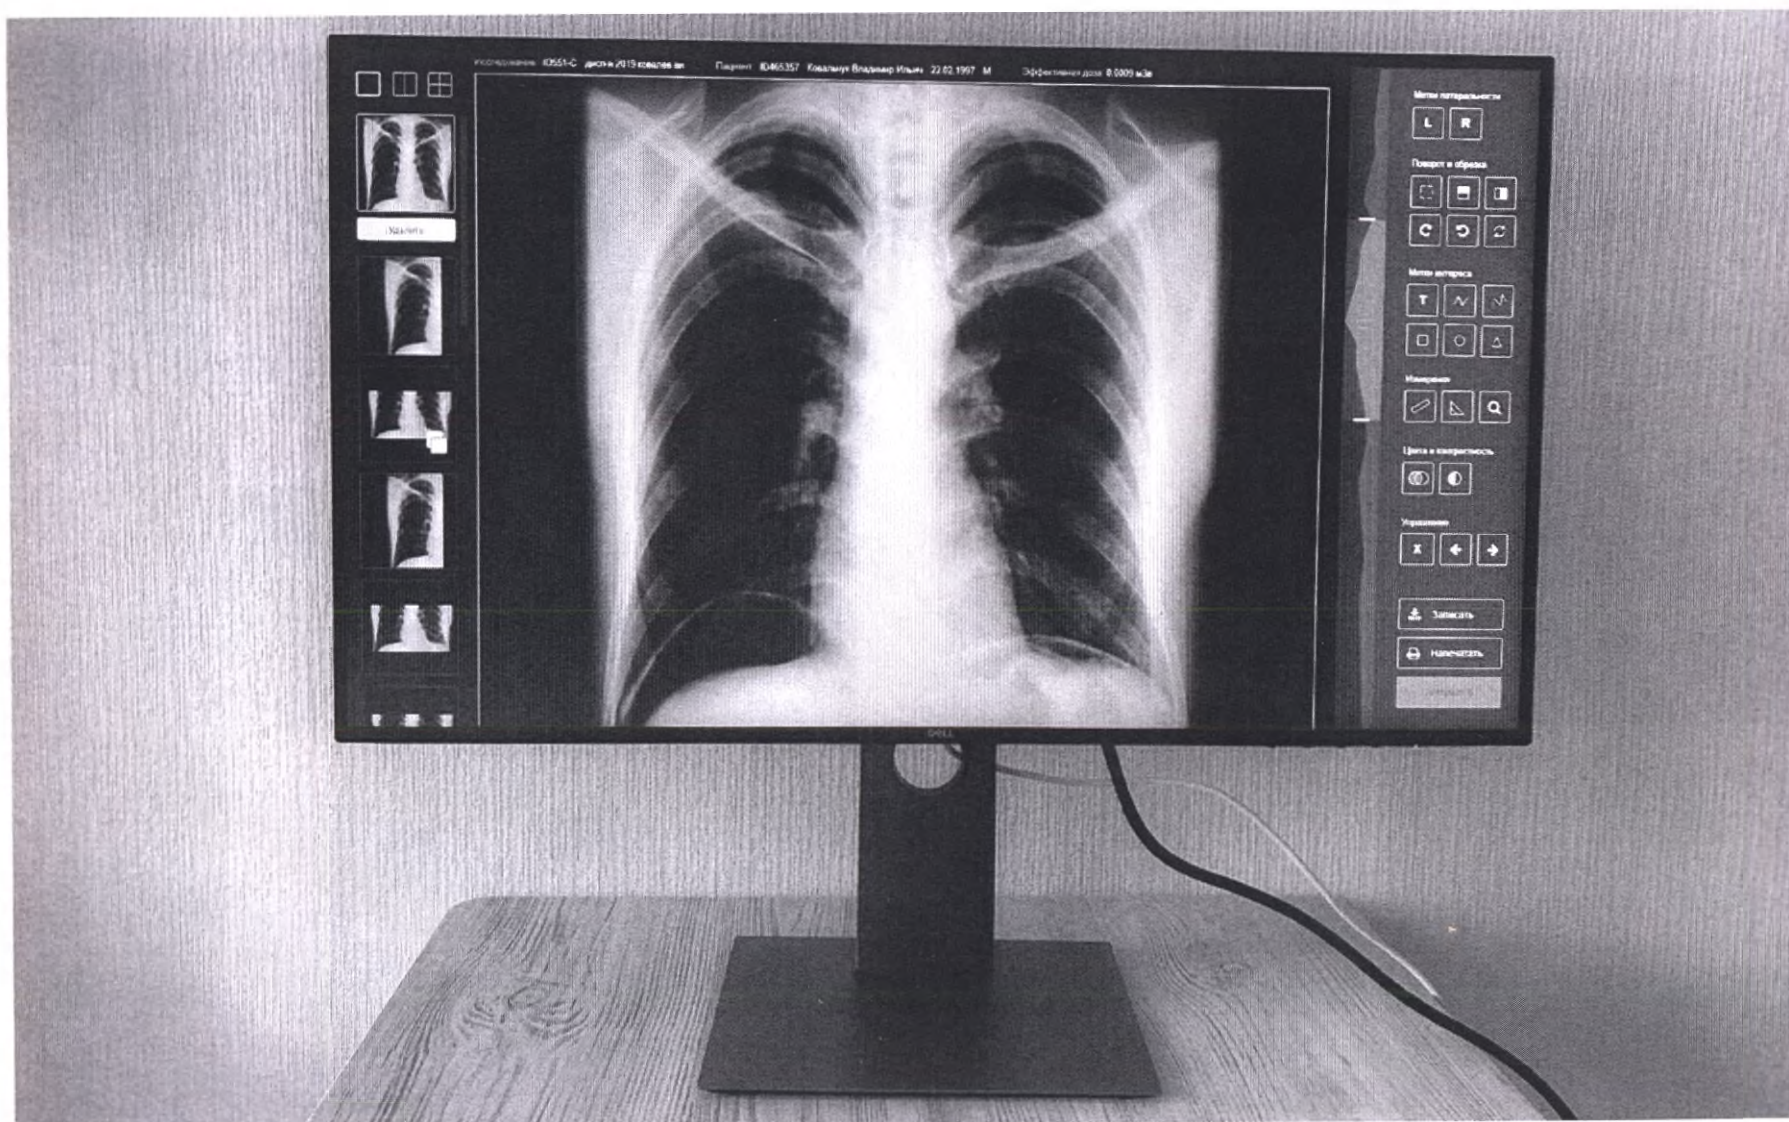

Монитор ЖК с диагональю от 19 до 32 дюймов DELL, производства DELL, Китай

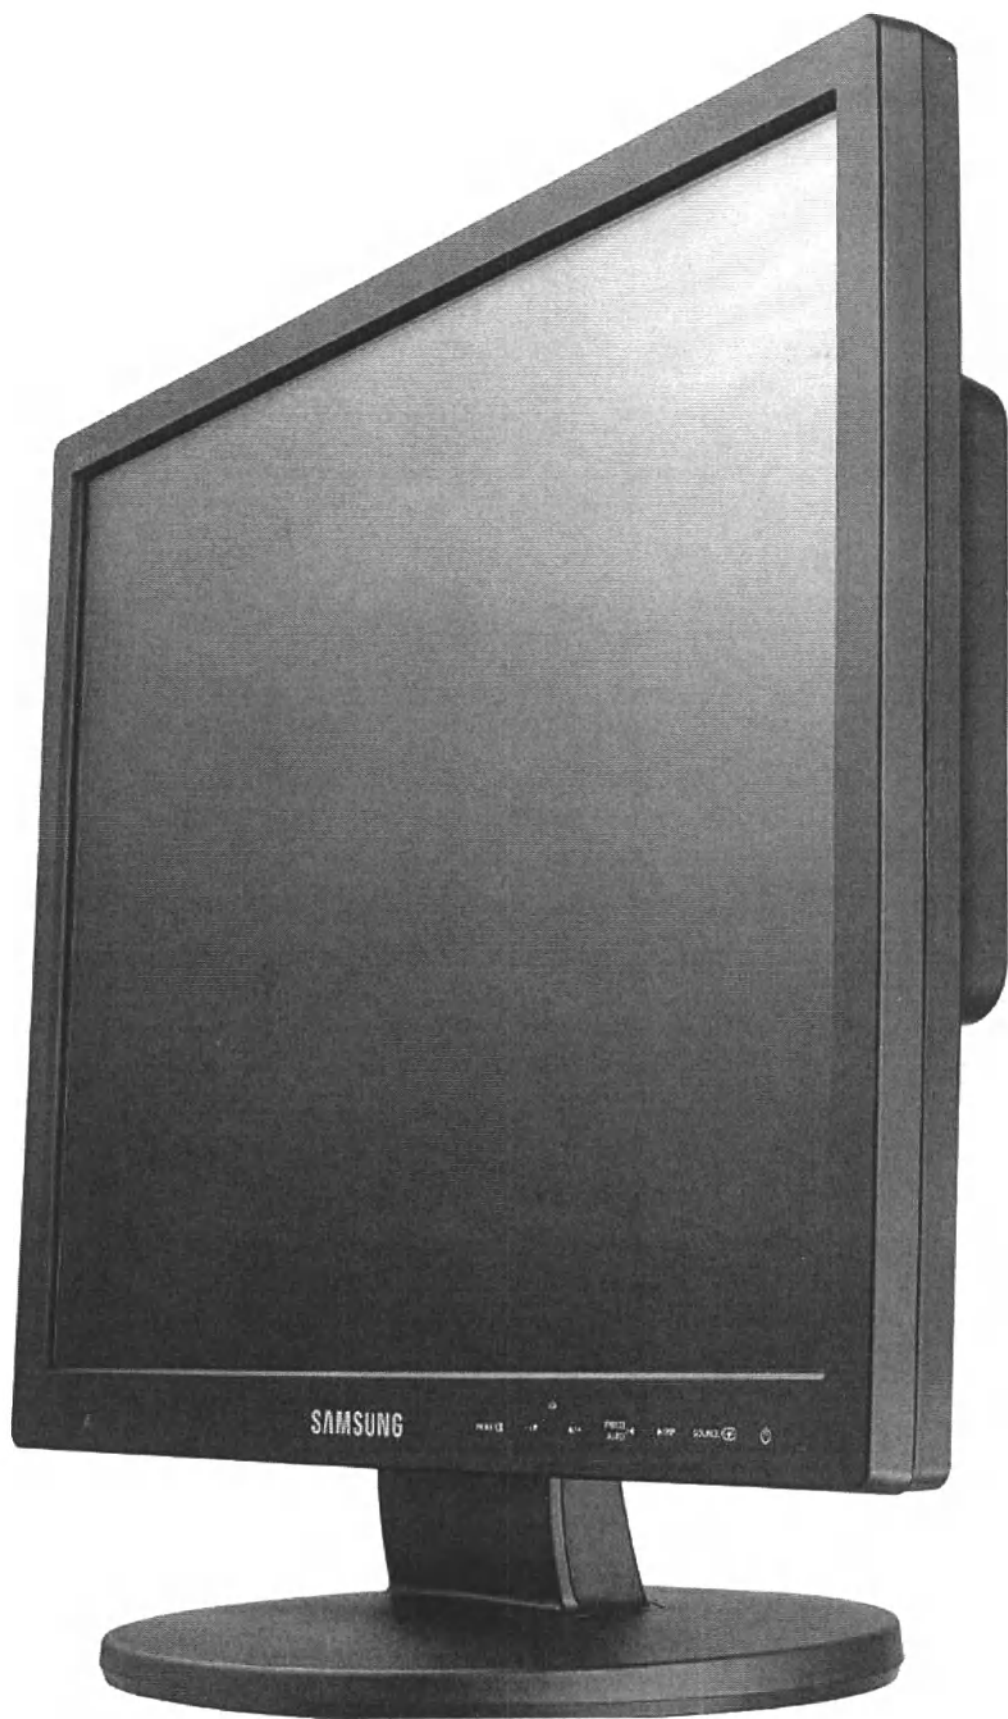


Монитор ЖК с диагональю от 19 до 32 дюймов Samsung, производства Samsung, Республика Корея

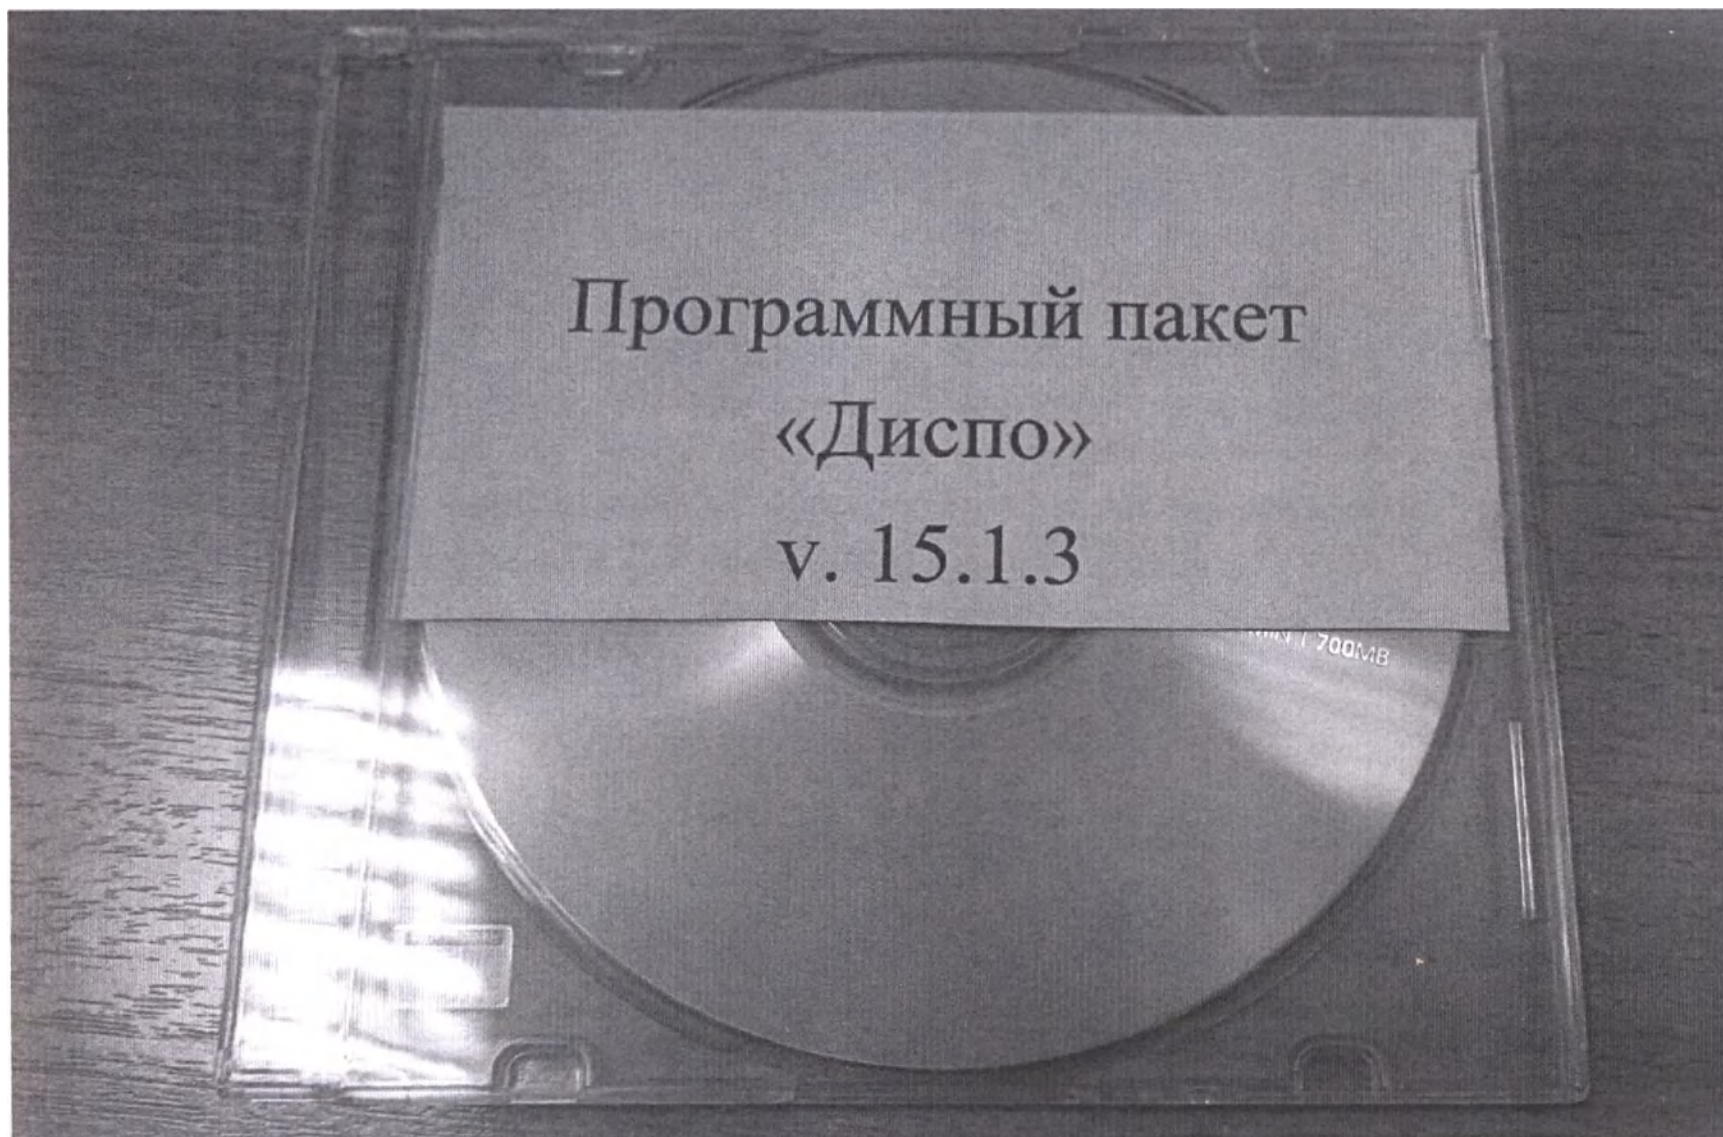


Программный пакет «Диспо», производства ООО «Лаборатория инноваций МТ», Россия



Программное обеспечение для работы с цифровыми медицинскими изображениями лучевой диагностики «КОРД-МТ», производства АО «МТЛ», Россия.

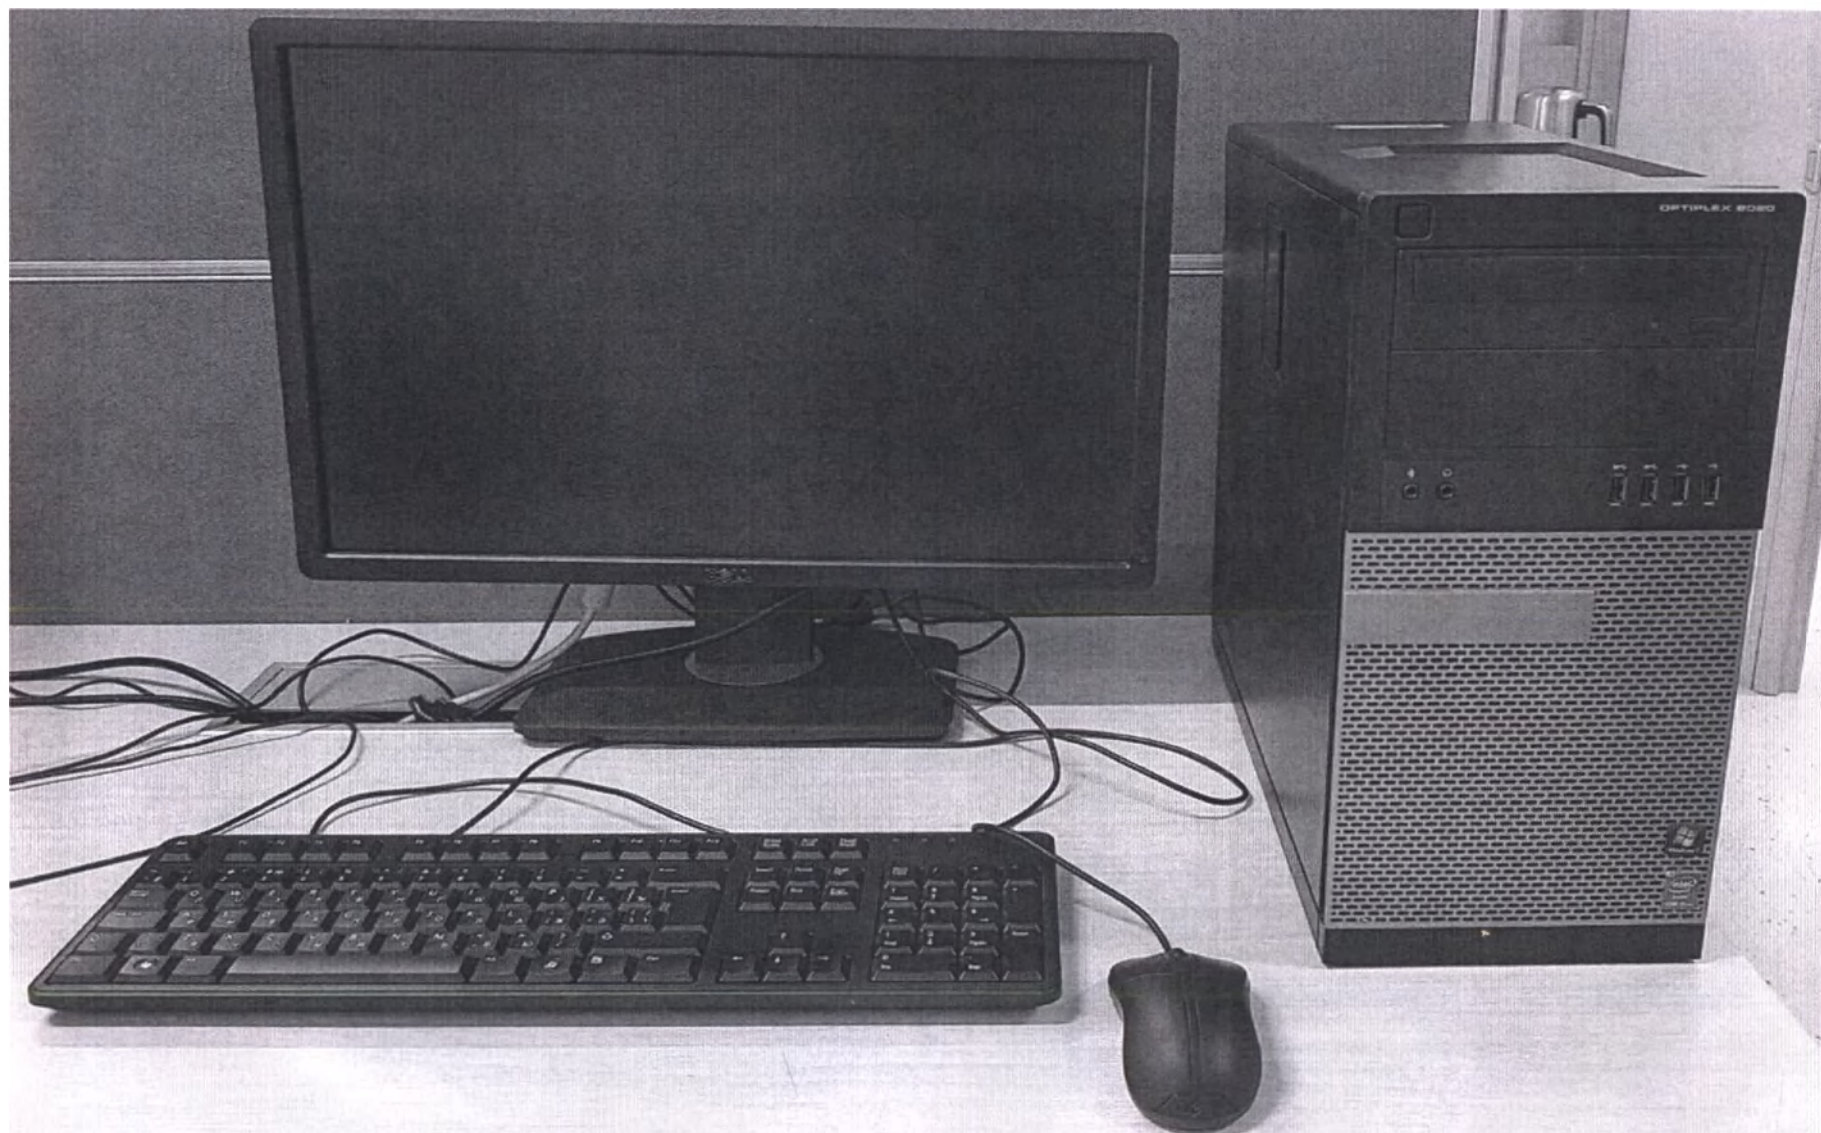


Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога «ДИАРМ-МТ-Плюс», производства АО «МТЛ», Россия

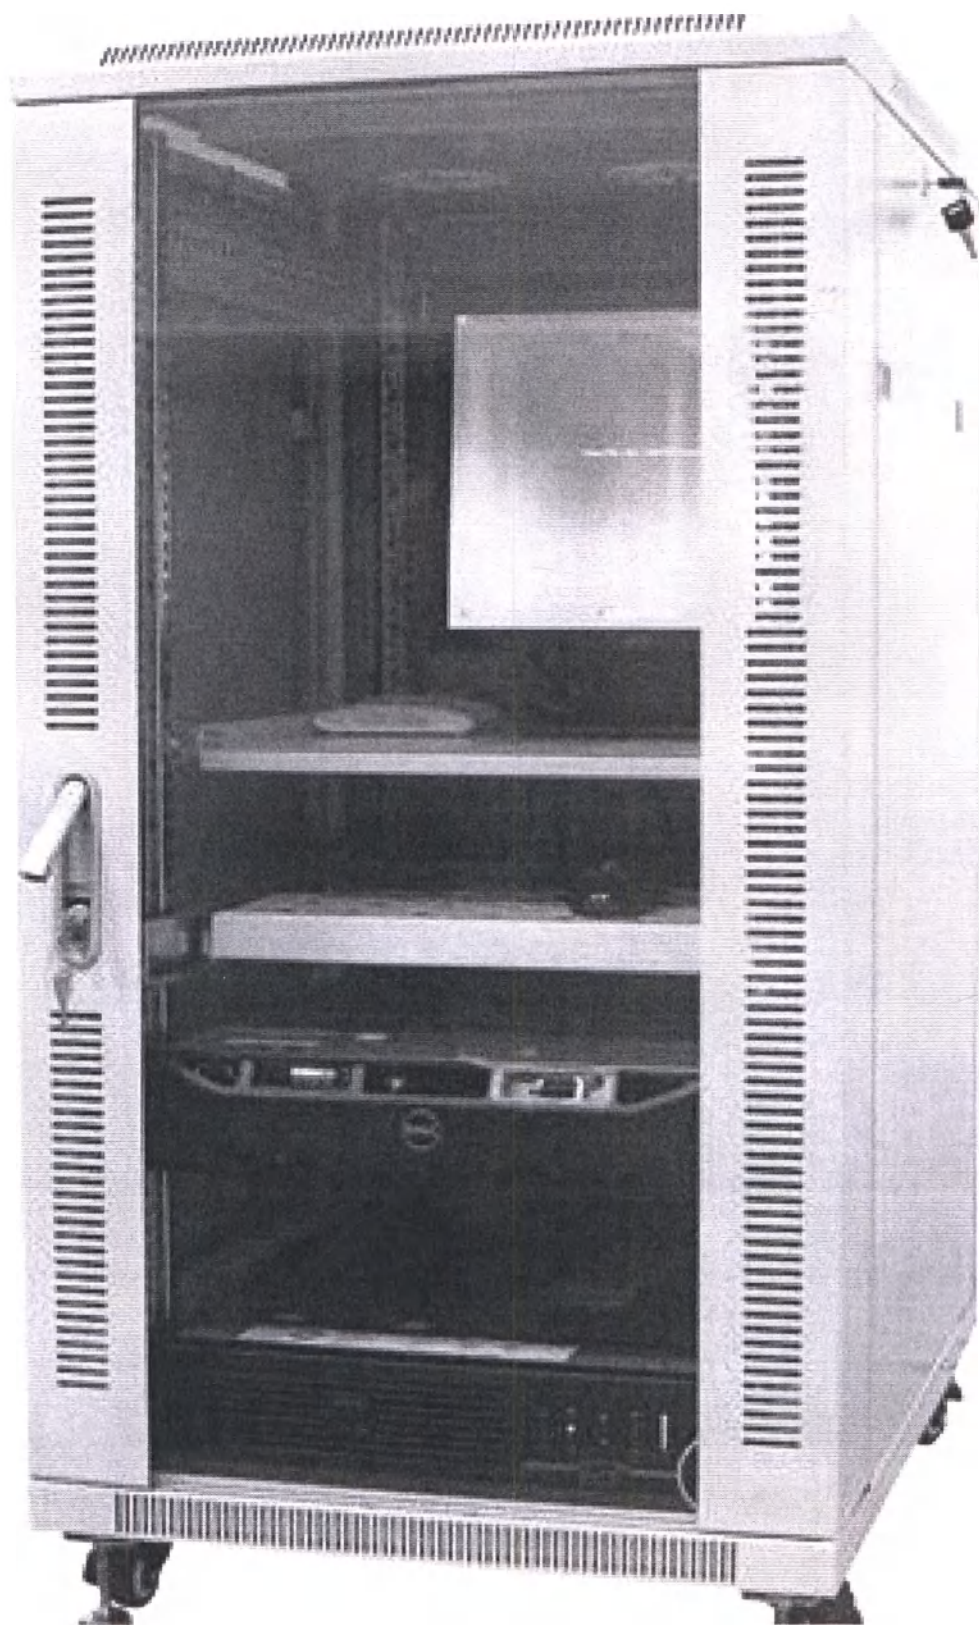

Радиологическая информационная система «ИнтеГРИС-МТ»,
производства АО «МТЛ», Россия

Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1, производства НПП «Доза», Россия

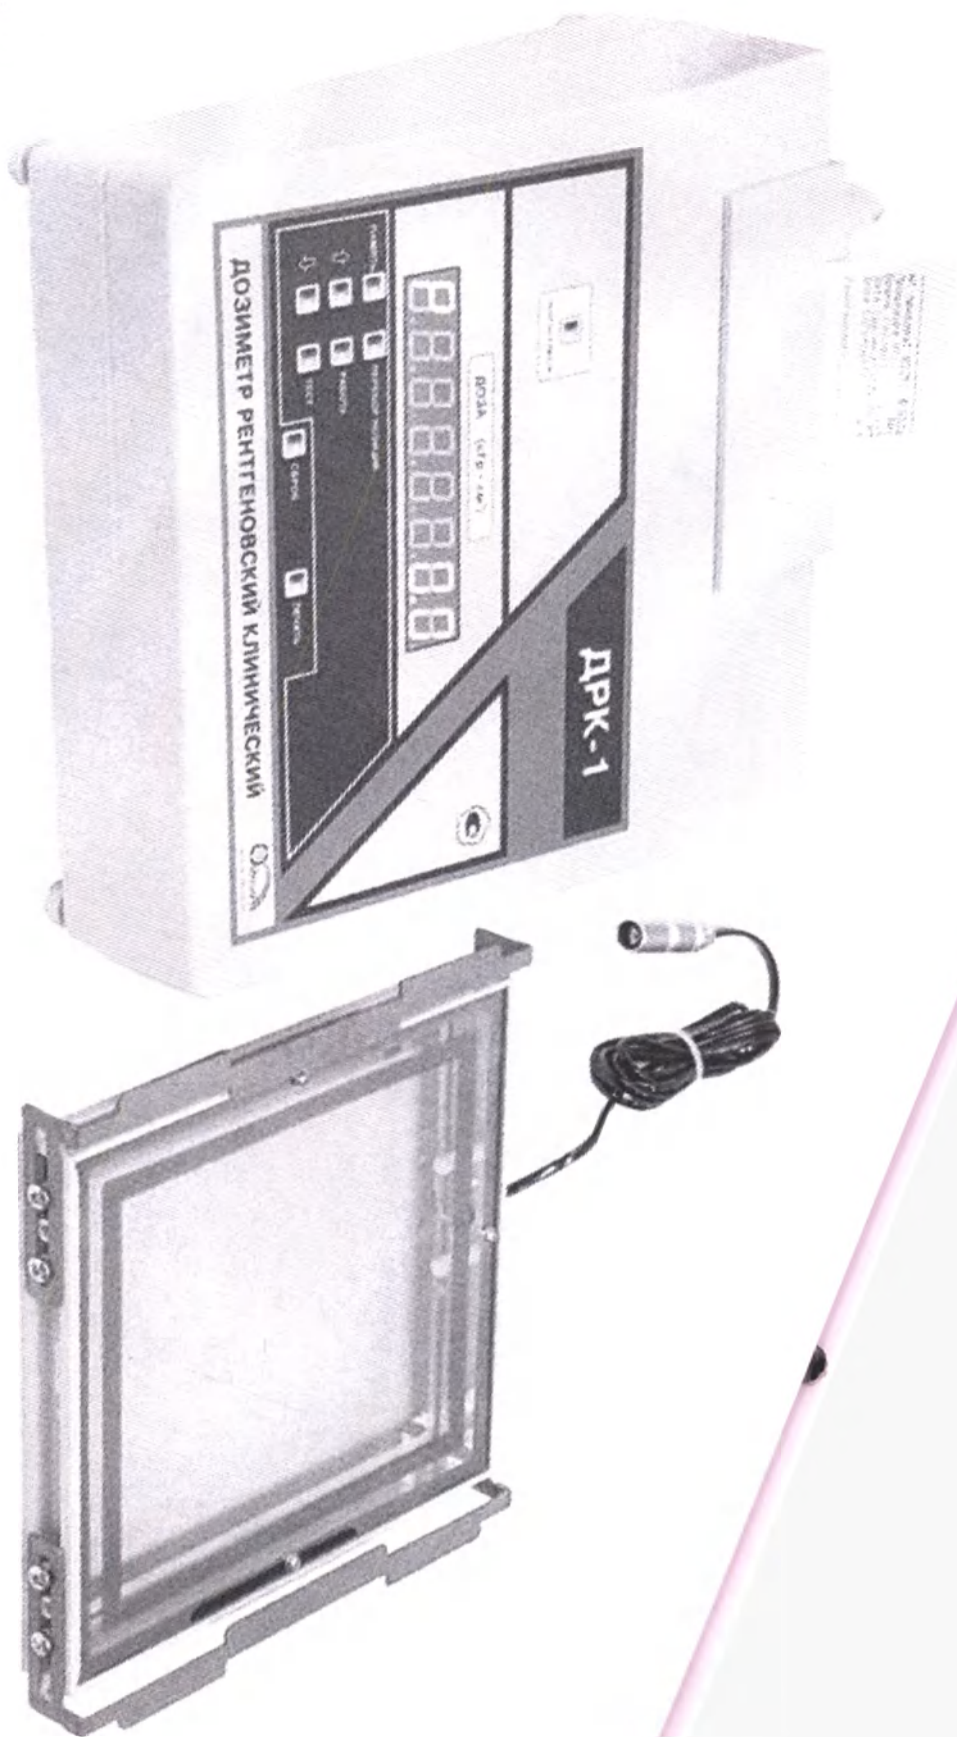



Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1М, производства НПП «Доза», Россия



Дозиметр клинический для контроля радиологических процедур серии VacuDap System, производства VacuTec, Meßtechnik GmbH, Германия.




Камера лазерная мультимедийная DRYVIEW 5950 Laser Imaging System с принадлежностями, производства Carestream Health, Inc., США.



Камера лазерная мультиматная DRYVIEW 5700 Laser Imaging System для печати медицинских изображений, с принадлежностями, производства Carestream Health, Inc., США




Камера лазерная мультиформатная TRIMAX TX55 Laser Imaging System с принадлежностями, производства Carestream Health, Inc., США.

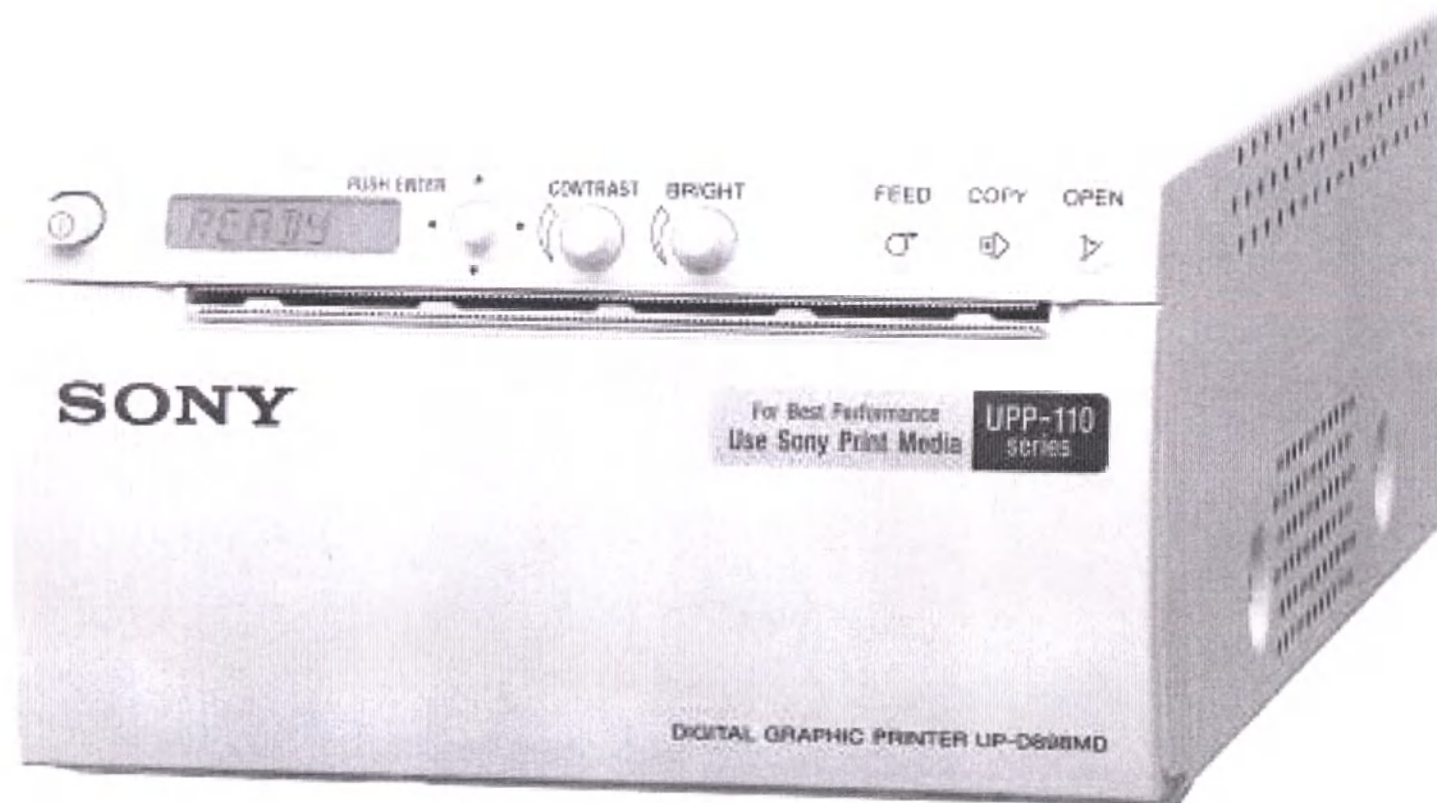

Устройство для печати монохромных медицинских изображений, производства Sony Corporation,
Япония




Камера лазерная мультиматная UP-DF750 для печати медицинских изображений, производства Sony Corporation, Япония

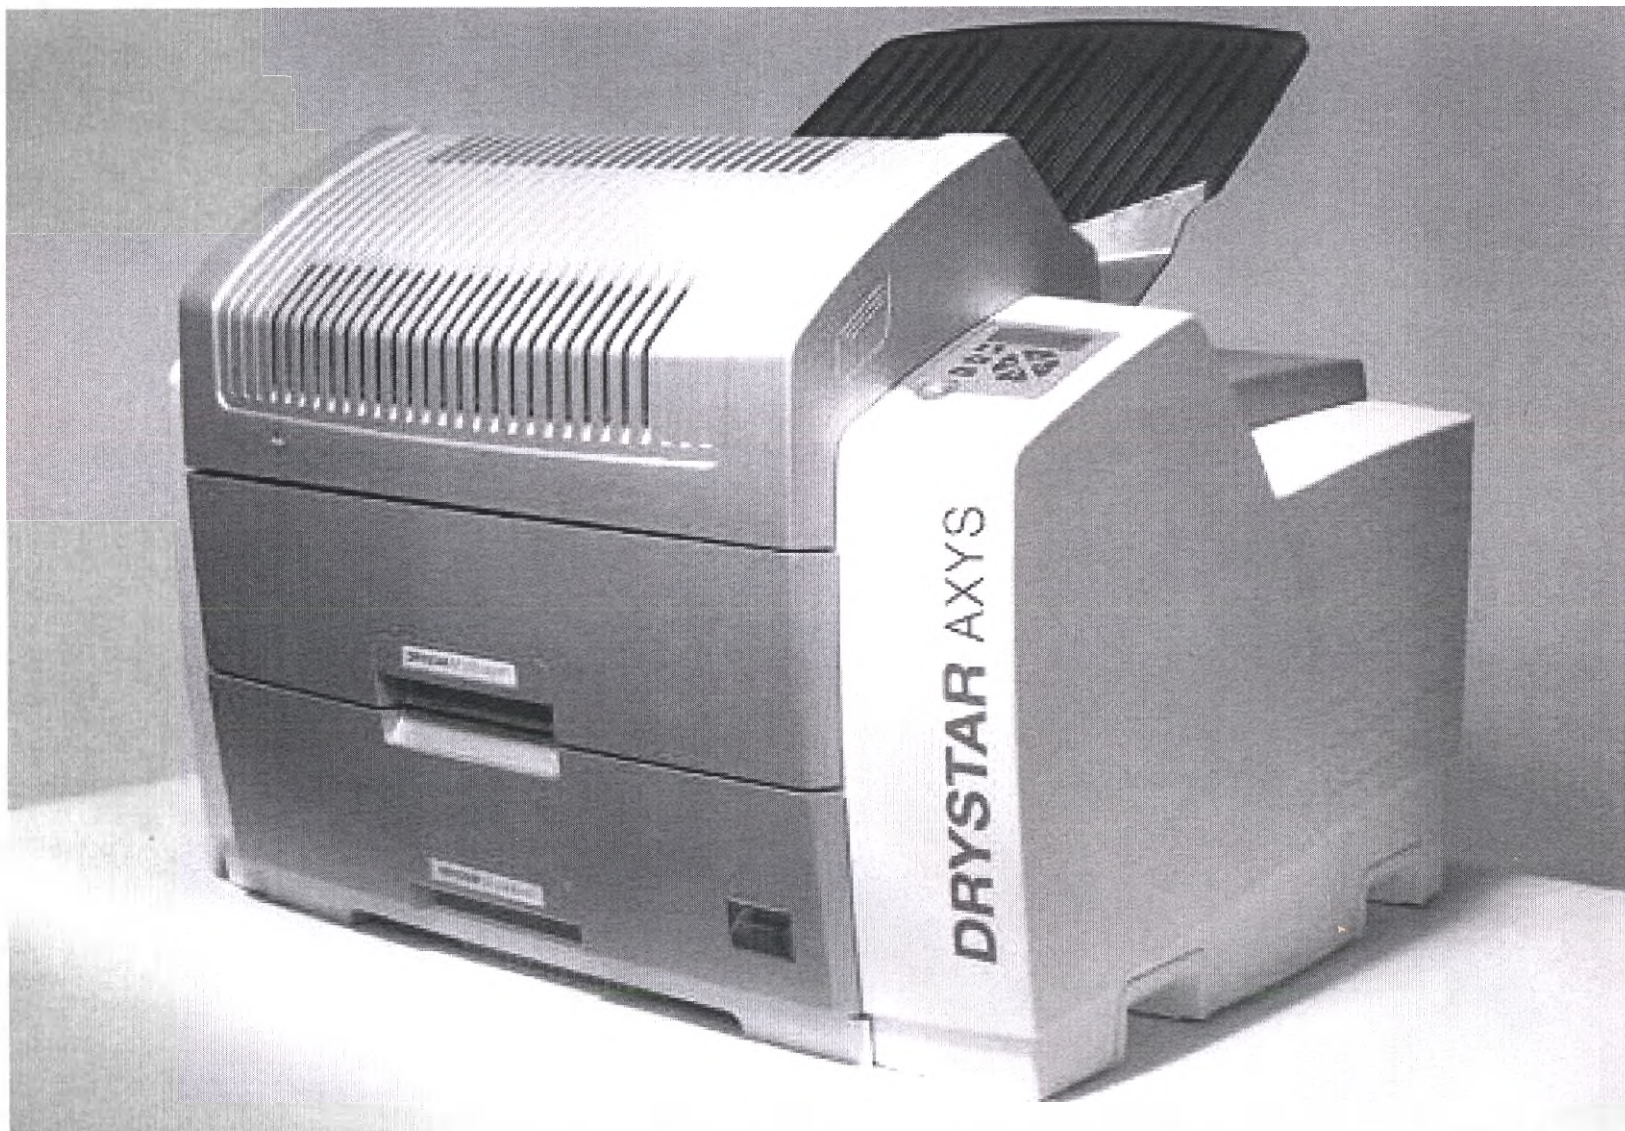


Камера мультиматная термографическая Drystar AXYS с принадлежностями, производства Agfa N.V., Бельгия




Камера мультиматная термографическая Drystar 5302 с принадлежностями, производства Agfa N.V., Бельгия

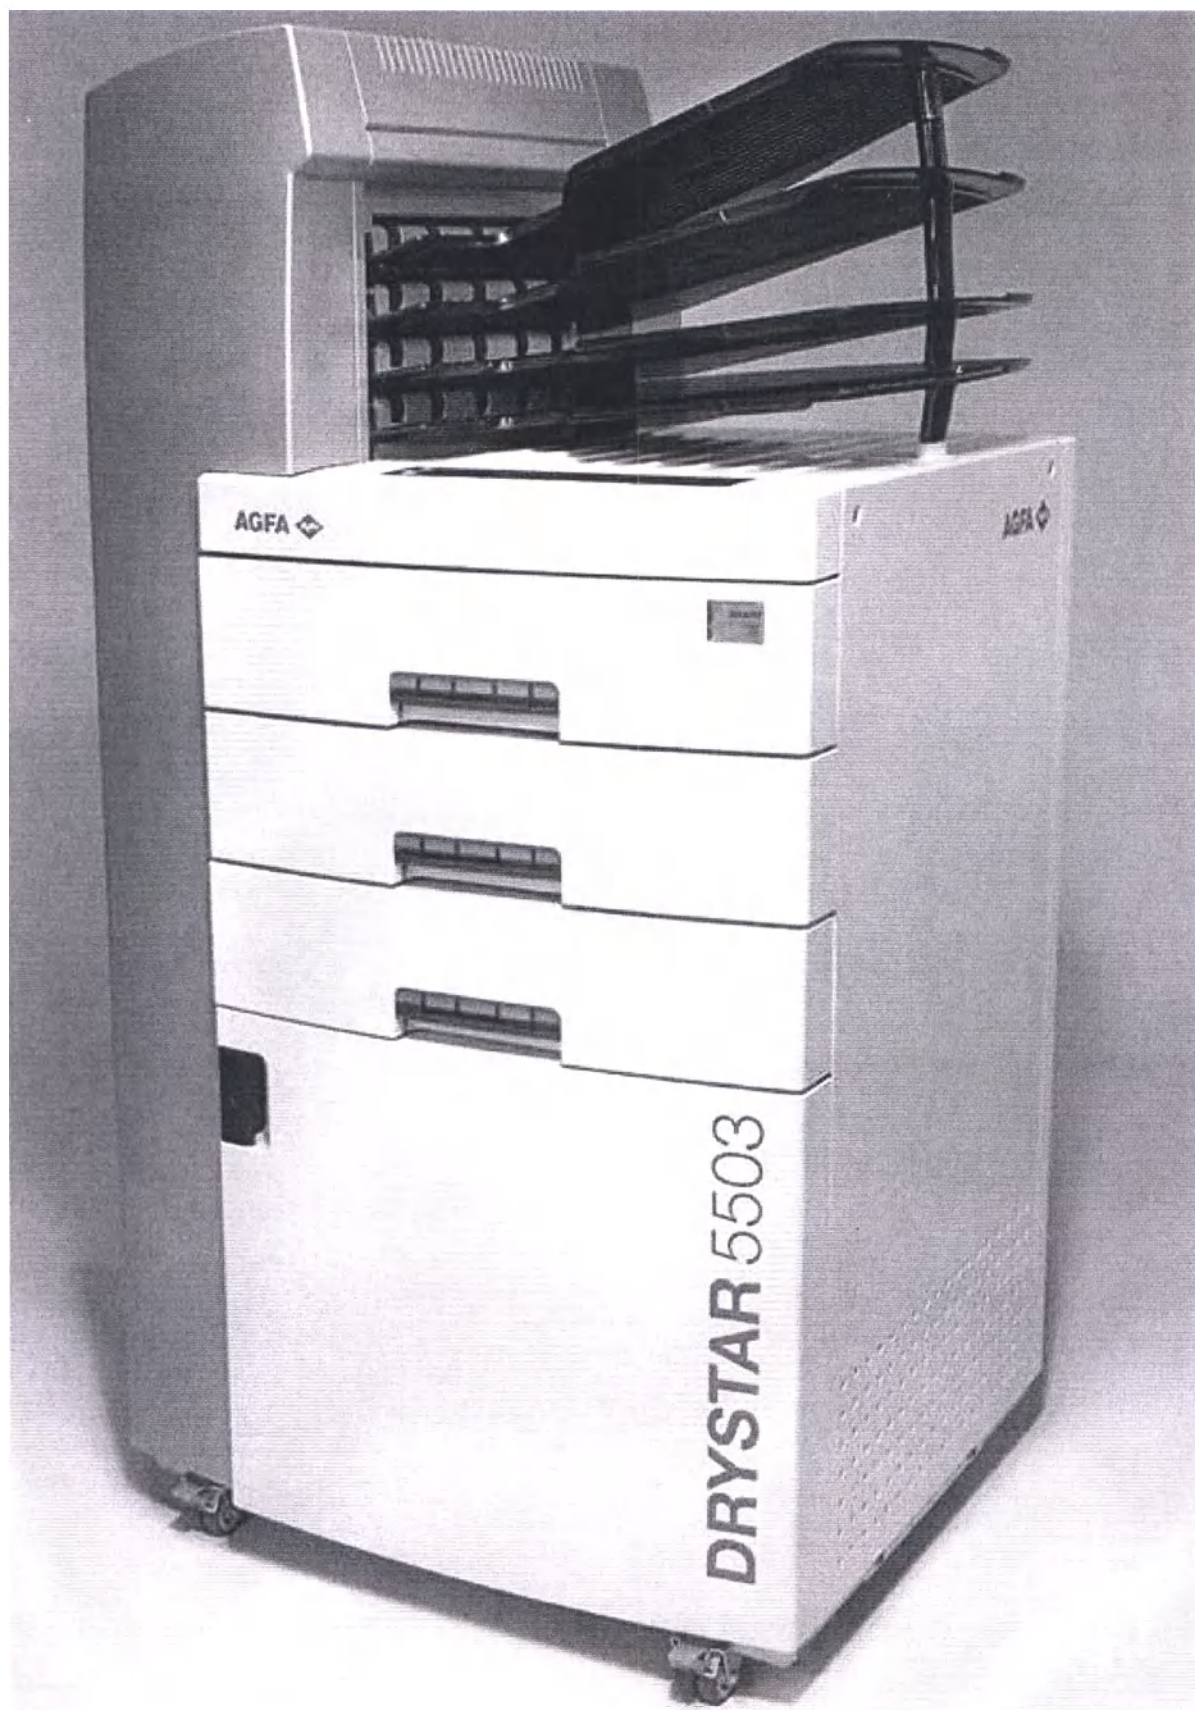

Камера мультиматная термографическая Drystar 5503 с принадлежностями, производства Agfa N.V., Бельгия

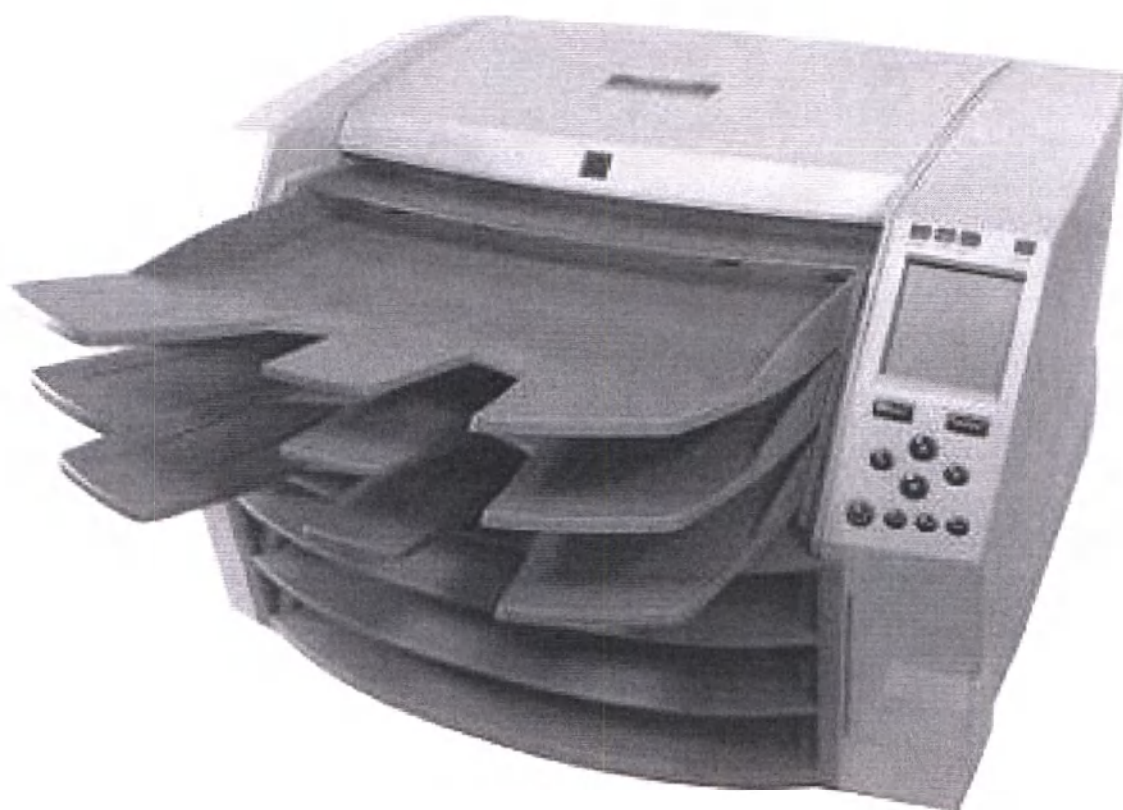

Устройство печати цифровых диагностических медицинских изображений «Horizon», исполнения: Ci, Ci-s, Ci-RAD, G, GS, GS-s, GS-RAD, G1, G2, XL, SF, производства Codonics, Inc., США.

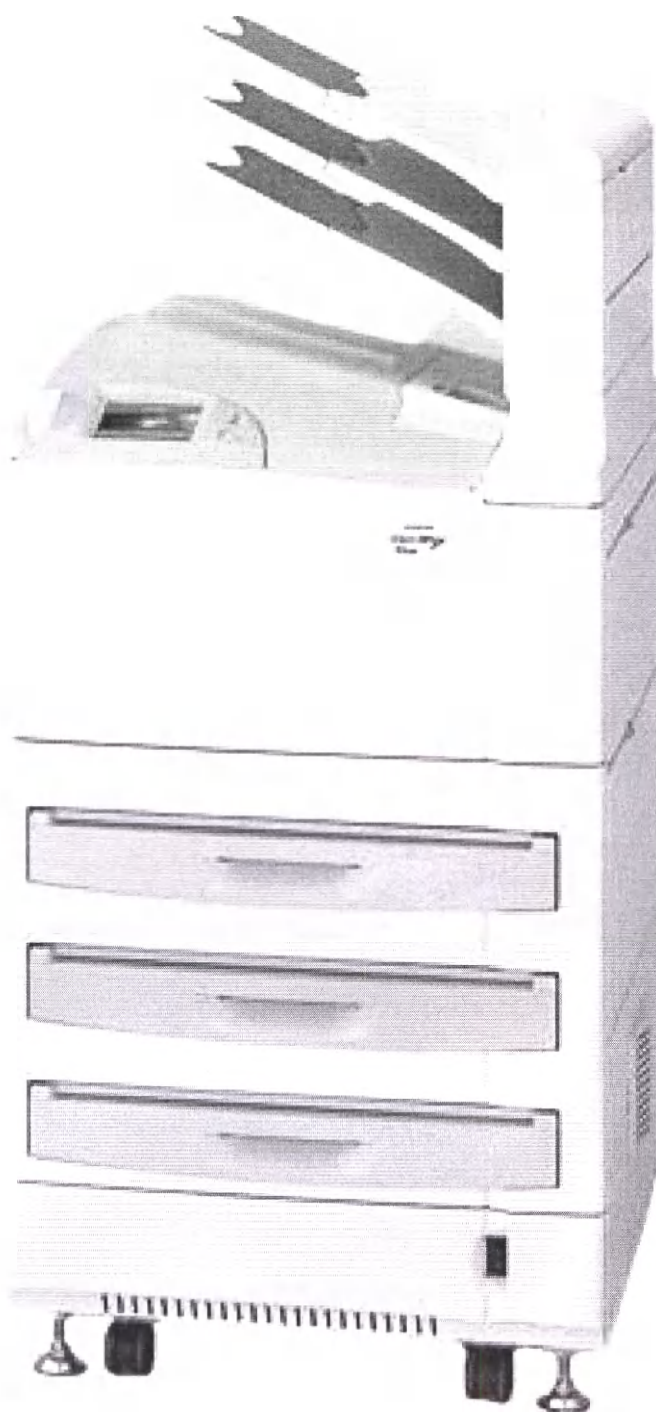


Камера медицинская лазерная мультиформатная DRYPIX 4000
исполнения DRYPIX Plus с принадлежностями, производства
FUJIFILM Corporation, Япония



Камера медицинская термографическая мультiformатная DRYPIX 2000 исполнения DRYPIX Lite с принадлежностями, производства FUJIFILM Corporation, Япония



Носители бумажные и пленочные для термической печати диагностических медицинских изображений: Direct Vista, Chroma Vista производства, производства Codonics, Inc., США

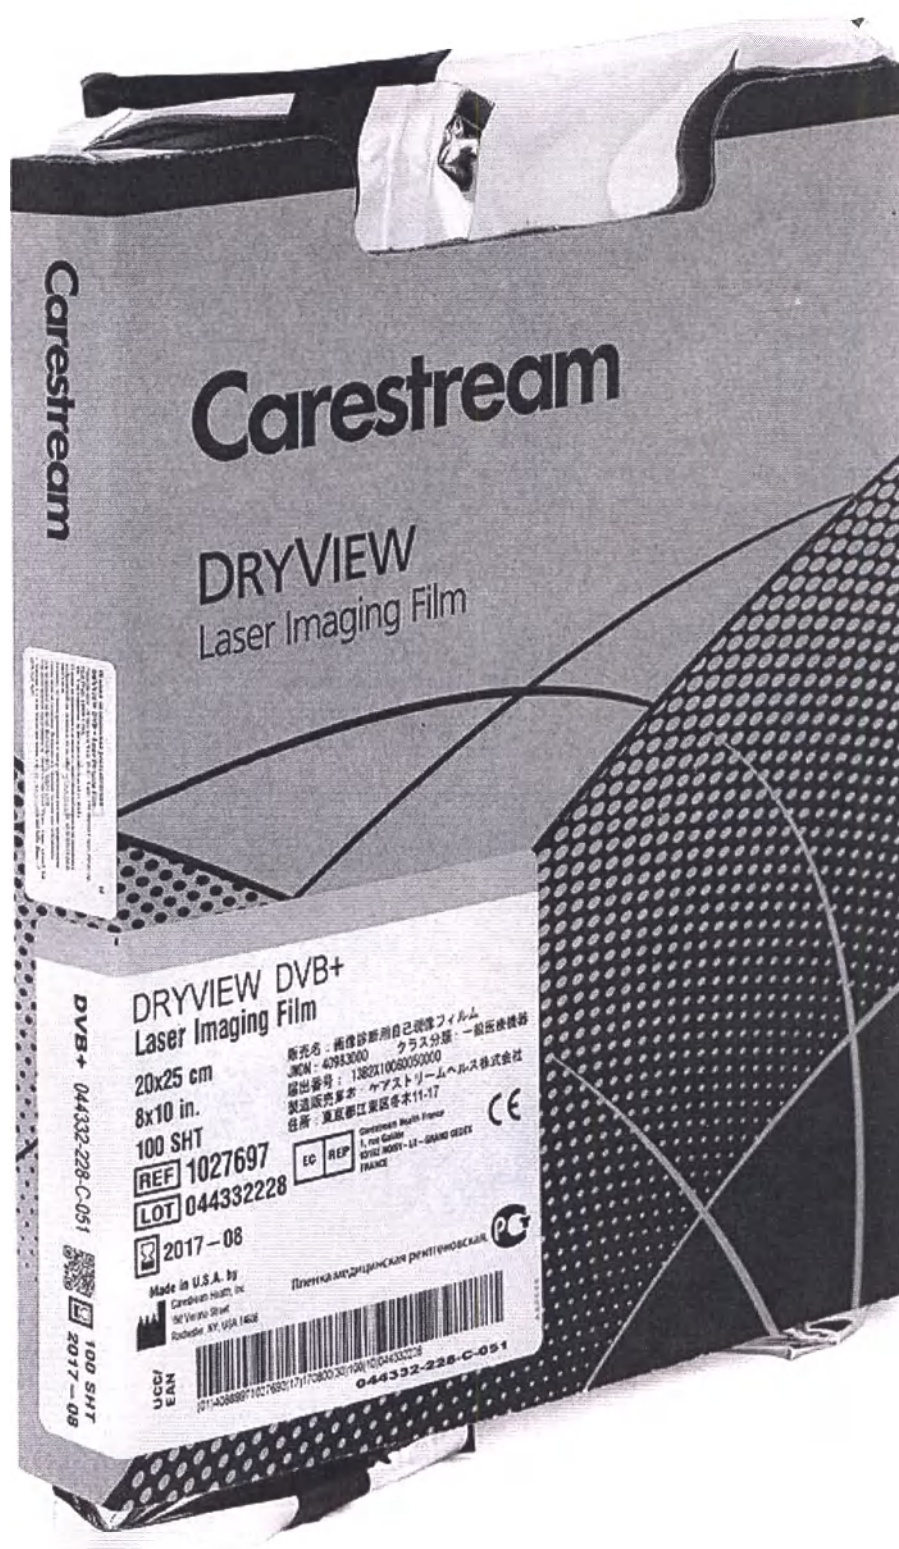


Пленка медицинская рентгеновская, производства Carestream Health, Inc., США



Пленка медицинская термографическая и лазерная: DI-AT, DI-HT, DI-HL, DI-HL2, DI-AL, DI-ML, производства FUJIFILM Corporation, Япония



Пленка термографическая медицинская Drystar DT 10 B,
производства Agfa N.V., Бельгия

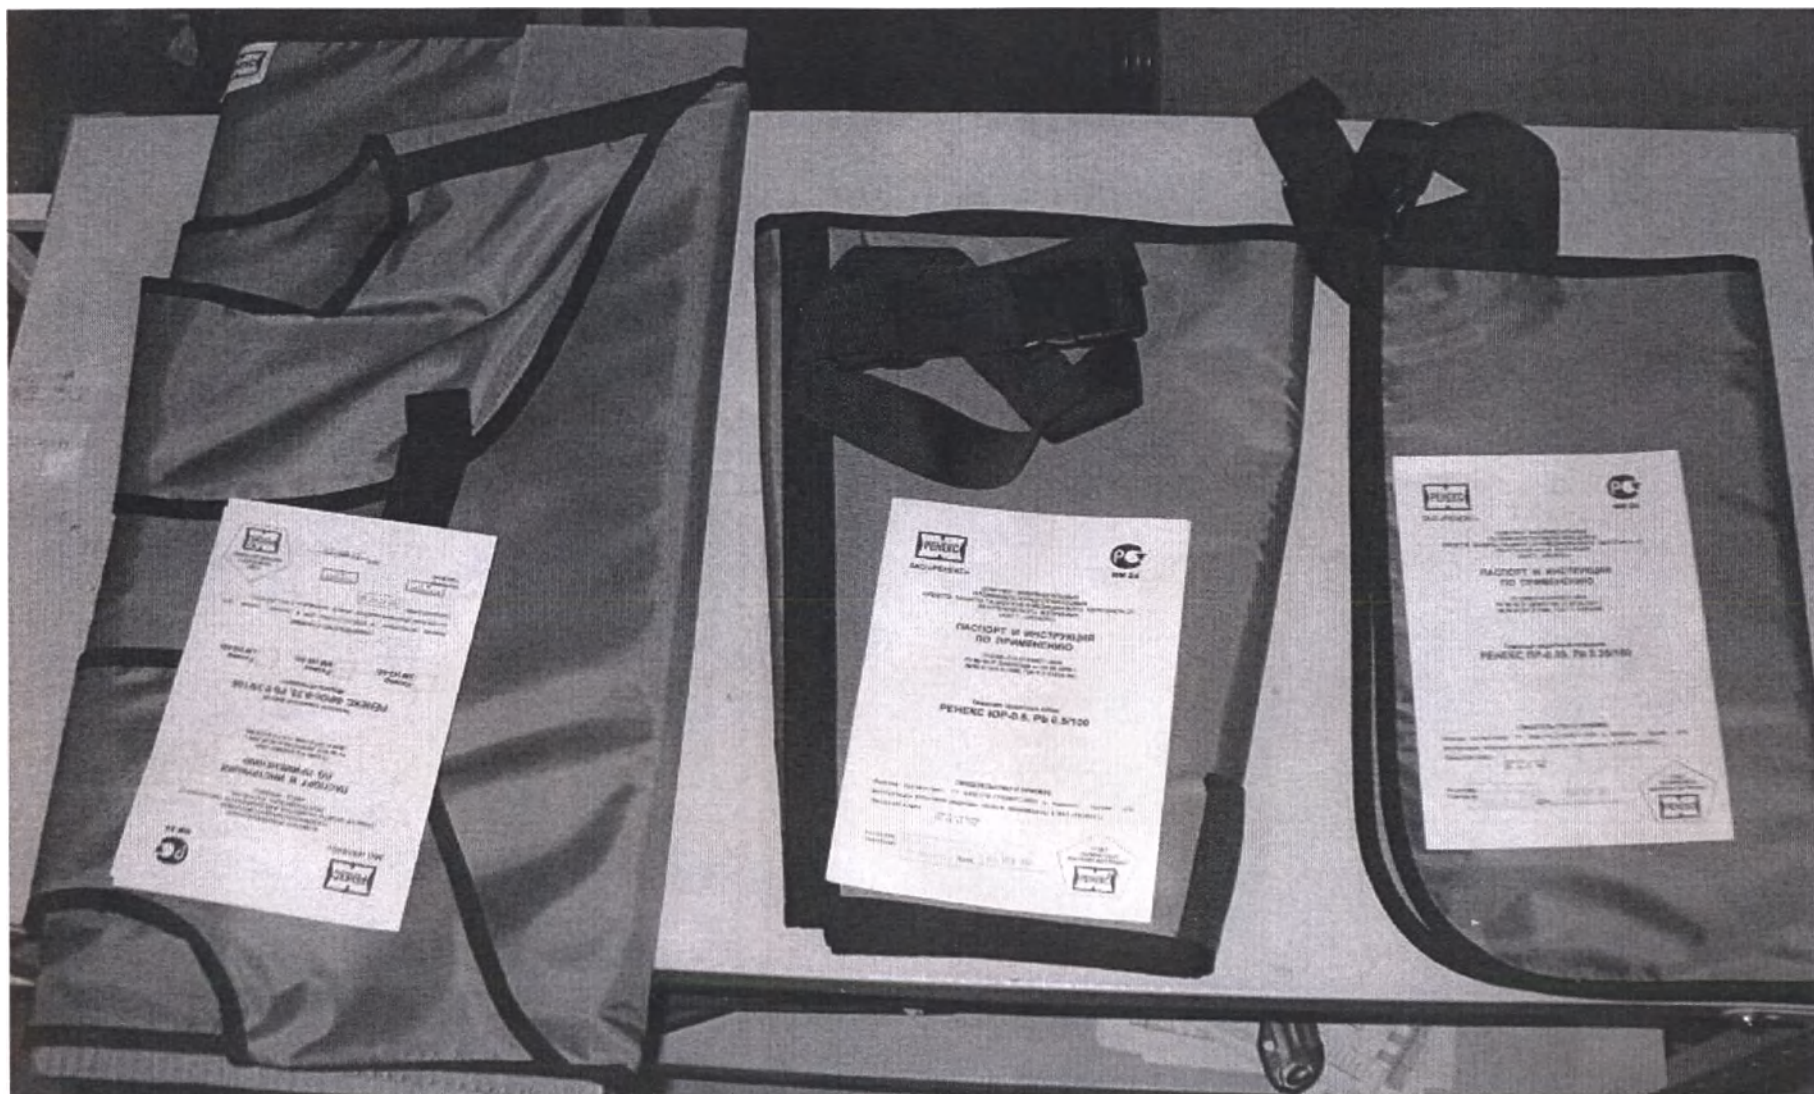

Комплект индивидуальных поливинилхлоридсвинцовых средств защиты пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения КИСЗ-«РЕНЕКС» по ТУ 9398-010-21009821-2004, производства ЗАО «Ренекс», Россия



Окно рентгенозащитное серии МАСО, производства Hans O.Mahn & Co. KG, Германия или РЕНЕКС ОСПЗ, производства ЗАО «Ренекс», Россия



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 62


шестидесяти двух листах

Генеральный директор
ООО «ВКО Медпром»

Мещеряков О.В.

**Макет маркировки и
упаковки медицинского
изделия Аппарат
флюорографический
Р-600 «Флюоро»**


ООО
«ВКО Медпром»

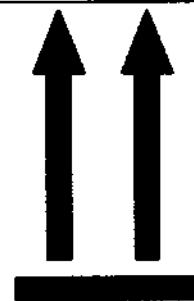

Аппарат флюорографический Р-600 «Флюоро»

Серийный номер:

Год и месяц упаковывания:

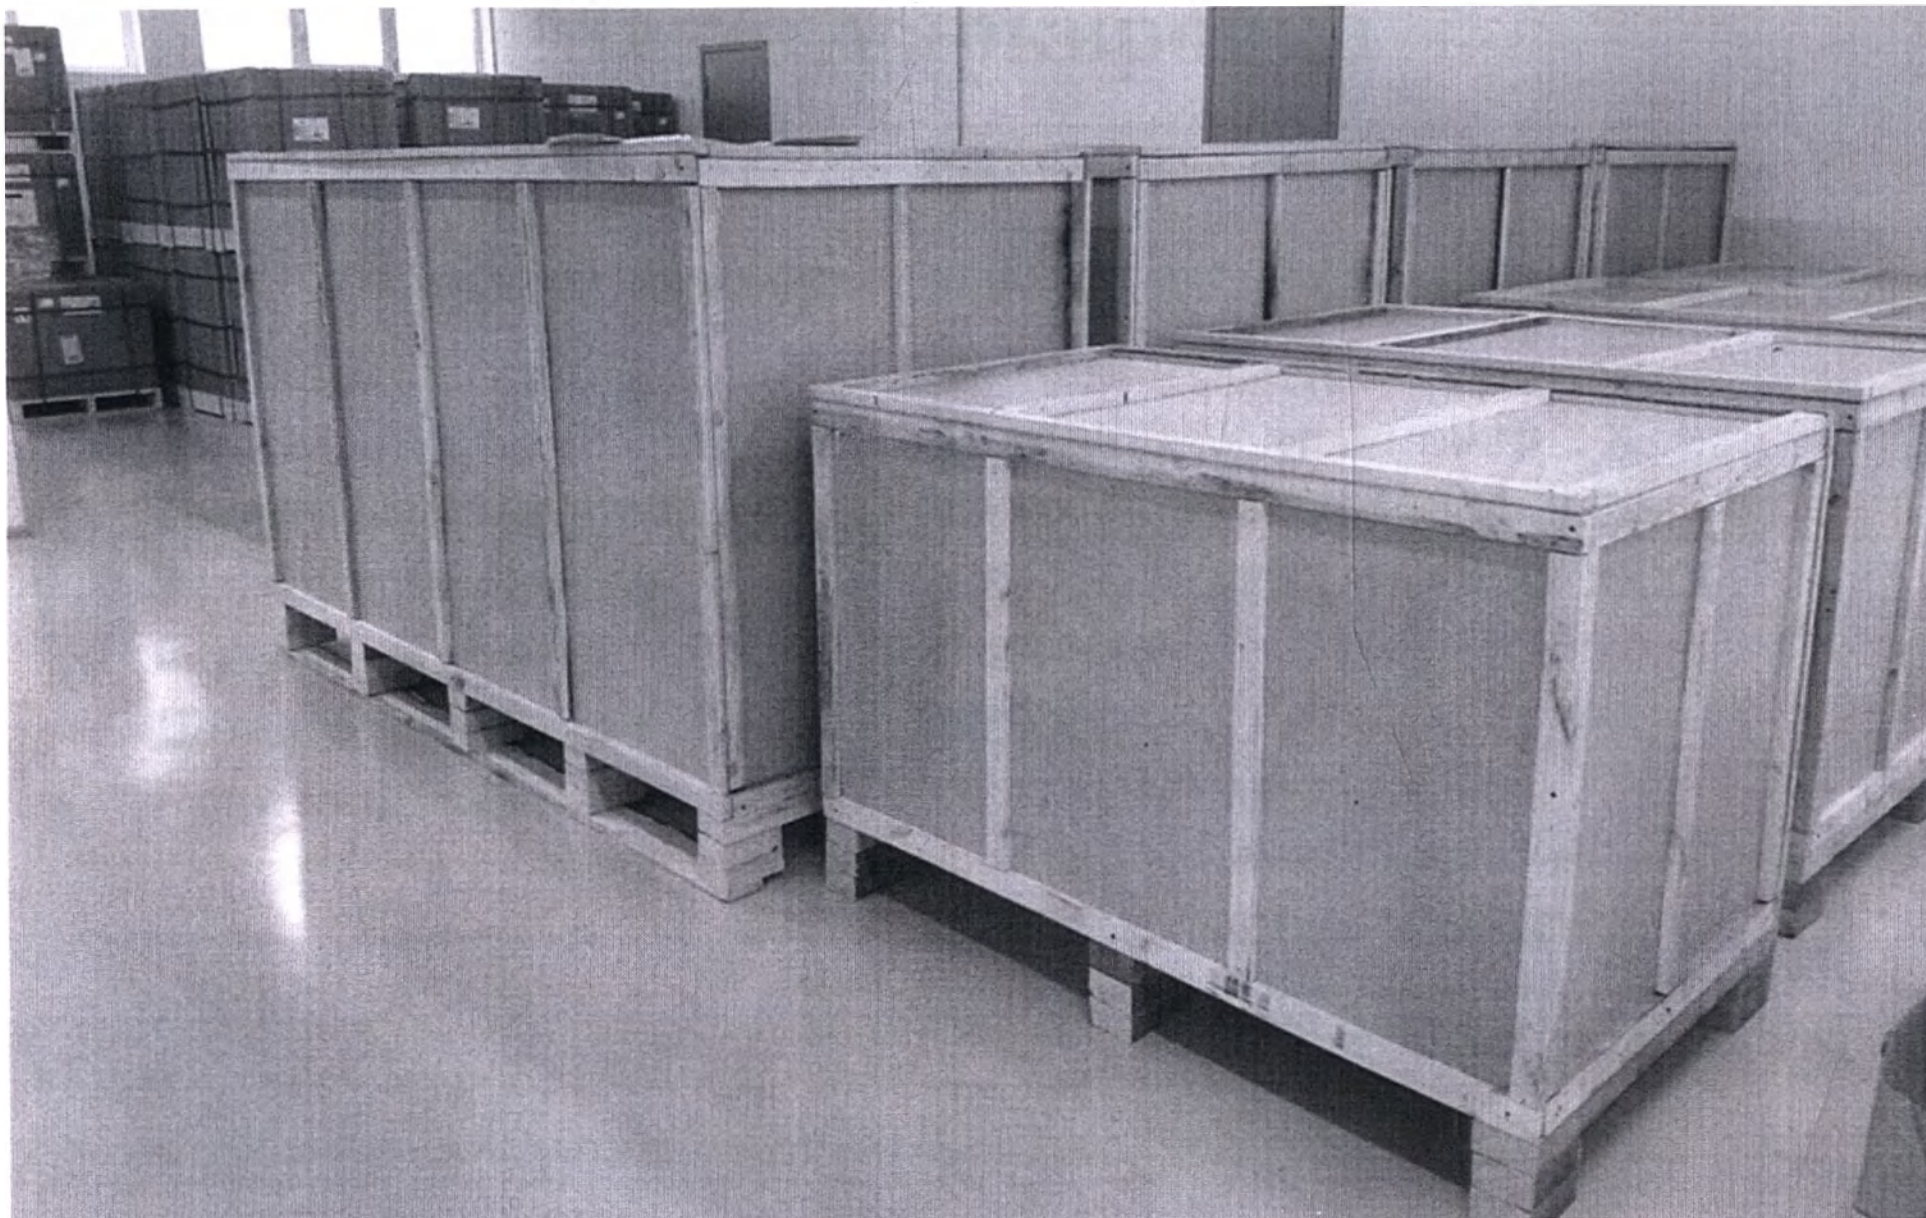

В зависимости от комплектации аппарат может быть упакован от 2 до 6 ящиков. В ящиках 3-6 расположены: АРМ врача, радиологическая информационная система, устройство печати, крепление для детей и другие изделия поставляемые по согласованию с заказчиком. Изделия поставляются в оригинальной упаковке производителей.

Макет маркировки



Аппарат флюорографический Р-600 «Флюоро»

Обозначение	У2-А0000-0Х, исполнение Х
Технические условия	26.60.11-004-67684634-2020
Рег. удостоверение	ХХХ ХХХХ/ХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ
Серийный номер	Р-ХХ-ХХХ
Дата производства	ХХ.ХХХХ
Производитель	ООО «ВКО Медпром»



3N~ 380/400 В, 50 Гц, 100 кВ·А



Х – значения указываются при поставке и после получении Регистрационного удостоверения

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 4

четыре листах

Генеральный директор
ООО «ВКО Медпром»



С.В. Яков