



**ЦЕНТР
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
СООТВЕТСТВИЯ**

Общество с ограниченной ответственностью
«Центр Подтверждения Соответствия»
123308, г. Москва, ул. Мневники, дом 3, корпус 1
ИНН/КПП 7725790126/773401001
ОГРН 1137746368869
Тел/факс +7 495 532 92 10,
эл. почта: info@ctrps.ru

**Фотографические изображения медицинского изделия
Катетеры для консоли внутрисердечной криоабляции
SMARTFREEZE, варианты исполнения**



Рис. 1 Катетер баллонный для криоабляции POLARx, диаметр катетера 11,8 F (3,93 мм) во вторичной упаковке

Boston
Scientific


POLARx™ **SHORT TIP**

11.8F

Cryoablation Balloon Catheter

Cateter balon para crioablación. Cathéter à ballonnet pour cryoablation.
Kryoablations-Balloonkatheter. Catetere per crioablazione a palloncino.
Cryoablationballoonkatheter. Ballonkatheter til kryoablation. Κρυοαβλακτικός μπαλονκάθετηρ.
Cateter de Balão para Crioablação. Ballongkateter för kryoablation. Kryoablačios ballonkateter.
Kryoablačni balonkový katétr. Cewnik balonowy do kryoabłacji. Ballongkateter för kryoablasjon.
Kryoablasjon Balon Kateteri. Kryoablastopallokatetri. Cateter cu balon pentru crioablație. Balónikový
katéter na kryoablaciu

Contents (1)



Consult instructions
for use.



CAUTION

Attention: Consult

ACCOMPANYING DOCUMENTS.



Keep Away from Sunlight



Keep Dry



Non-Pyrogenic



Humidity
Immune

GTIN

08714729992561

LOT

25766486

REF

Catalog No.

M004CRBS2000

Use By

2021-06-04

Internal BSC Bar Code



X232386-01A

Boston Scientific
POLARx™
11.8F

GTIN 08714729992561

REF M004CRBS2000

REF 25766486

Boston Scientific
POLARx™
11.8F

GTIN 08714729992561

REF M004CRBS2000

REF 25766486

Boston Scientific
POLARx™
11.8F

GTIN 08714729992561

REF M004CRBS2000

REF 25766486

CE 0123

Made in COSTA RICA

307 Parkway

Global Park, Heredia COSTA RICA



08714729992561 1727 25766486 0521

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Temperature Limitation

-30°C - 40°C

STERILE

Sterilized using
ethylene oxide

Рис. 2 Маркировка вторичной упаковки катетера баллонного для криоабляции POLARx, диаметр катетера 11,8 F (3,93 мм) (на примере вариант исполнения с коротким дистальным кончиком)

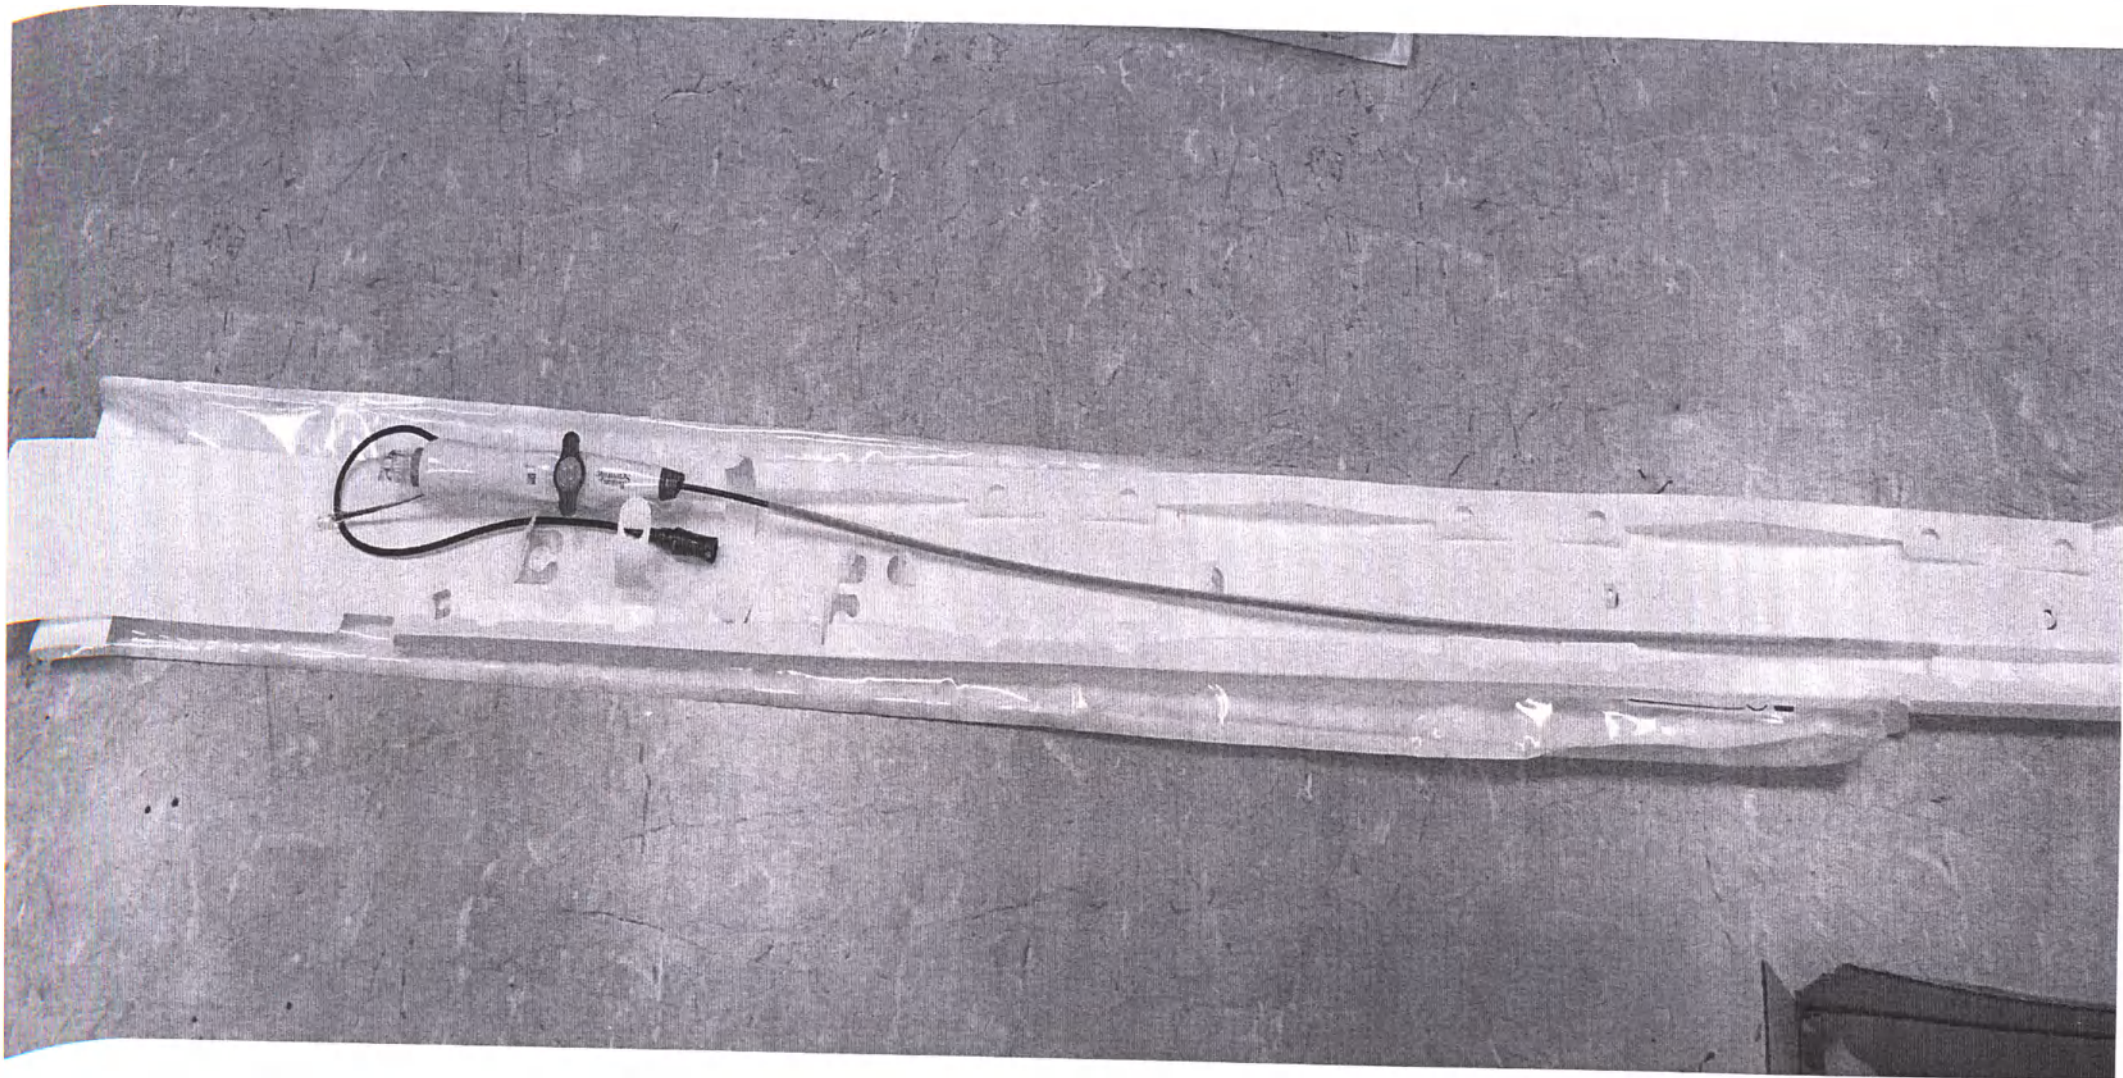


Рис. 4 Катетер баллонный для криоабляции POLARx, диаметр катетера 11,8 F (3,93 мм) (на примере вариант исполнения с коротким дистальным кончиком)

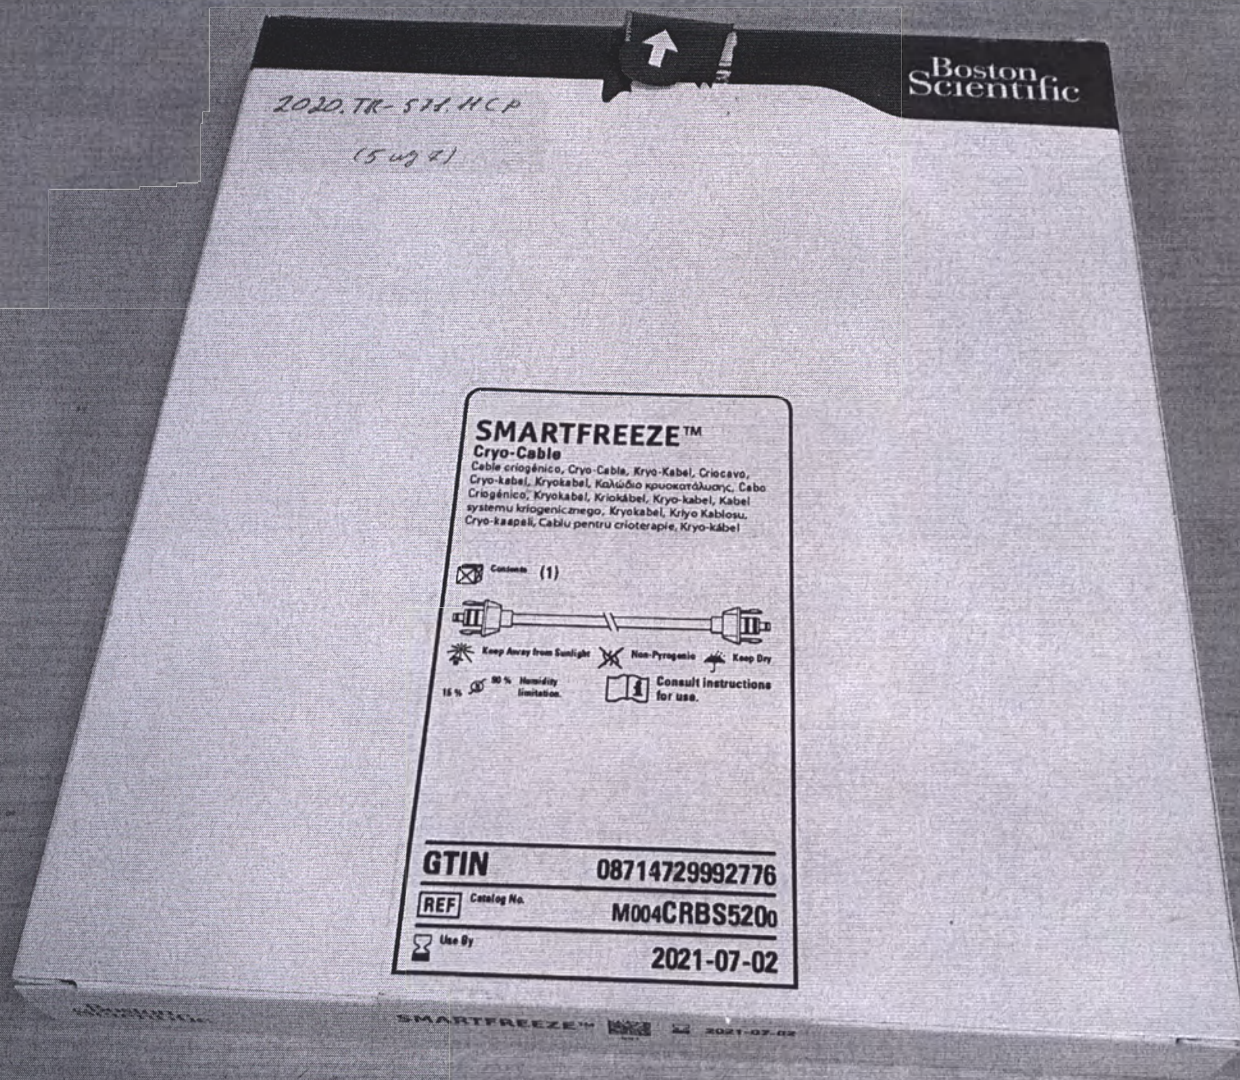


Рис. 5 Криокабель SMARTFREEZE во вторичной упаковке

2020.TK-578.HCP

(5498)


Boston
Scientific

SMARTFREEZE™

Cryo-Cable

Cable criogénico, Cryo-Cable, Kryo-Kabel, Criocavo,
Cryo-kabel, Kryokabel, Kriokabel, Kriokabel, Cryo-
Cable, Cryo-kabel, Kriokabel, Kriokabel, Kriokabel,
systemu kriogenicznego, Kryokabel, Kriyo Kablosu,
Cryo-kabel, Cablu pentru crioterapie, Kryo-kabel

Contains (1)



Keep Away from Sunlight Non-Pyrogenic Keep Dry
15% 90% Humidity Limitation Consult instructions for use.

GTIN

08714729992776

REF

Catalog No.

M004CRBS5200



Use By

2021-07-02

SMARTFREEZE™ 2021-07-02

Рис. 5 Криокабель SMARTFREEZE во вторичной упаковке

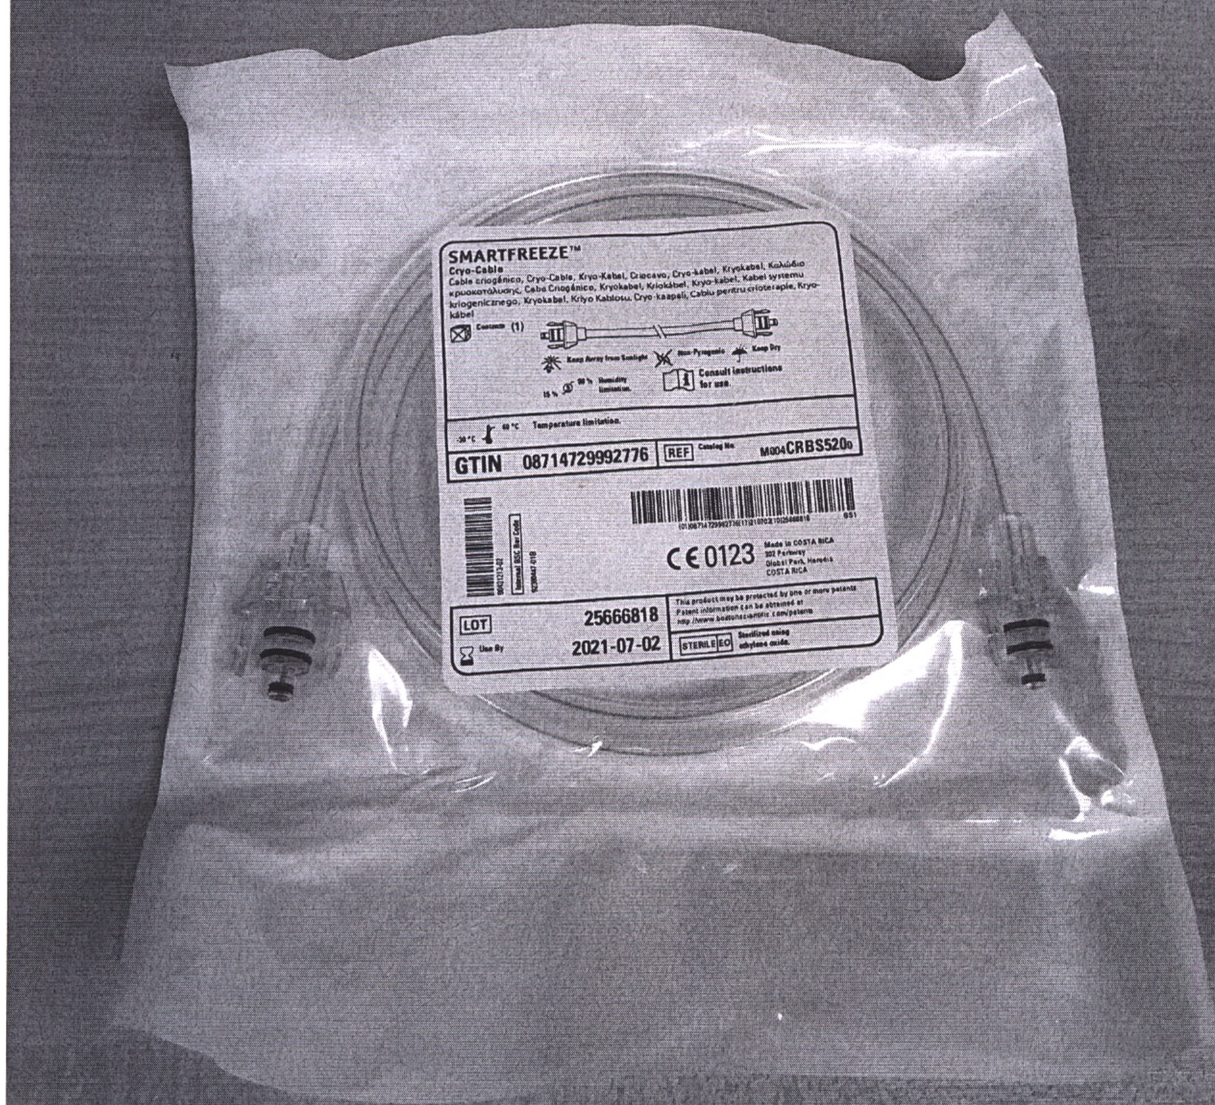


Рис. 6 Криокабель SMARTFREEZE в первичной упаковке

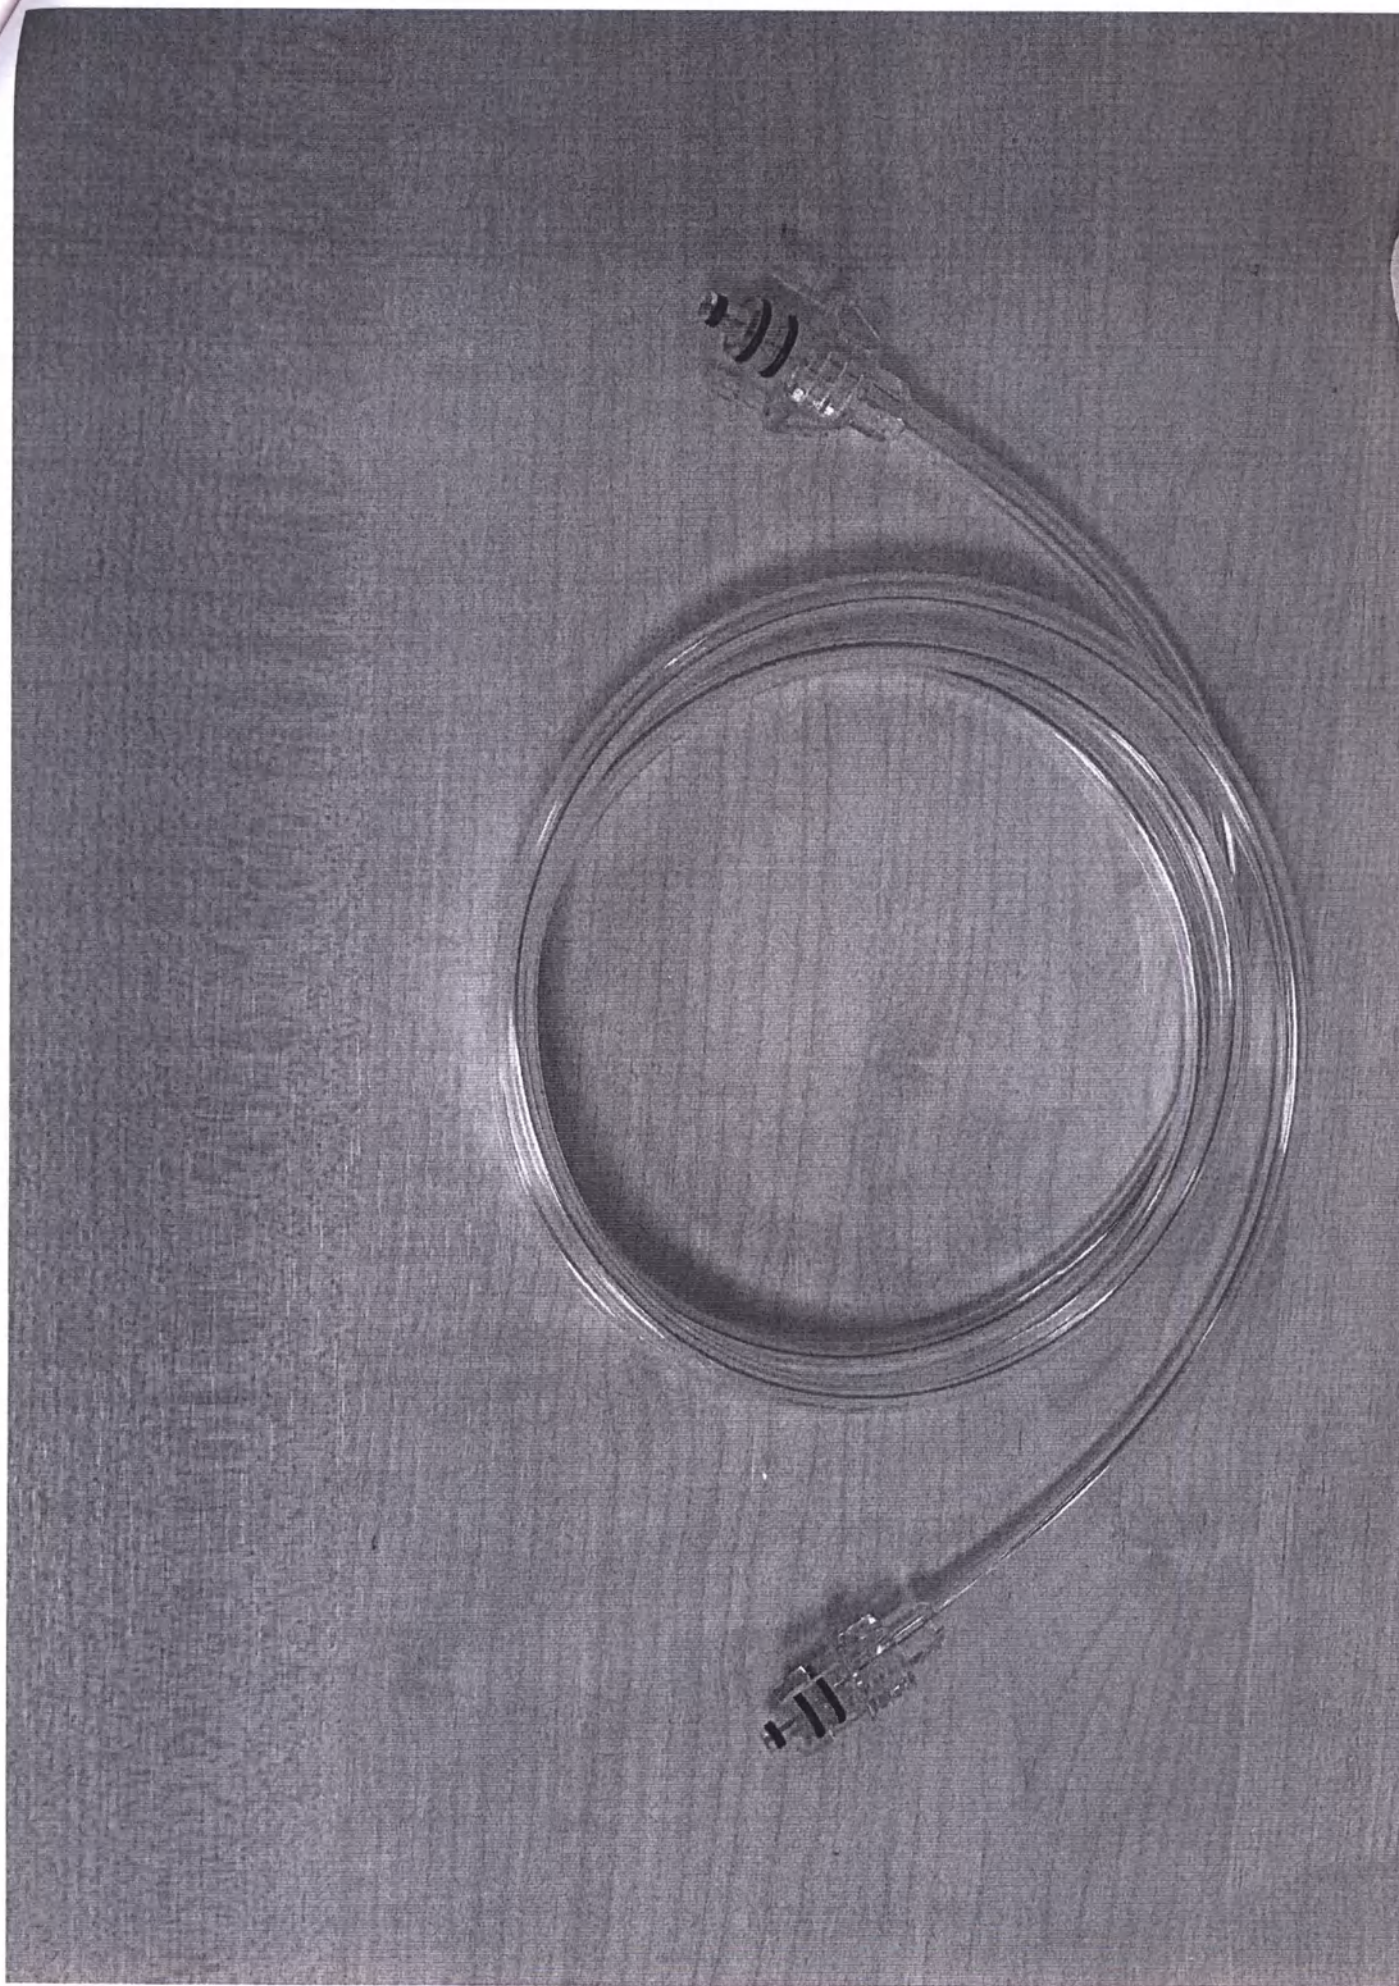


Рис. 7 Криокабель SMARTFREEZE

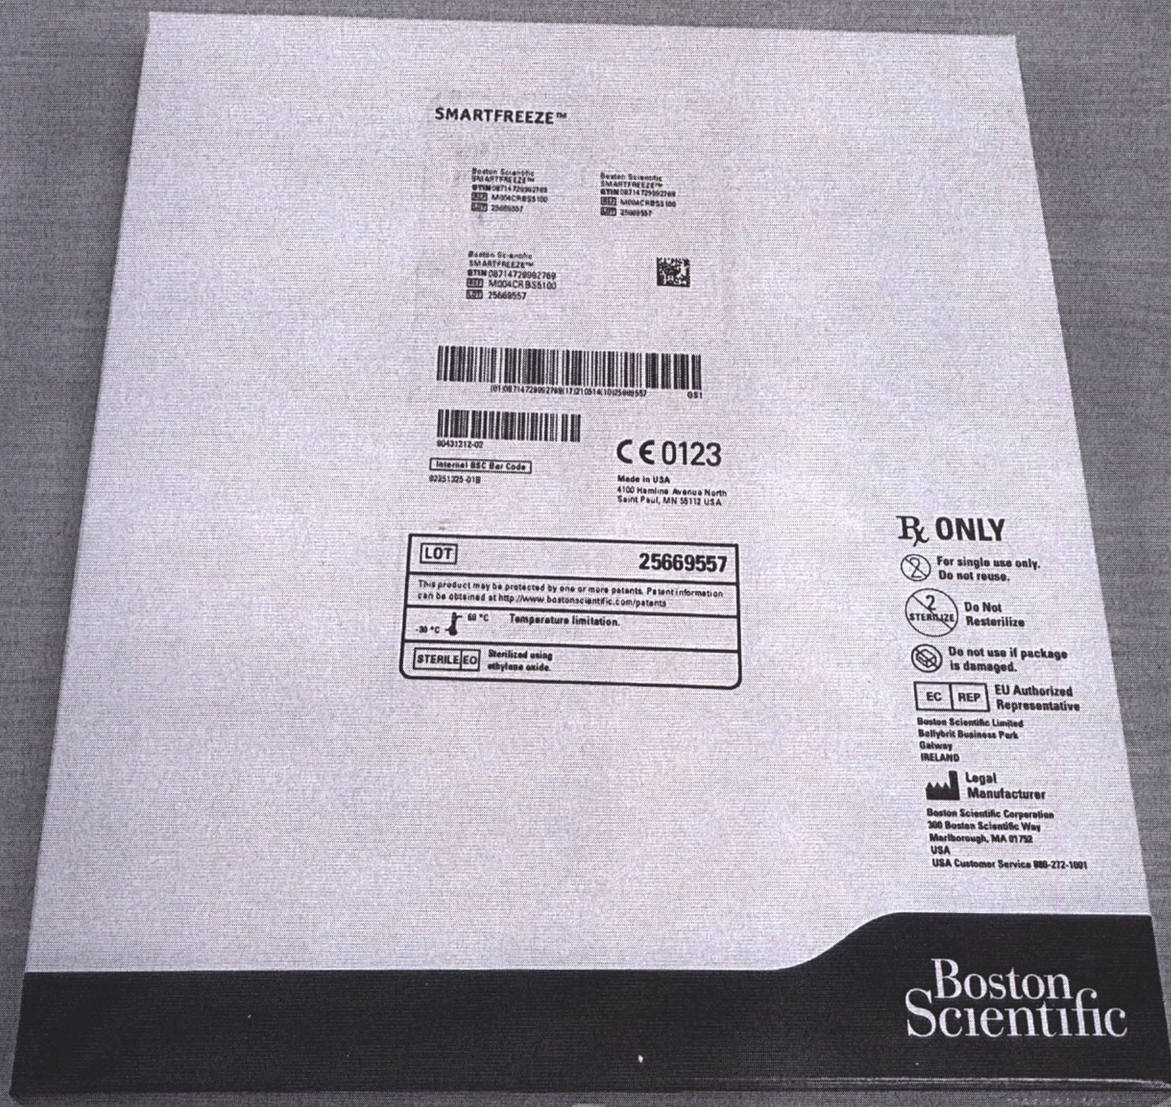


Рис. 8 Кабель-удлинитель катетера SMARTFREEZE во вторичной упаковке



Рис. 10 Кабель-удлинитель катетера SMARTFREEZE

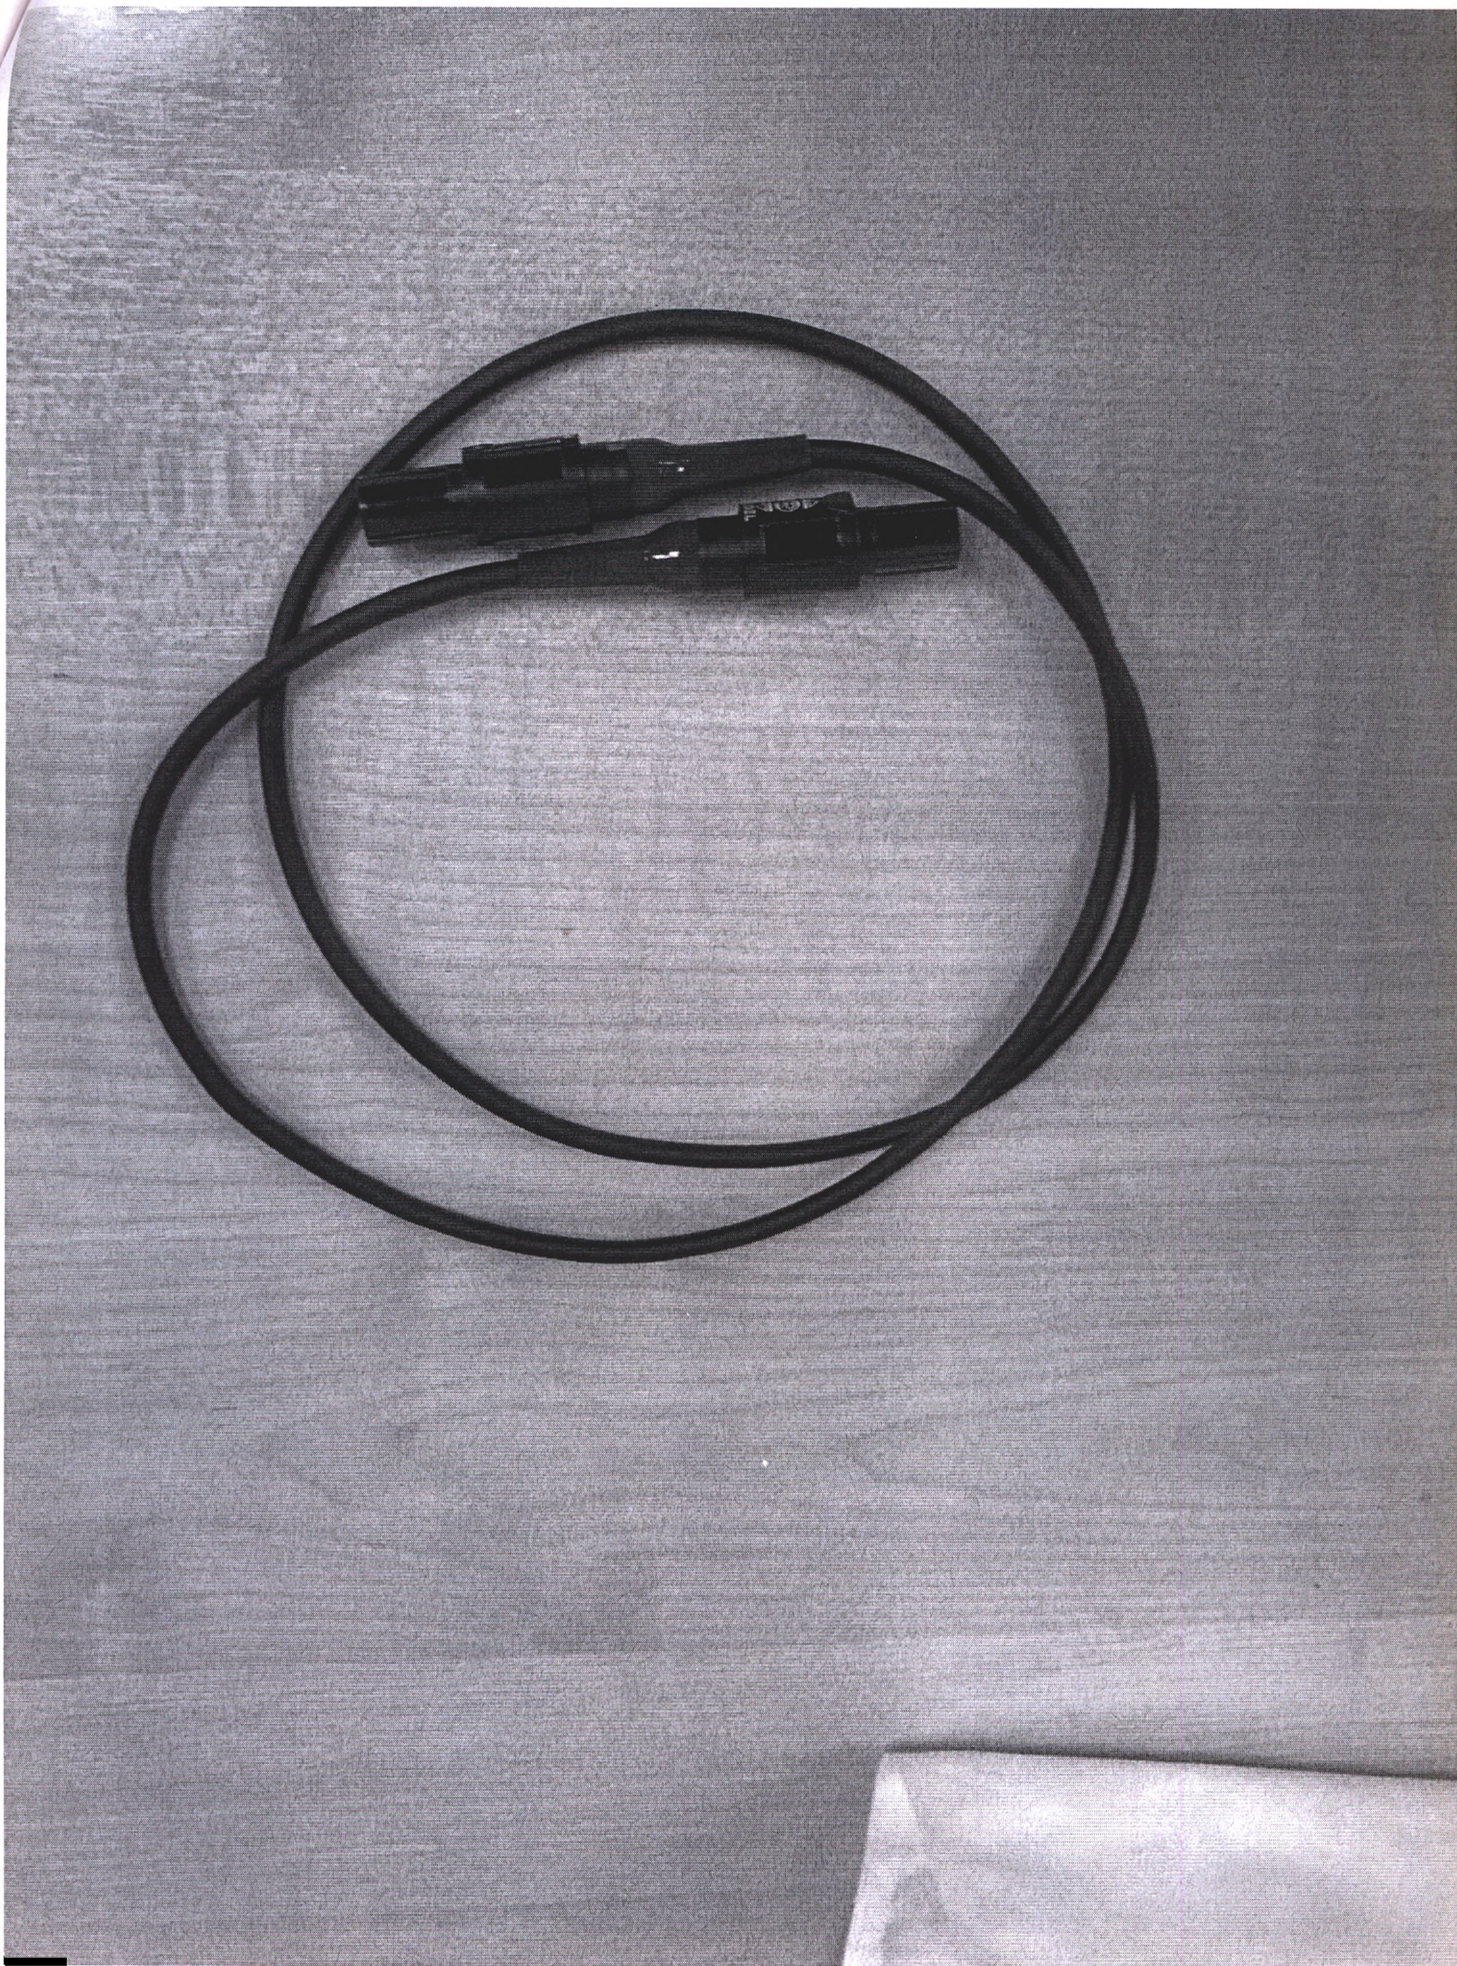


Рис. 10 Кабель-удлиннитель катетера SMARTFREEZE

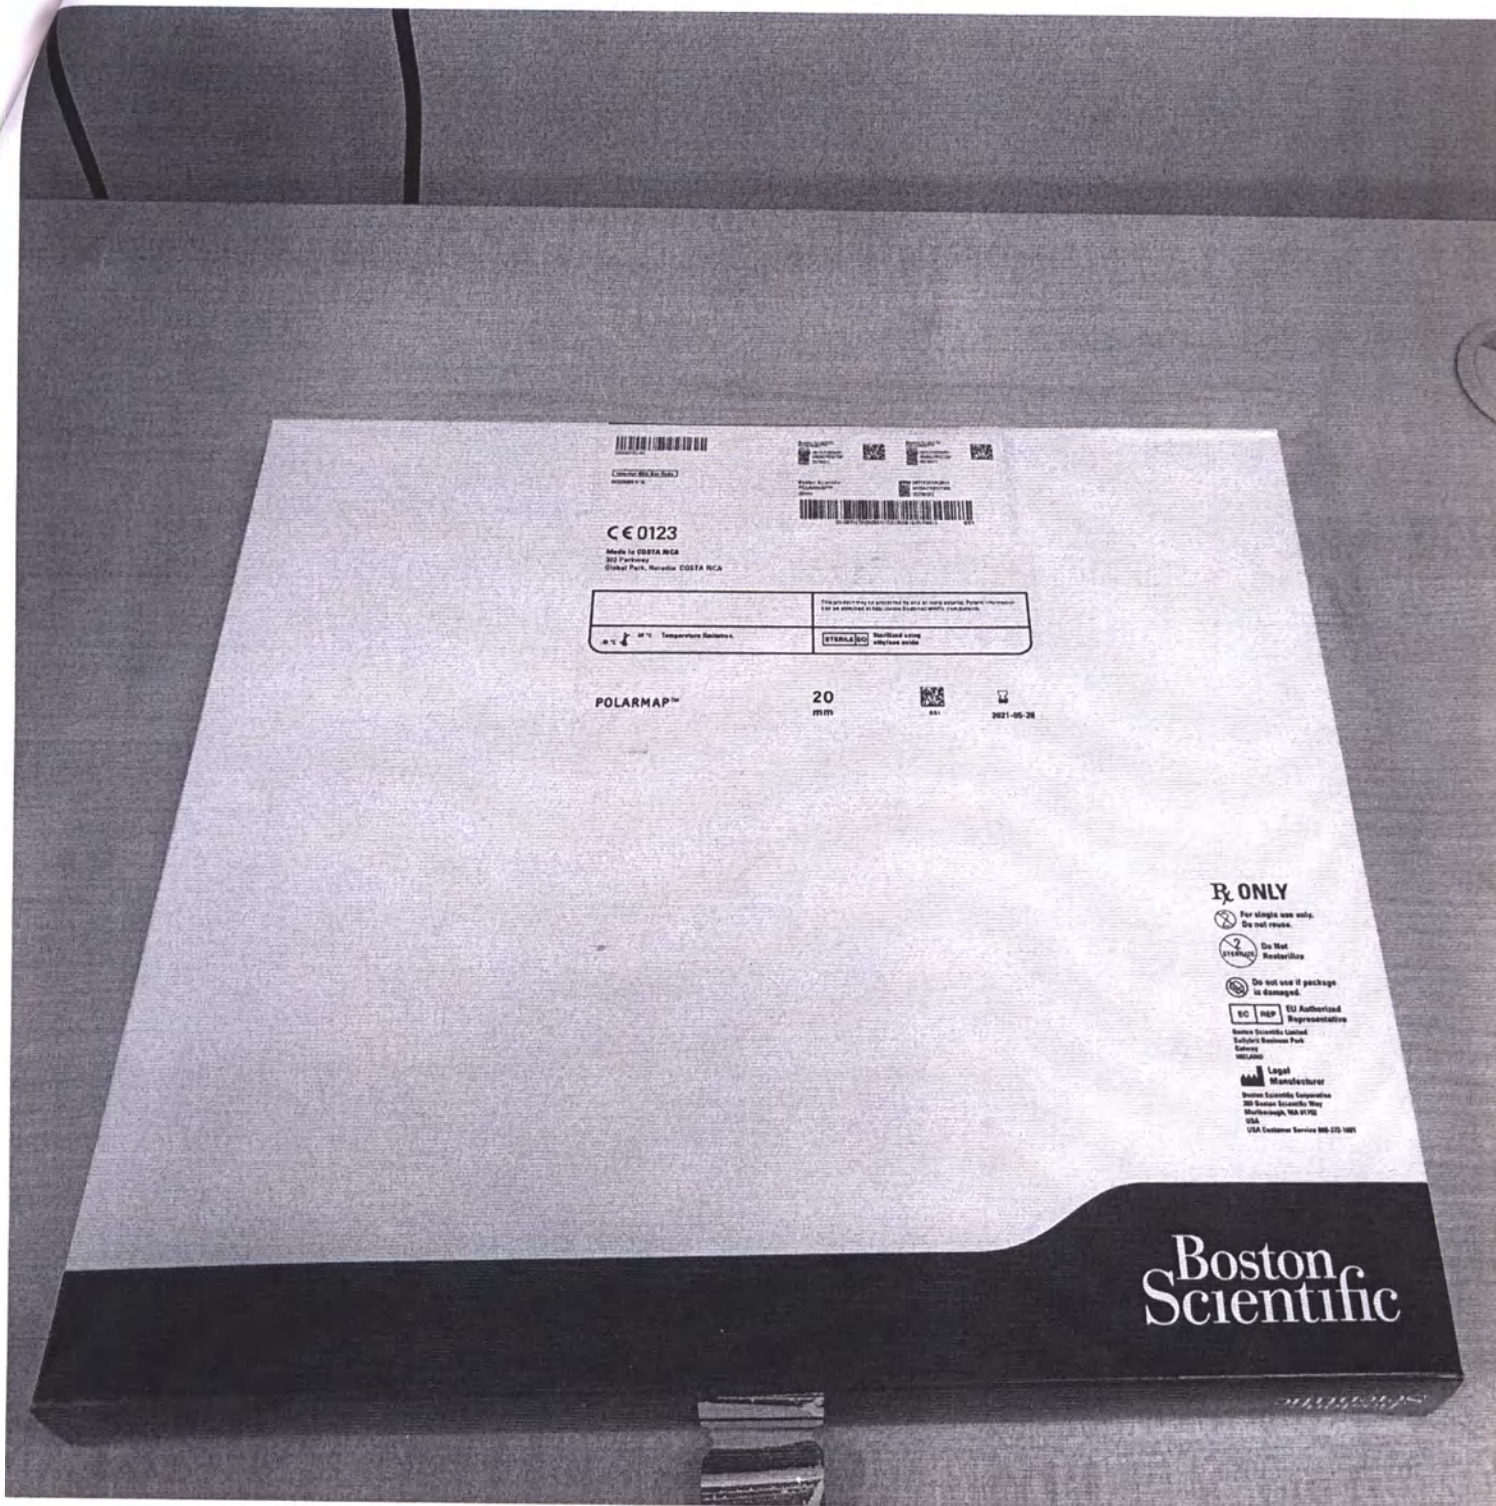


Рис. 11 Катетер для циркулярного картирования POLARMAP, диаметр катетера 20 мм во вторичной упаковке



Рис. 12 Катетер для циркулярного картирования POLARMAP, диаметр катетера 20 мм в первичной упаковке



Рис. 12 Катетер для циркулярного картирования POLARMAP, диаметр катетера 20 мм в первичной упаковке

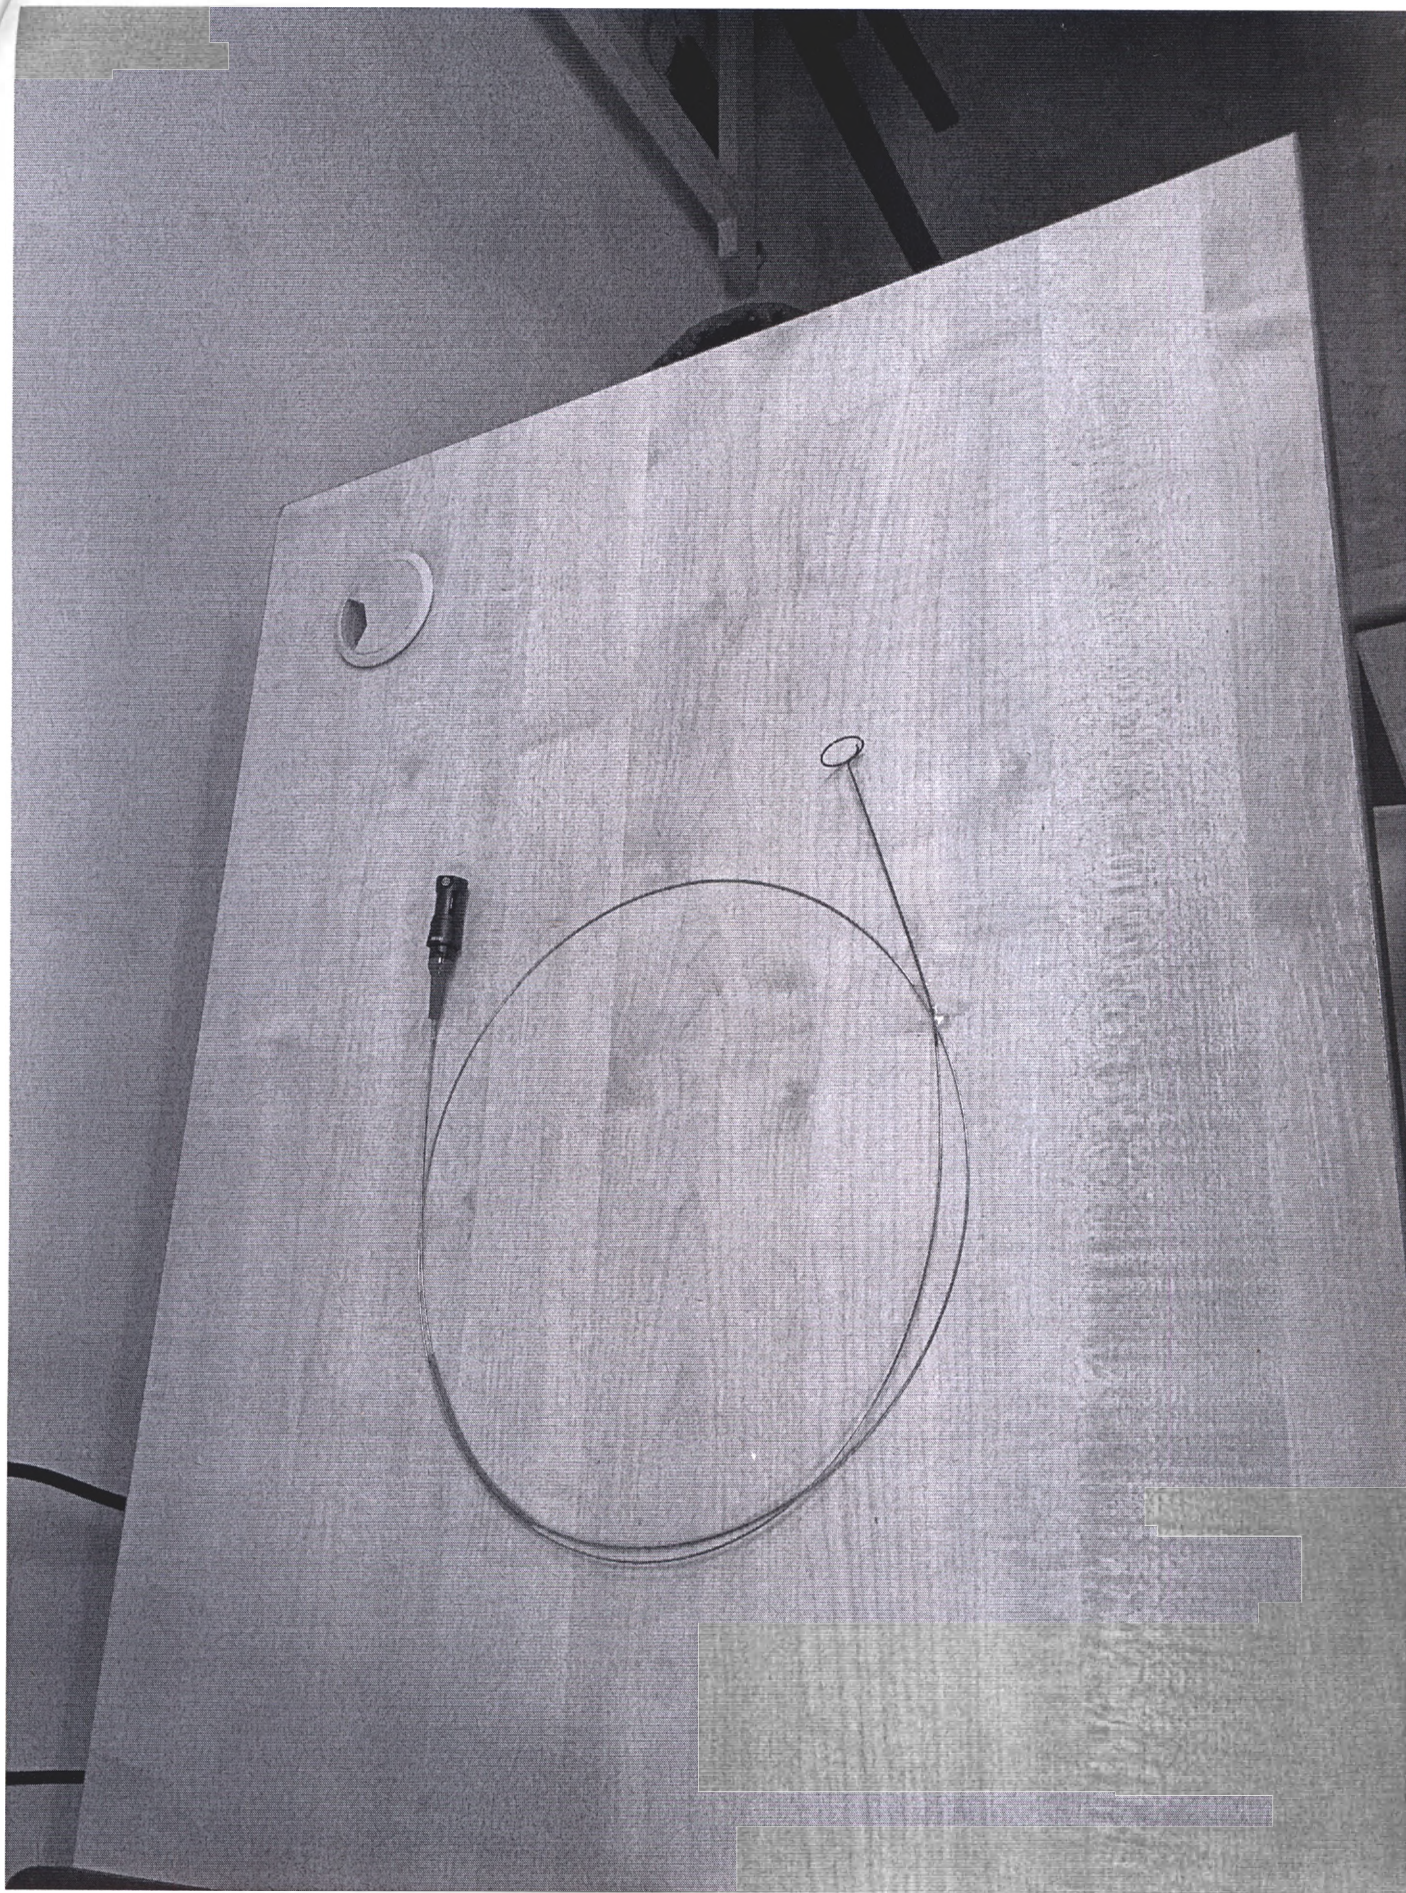


Рис. 13 Катетер для циркулярного картирования POLARMAP, диаметр катетера 20 мм

POLARMAP™

Boston Scientific
POLARMAP™
GTIN 08714729982790
BSC M004CRBS6200
LOT 25669690

Boston Scientific
POLARMAP™
GTIN 08714729982790
BSC M004CRBS6200
LOT 25669690

Boston Scientific
POLARMAP™
GTIN 08714729982790
BSC M004CRBS6200
LOT 25669690



(01)08714729982790(17)210514(10)25669690 GS1



80431212-02

Internal BSC Bar Code
92380435-01B

CE 0123

Made in USA
3545 Harbor Blvd, Suite 150
Costa Mesa, CA 92626 USA

LOT	25669690
This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at http://www.bostonscientific.com/patents	
-30 °C — 50 °C Temperature limitation.	
STERILE	EC Sterilized using ethylene oxide.

Rx ONLY

For single use only.
Do not reuse.

2
STERILIZE Do Not
Resterilize

Do not use if package
is damaged.

EC REP EU Authorized
Representative

Boston Scientific Limited
Ballybrit Business Park
Galway
IRELAND

Legal
Manufacturer

Boston Scientific Corporation
300 Boston Scientific Way
Marlborough, MA 01752
USA
USA Customer Service 888-272-1061

Boston
Scientific

Рис. 14 Электрофизиологический кабель POLARMAP во вторичной упаковке

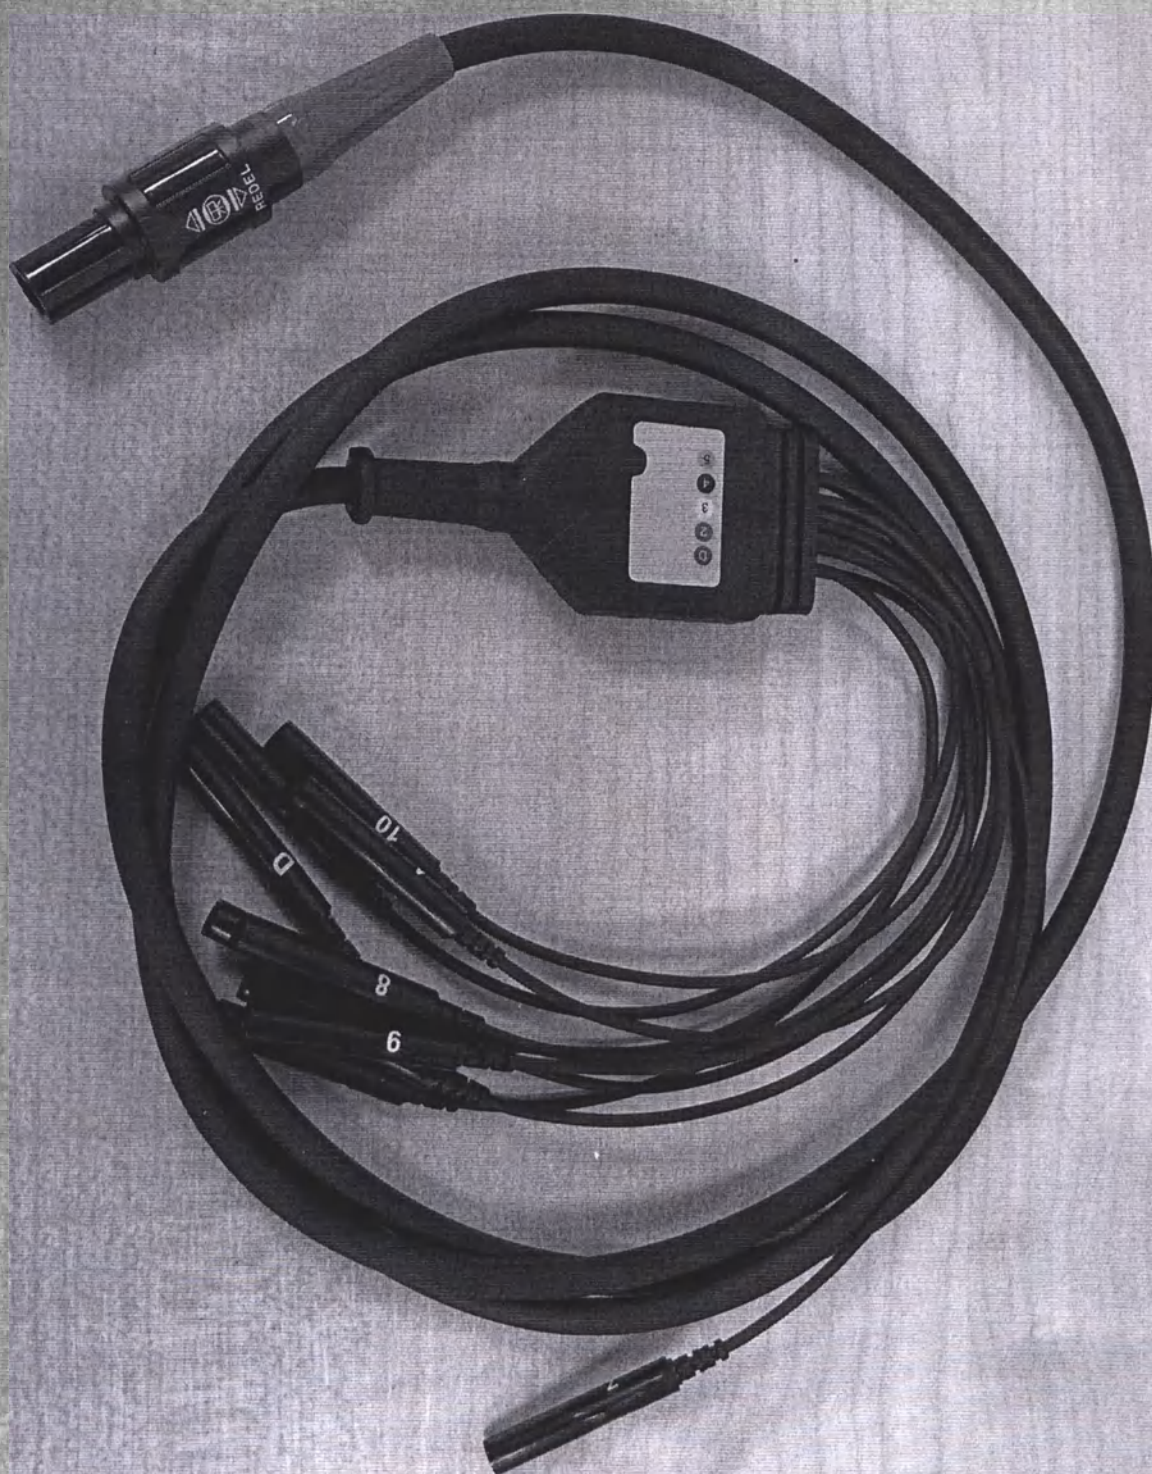


Рис. 16 Электрофизиологический кабель POLARMAP

Boston
Scientific


POLARSHEATH™

Steerable Sheath

Vaina dirigibilă, Gaine orientabilă,
Steuerbare Einführschleuse, Gainea manovrabilă,
Stuurbare huls, Styrbart hylster,
Κατευθύνσιμο θηκόρι, Bainha Direcționabilă,
Styrbar hylsa, Irányítható hüvely, Ovládateľný plášť,
Sterowalna koszulka, Styrbar hylse, Yönlendirilebilir Kilif,
Ohjattava holkki, Teacă dirijabilă, Riaditeľné puzdro

12F

Contents (1)



Consult instructions
for use.



CAUTION
Attention: Consult
ACCOMPANYING DOCUMENTS.

Keep Away from Sunlight

Keep Dry

Non-Pyrogenic

50 % Humidity
Limitation

GTIN

08714729992684

REF

Catalog No.

M004CRBS3050

Boston Scientific
POLARSHEATH™
12F
GTIN 08714729992684
REF M004CRBS3050
LOT 25760601

Boston Scientific
POLARSHEATH™
12F
GTIN 08714729992684
REF M004CRBS3050
LOT 25760601



GS1

Boston Scientific
POLARSHEATH™
12F
GTIN 08714729992684
REF M004CRBS3050
LOT 25760601



Internal BSC Bar Code

9233393 01A

CE 0123

Made in COSTA RICA
302 Parkway
Global Park, Heredia
COSTA RICA

LOT 25760601

Use By

2021-06-03

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained
at <http://www.bostonscientific.com/patents>

-30 °C 60 °C Temperature limitation.

STERILE EO

Sterilized using
ethylene oxide.

Рис. 17 Катетер интродьюсерный POLARSHEATH, размер 12 F (4 мм) с расширителем во вторичной упаковке

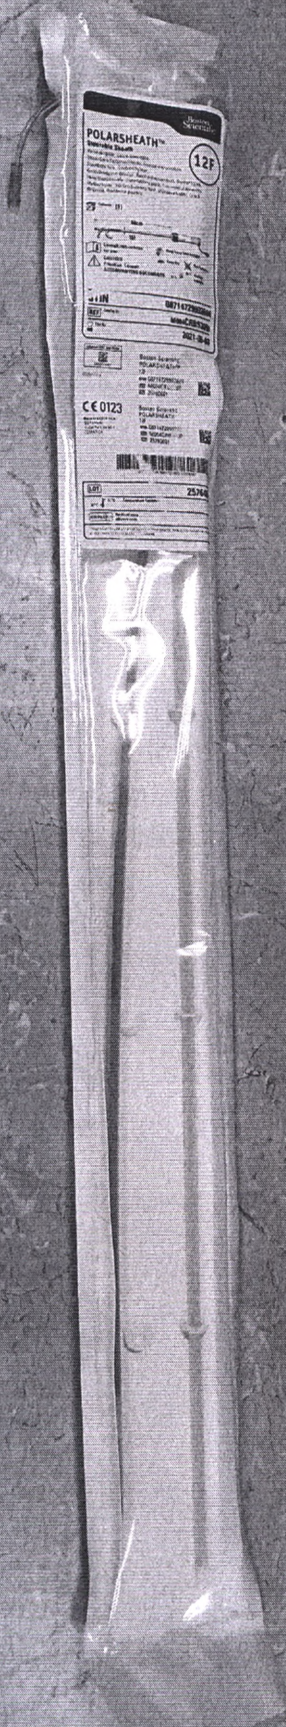


Рис. 18 Катетер интродьюсерный POLARSHEATH, размер 12 F (4 мм) с расширителем в первичной упаковке

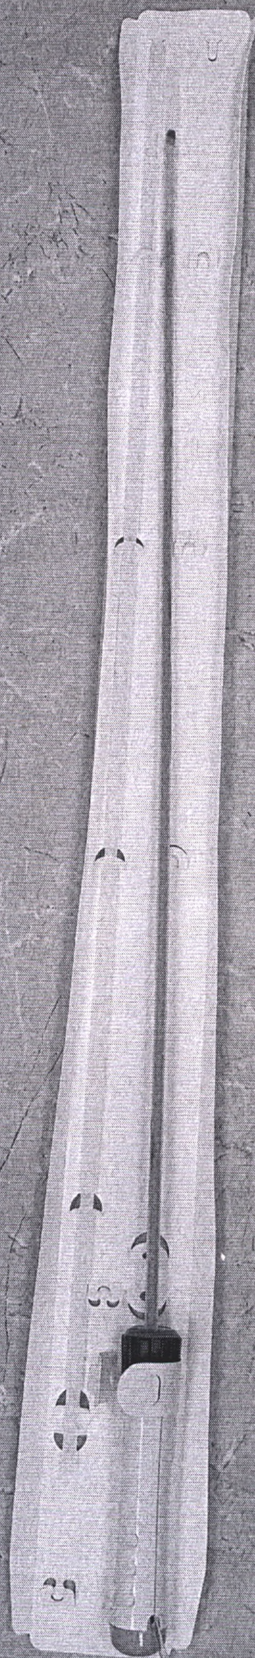


Рис. 19 Катетер интродьюсерный POLARSHEATH, размер 12 F (4 мм)

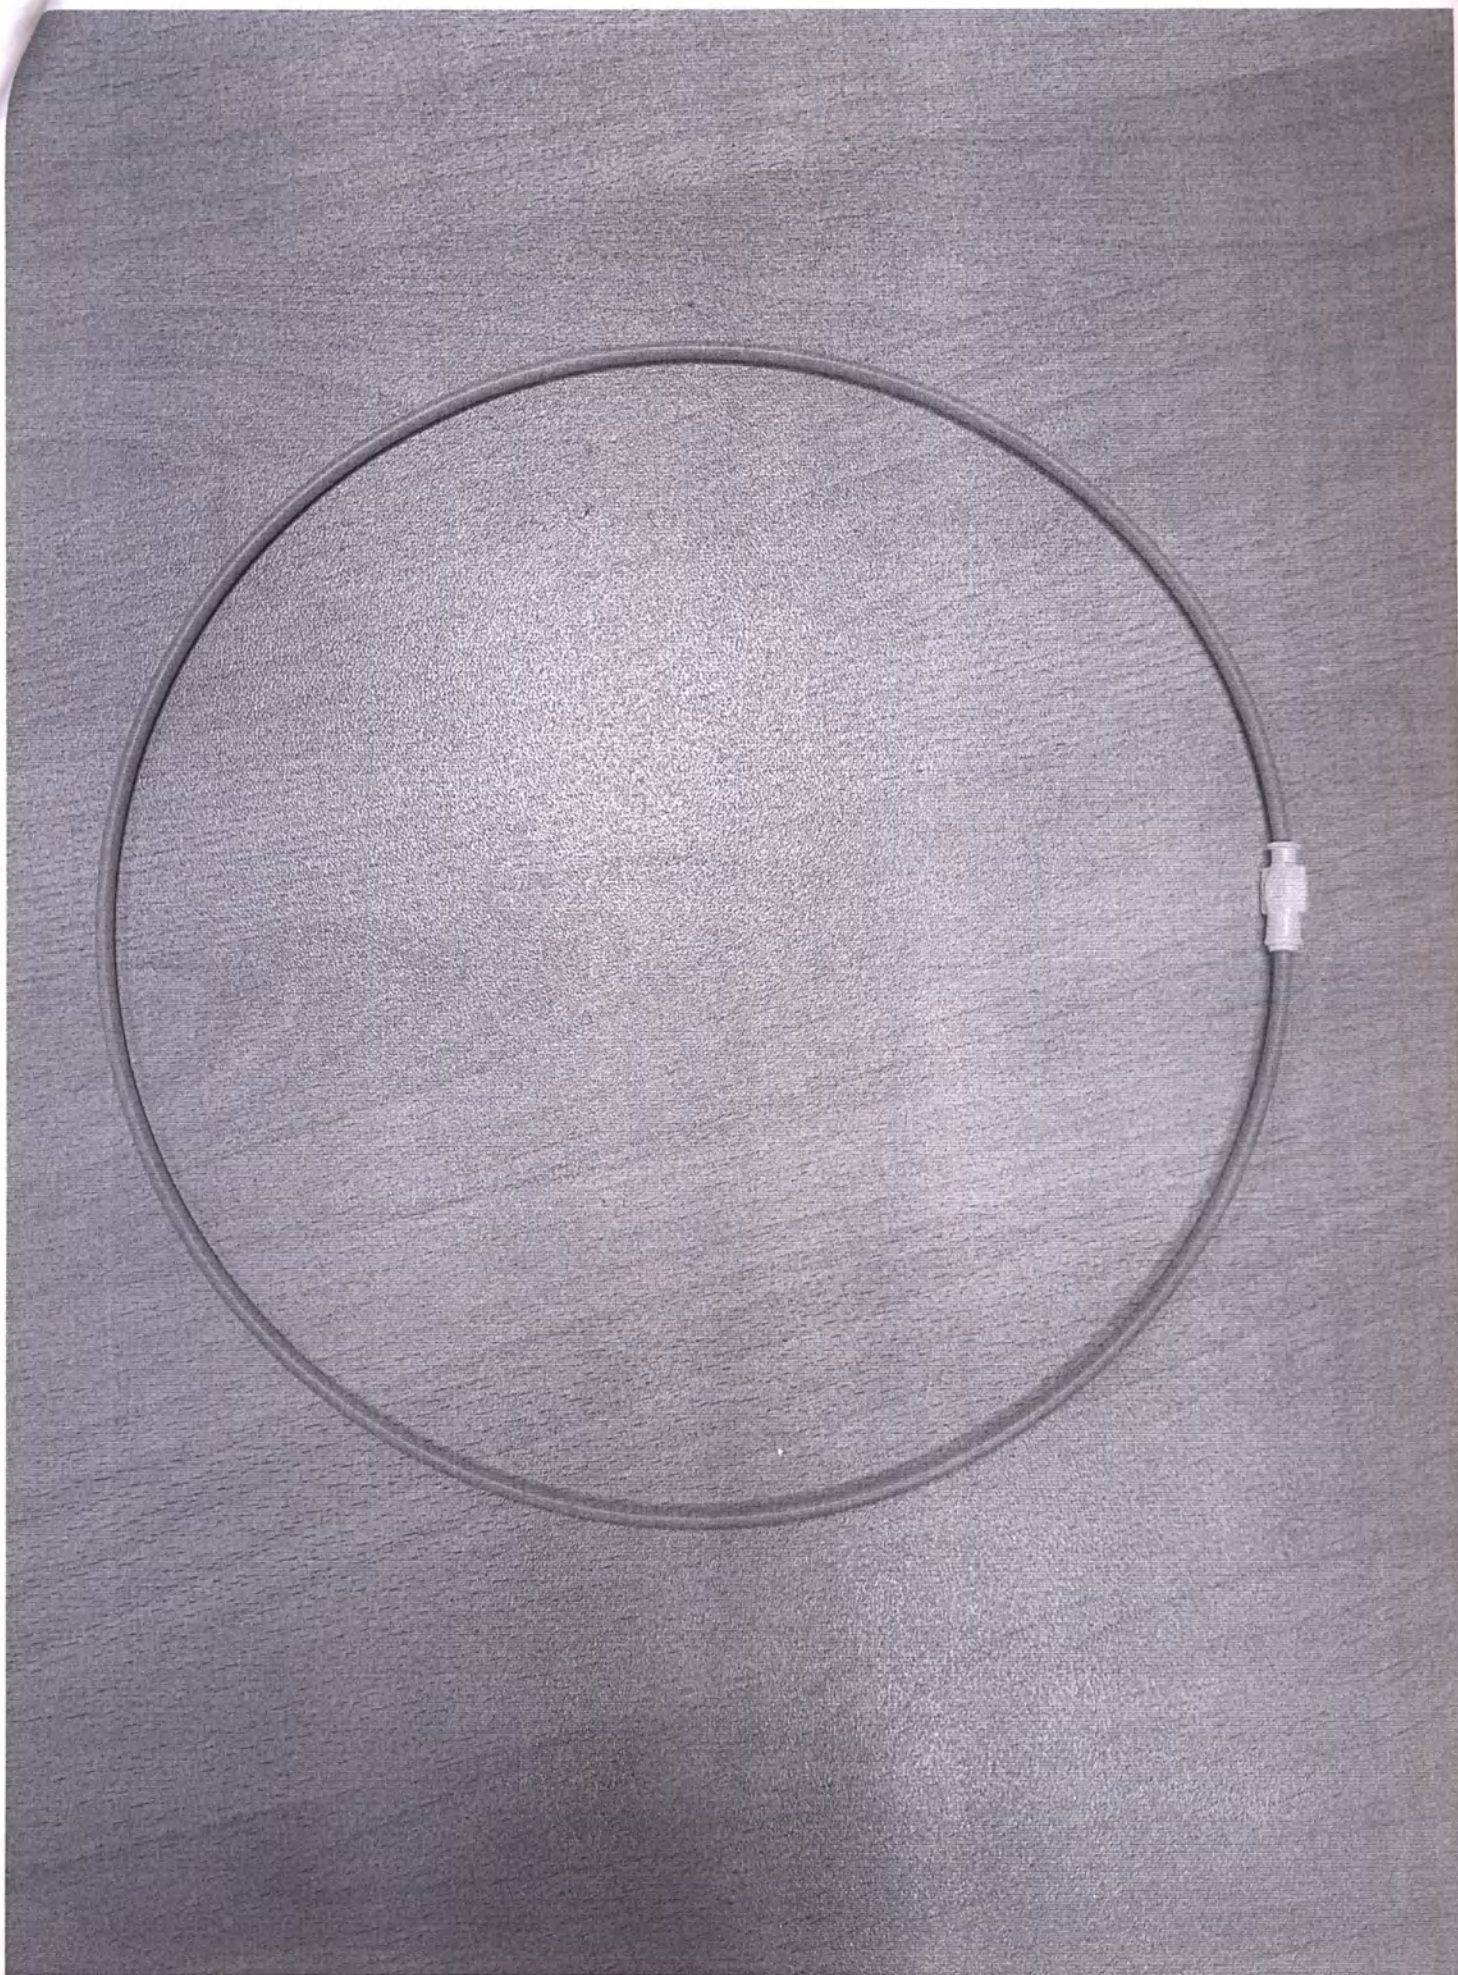


Рис. 20 Расширитель