

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "Физиотехника"



А.Е. Лапаев

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО
ИЗДЕЛИЯ**

**«Кушетка бесконтактного массажа «АКВАСПА П» по ТУ 32.50.21-024-
76228444-2020»**


Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Физиотехника»

Кушетка бесконтактного массажа «АКВАСПА П»

по ТУ 32.50.21-024-76228444-2020


Исполнение - 28Г8Х

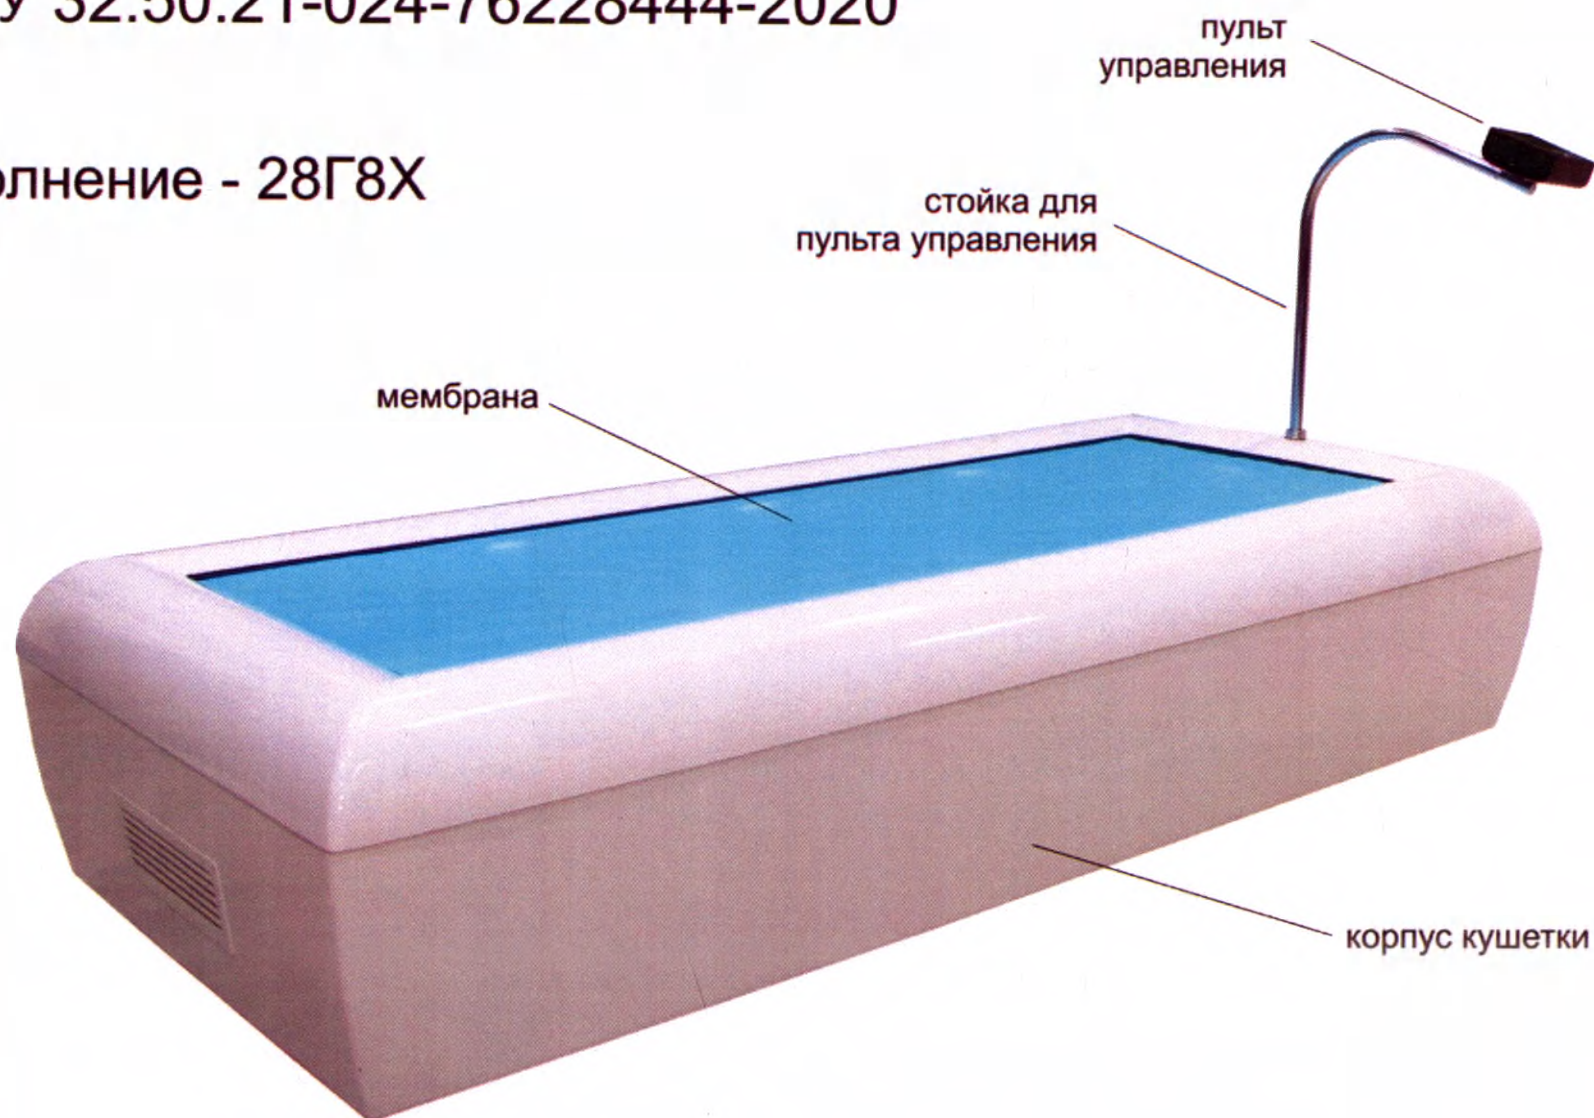

Кушетка бесконтактного массажа «АКВАСПА П»

по ТУ 32.50.21-024-76228444-2020


Исполнение - 24Г8Х

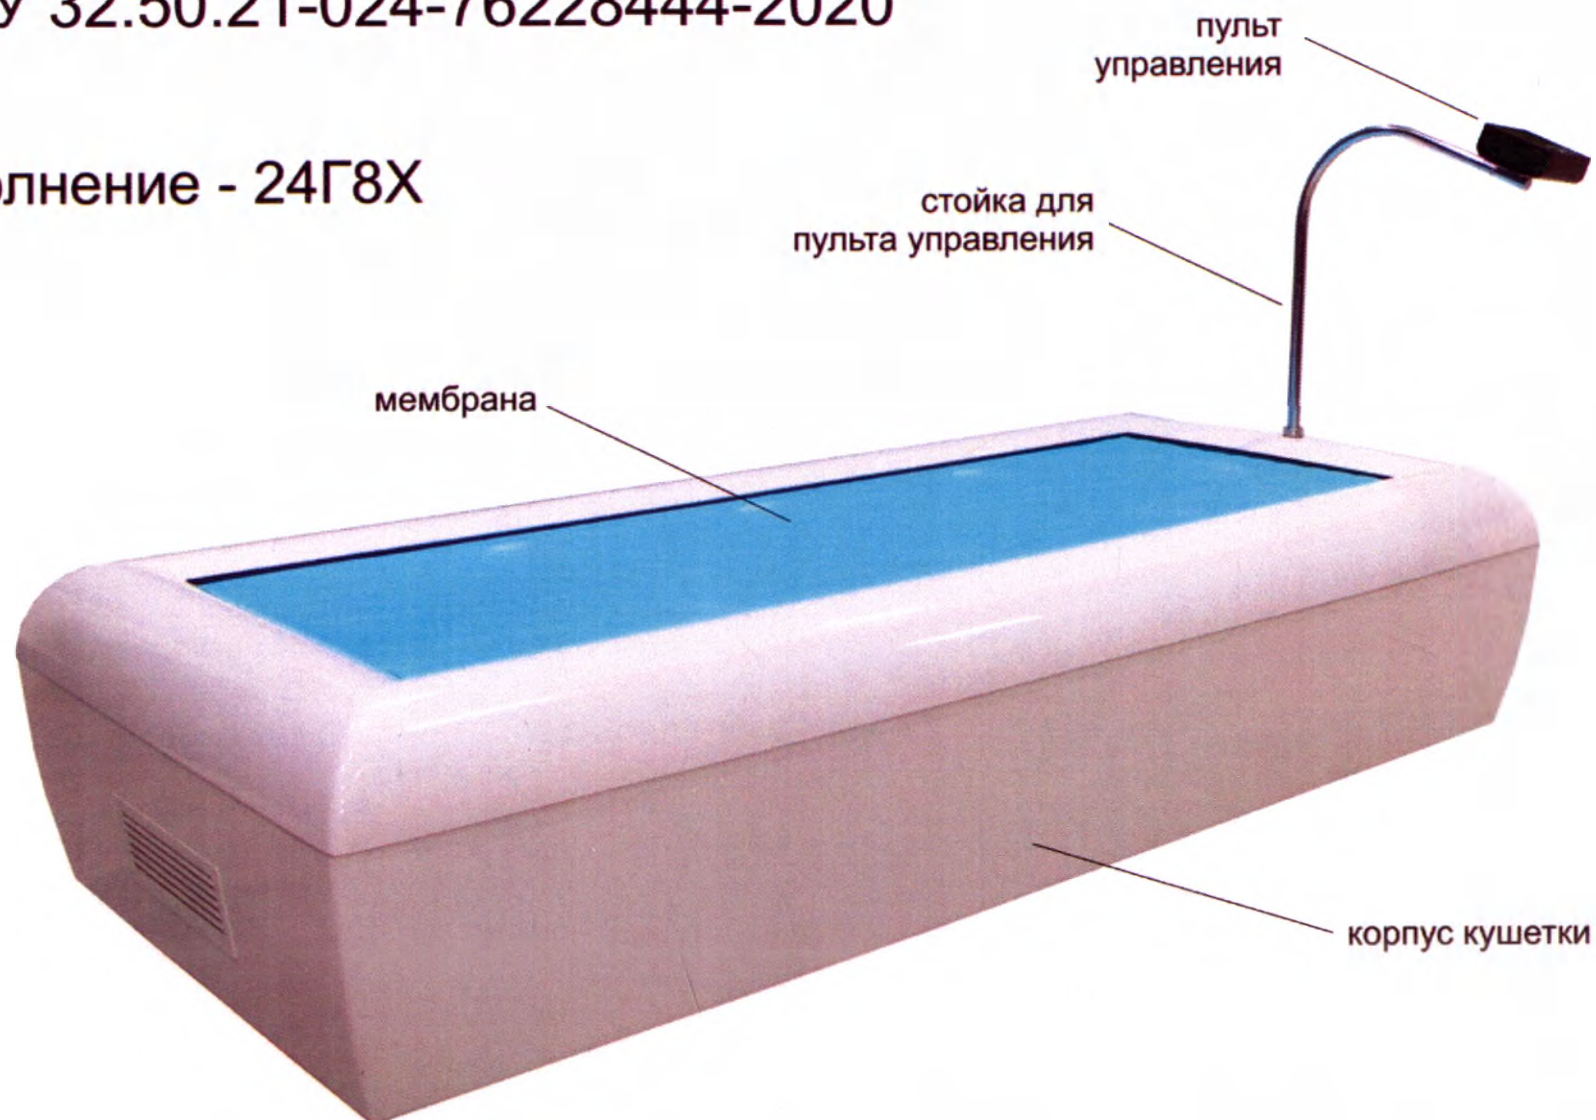

Кушетка бесконтактного массажа «АКВАСПА П»

по ТУ 32.50.21-024-76228444-2020


Исполнение - 28Г

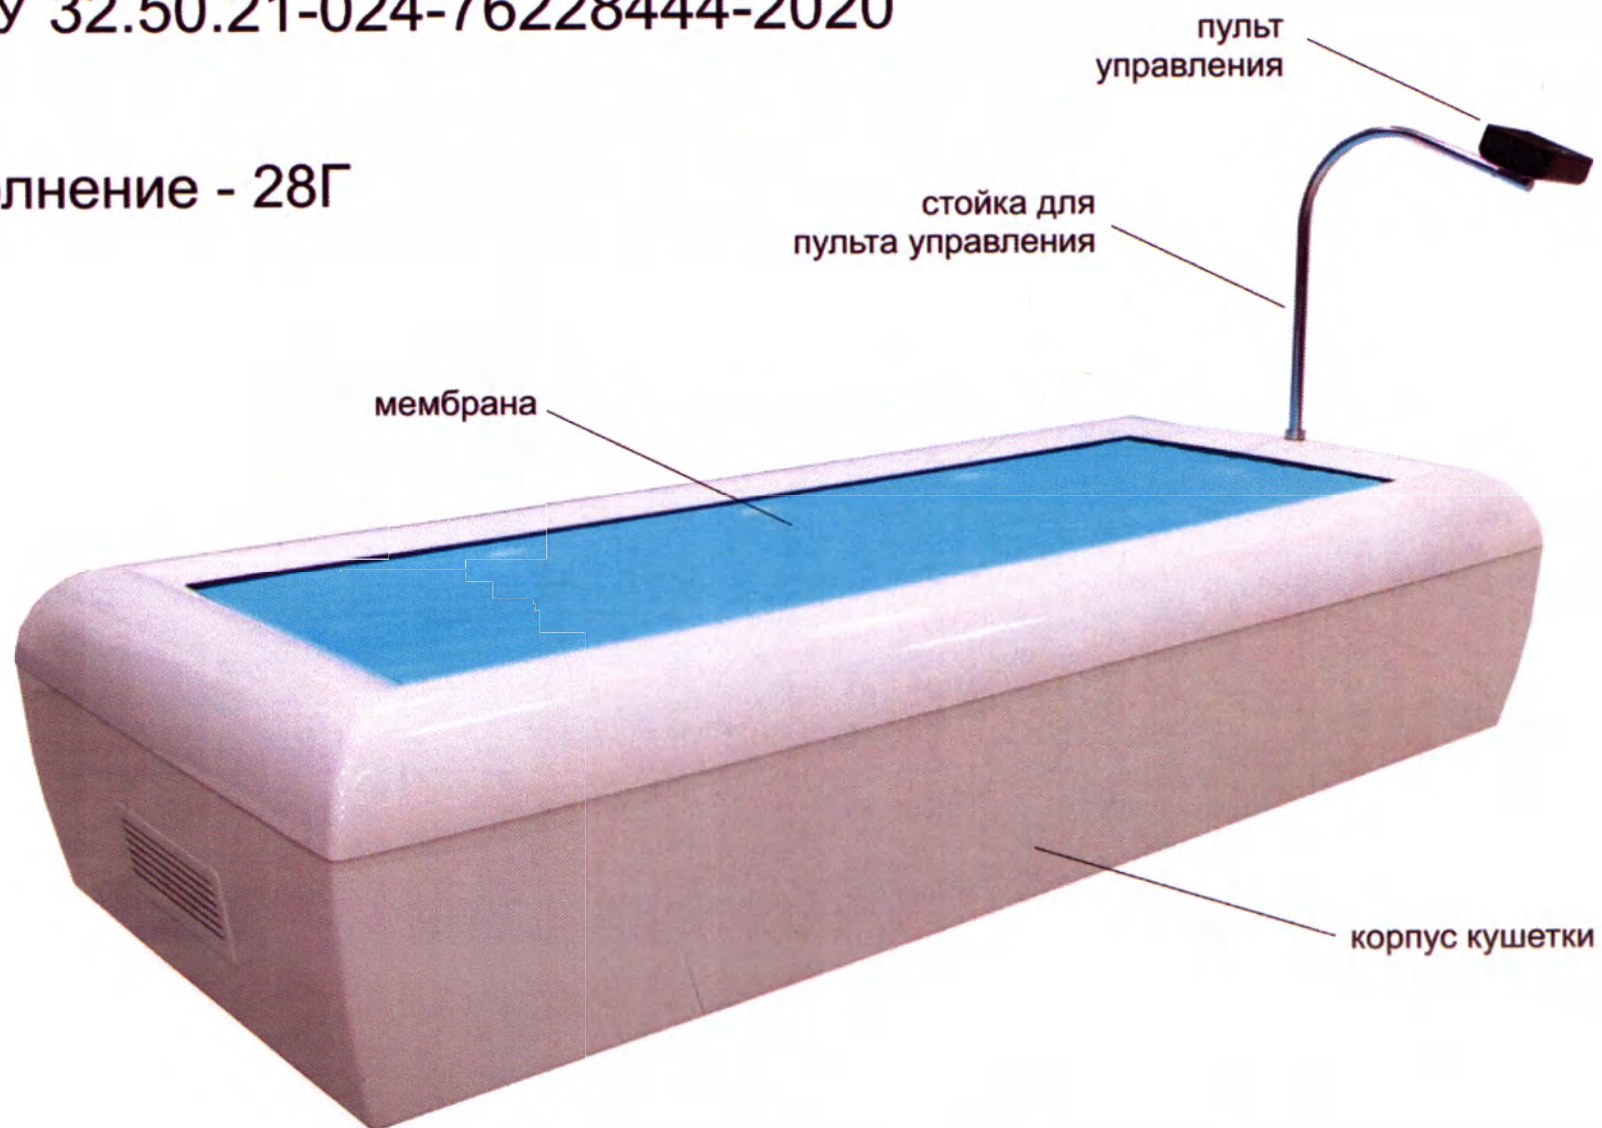

Кушетка бесконтактного массажа «АКВАСПА П»

по ТУ 32.50.21-024-76228444-2020

Исполнение - 24Г

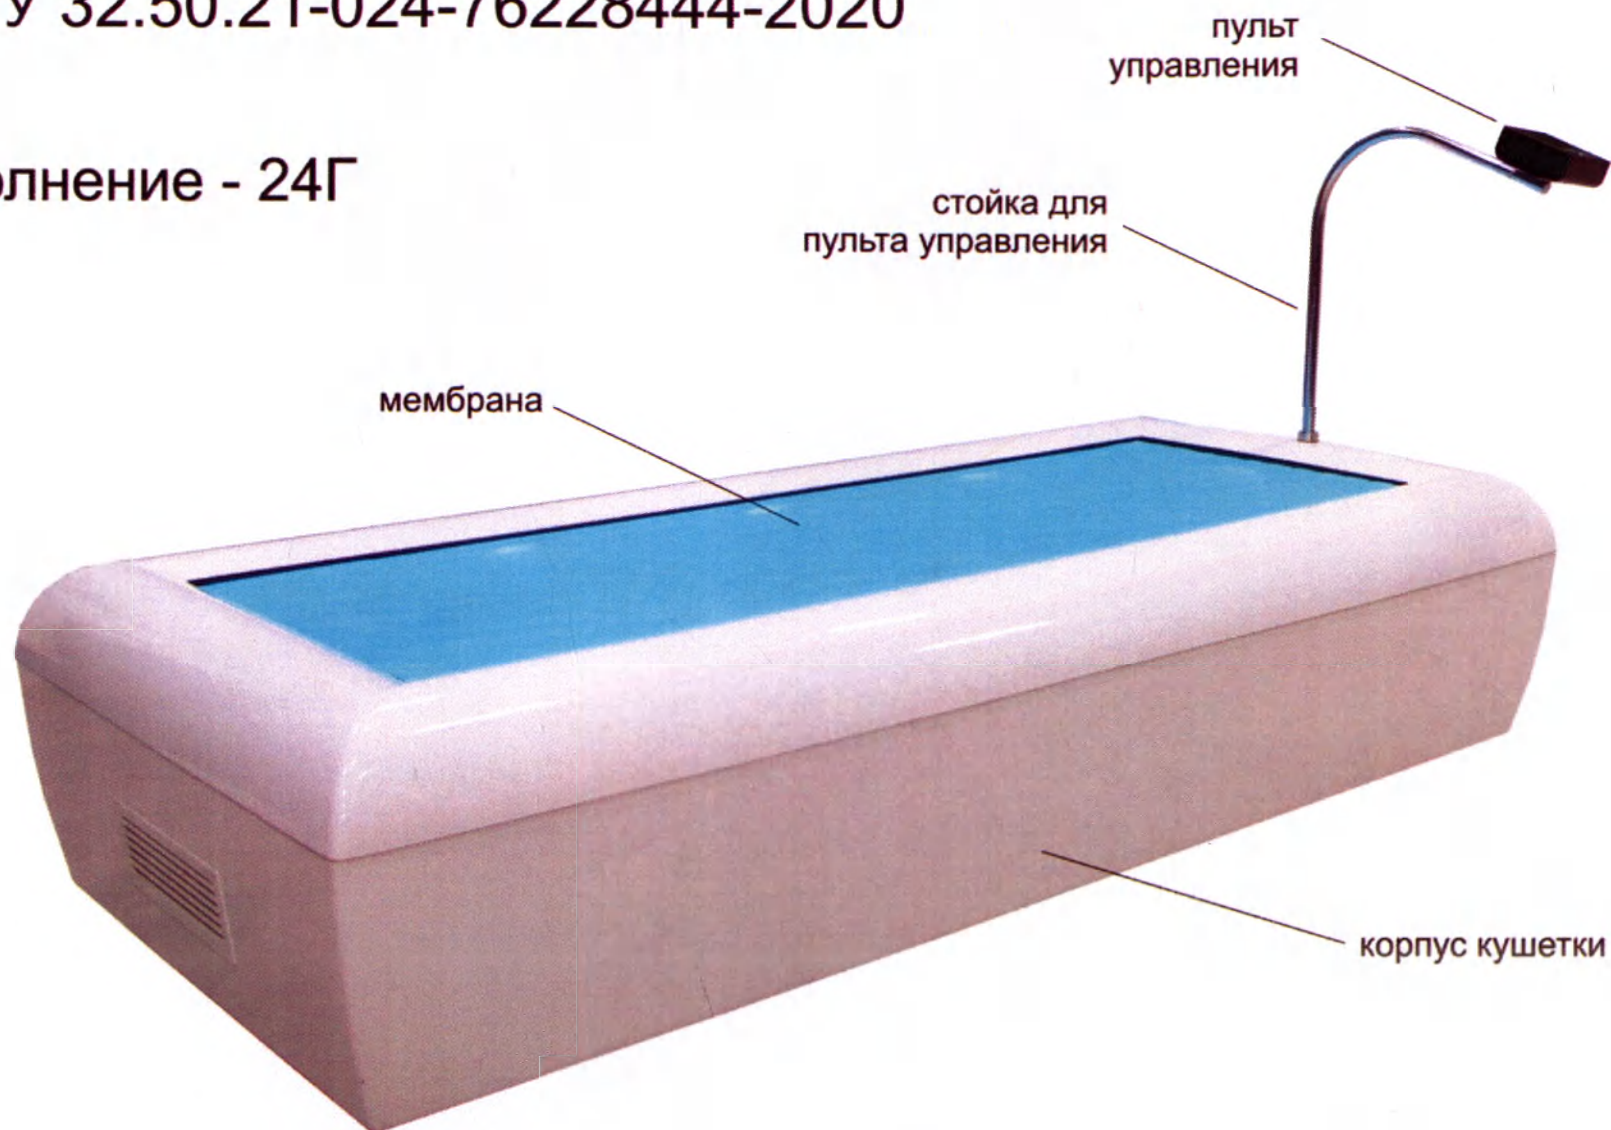

Physiotecnica



- ООО «Физиотехника»

Наименование изделия: Кушетка бесконтактного
массажа «АКВАСПА П» по ТУ 32.50.21-024-
76228444-2020, исполнение 28Г8Х,
напряжение питания и частота переменного тока
питающей сети - (220 ± 22) В, 50 Гц;
потребляемая мощность, не более, кВА: 3,5



- 001



- 2020г (III квартал)

   IP 45 

Physiotecnica



- ООО «Физиотехника»

Наименование изделия: Кушетка бесконтактного
массажа «АКВАСПА П» по ТУ 32.50.21-024-
76228444-2020, исполнение 24Г8Х,
напряжение питания и частота переменного тока
питающей сети - (220 ± 22) В, 50 Гц;
потребляемая мощность, не более, кВА: 3,5



- 001



- 2020г (III квартал)



IP 45



Physiotecnica



- ООО «Физиотехника»

Наименование изделия: Кушетка бесконтактного
массажа «АКВАСПА П» по ТУ 32.50.21-024-
76228444-2020, исполнение 28Г,
напряжение питания и частота переменного тока
питающей сети - (220 ± 22) В, 50 Гц;
потребляемая мощность, не более, кВА: 3,05



- 001



- 2020г (III квартал)



IP 45



Physiotecnica



- ООО «Физиотехника»

Наименование изделия: Кушетка бесконтактного
массажа «АКВАСПА П» по ТУ 32.50.21-024-

76228444-2020, исполнение 24Г,

напряжение питания и частота переменного тока
питающей сети - (220 ± 22) В, 50 Гц;

потребляемая мощность, не более, кВА: 3,05




- 001




- 2020г (III квартал)

IP 45

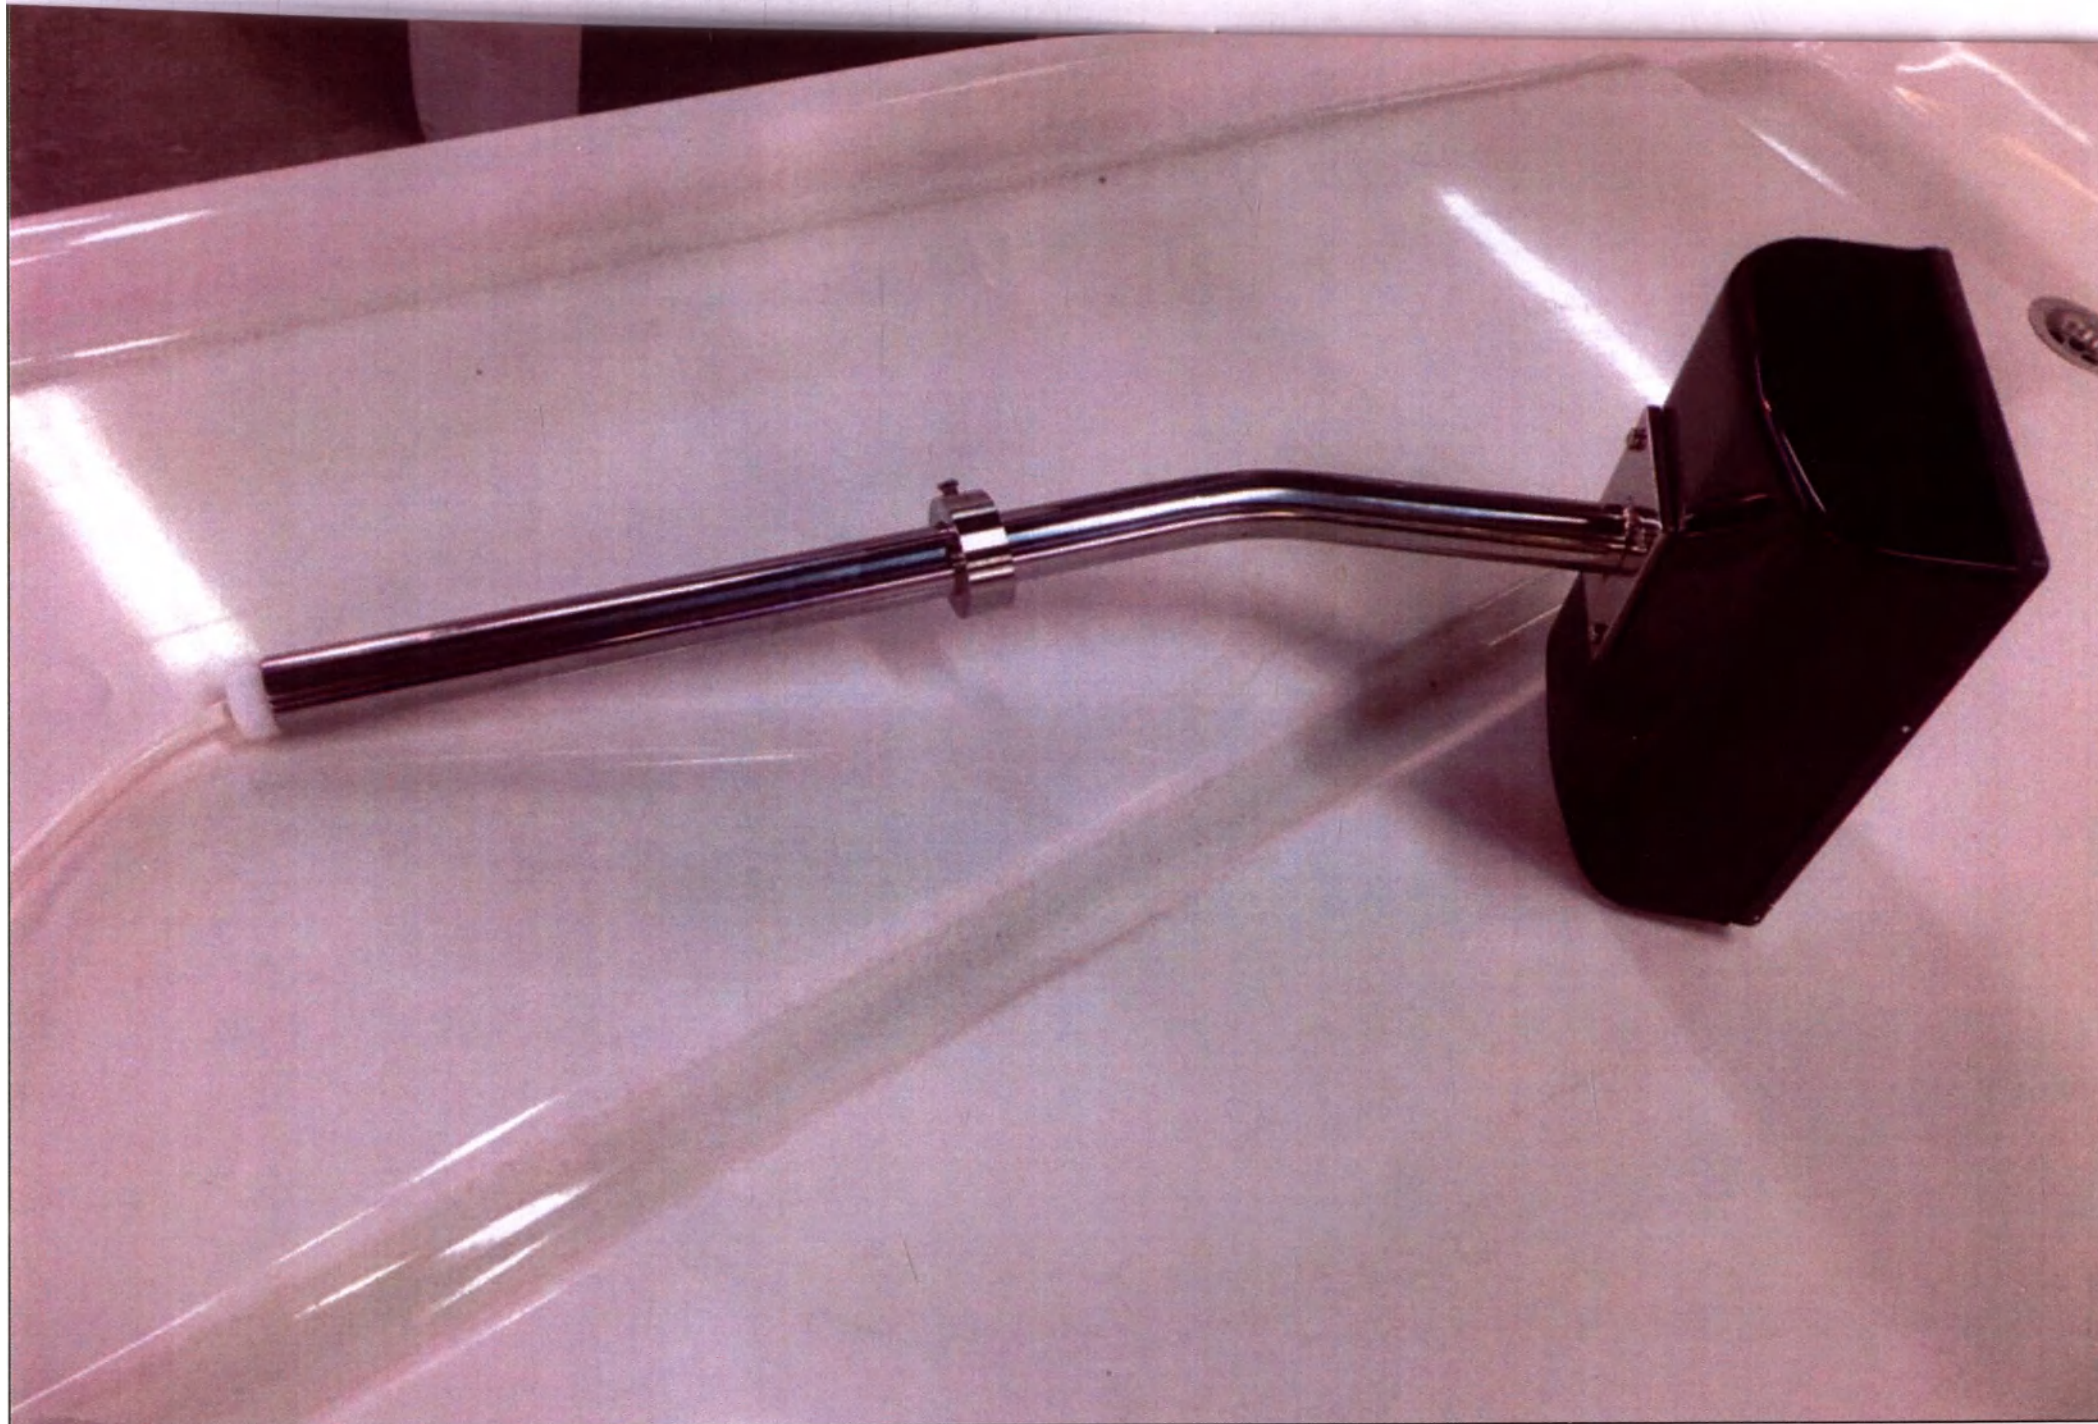

Пульт управления на короткой стойке

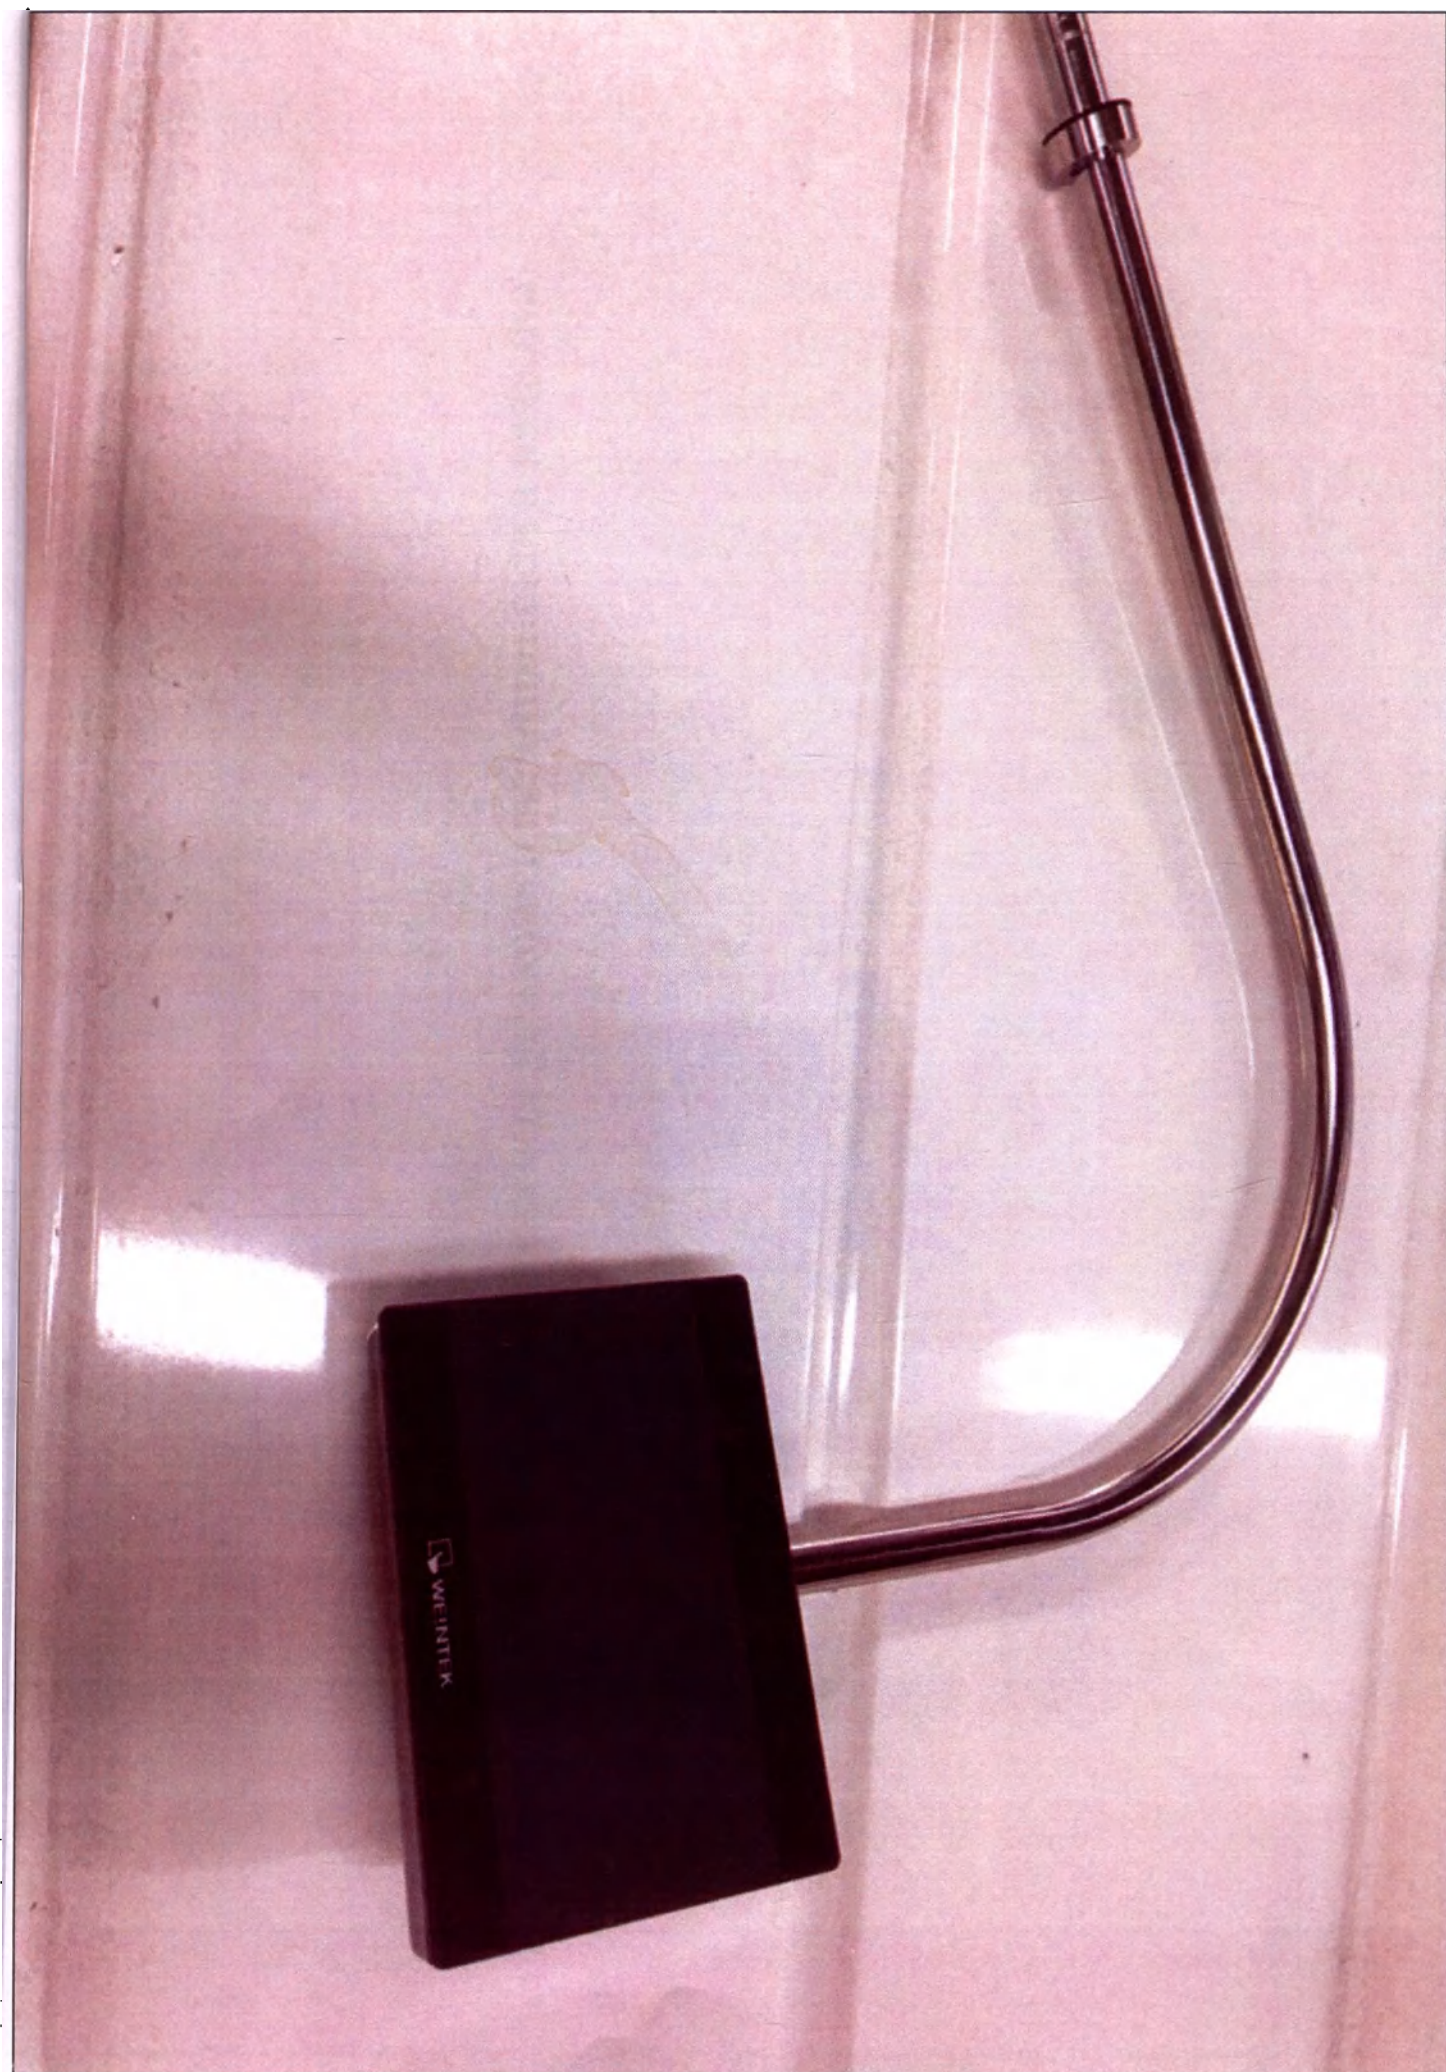

Фотографические изображения упаковки медицинского изделия





Условия хранения 2

Прошито и пронумеровано

Кол-во: 14 листов

Подпись

Ген.дир. Лапачев А.Е.

