


Фотографии общего вида медицинского изделия


Анализатор мочи UriLit автоматический, с принадлежностями

1. Анализатор мочи UriLit автоматический, варианты исполнения:
- UriLit 1500,

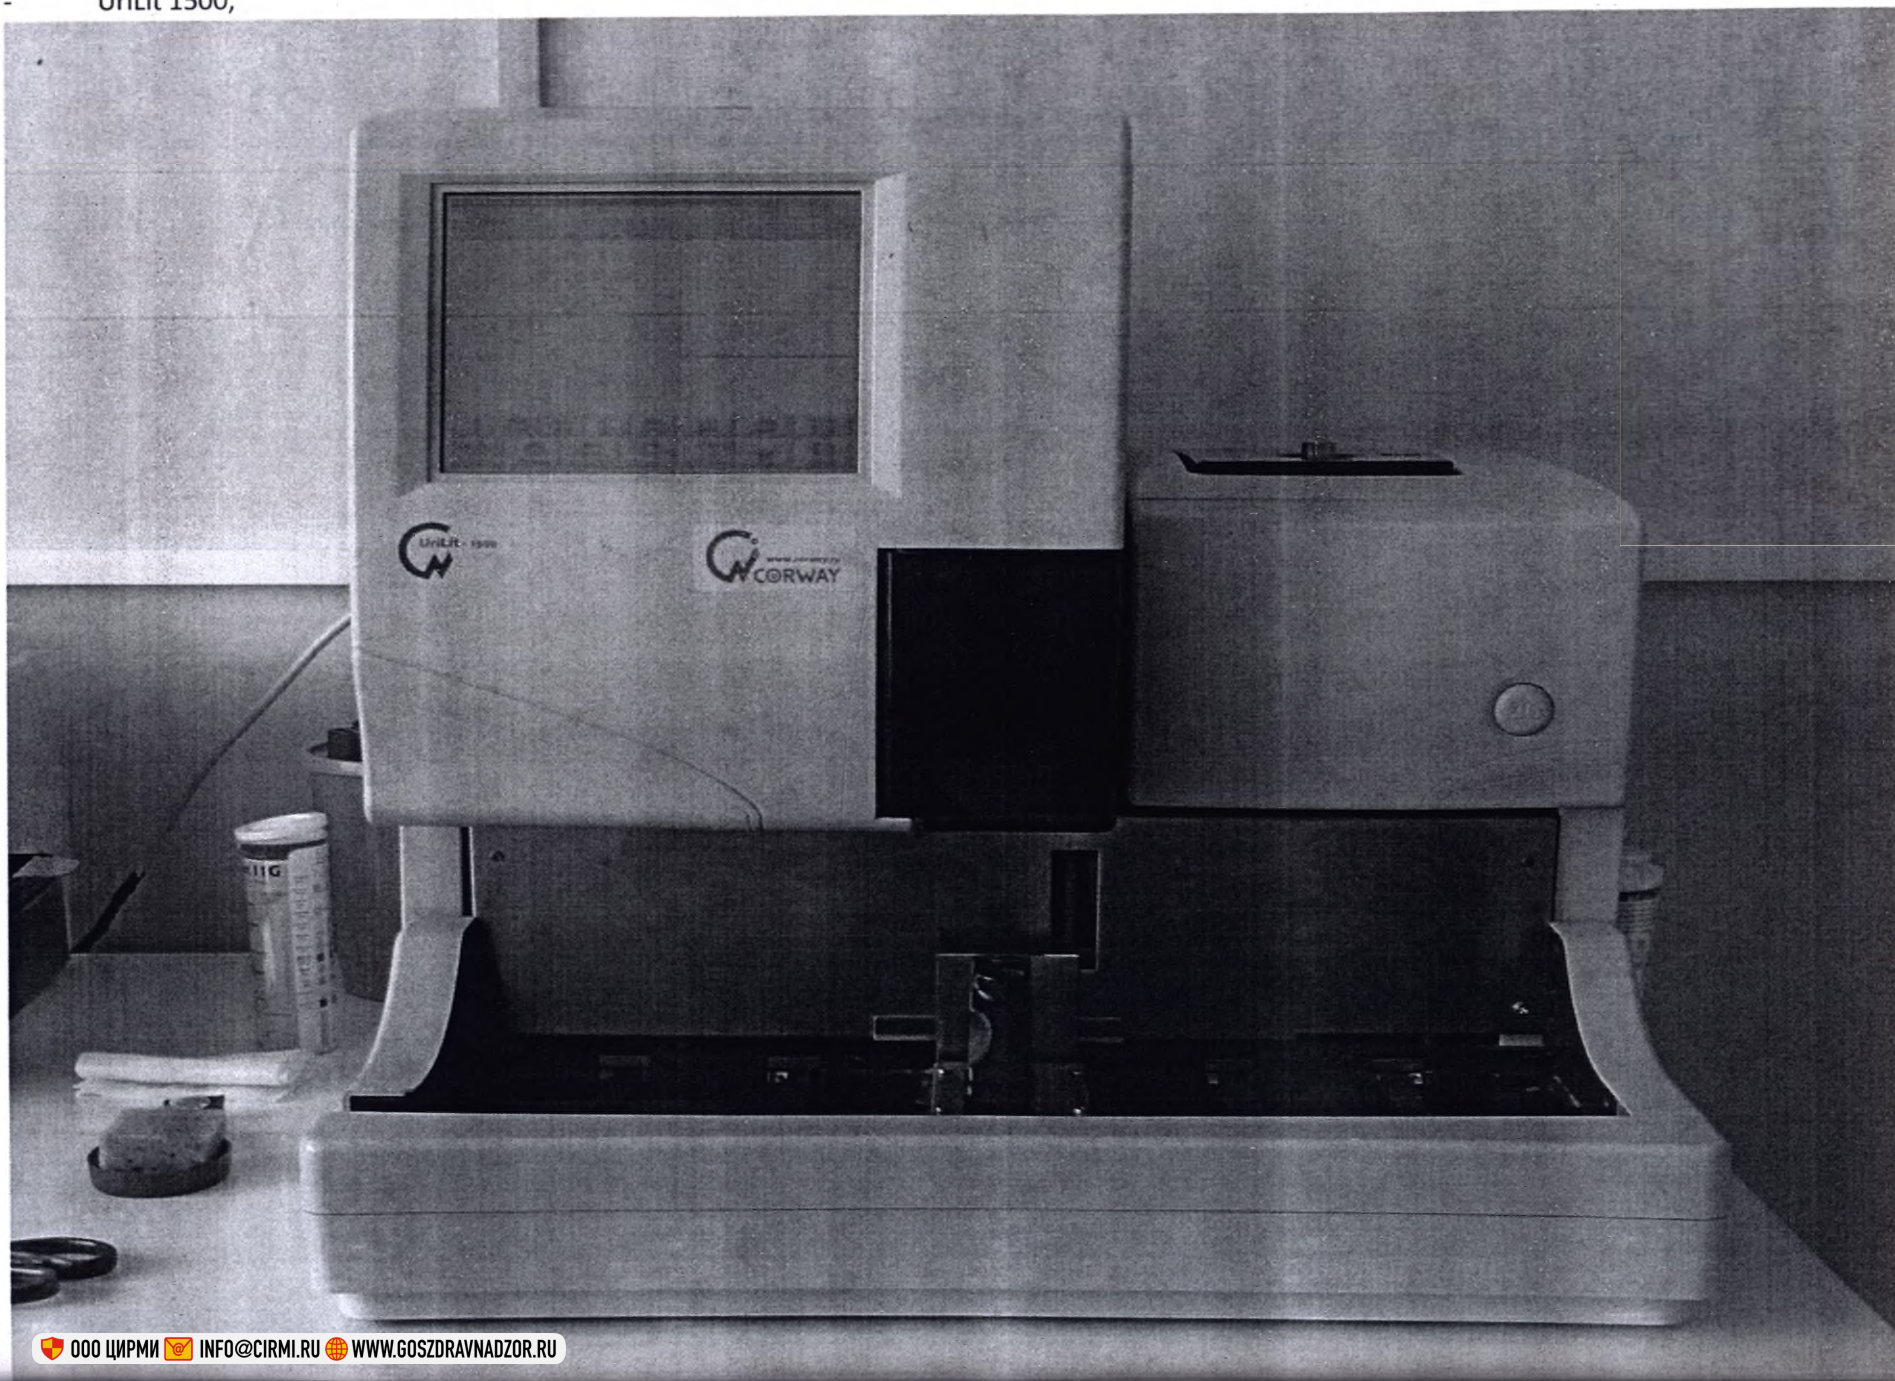

UriLit 1600.

UriLit-1600

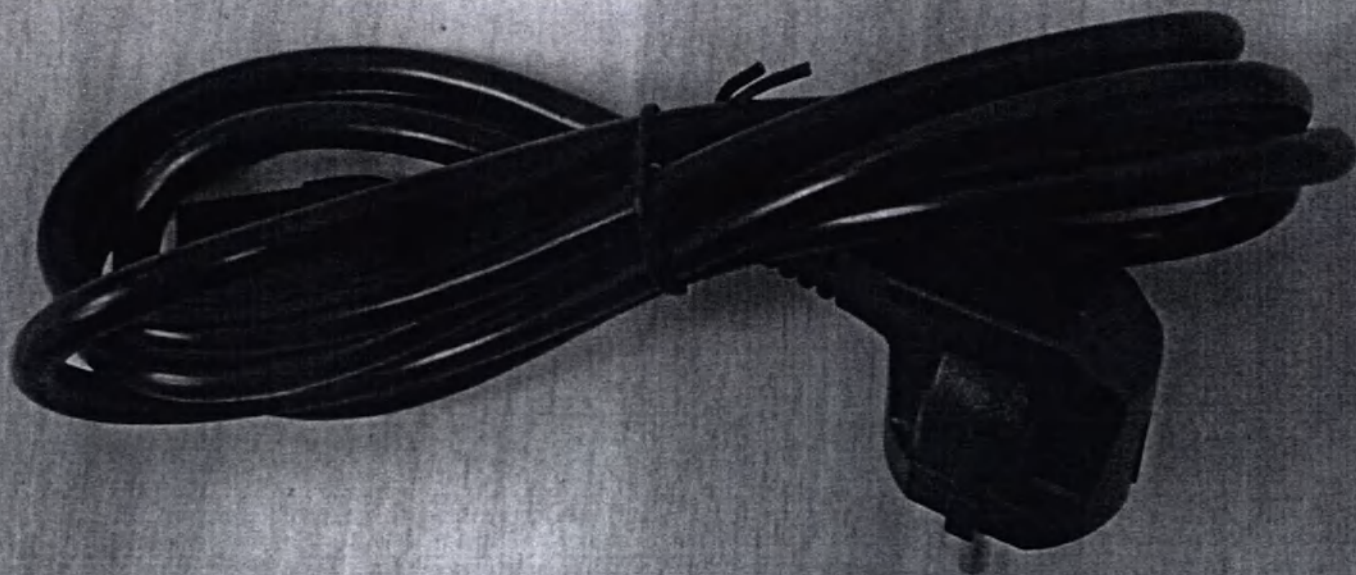

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

на медицинское изделие


«Анализатор мочи UriLit автоматический, с
принадлежностями»,

Производства


«УРИТ МЕДИКАЛ ЭЛЕКТРОНИК КО., ЛТД.»


Стартовый набор:

1) Детергент URIT D 12 500 мл

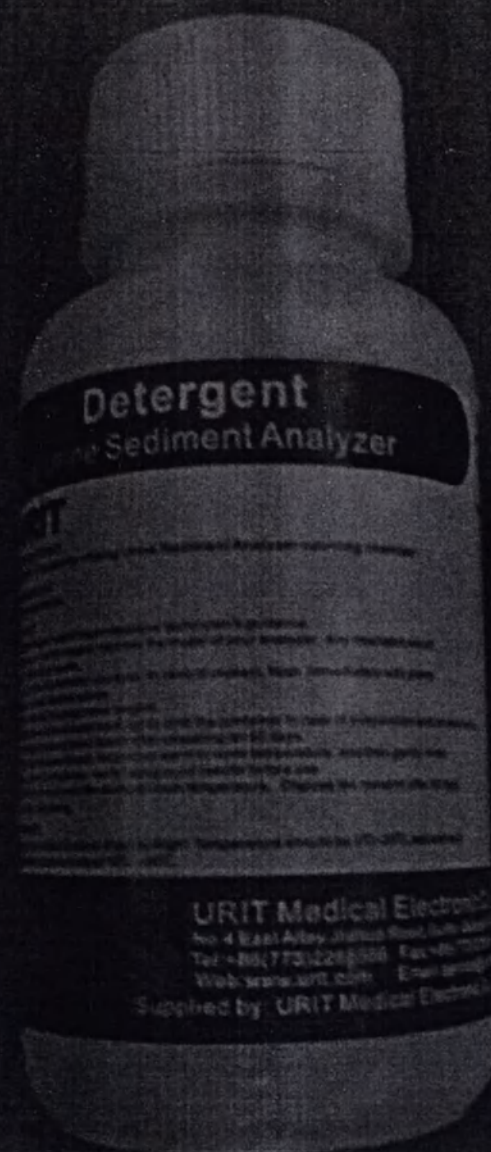


2) Промывающий раствор для обслуживания URIT D 22 1л

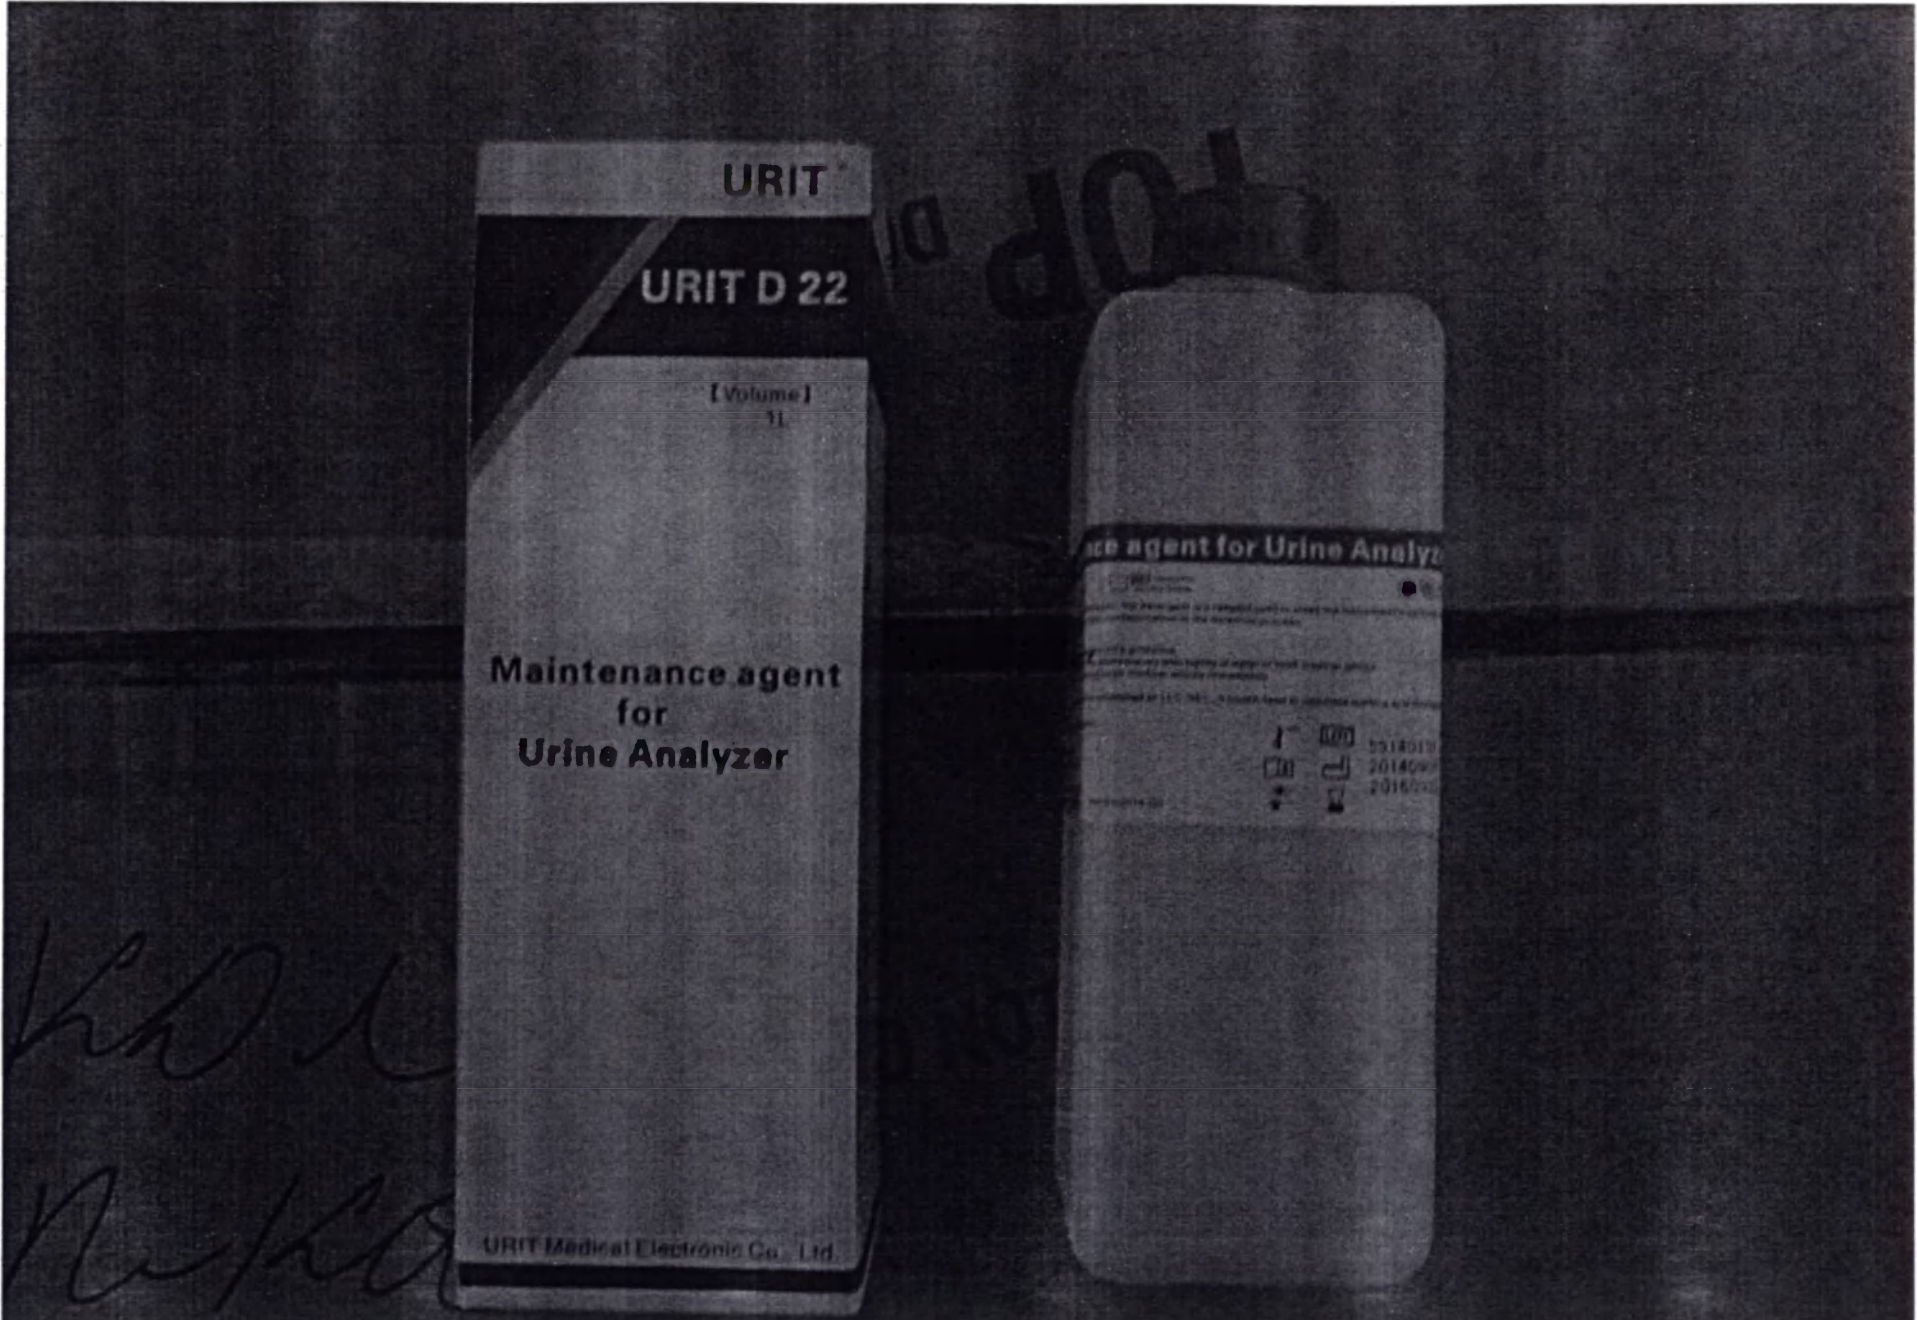

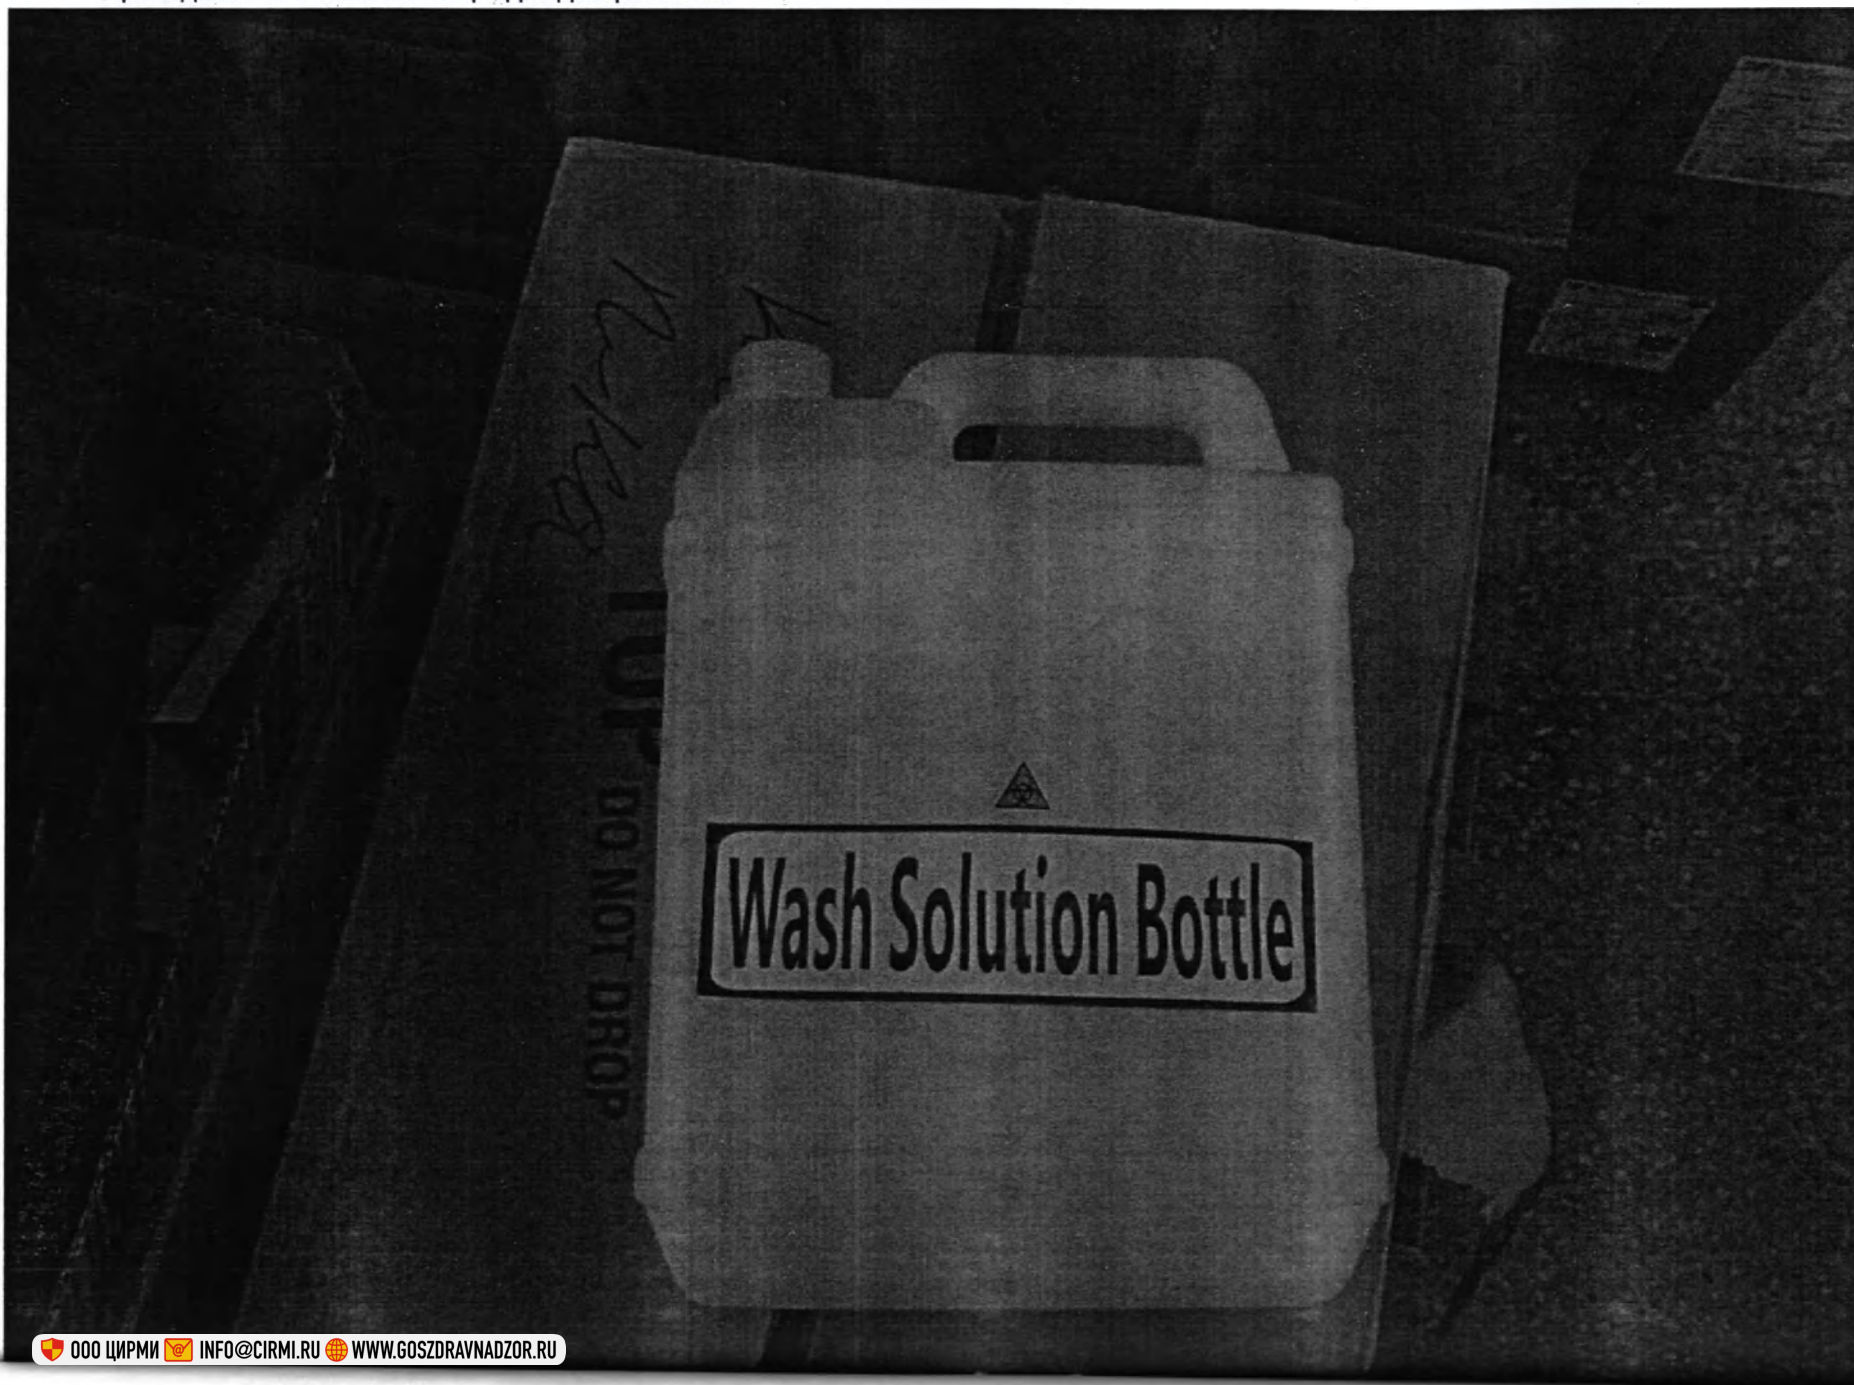




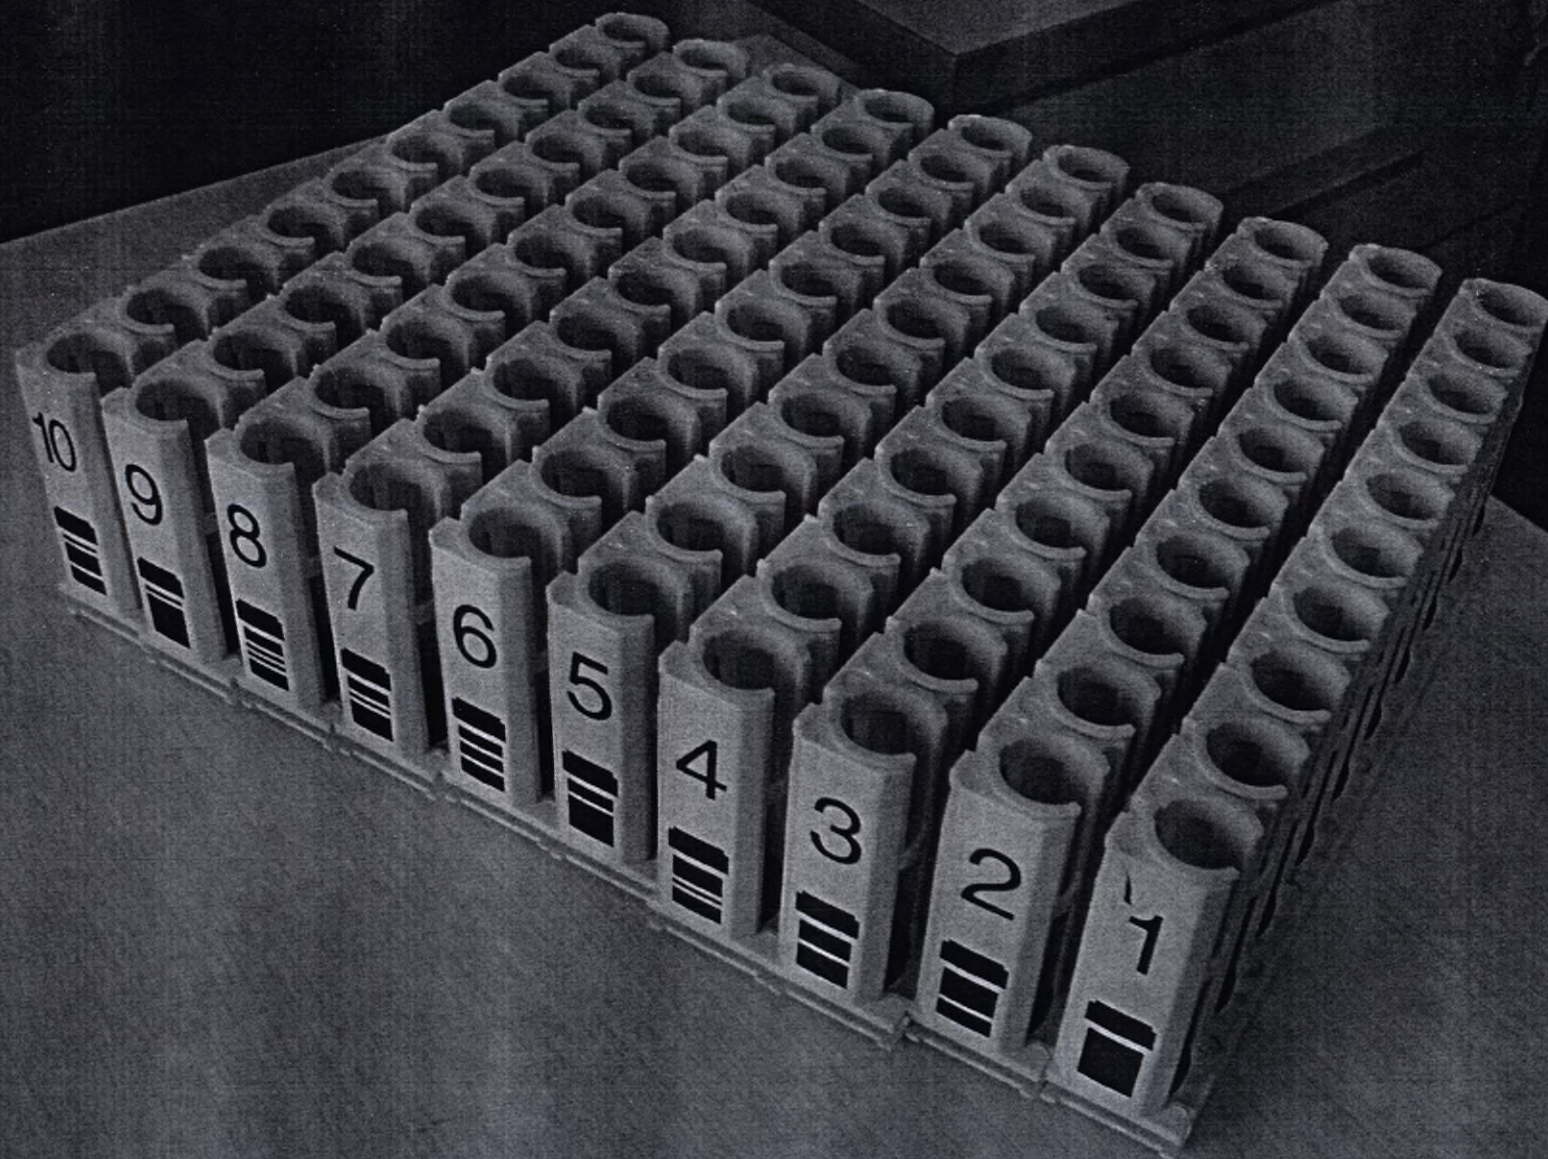





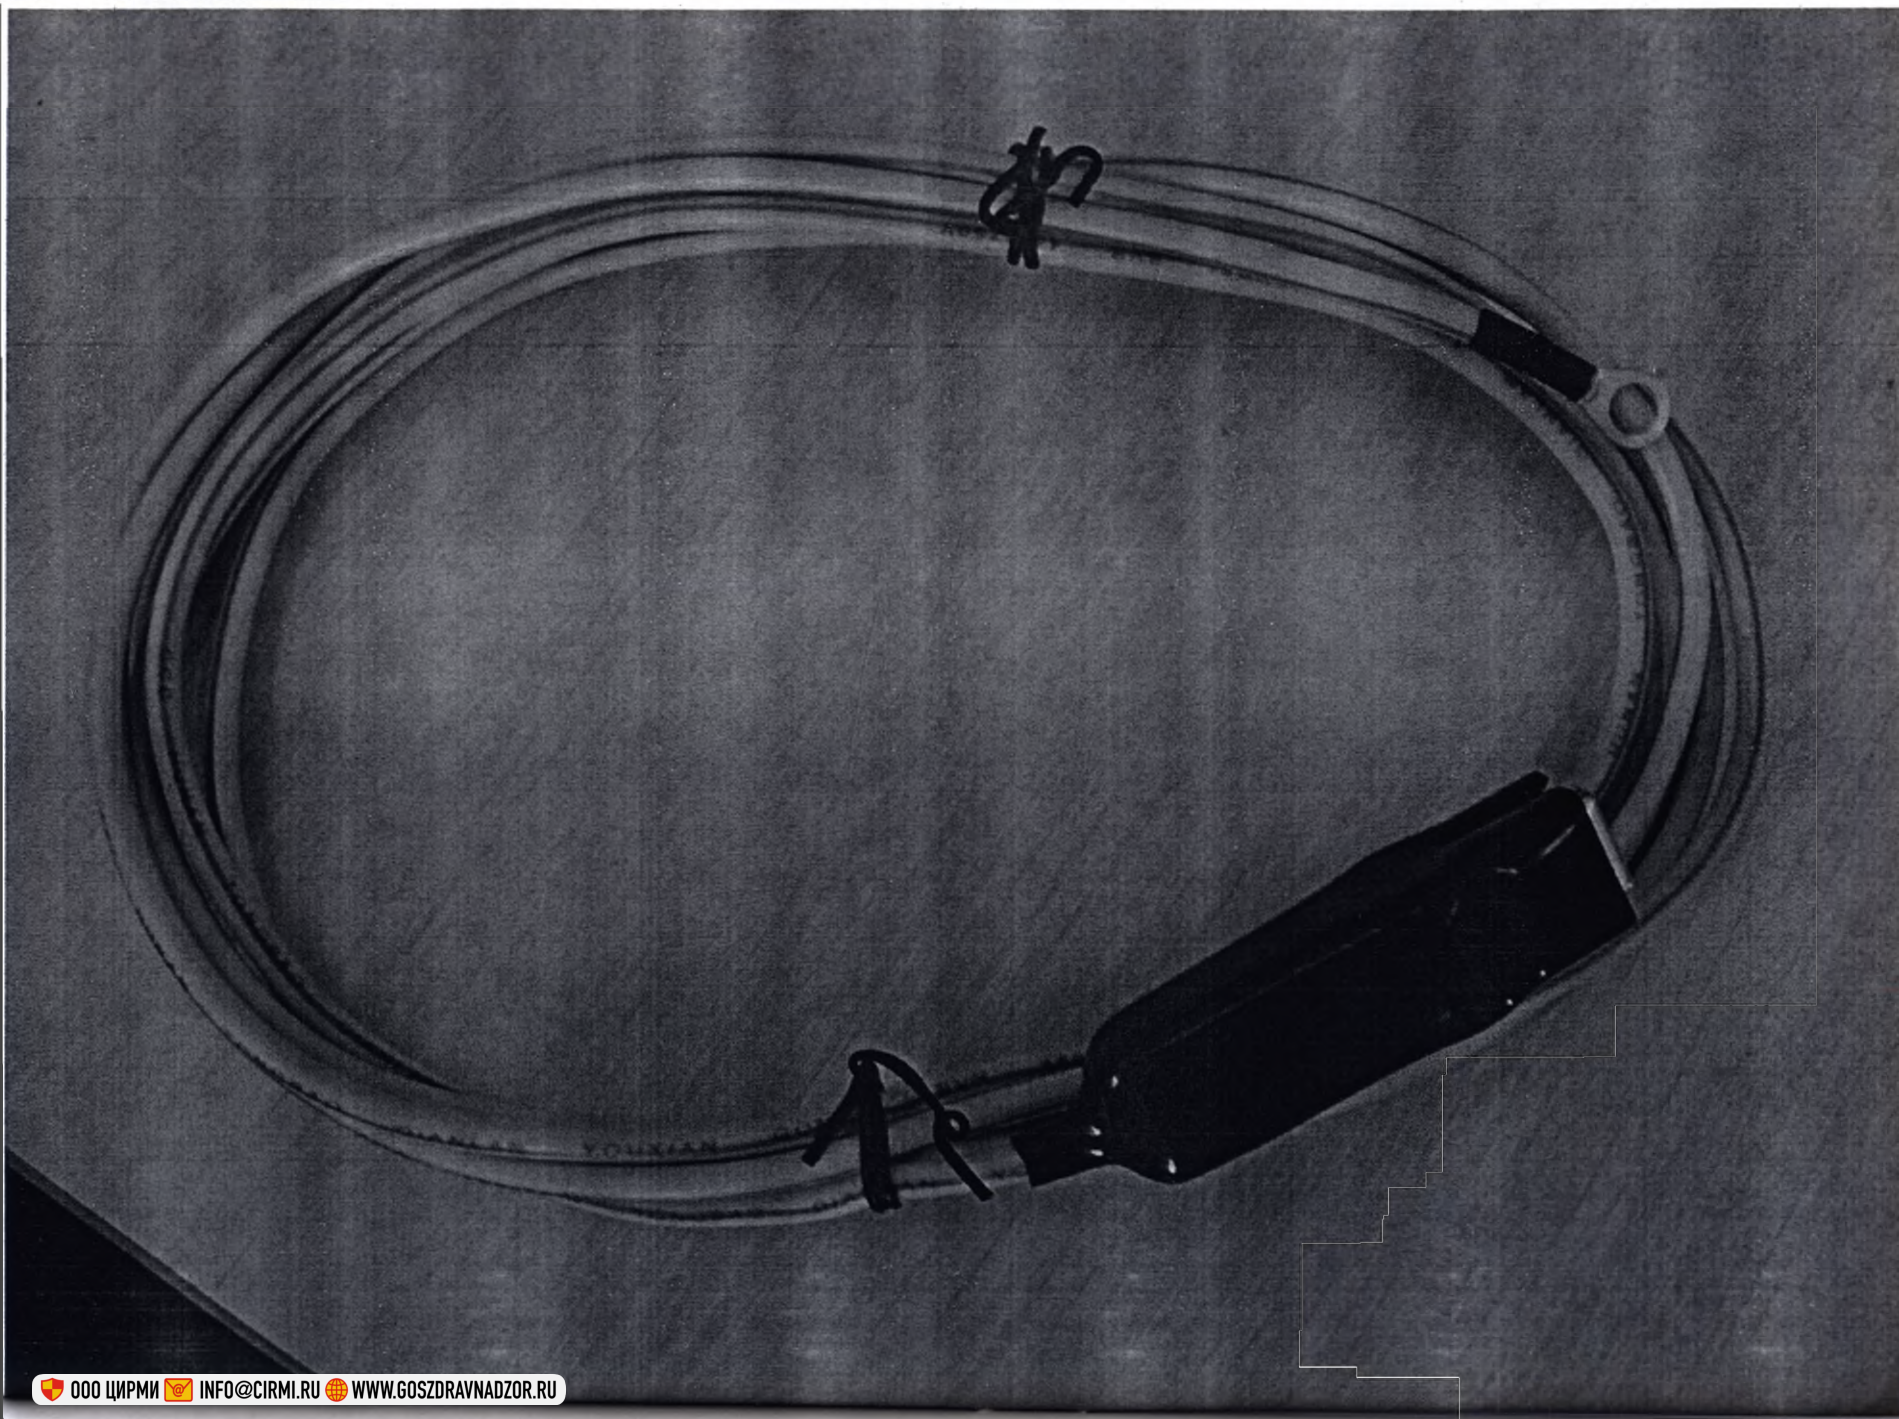





2.8. Силиконовая трубка 1м $\varnothing$ 2; 2.9. Силиконовая трубка 1м $\varnothing$ 3; 2.10. Силиконовая трубка 0,5м $\varnothing$ 1






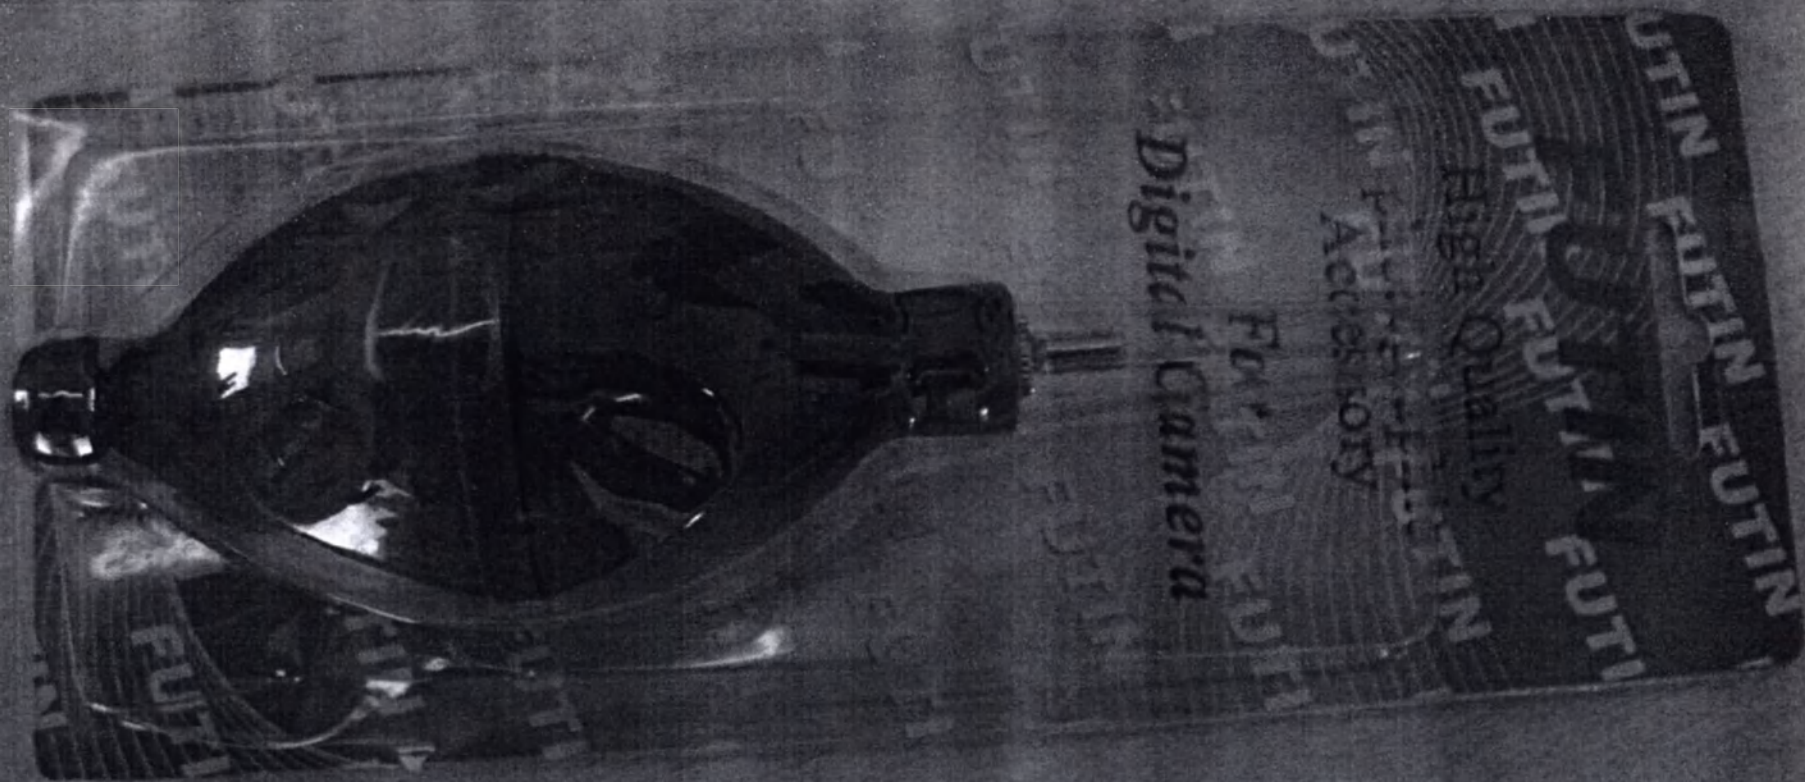

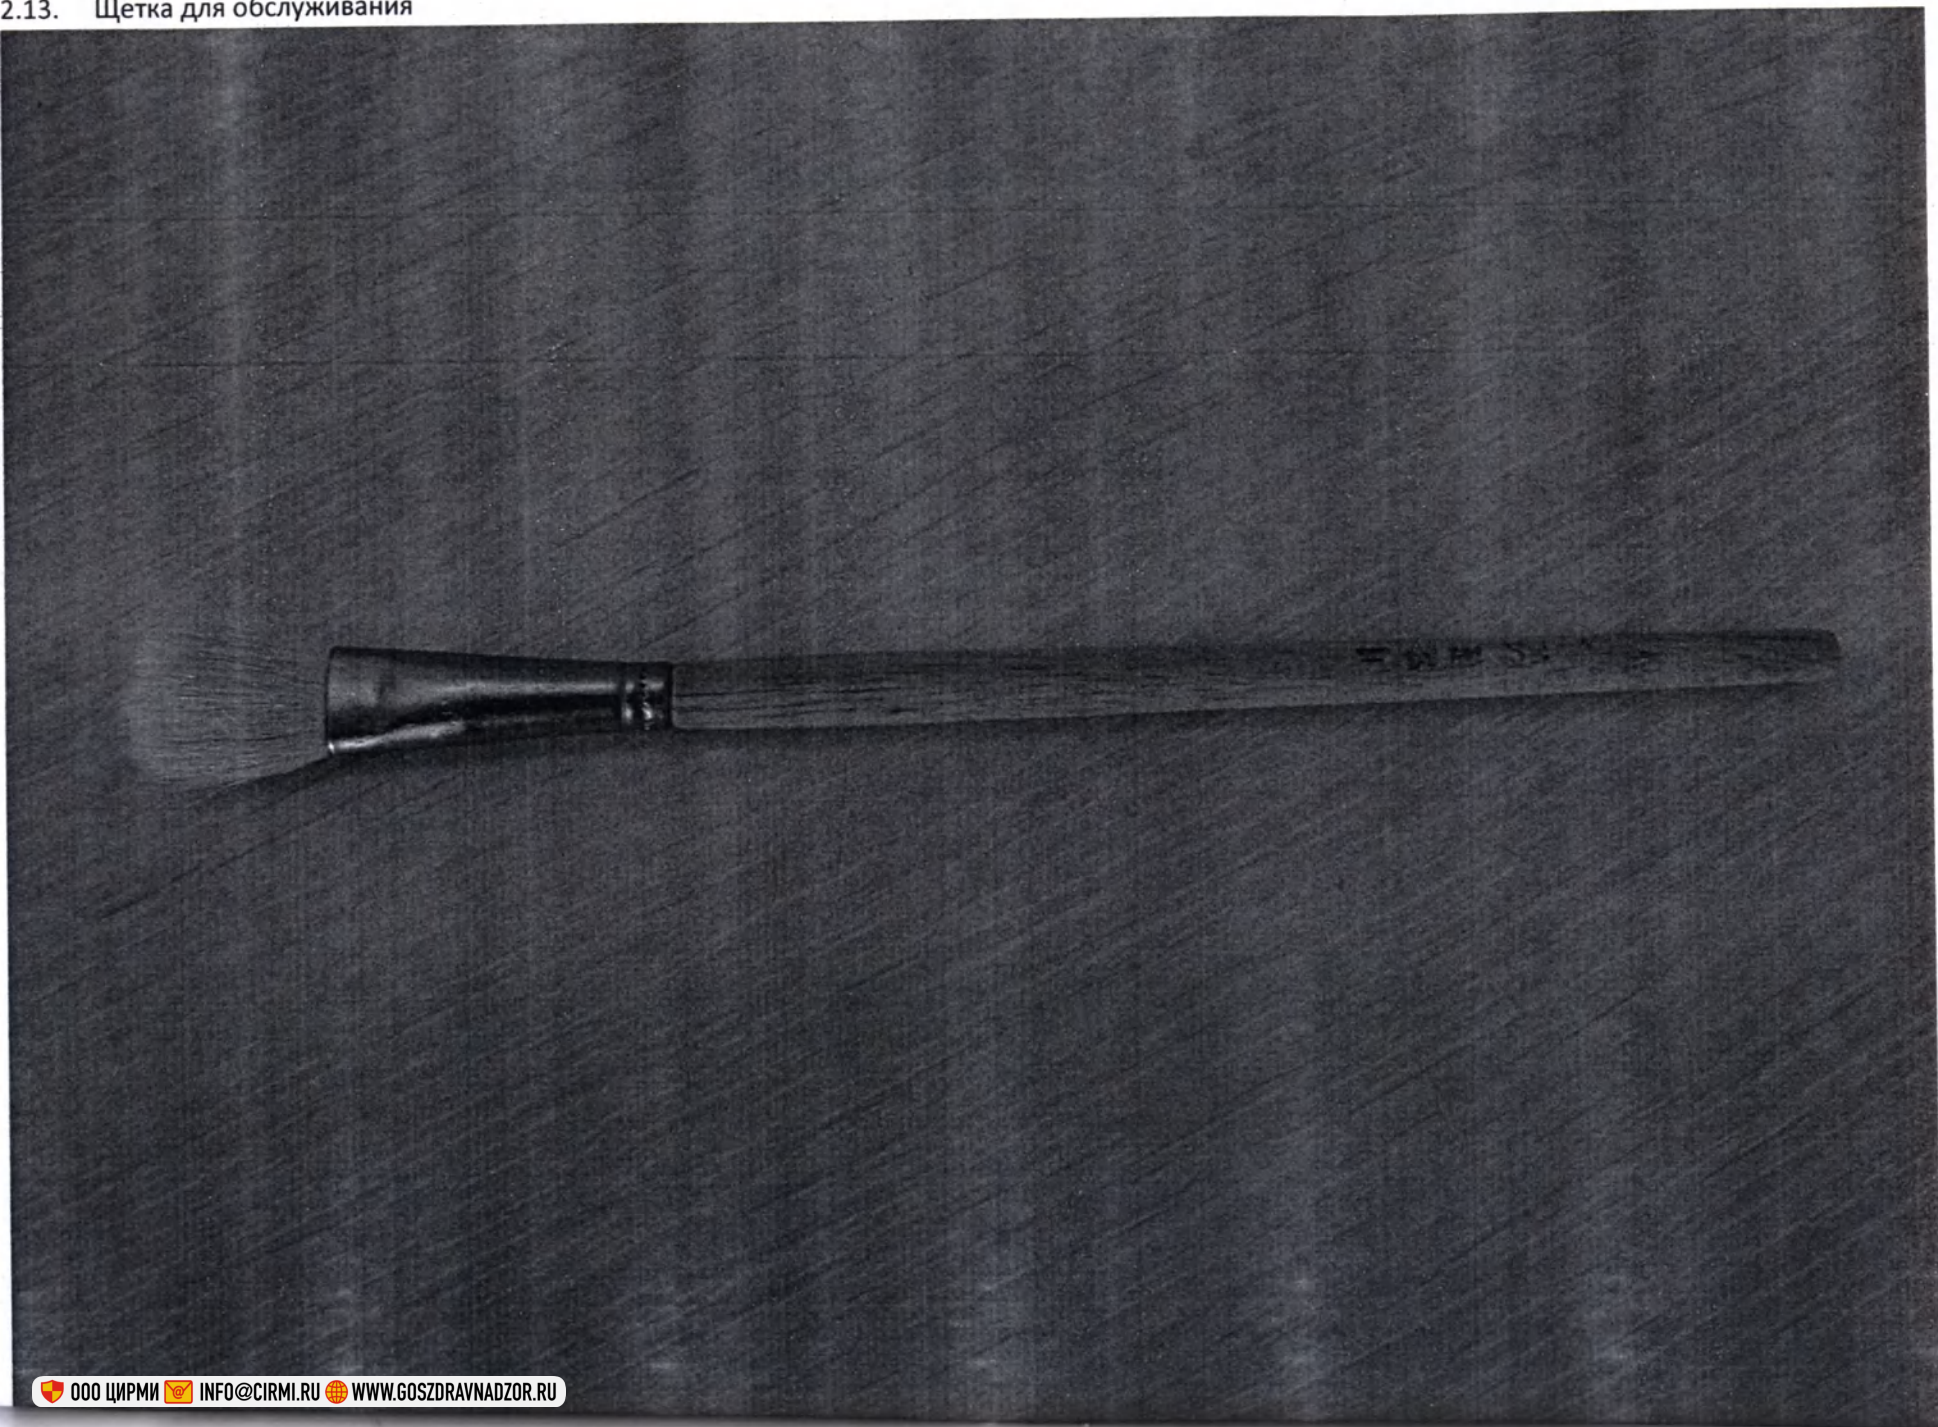


14. Смазка для клапанов, 10мл

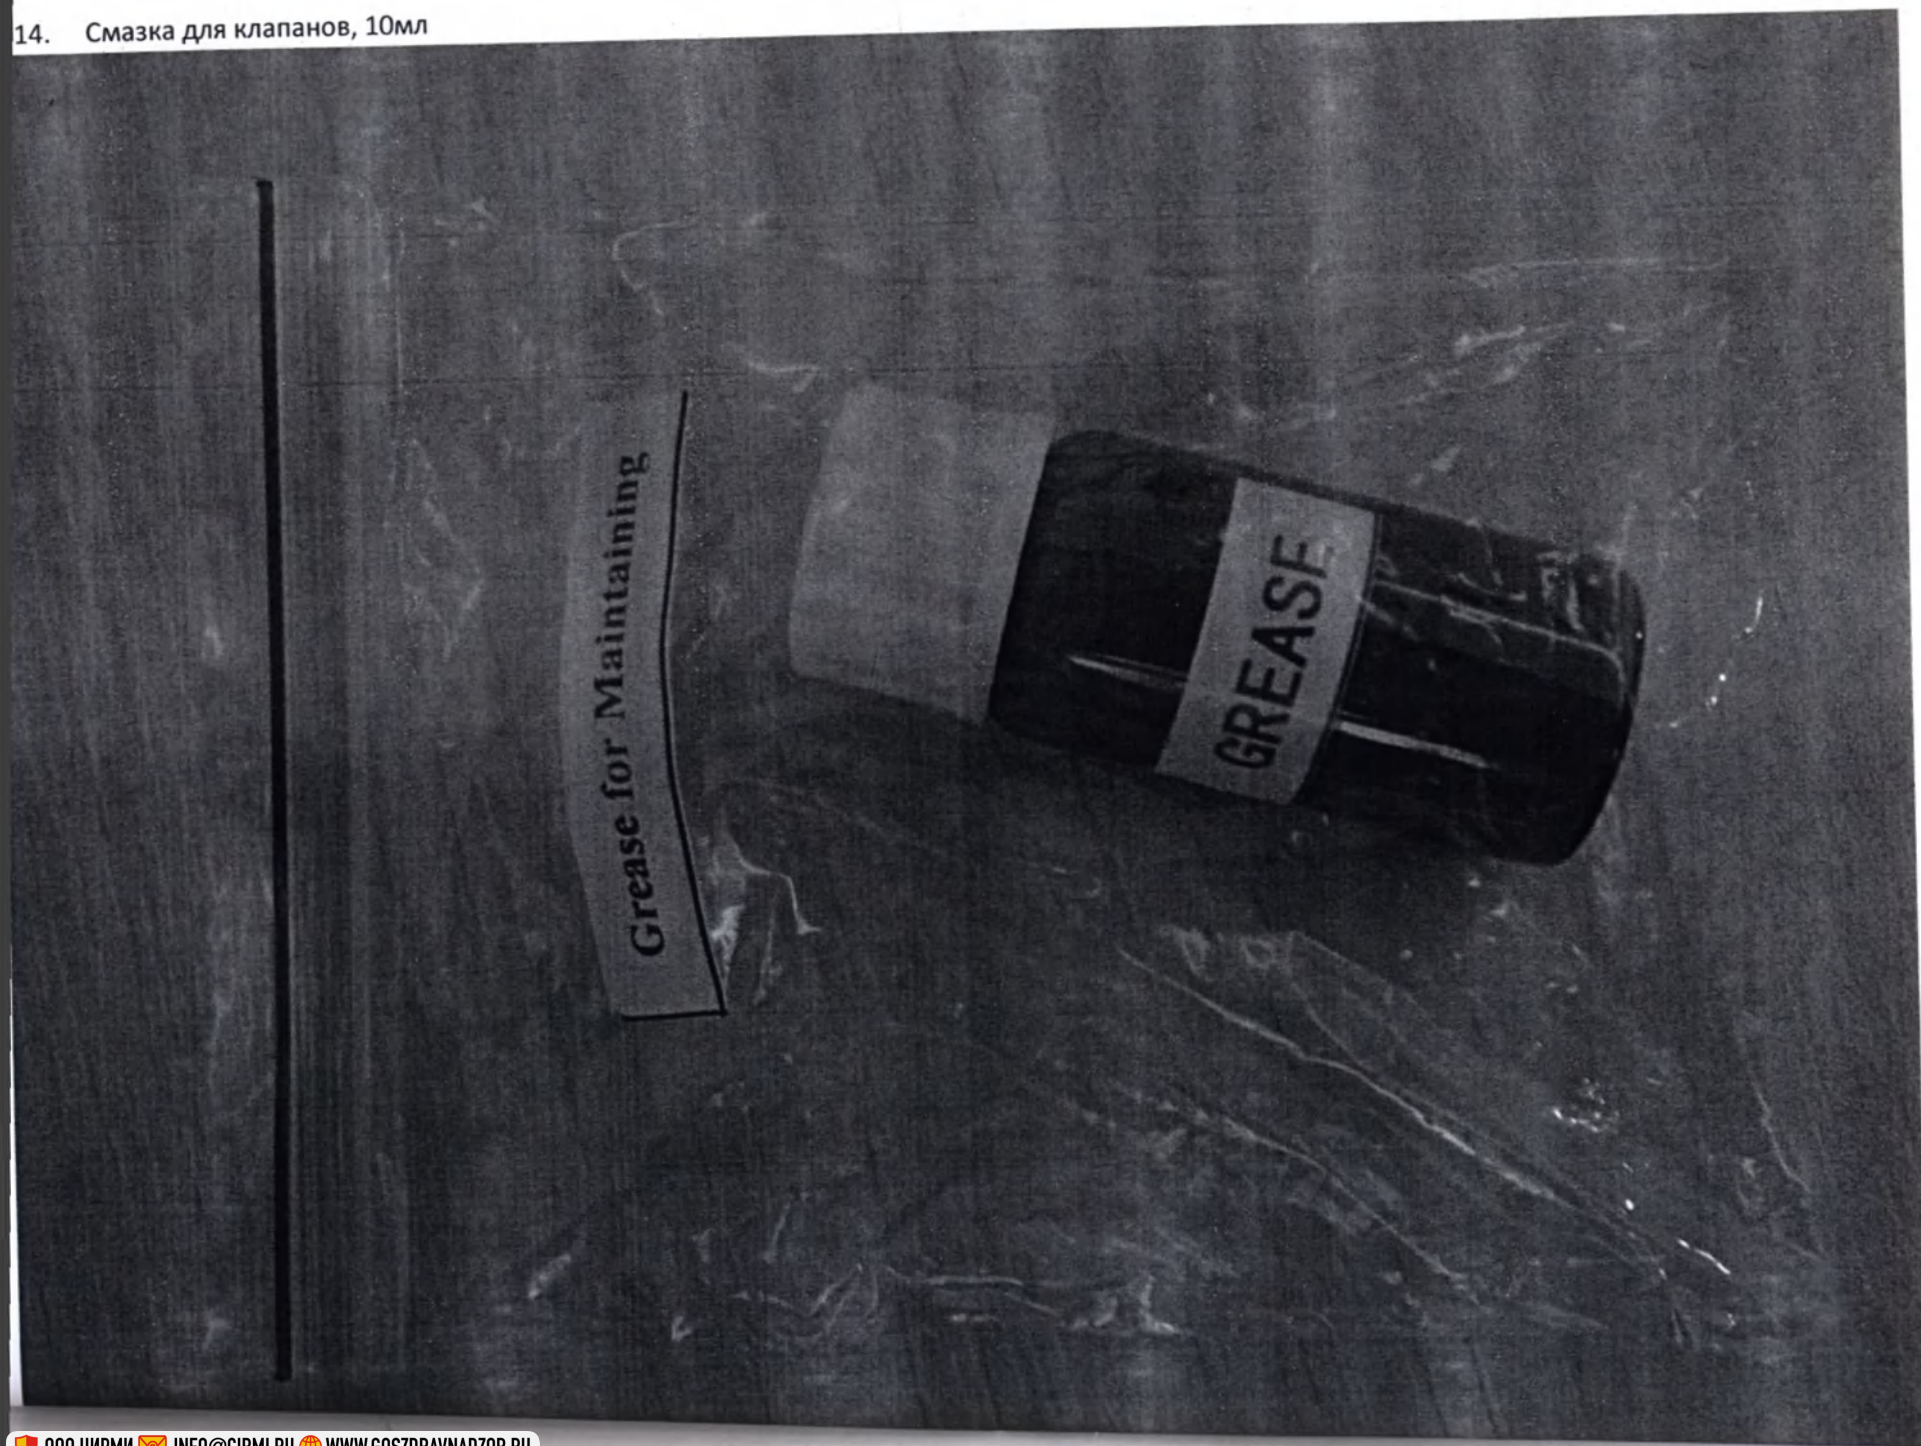






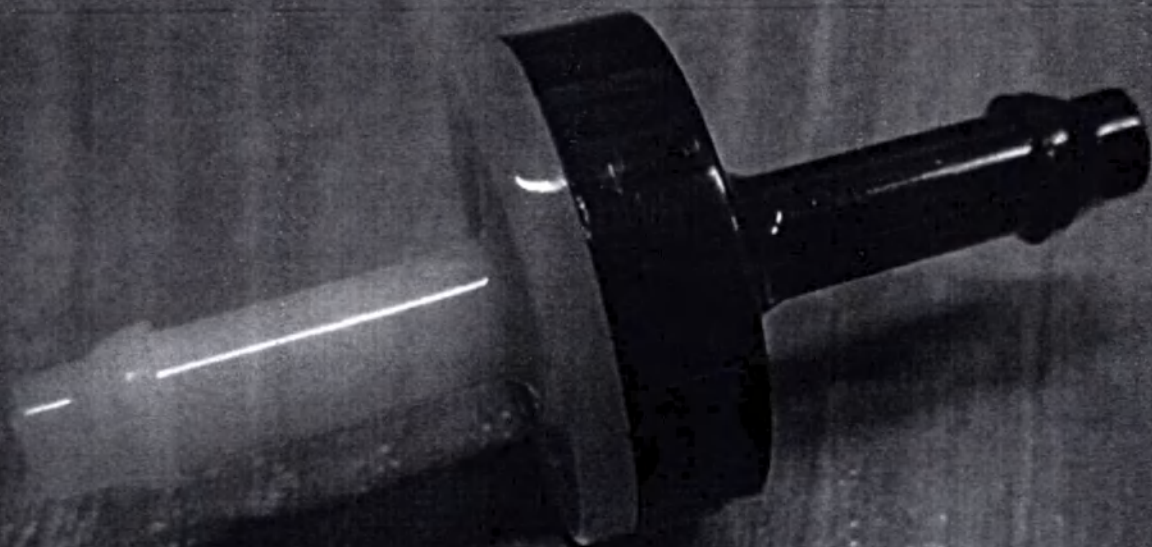









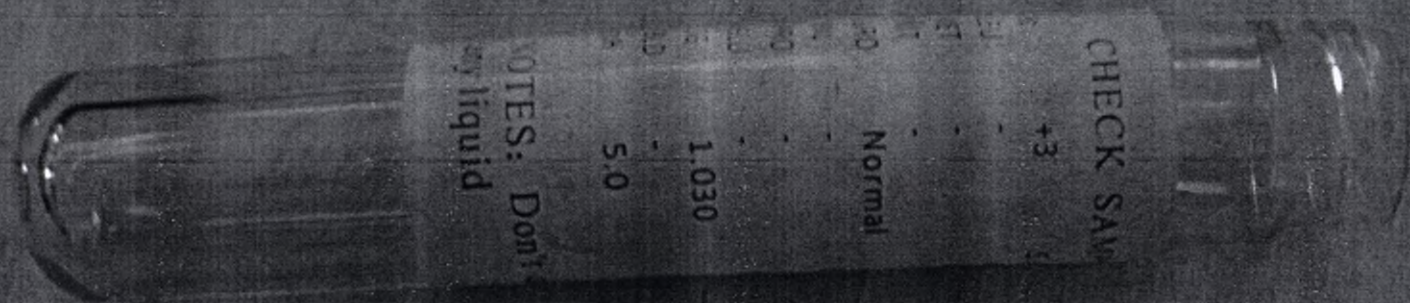


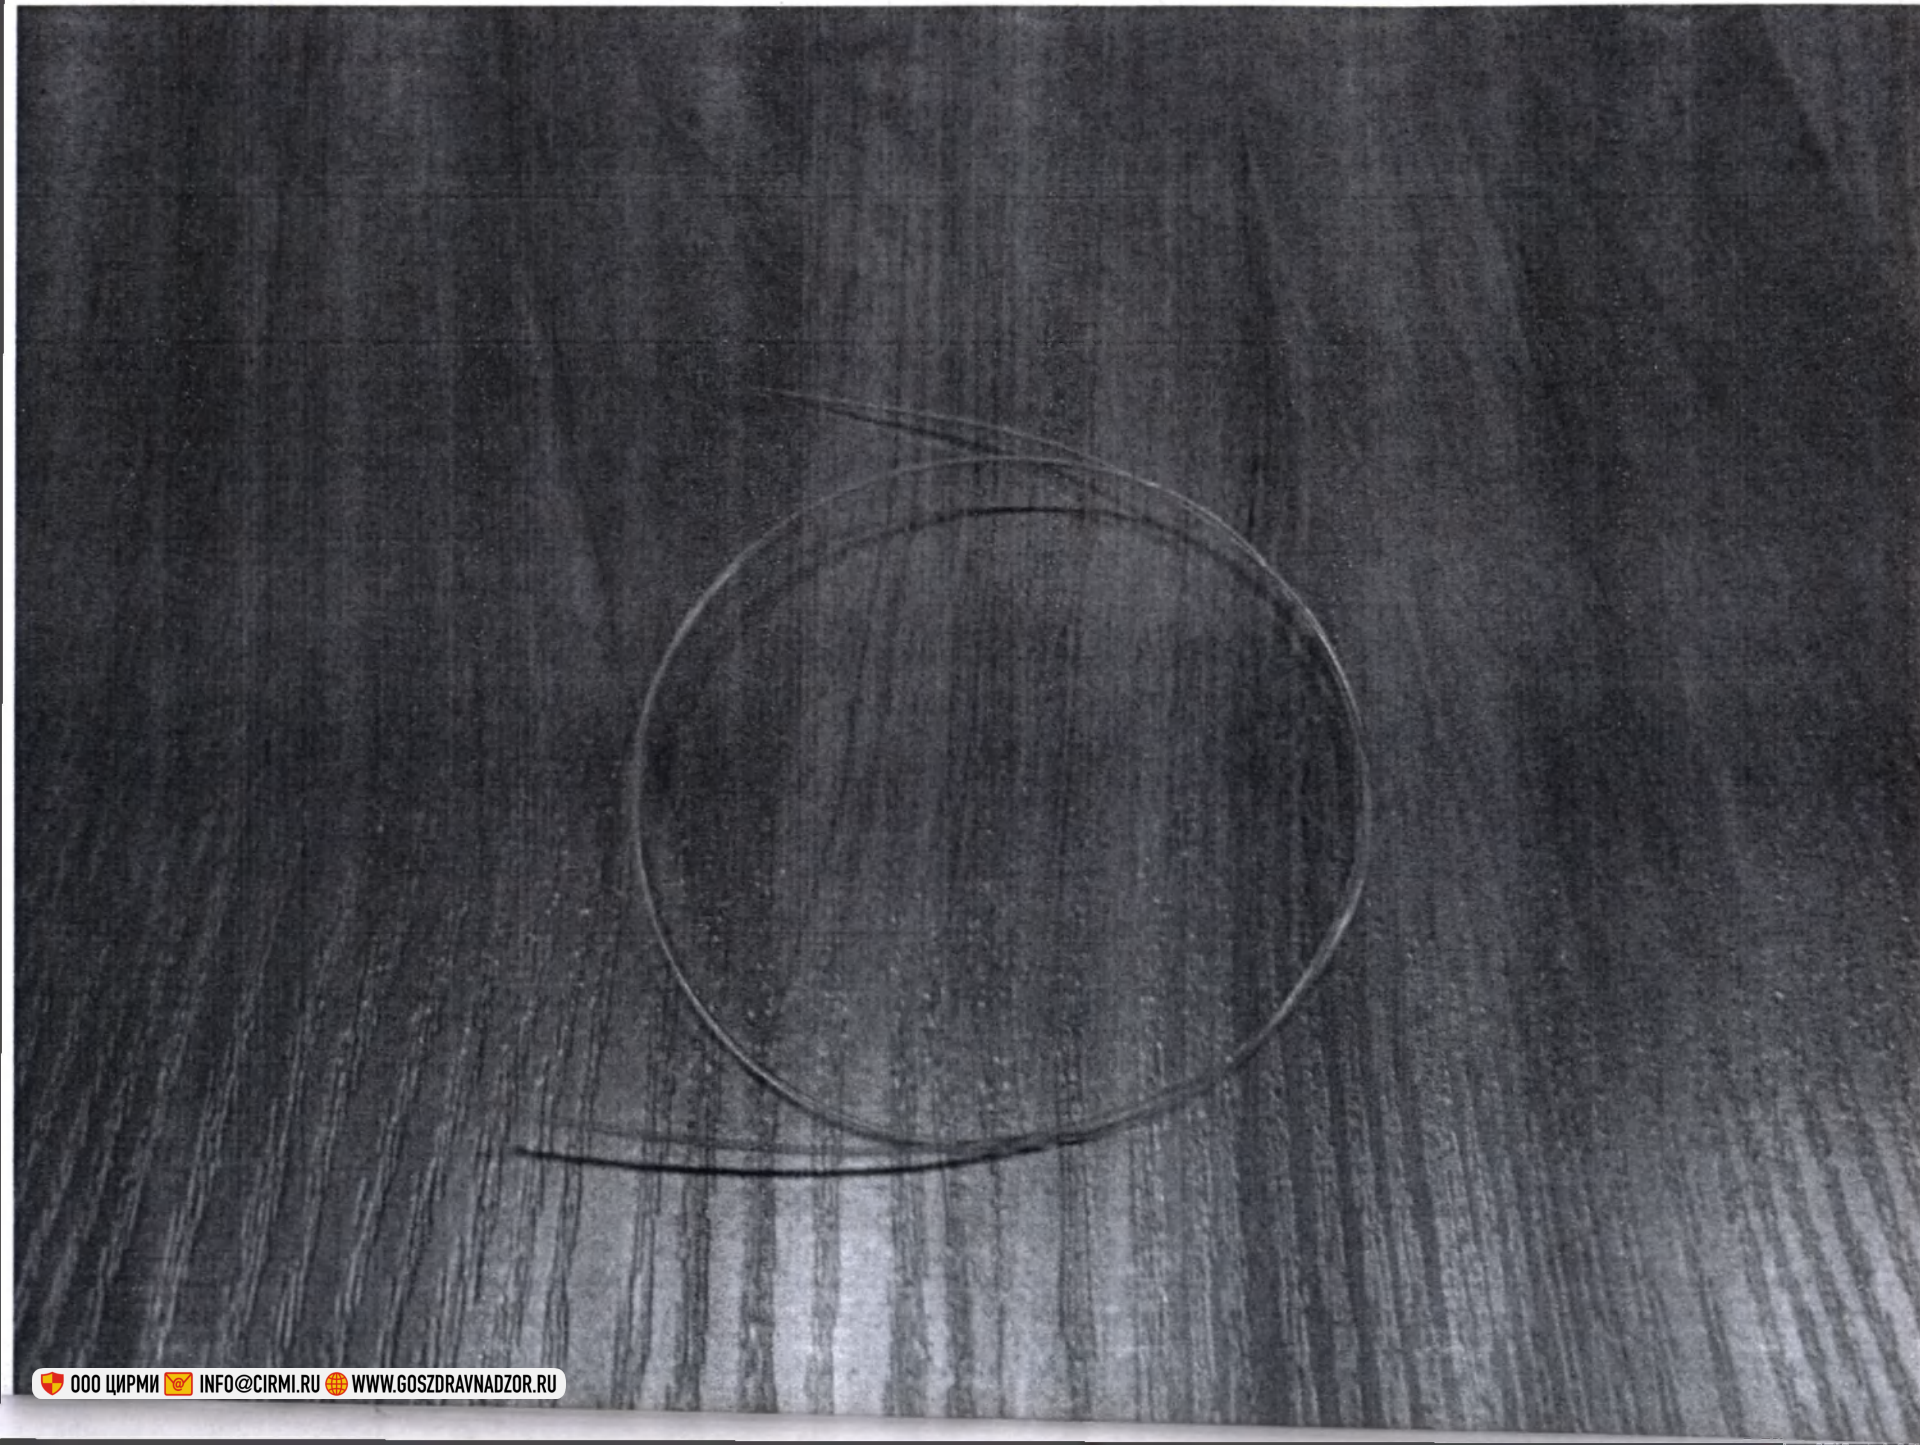


2.23. Металлическая пластина для соединения с 4 винтами



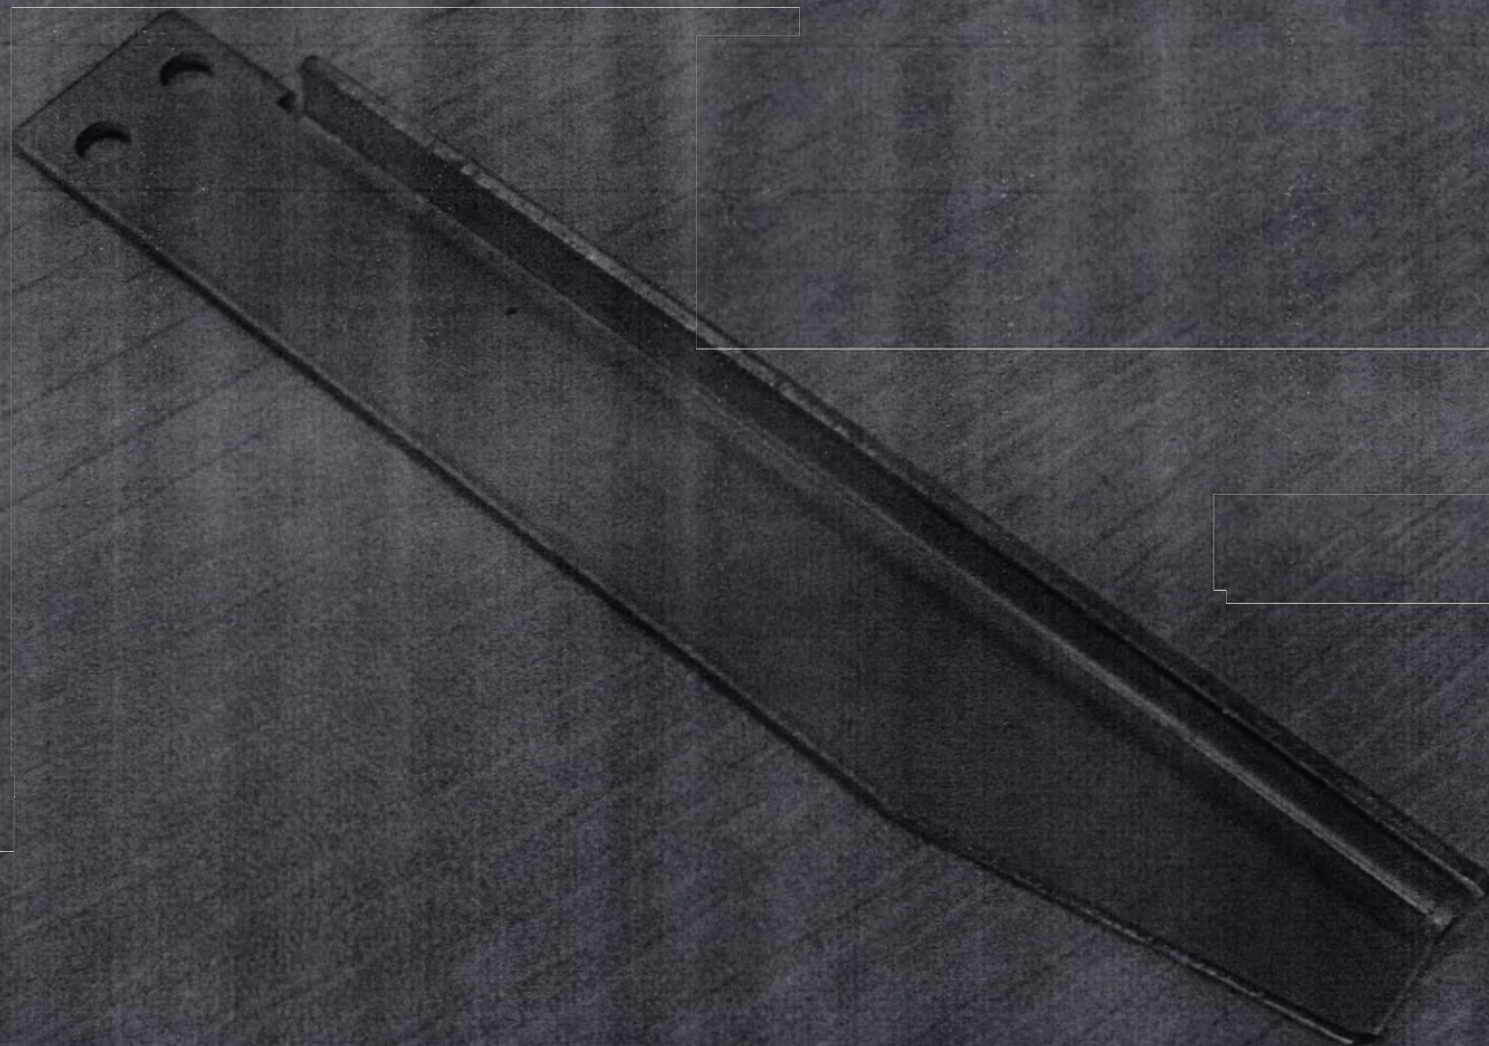

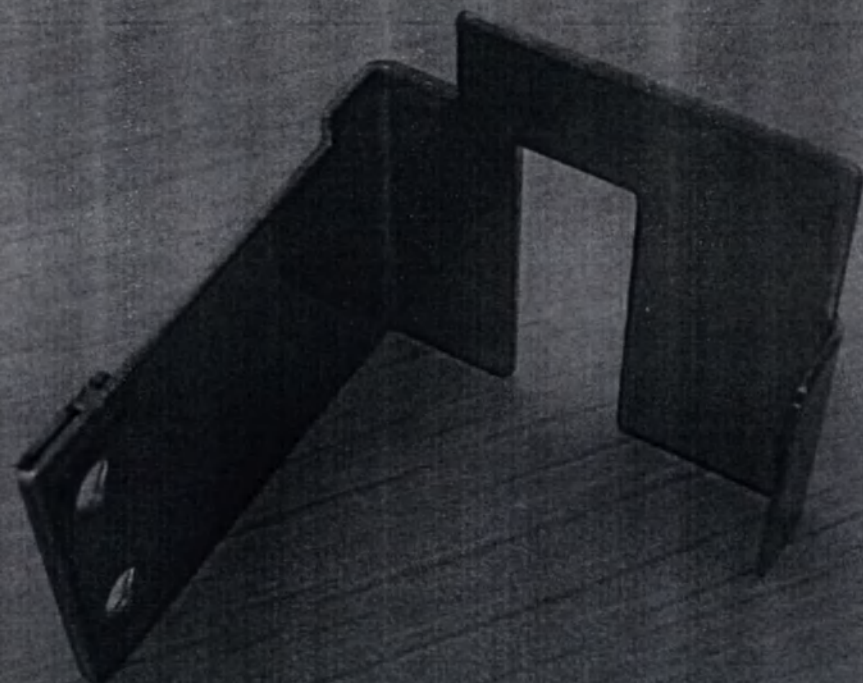

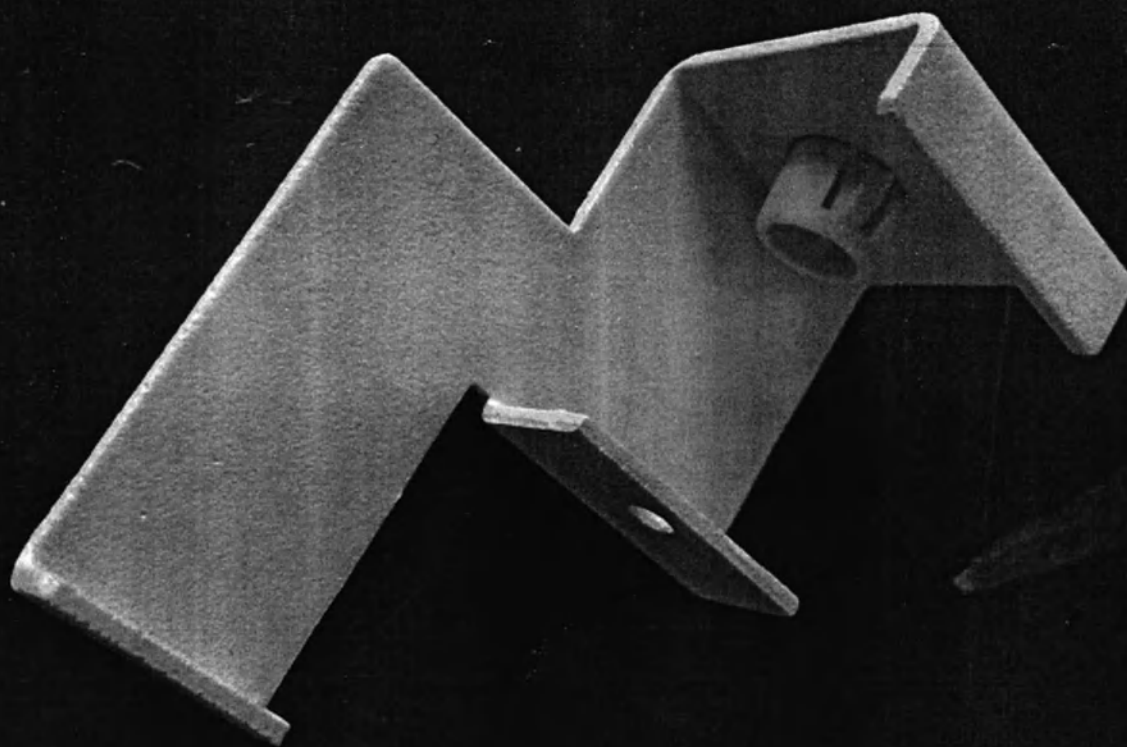

Прошито и скреплено печатью

31 лист (*тридцать один*)

Генеральный директор ООО «КОРВЕИ»

Линд В.А.

