

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Синерджи Консалтинг»




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

«Набор поверхностных референтных электродов»

Производитель: «Бостон Сайентифик Корпорейшн», США.

Boston Scientific Corporation, 300 Boston Scientific Way, Marlborough , MA 01752, USA

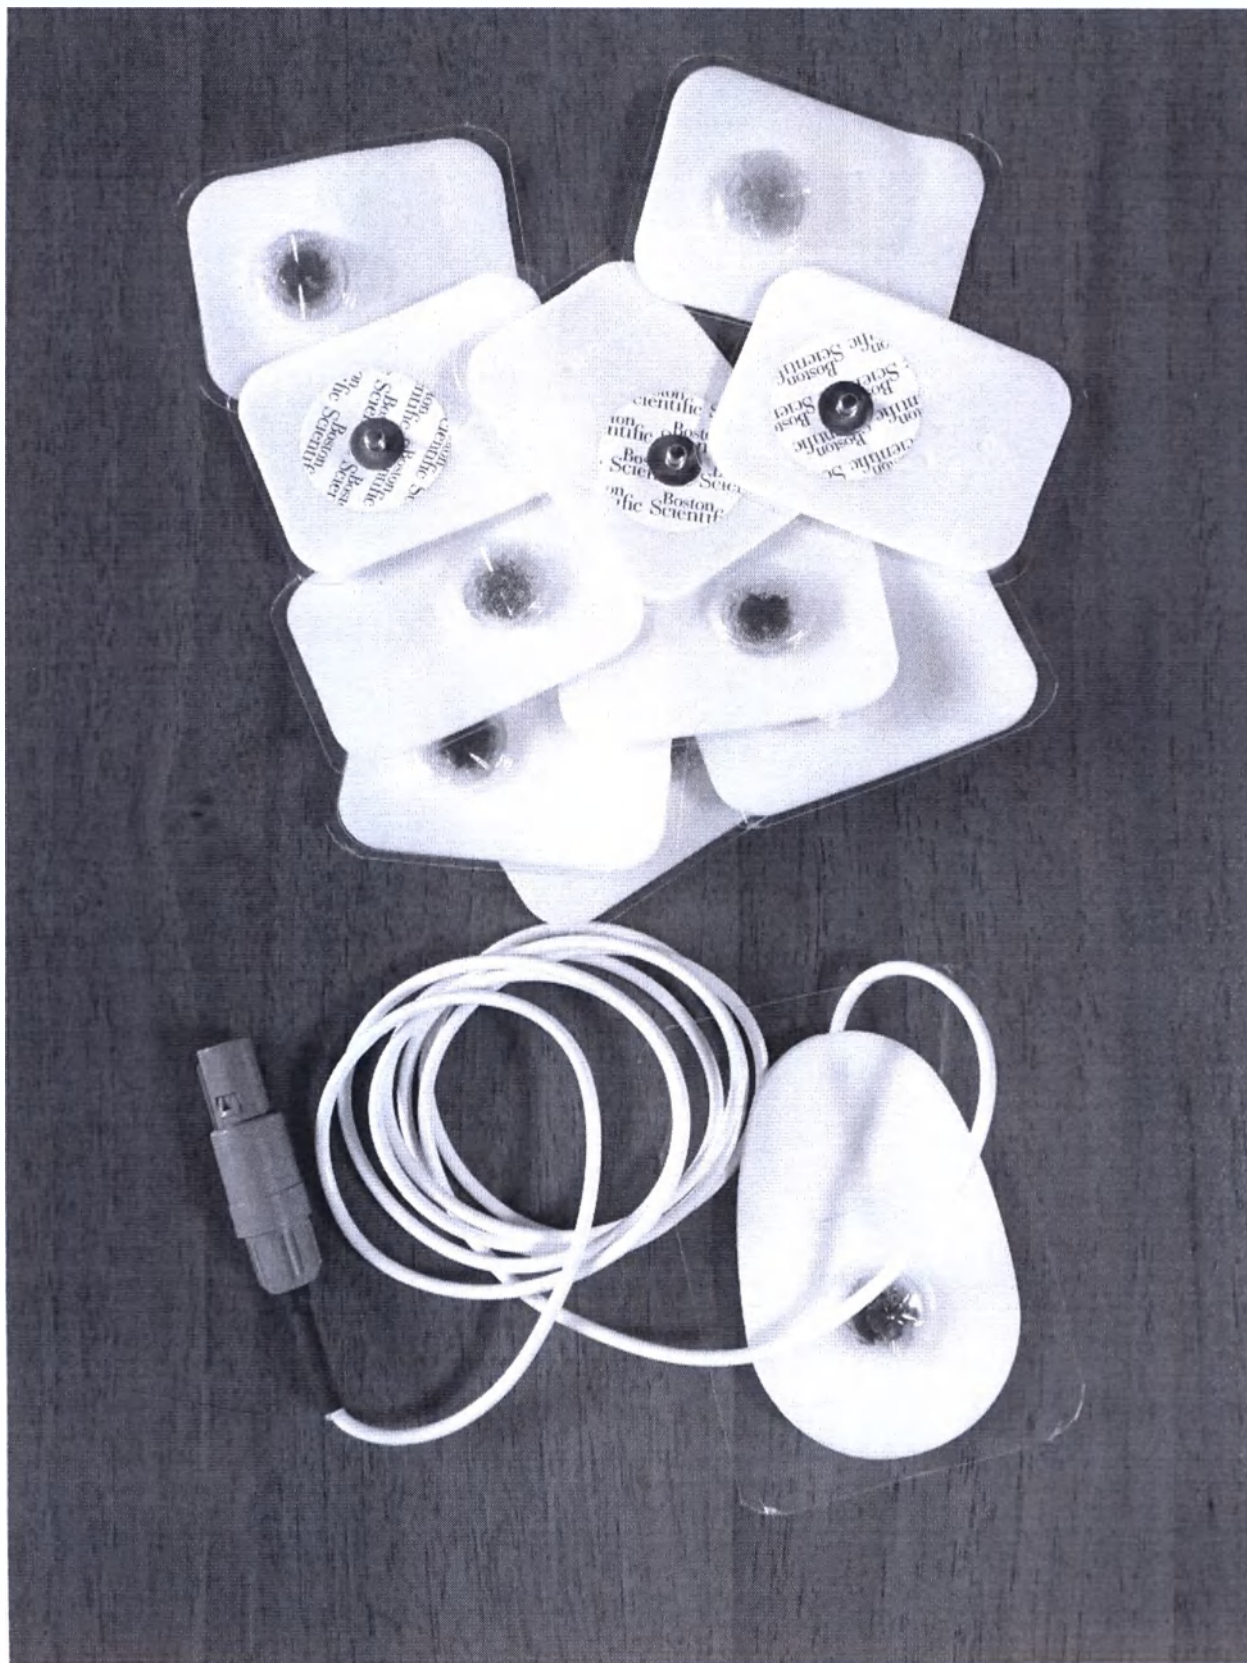

Набор поверхностных референтных электродов

Rhythmia™ Mapping System Boston Scientific

Location Reference Patch Kit

Kit de parches de referencia de ubicación, Kit de patch de référence d'emplacement, Positionsreferenz-Pflaster-Set, Kit del cerotto di riferimento della posizione, Patchset voor locatierreferentie, 電極位置リファレンス・パッチ・キット, Placering referencelpatchsæt, Kit ηλεκτροδίου αναφοράς θέσης, Kit de Placas de Referência de Localização, Sats med självhäftande lokaliseringreferenselektroder, Helyzeti referencia tapaszelektroda-készlet, Souprava referenční lepící značky umístění, Zestaw elektrody odniesienia do określania lokalizacji, Elektrodesett til posisjonsreferanse, Konum Referansı Yama Kiti

 **Contents** (1) Location Reference Back Patch
(10) ECG Electrodes

REF M004RAPATCH10

LOT 011218

GTIN 08714729841890

Use By 2019-01-12

Rx ONLY

 For single use only.
Do not reuse.

 Consult instructions
for use.

 Do not use if package
is damaged.

 Recyclable
Package

92065746A



LOT 011218

CE

Made in USA:
814 Airport Way
Sandpoint, ID 83864
USA



LOT 011218

10°C 32°C
50°F 90°F Temperature limitation.



This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

метоксично

01.12.2018

Набор поверхностных
референтных электродов
Регистрационное удостоверение:
№ РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XX
«Набор поверхностных референтных
электродов»

Rhythmia™ Mapping System

Location Reference Patch Kit

REF M004RAPATCH10


GTIN 08714729841890

LOT 011218

Use By 2019-01-12



Набор поверхностных референтных электродов маркировка на упаковке – лицевая и боковая сторона

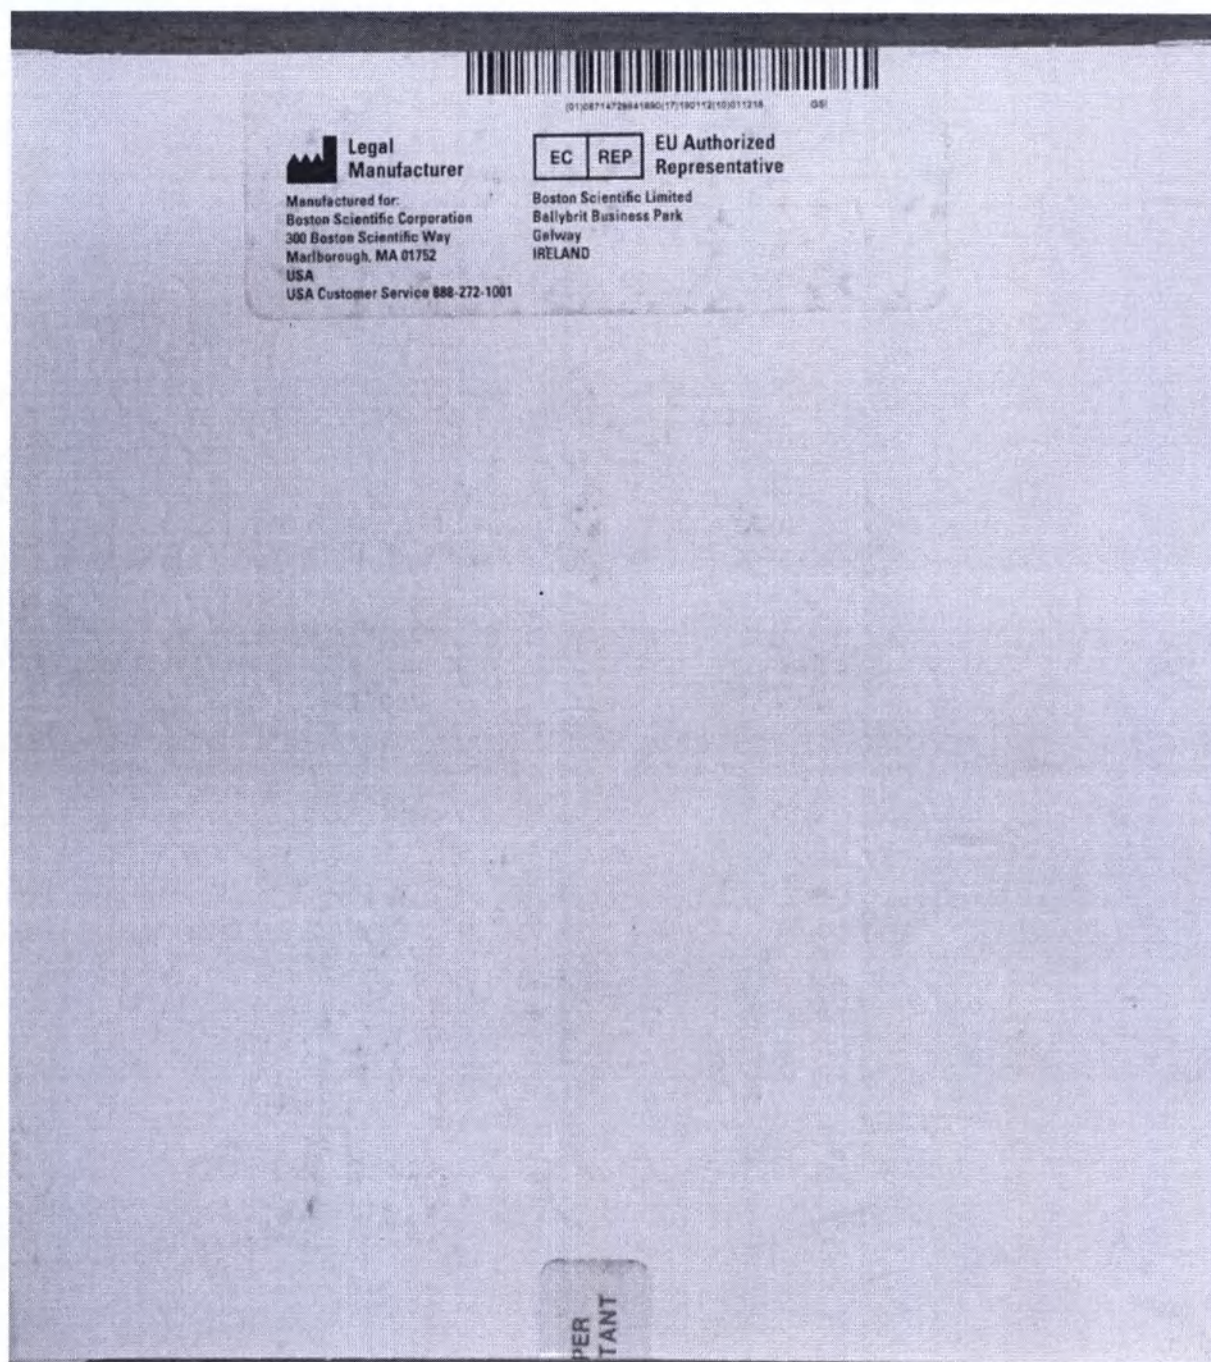

Набор поверхностных референтных электродов маркировка на упаковке – оборотная сторона

Набор поверхностных референтных электродов – первичная упаковка

Boston Scientific

Rhythmia™ Mapping System

Location Reference Patch Kit

Kit de parches de referencia de ubicación, Kit de patch de référence d'emplacement, Positionierungs-Pflaster-Set, Kit del cerotto di riferimento della posizione, Patchset voor locatie-referentie, 電極位置リファレンス・パッチ・キット, Placering referencieparchiset, Kit nřakroboů ověřovací (Ryzy), Kit de Placa de Referência de Localização, Sats med självständiga lokaliseringreferenselektroder, Helyzeti referencia tápaszelektroda-készlet, Souprava referenční lepicí značky umístění, Zestaw elektrod odniesienia do określania lokalizacji, Elektrodesett til posisjonsreferanse, Konum Referans Yama Kiti

Caution (1) Location Reference Patch, Patche transfer de referencia de ubicación, Patch de renfort de référence d'emplacement, Positionierungs-Pflaster, Cerotto posteriore di riferimento della posizione, Rugpatch voor locatie-referentie, 電極位置リファレンス・パッチ・キット, Placering referencieparch till ryg, Oměšbo nřakroboů ověřovací (Ryzy), Placa Posterior de Referência de Localização, Sřakrobnře lokaliseringreferenselektrod til ryg, Helyzeti referencia hřlt tápaszelektroda, Zřdri referenční lepicí značka umístění, Powozna elektroda odniesienia do określania lokalizacji, Ryggpřtt til posisjonsreferanse, Konum Referans Arka Yama

LOT 011218

Use By 2019-01-12

92065742A

Rx ONLY

CE



 For single use only. Do not reuse.

 Consult instructions for use.

 Do not use if package is damaged.

 10°C 32°C 90°F Temperature limitation.

Boston Scientific

Rhythmia™ Mapping System

Location Reference Patch Kit

Kit de parches de referencia de ubicación, Kit de patch de référence d'emplacement, Positionierungs-Pflaster-Set, Kit del cerotto di riferimento della posizione, Patchset voor locatie-referentie, 電極位置リファレンス・パッチ・キット, Placering referencieparchiset, Kit nřakroboů ověřovací (Ryzy), Kit de Placa de Referência de Localização, Sats med självständiga lokaliseringreferenselektroder, Helyzeti referencia tápaszelektroda-készlet, Souprava referenční lepicí značky umístění, Zestaw elektrod odniesienia do określania lokalizacji, Elektrodesett til posisjonsreferanse, Konum Referans Yama Kiti

Caution (10) ECG Electrodes, Electrodes de ECG, EKG-Elektroden, Elektrodi per ECG, ECG-elektroden, ECG電極, EKG-elektroder, Hřakroboů Hřt, Electrodes de ECG, EKG-elektroder, EKG-elektrode, Elektrody EKG, Elektrody EKG, EKG-Elektroden, EKG Elektroden

LOT 011218

Use By 2019-01-12

92065742A

Rx ONLY

CE



 For single use only. Do not reuse.

 Consult instructions for use.

 Do not use if package is damaged.

 10°C 32°C 90°F Temperature limitation.

Прошито, пронумеровано
(5 лист(ов))
скреплено печатью

