

УТВЕРЖДАЮ

Председатель правления
ООО «МФК ИНМУНОТЕХ»

Алейников В.А.


«12» декабря 2020 г.



Фотографические изображения медицинского изделия

«Устройство для считывания и обработки результатов ImageXplorer при сканировании
аллергочипов технологии ALEX»

Производитель: MacroArray Diagnostics GmbH,
Lemböckgasse 59/ Top 4, A-1230 Wien Austria

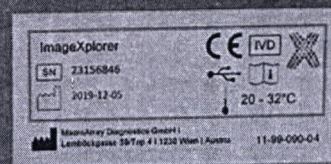


CoM / CoQ / CoM
Certificate of Analysis / Quality / Manufacturing

Product	ImageXplorer
REF	P-2020-01
Serial Number	Z755946
Released on	15.12.2019
Software	ImageXplorer
Software Version	01

УСТРОЙСТВО ДЛЯ СЧИТЫВАНИЯ И
ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
IMAGEXPLOER ПРИ
СКАНИРОВАНИИ АЛЛЕРГОЧИПОВ
ТЕХНОЛОГИИ ALEX
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Устройство для считывания и обработки результатов ImageXplorer при сканировании аллергочипов технологии ALEX

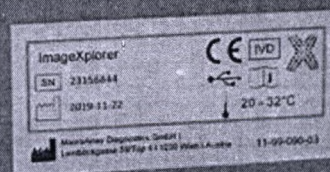


MAD
MEDICAL DEVICES

Совместно
Сертификат соответствия ГОСТ Р

Product	ImageXplorer
REF	1000000
Serial Number	23156844
Release Date	21.12.19
Software	ImageXplorer
Software Version	11

УСТРОЙСТВО ДЛЯ СЧИТЫВАНИЯ И
ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
IMAGEXPLORER ПРИ
СКАНИРОВАНИИ АЛЛЕРГОЧИПОВ
ТЕХНОЛОГИИ ALEX

Устройство для считывания и обработки результатов ImageXplorer при сканировании аллергочипов технологии ALEX

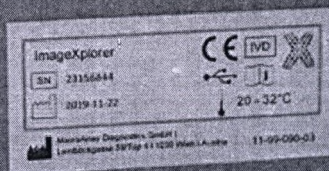


MAD
MICRO XPERT DIAGNOSTICS

COA/POD-COA
Certificate of Analysis / Quality Measurement

Product	ImageXplorer
MS	1000045
Serial Number	2355944
Release Date	2012103
Software	ImageXplorer
Software Version	1.0

УСТРОЙСТВО ДЛЯ СЧИТЫВАНИЯ И ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ImageXplorer ПРИ СКАНИРОВАНИИ АЛЛЕРГОЧИПОВ
ТЕХНОЛОГИИ ALEX

Устройство для считывания и обработки результатов ImageXplorer при сканировании аллергочипов технологии ALEX

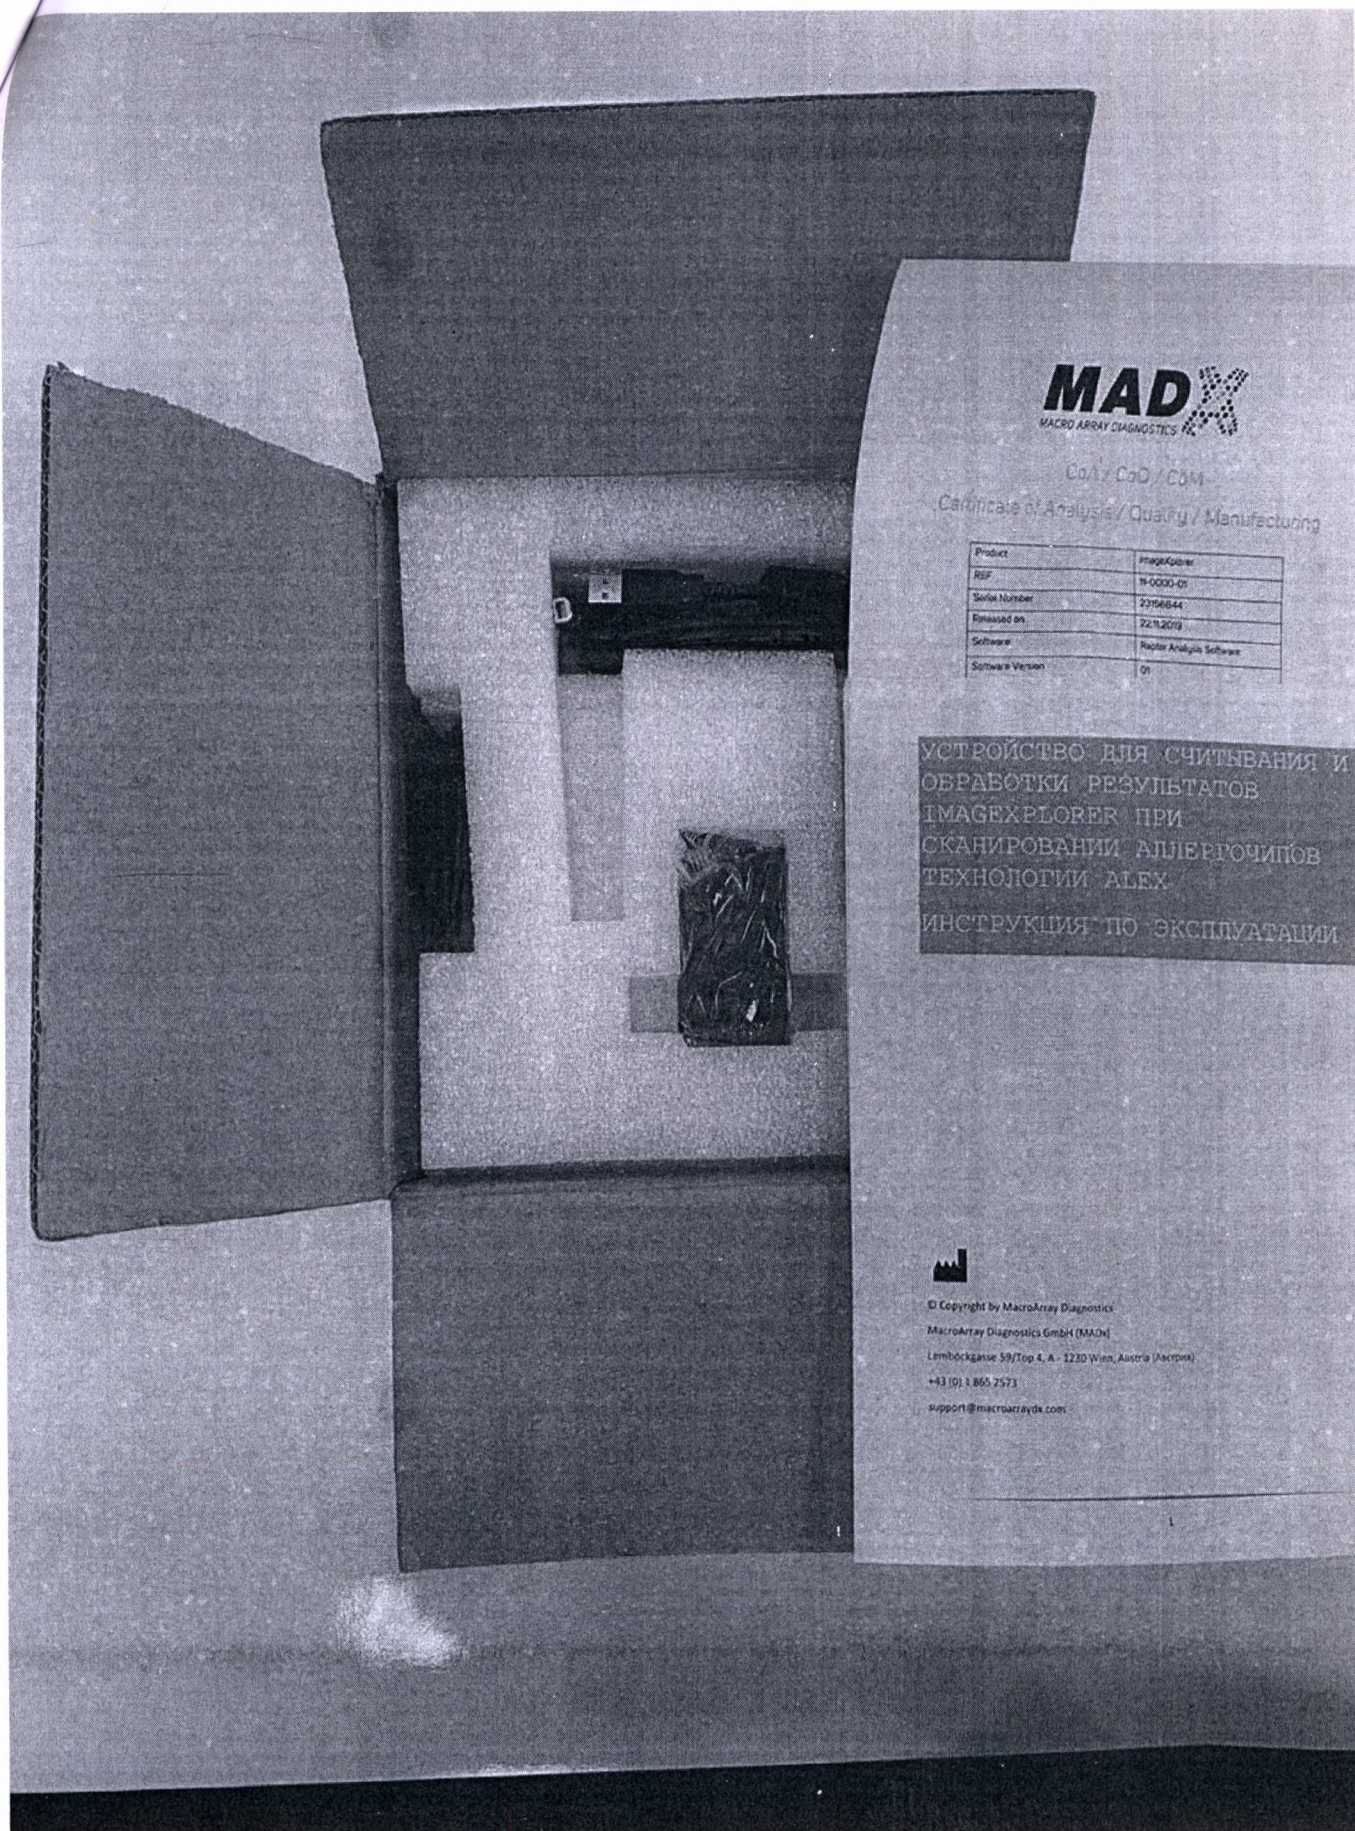

Устройство для считывания и обработки результатов ImageXplorer при сканировании аллергочипов технологии ALEX



CoA / CoO / CoM

Certificate of Analysis / Quality / Manufacturing


Product	ImageXplorer
REF	11-0000-01
Serial Number	23156846
Revised on	09.12.2019
Software	Radiotr Analysis Software
Software Version	01


УСТРОЙСТВО ДЛЯ СЧИТЫВАНИЯ И
ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
IMAGEXPLORER ПРИ
СКАНИРОВАНИИ АЛЛЕРГОЧИПОВ
ТЕХНОЛОГИИ ALEX
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



© Copyright by MacroArray Diagnostics
MacroArray Diagnostics GmbH (MADx)
Lemböckgasse 59/Top 6, A - 1230 Wien, Austria (Австрия)
+43 (0) 1 865 2573
support1@macroarraydx.com

Устройство для считывания и обработки результатов ImageXplorer при сканировании аллергочипов технологии ALEX

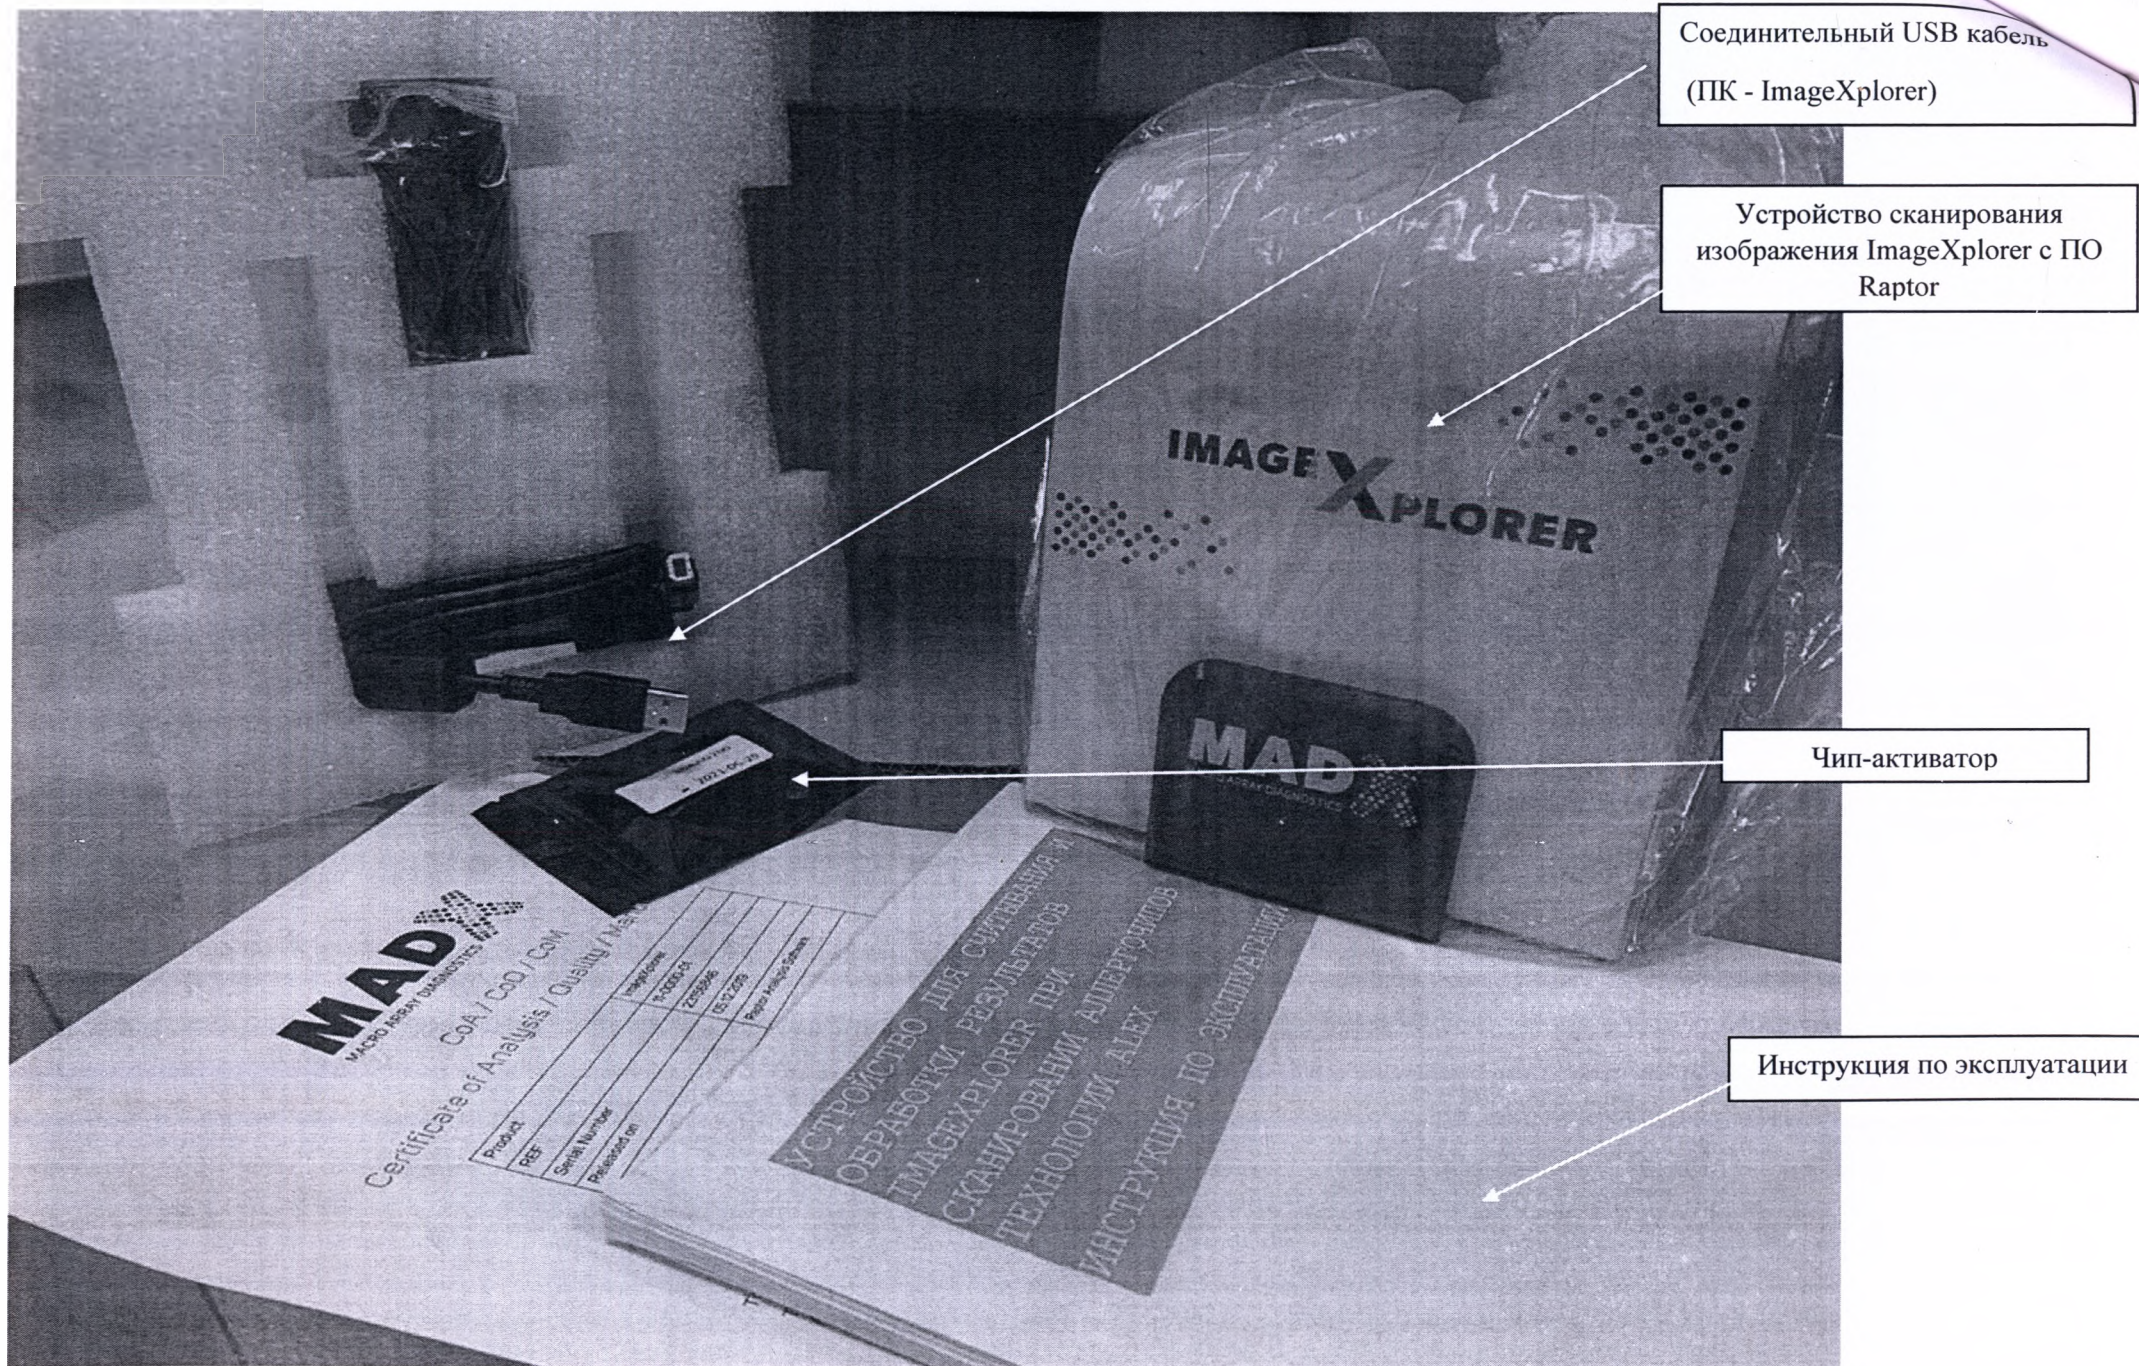

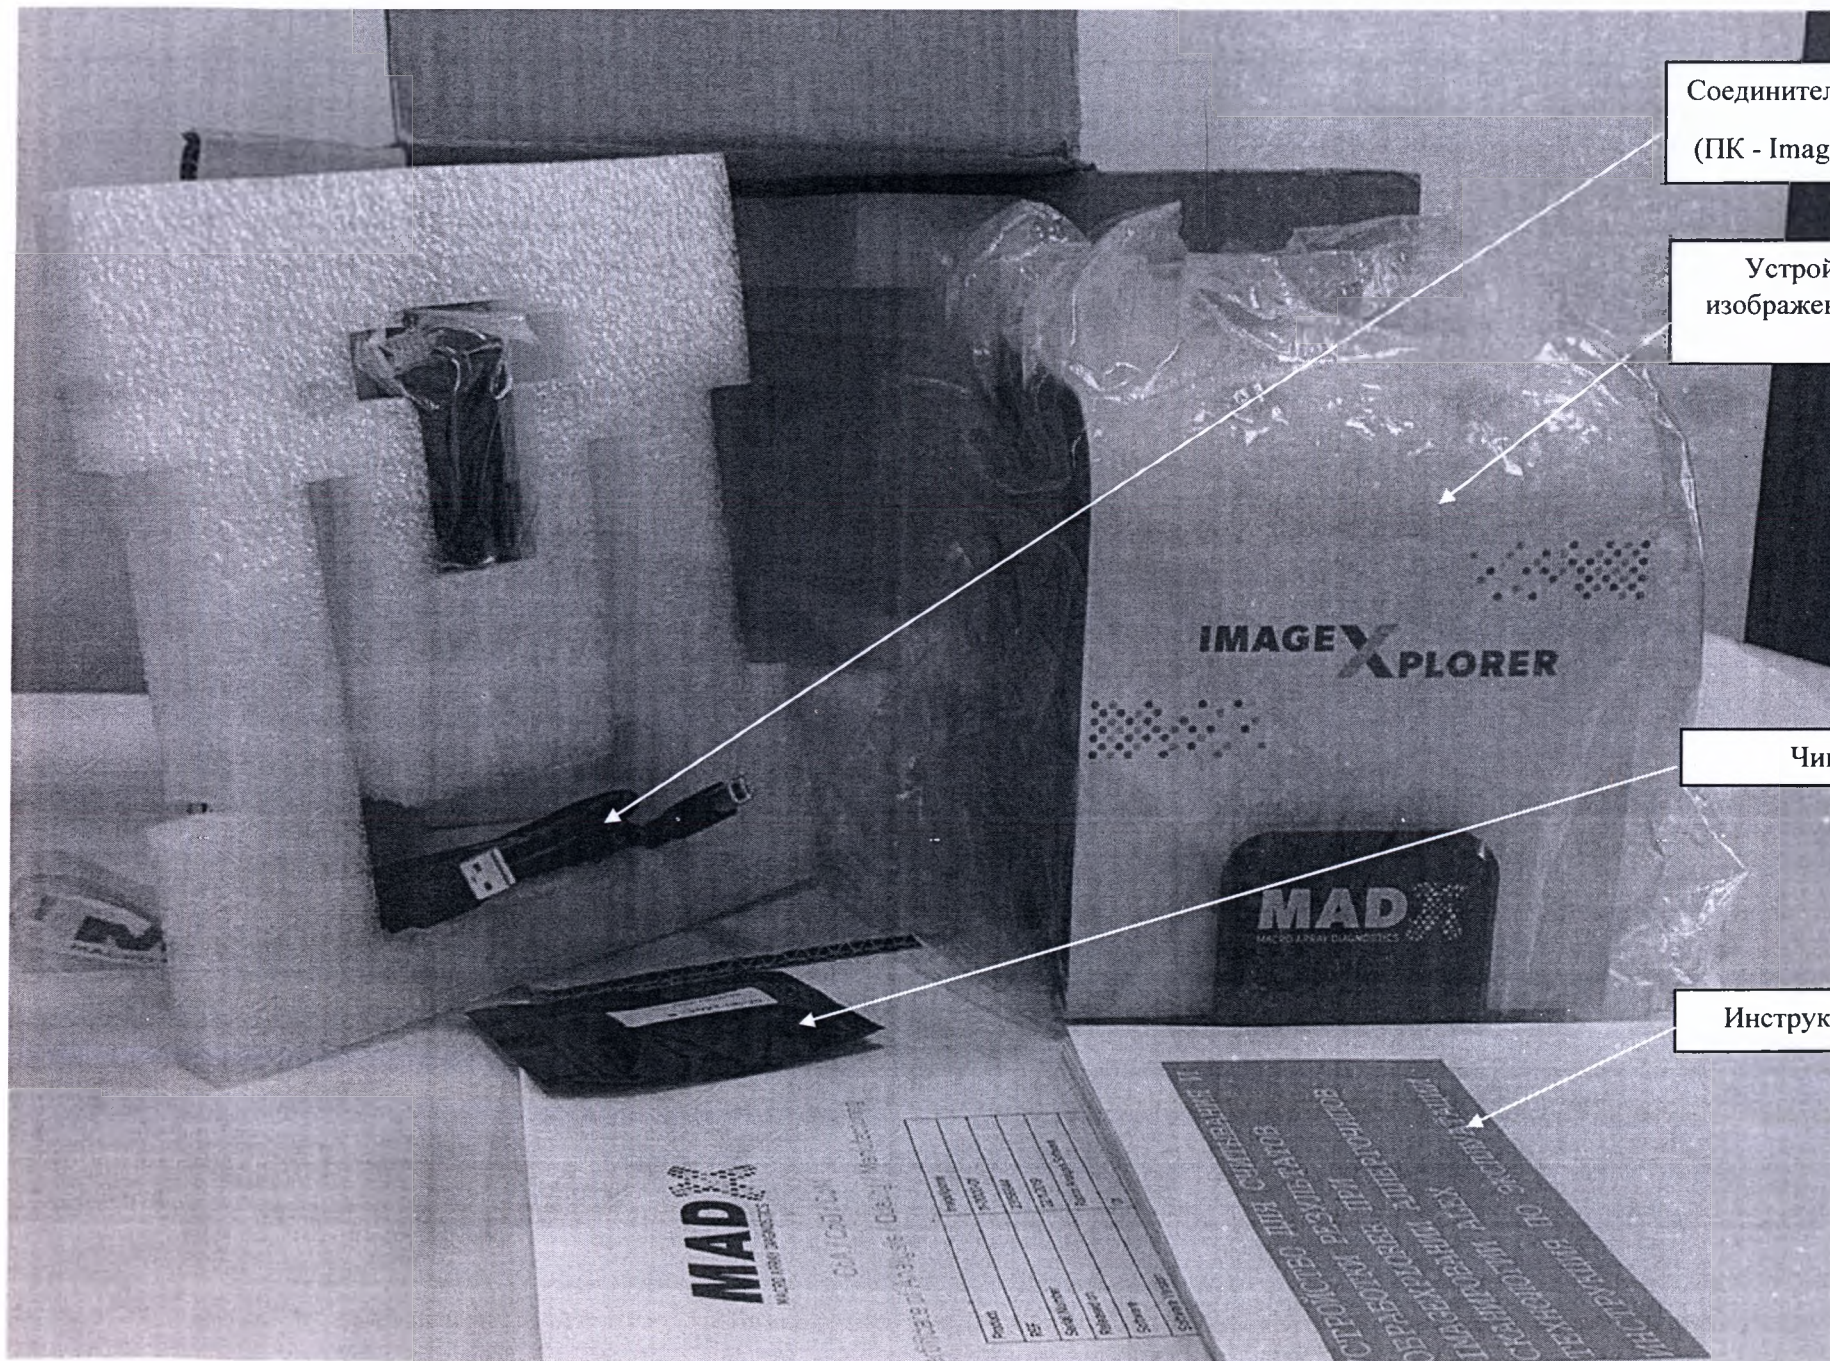

Соединительный USB кабель
(ПК - ImageXplorer)

Устройство сканирования
изображения ImageXplorer с ПО
Raptor

Чип-активатор

Инструкция по эксплуатации


MAD
MACRO ARRAY DIAGNOSTICS

CoA / CoQ / CoM
Certificate of Analysis / Quality / Manual

Product		ImageXplorer
REF		11-0000-01
Serial Number		23155844
Released on		22.11.2019
Software		Raptor Analysis Software

УСТРОЙСТВО ДЛЯ СЧИТЫВАНИЯ И
ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
IMAGEXPLOER ПРИ
СКАНИРОВАНИИ АЛЛЕРГОЧИПОВ
ТЕХНОЛОГИИ ALEX

The instru
The Rapt
Austria
Usability
verified by
The image
61026 (EU

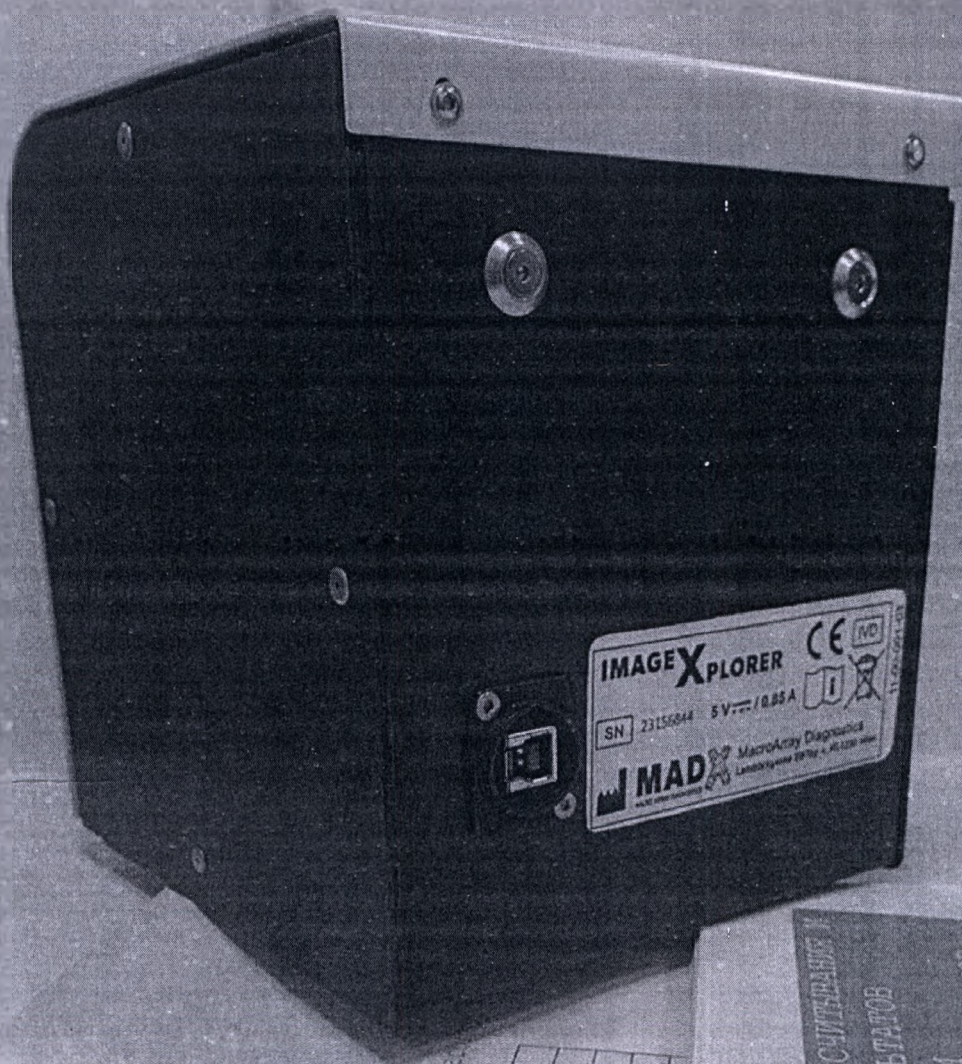


Устройство для считывания и обработки результатов ImageXplorer при сканировании аллергочипов технологии ALEX



CoA / CoQ / CoM

Certificate of Analysis / Quality / Manufacturing

Product	ImageXplorer
REF	11-0000-01
Serial Number	23156846
Released on	05.12.2019
Software	Report Analyst Software
	01

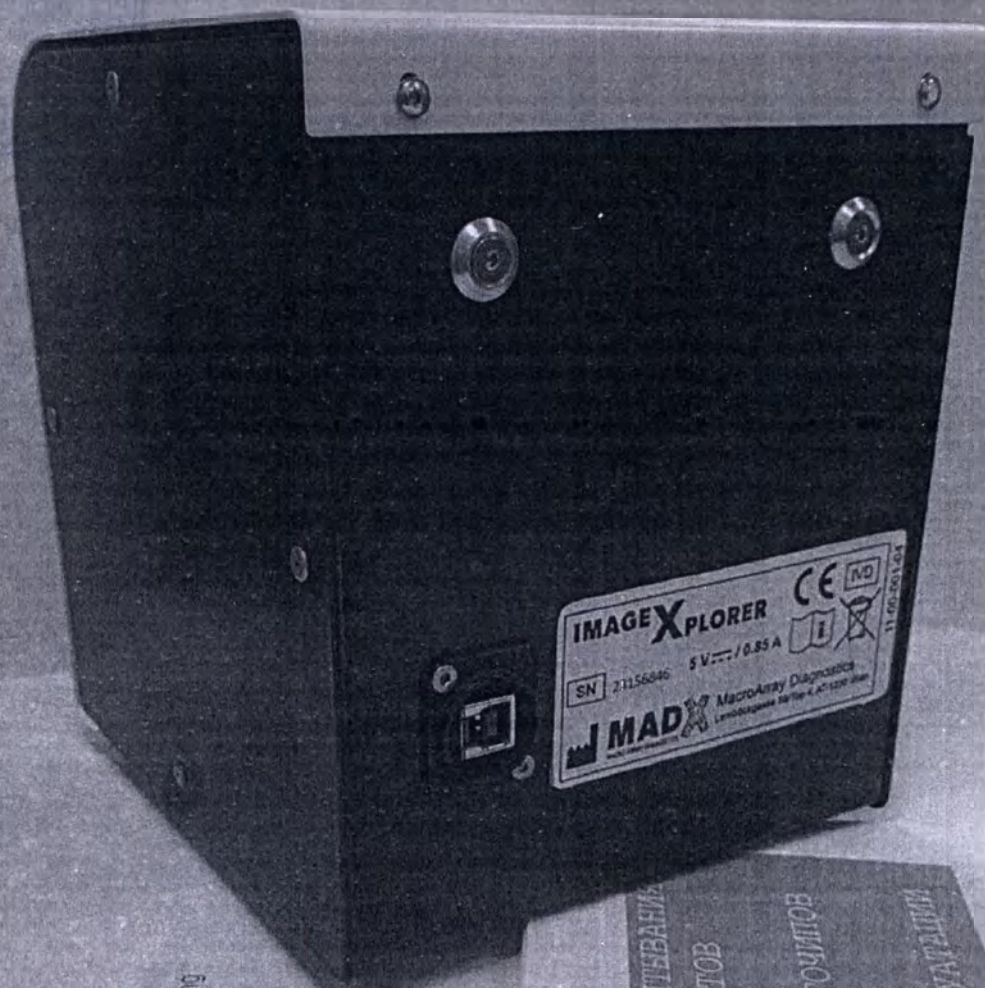

УСТРОЙСТВО ДЛЯ СЧИТЫВАНИЯ
ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
IMAGEXPLORE при
СКАНИРОВАНИИ АЛЛЕРГОЧИПОВ
ТЕХНОЛОГИИ ALEX
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Устройство для считывания и обработки результатов ImageXplorer при сканировании аллергочипов технологии ALEX

Прошито и скреплено печатью

