



УТВЕРЖДАЮ

Председатель правления

ООО «МОК ИММУНОТЕХ»


Алейников В.А.

декабря 2020 г.

Фотографические изображения медицинского изделия

«Набор реагентов для одновременного количественного определения специфических IgE к алергокомпонентам и экстрактам аллергенов и полуколичественного определения общего IgE в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа на алергочипе ALEX² (Allergy Explorer²)»

**Производитель: MacroArray Diagnostics GmbH,
Lemböckgasse 59/ Top 4, A-1230 Wien Austria**

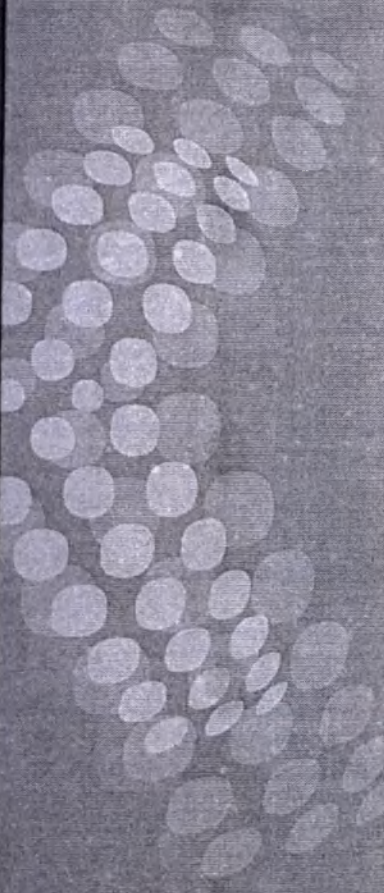

ALEX²

ALLERGY EXPLORER

CONTENT


2 x 10	ALEX ² Cartridges
2 x 50 mL	ALEX ² Washing Solution
1 x 9 mL	ALEX ² Sample Diluent
1 x 11 mL	ALEX ² Detection Antibody
1 x 11 mL	ALEX ² Substrate Solution
1 x 2.4 mL	ALEX ² Stop Solution

www.macroarraydx.com

Набор реагентов для одновременного количественного определения специфических IgE к аллергокомпонентам и экстрактам аллергенов и полуколичественного определения общего IgE в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа на аллергочипе ALEX² (Allergy Explorer²)



Набор реагентов для одновременного количественного определения специфических IgE к алергокомпонентам и экстрактам аллергенов и полуколичественного определения общего IgE в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа на алергочипе ALEX² (Allergy Explorer²)

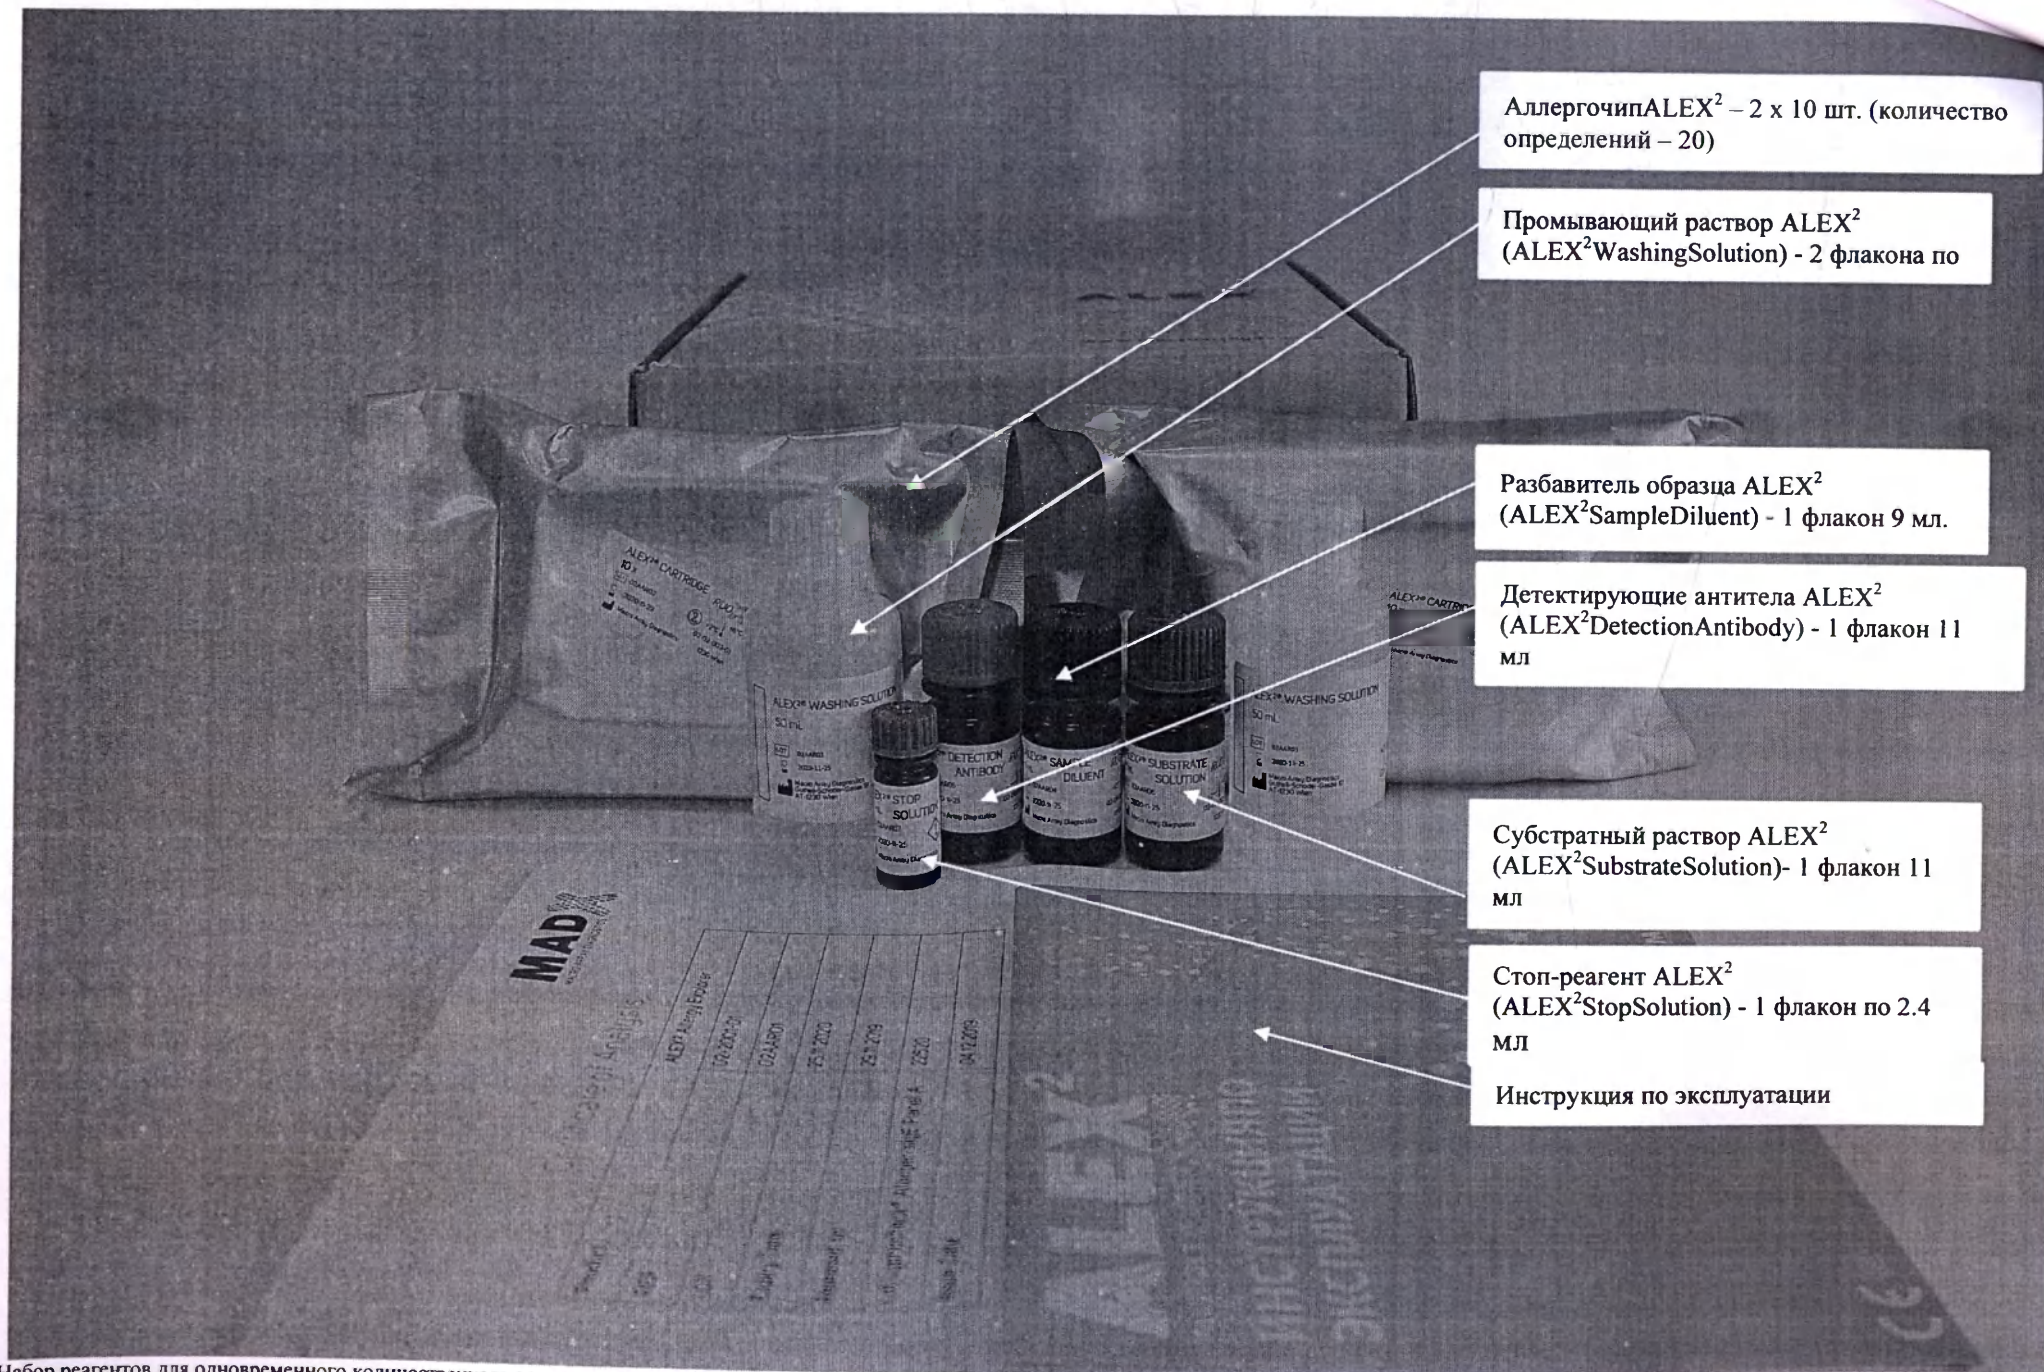

Аллергочип ALEX² – 2 x 10 шт. (количество определений – 20)

Промывающий раствор ALEX²
(ALEX² Washing Solution) - 2 флакона по

Разбавитель образца ALEX²
(ALEX² Sample Diluent) - 1 флакон 9 мл.

Детектирующие антитела ALEX²
(ALEX² Detection Antibody) - 1 флакон 11 мл

Субстратный раствор ALEX²
(ALEX² Substrate Solution) - 1 флакон 11 мл


Стоп-реагент ALEX²
(ALEX² Stop Solution) - 1 флакон по 2.4 мл

Инструкция по эксплуатации

Набор реагентов для одновременного количественного определения специфических IgE к аллергокомпонентам и экстрактам аллергенов и полуколичественного определения общего IgE в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа на аллергочипе ALEX² (Allergy Explorer²)



Набор реагентов для одновременного количественного определения специфических IgE к аллергокомпонентам и экстрактам аллергенов и полуколичественного определения общего IgE в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа на аллергочипе ALEX2 (Allergy Explorer2)

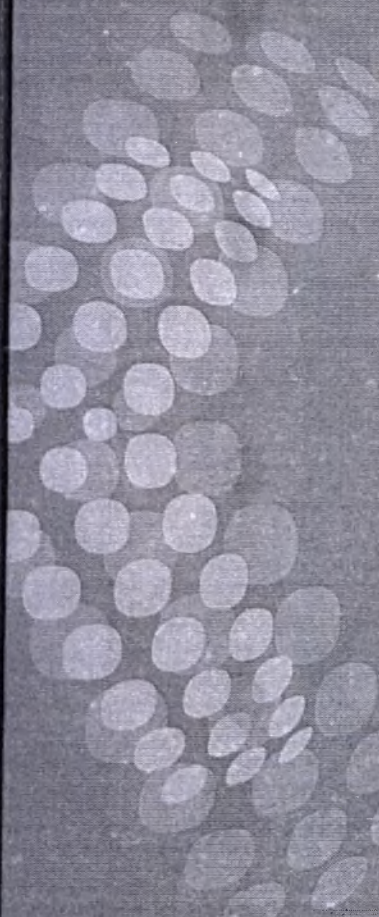

ALEX²

ALLERGY EXPLORER

CONTENT


2 x 10	ALEX ² Cartridges
2 x 50 mL	ALEX ² Washing Solution
1 x 9 mL	ALEX ² Sample Diluent
1 x 11 mL	ALEX ² Detection Antibody
1 x 11 mL	ALEX ² Substrate Solution
1 x 2.4 mL	ALEX ² Stop Solution

www.macroarraydx.com

Набор реагентов для одновременного количественного определения специфических IgE к аллергокомпонентам и экстрактам аллергенов и полуколичественного определения общего IgE в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа на аллергочипе ALEX2 (Allergy Explorer2)



Набор реагентов для одновременного количественного определения специфических IgE к алергокомпонентам и экстрактам алергенов и полуколичественного определения общего IgE в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа на алергочипе ALEX2 (Allergy Explorer2)

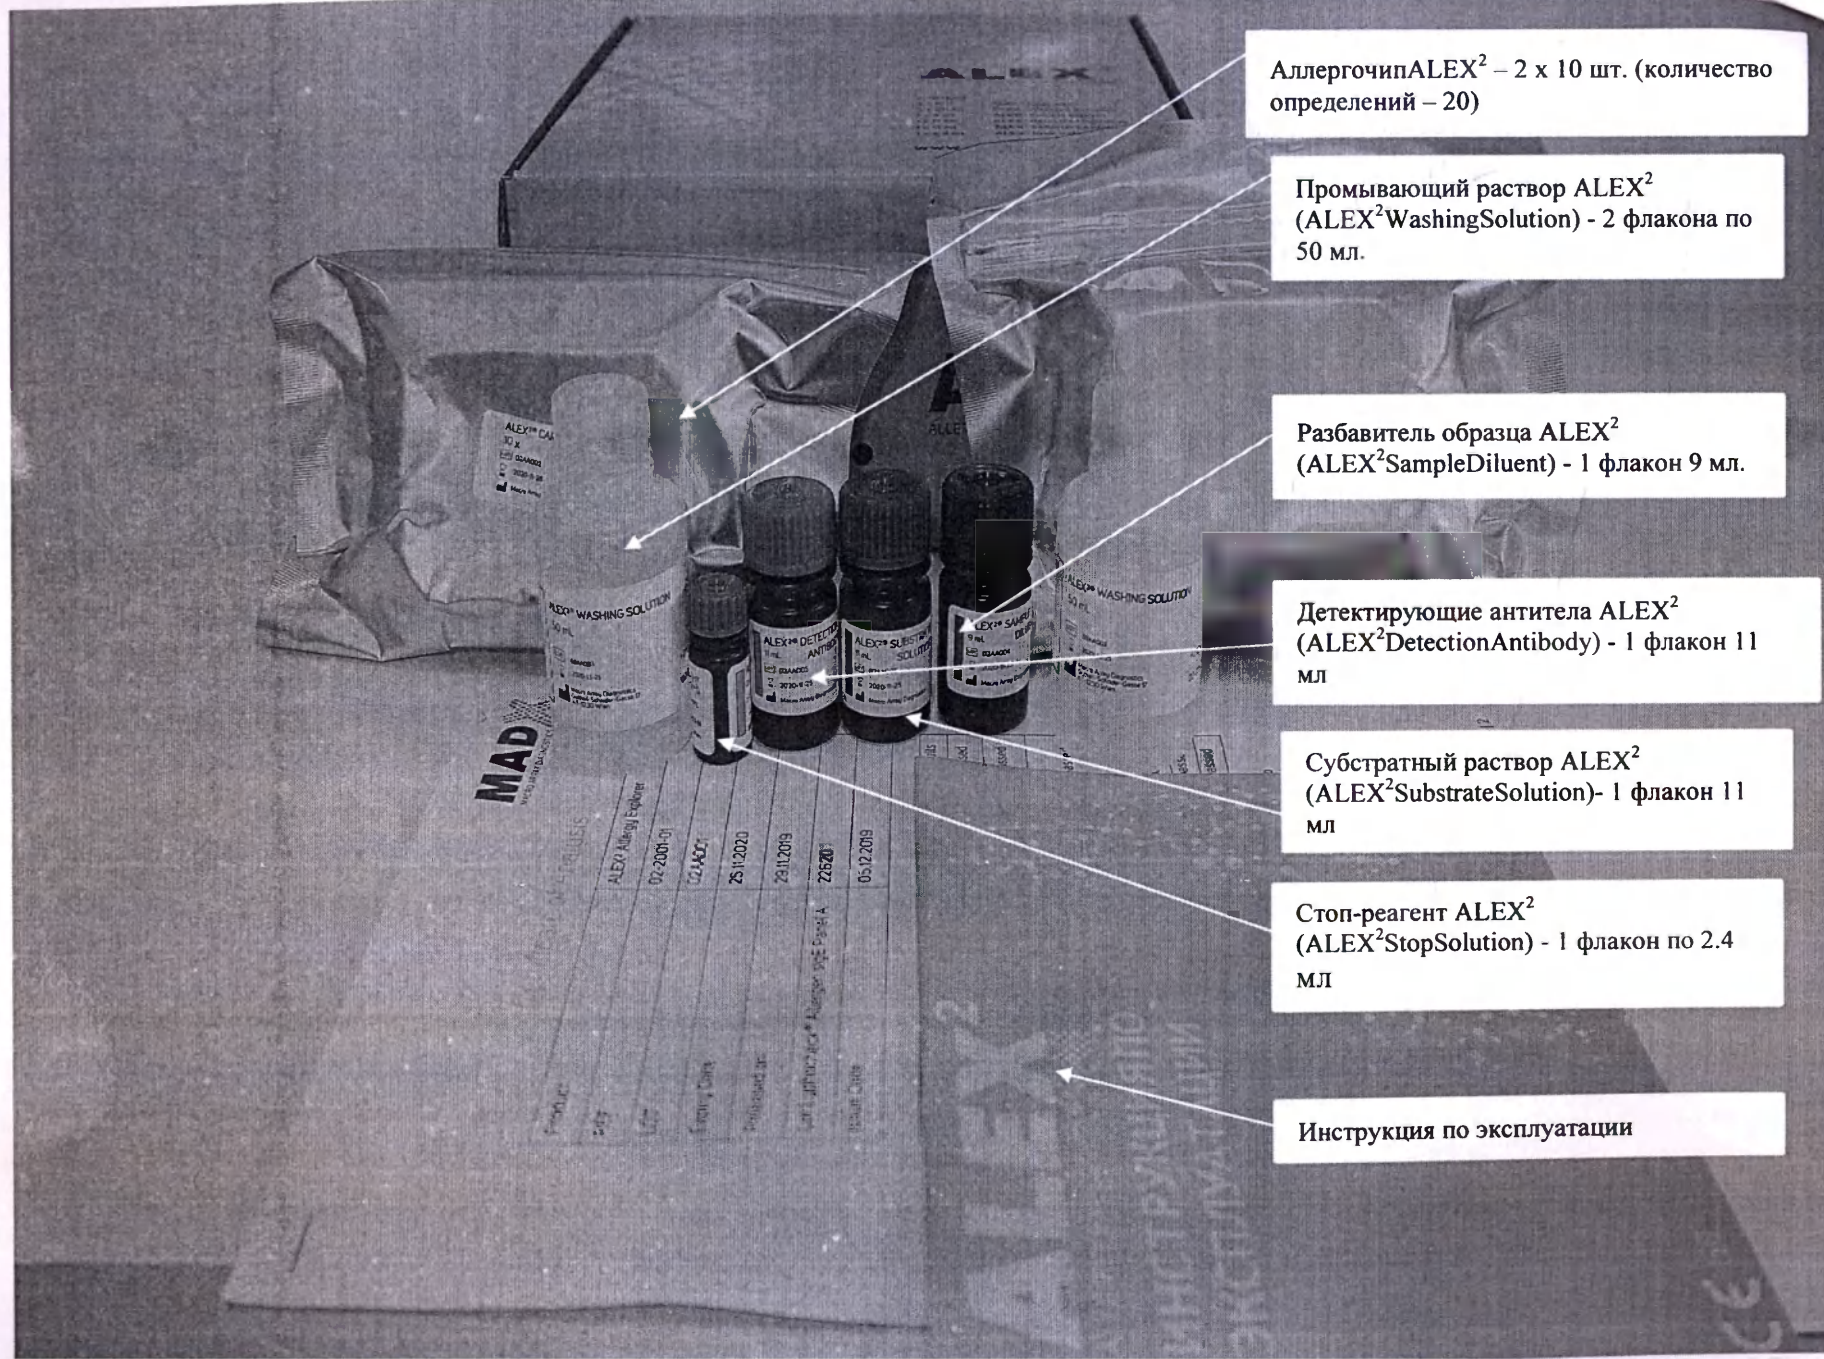

Набор реагентов для одновременного количественного определения специфических IgE к аллергокомпонентам и экстрактам аллергенов и полуколичественного определения общего IgE в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа на аллергочипе ALEX2 (Allergy Explorer)

MAD
ALLERGY REAGENT MANUFACTURER

Certificate of Analysis

Product	ALEX ² Allergy Explorer
REF	02-2001-01
IQT	02AAR01
Expiry Date	25.11.2020
Released on	20.11.2019
Lot Lymphochek® Allergen sIgE Panel A	72620
Issue Date	05.12.2019

QC release specifications

Mean QC test samples $\pm 30\%$ of reference data set

Linear correlation (R) of QC test samples ≥ 0.95

Results

passed

ALEX²
ALLERGY EXPLORER

ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

CE (M)

Manufactured by
MAD

Набор реагентов для одновременного количественного определения специфических IgE к аллергокомпонентам и экстрактам аллергенов и полуколичественного определения общего IgE в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа на аллергочипе ALEX² (Allergy Explorer²)

Прошито и скреплено печатью

