

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Миндрей Медикал Рус»



Чэнь Син

«29» декабря 2020 г.

ПОВЕРЕННОСТИ ОТ 20.08.2017
СЫСОВА Н.В.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Система ультразвуковой визуализации универсальная серии MX с принадлежностями,
варианты исполнения: MX8, MX8 Exp, MX8T, MX8S, MX8 Pro**

производства компании

Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд /
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.

2020 г.

[illegible]

ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




Основной блок, варианты исполнения:
MX8, MX8 Exp, MX8T, MX8S, MX8 Pro.






Основной блок, варианты исполнения:
MX8, MX8 Exp, MX8T, MX8S, MX8 Pro. Вид снизу.

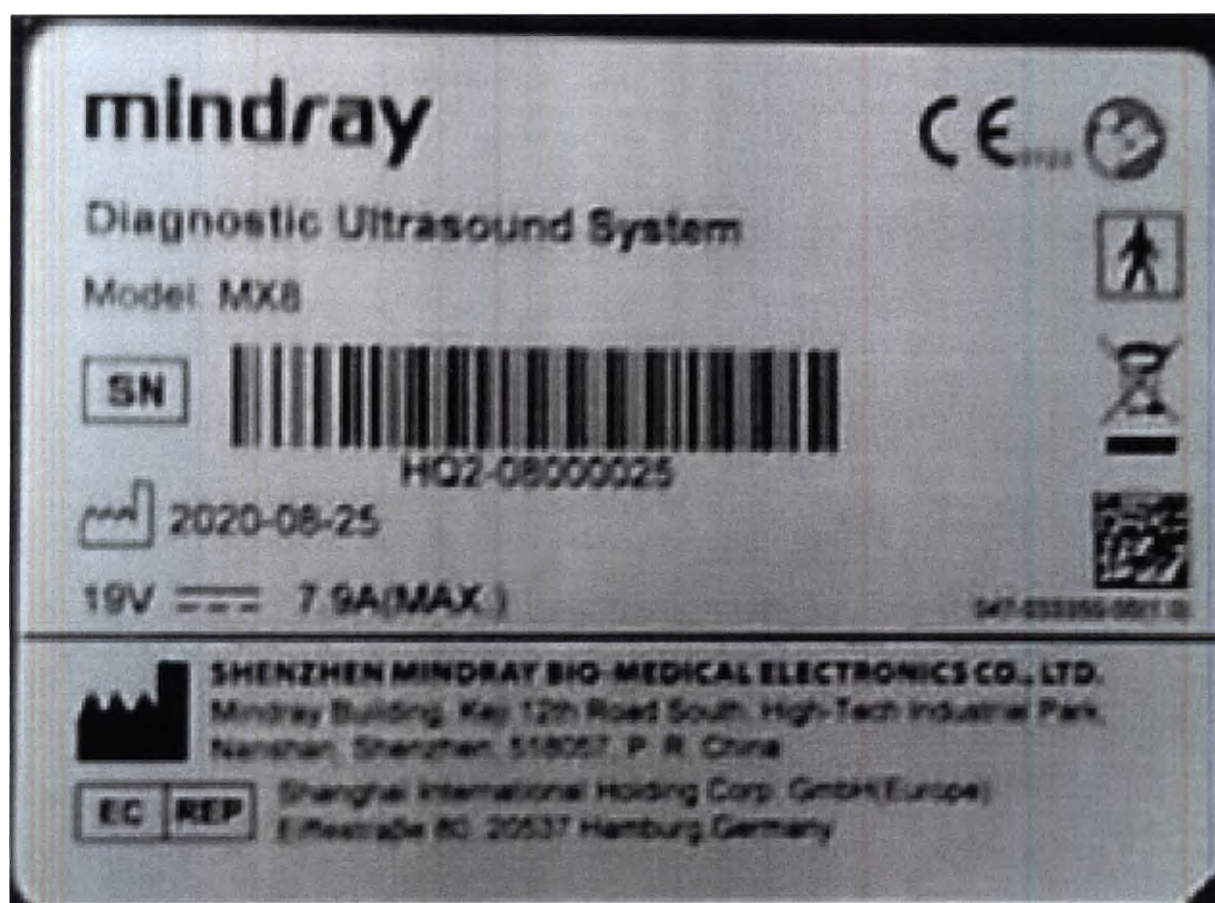

Маркировка на основном блоке

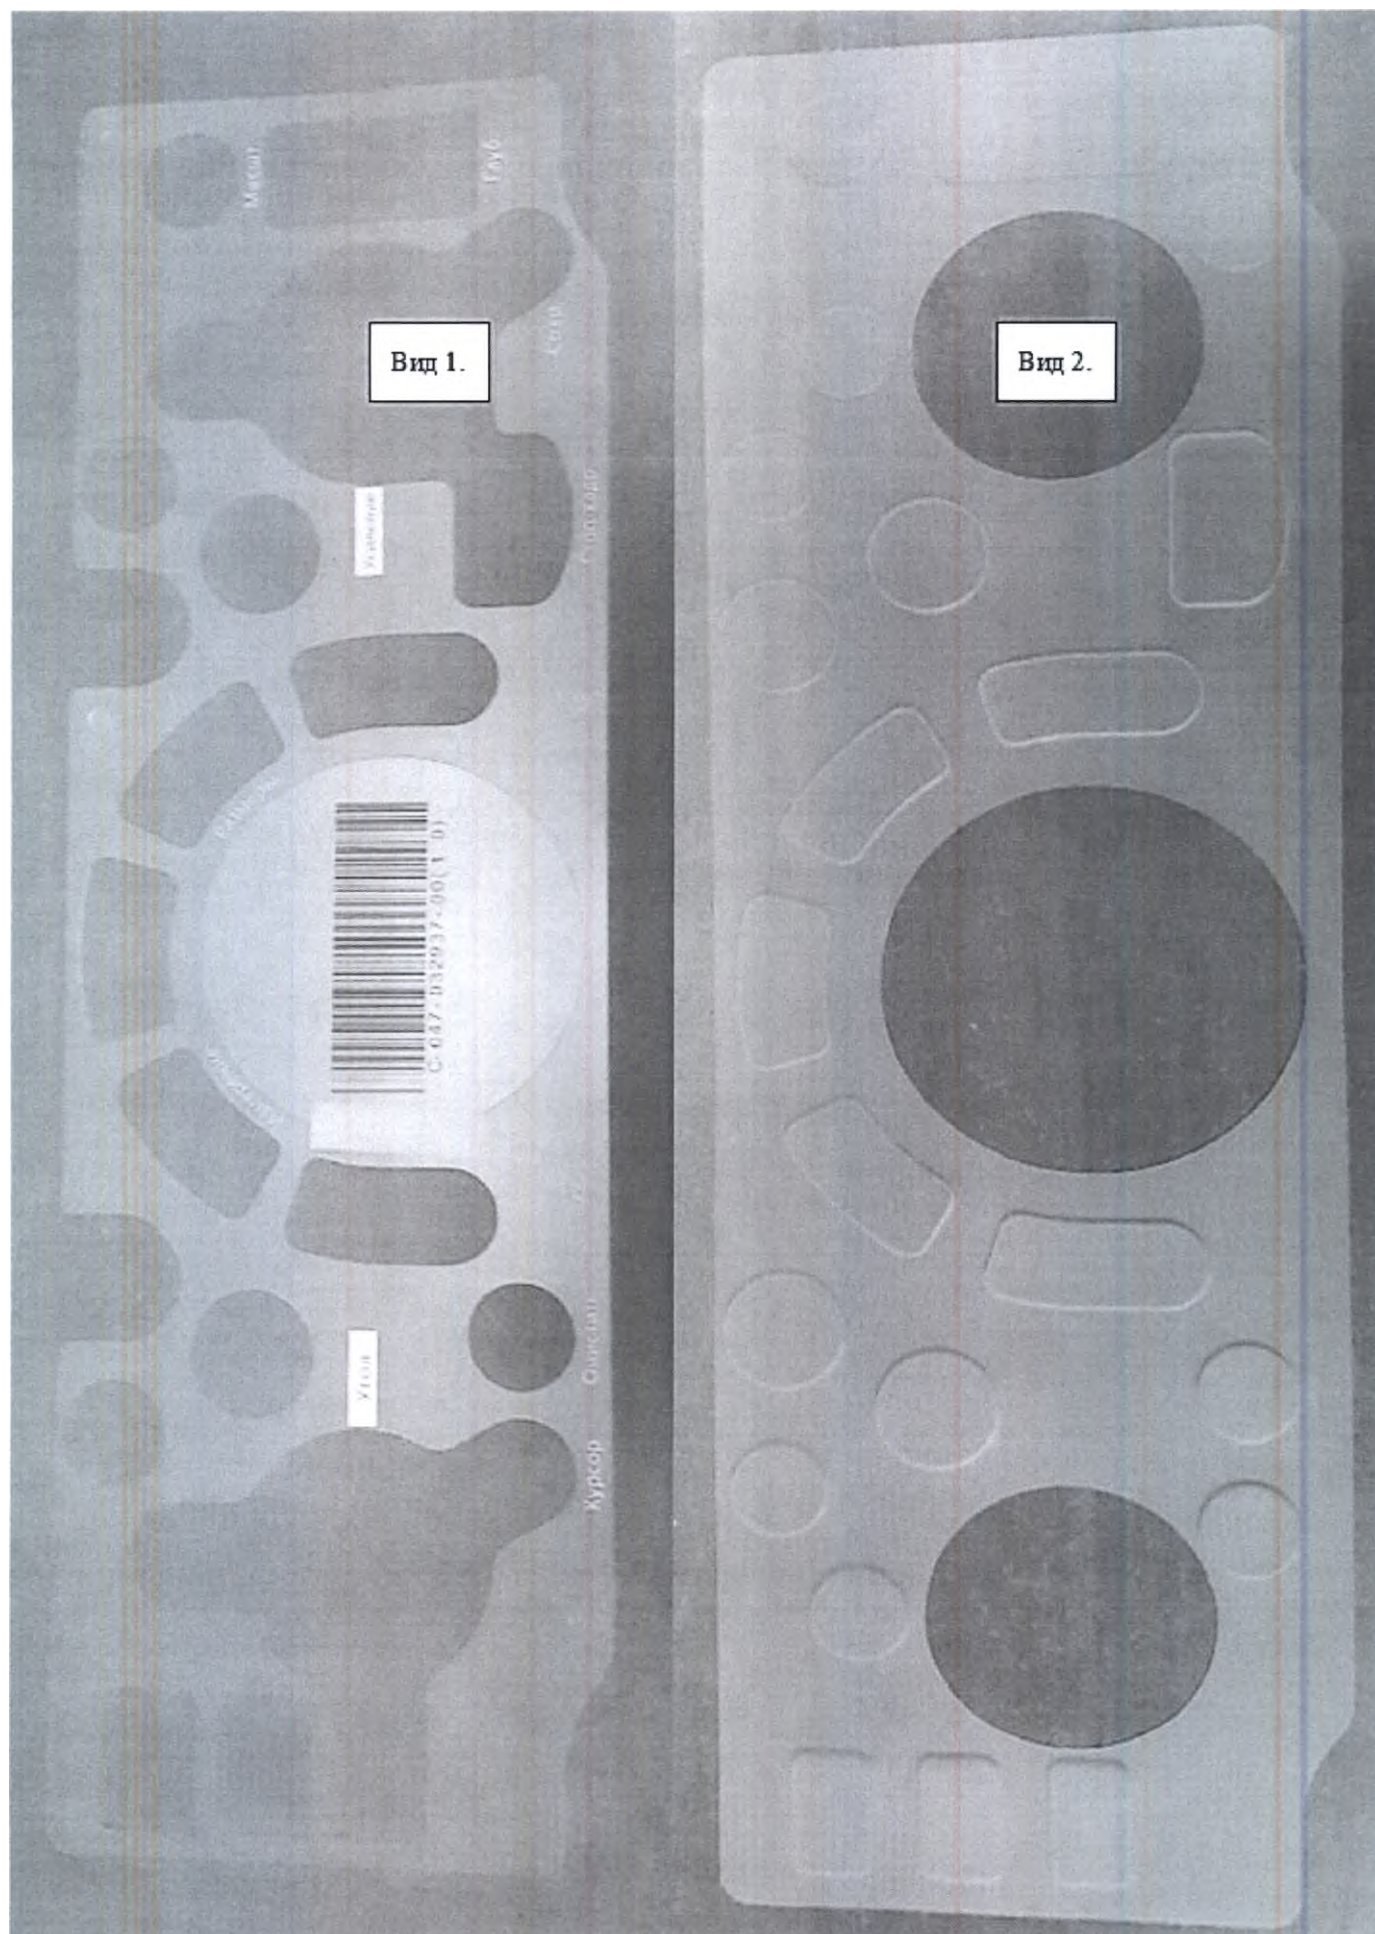


Вид 1.

Вид 2.

Накладка на панель управления с переводом на русский язык. Вид 1.

Накладка на панель управления защитная. Вид 2.

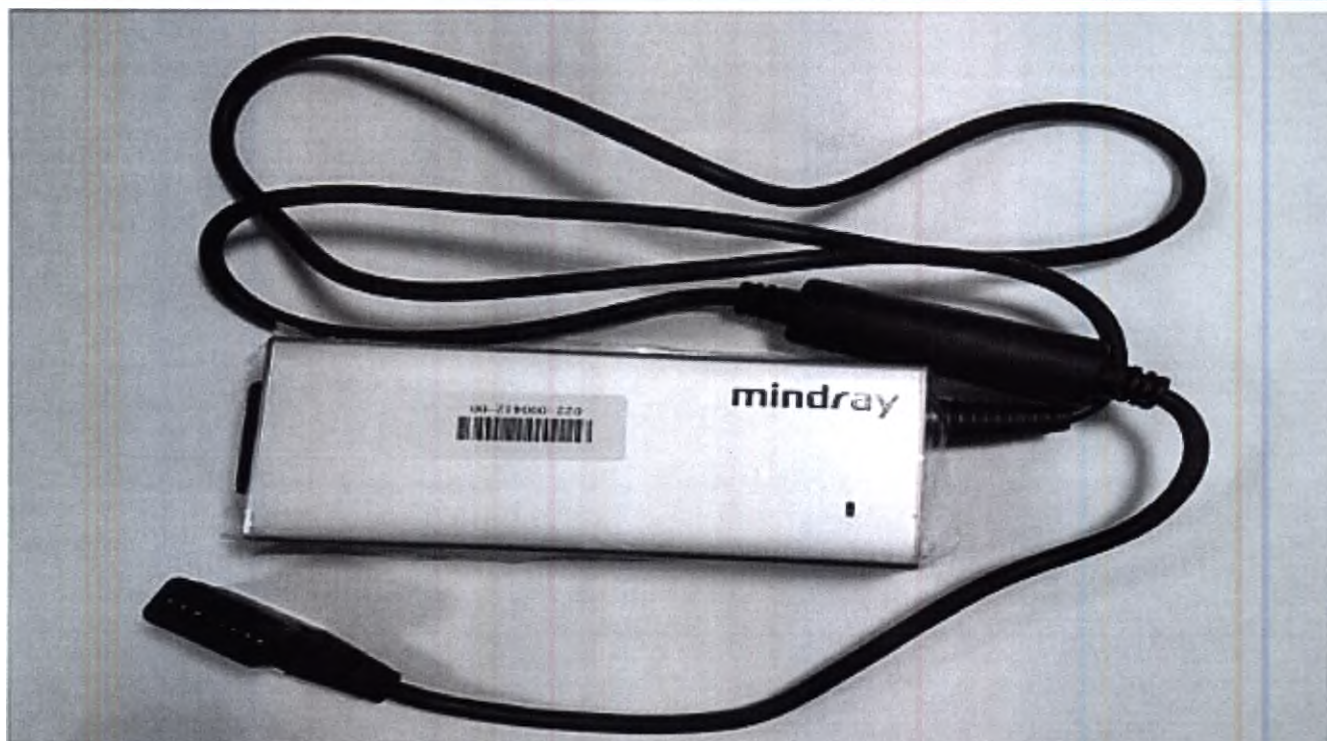

Адаптер питания AC-DC. Упаковывается в кейс для транспортировки. Вид спереди.



Адаптер питания AC-DC. Упаковывается в кейс для транспортировки. Вид сзади.




Кабель питания адаптера AC-DC. Упаковывается в кейс для транспортировки. Вид сверху.



Адаптер Wi-Fi встроенный Вид сверху.




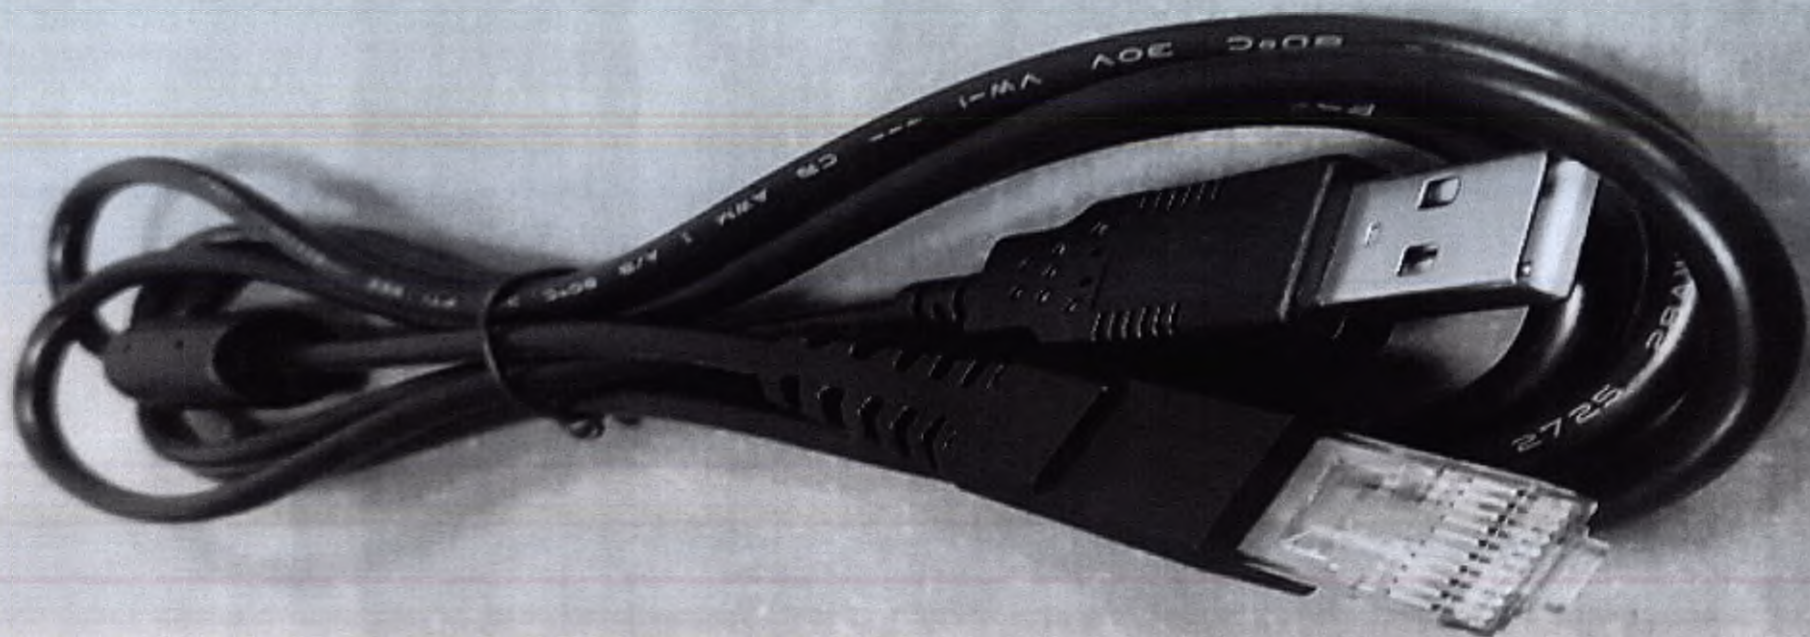


Кабель USB к сканеру штрих-кодов 1D. Вид сверху.




Держатель сканера на гибком стержне с гофрированной защитой.
Сканер штрих-кодов 1D. Вид сбоку.

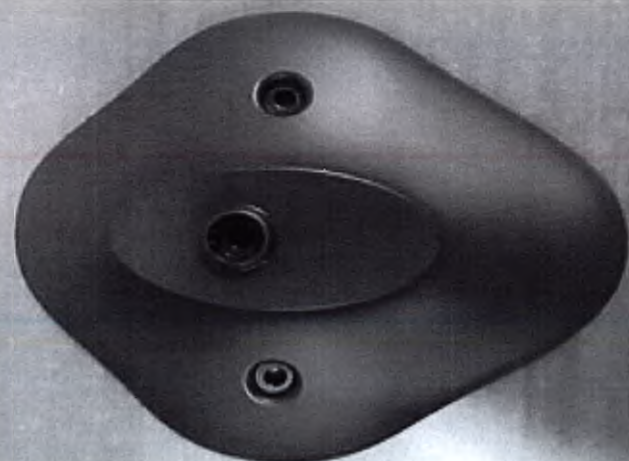

Основание. Сканер штрих-кодов 1D. Вид сверху.

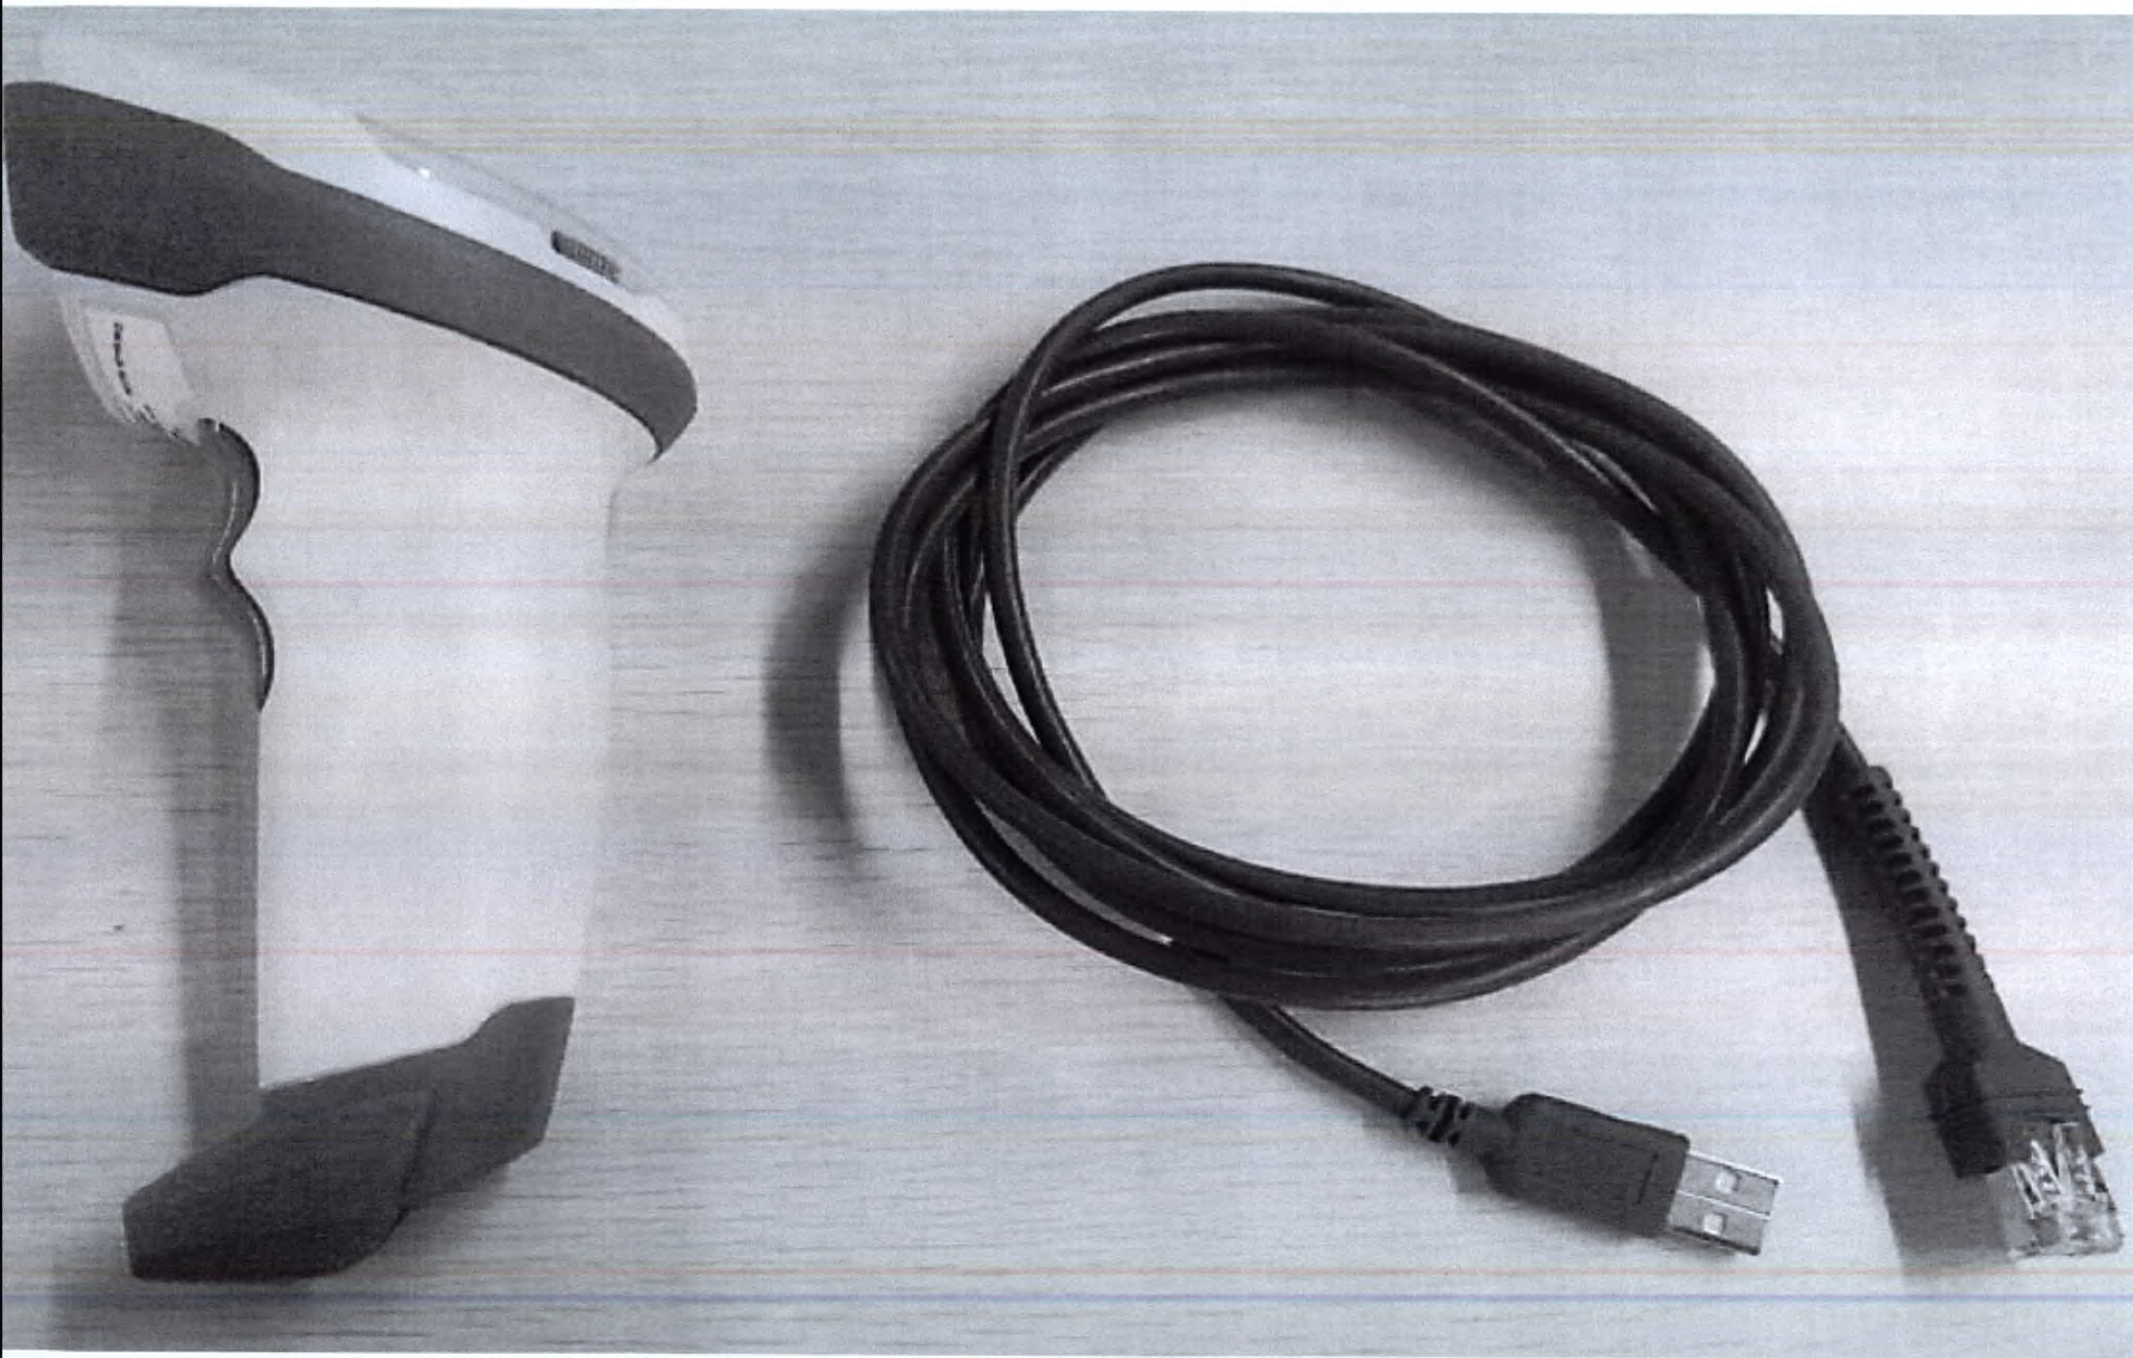

Сканер штрих-кодов 2D и Кабель USB. Вид спереди.

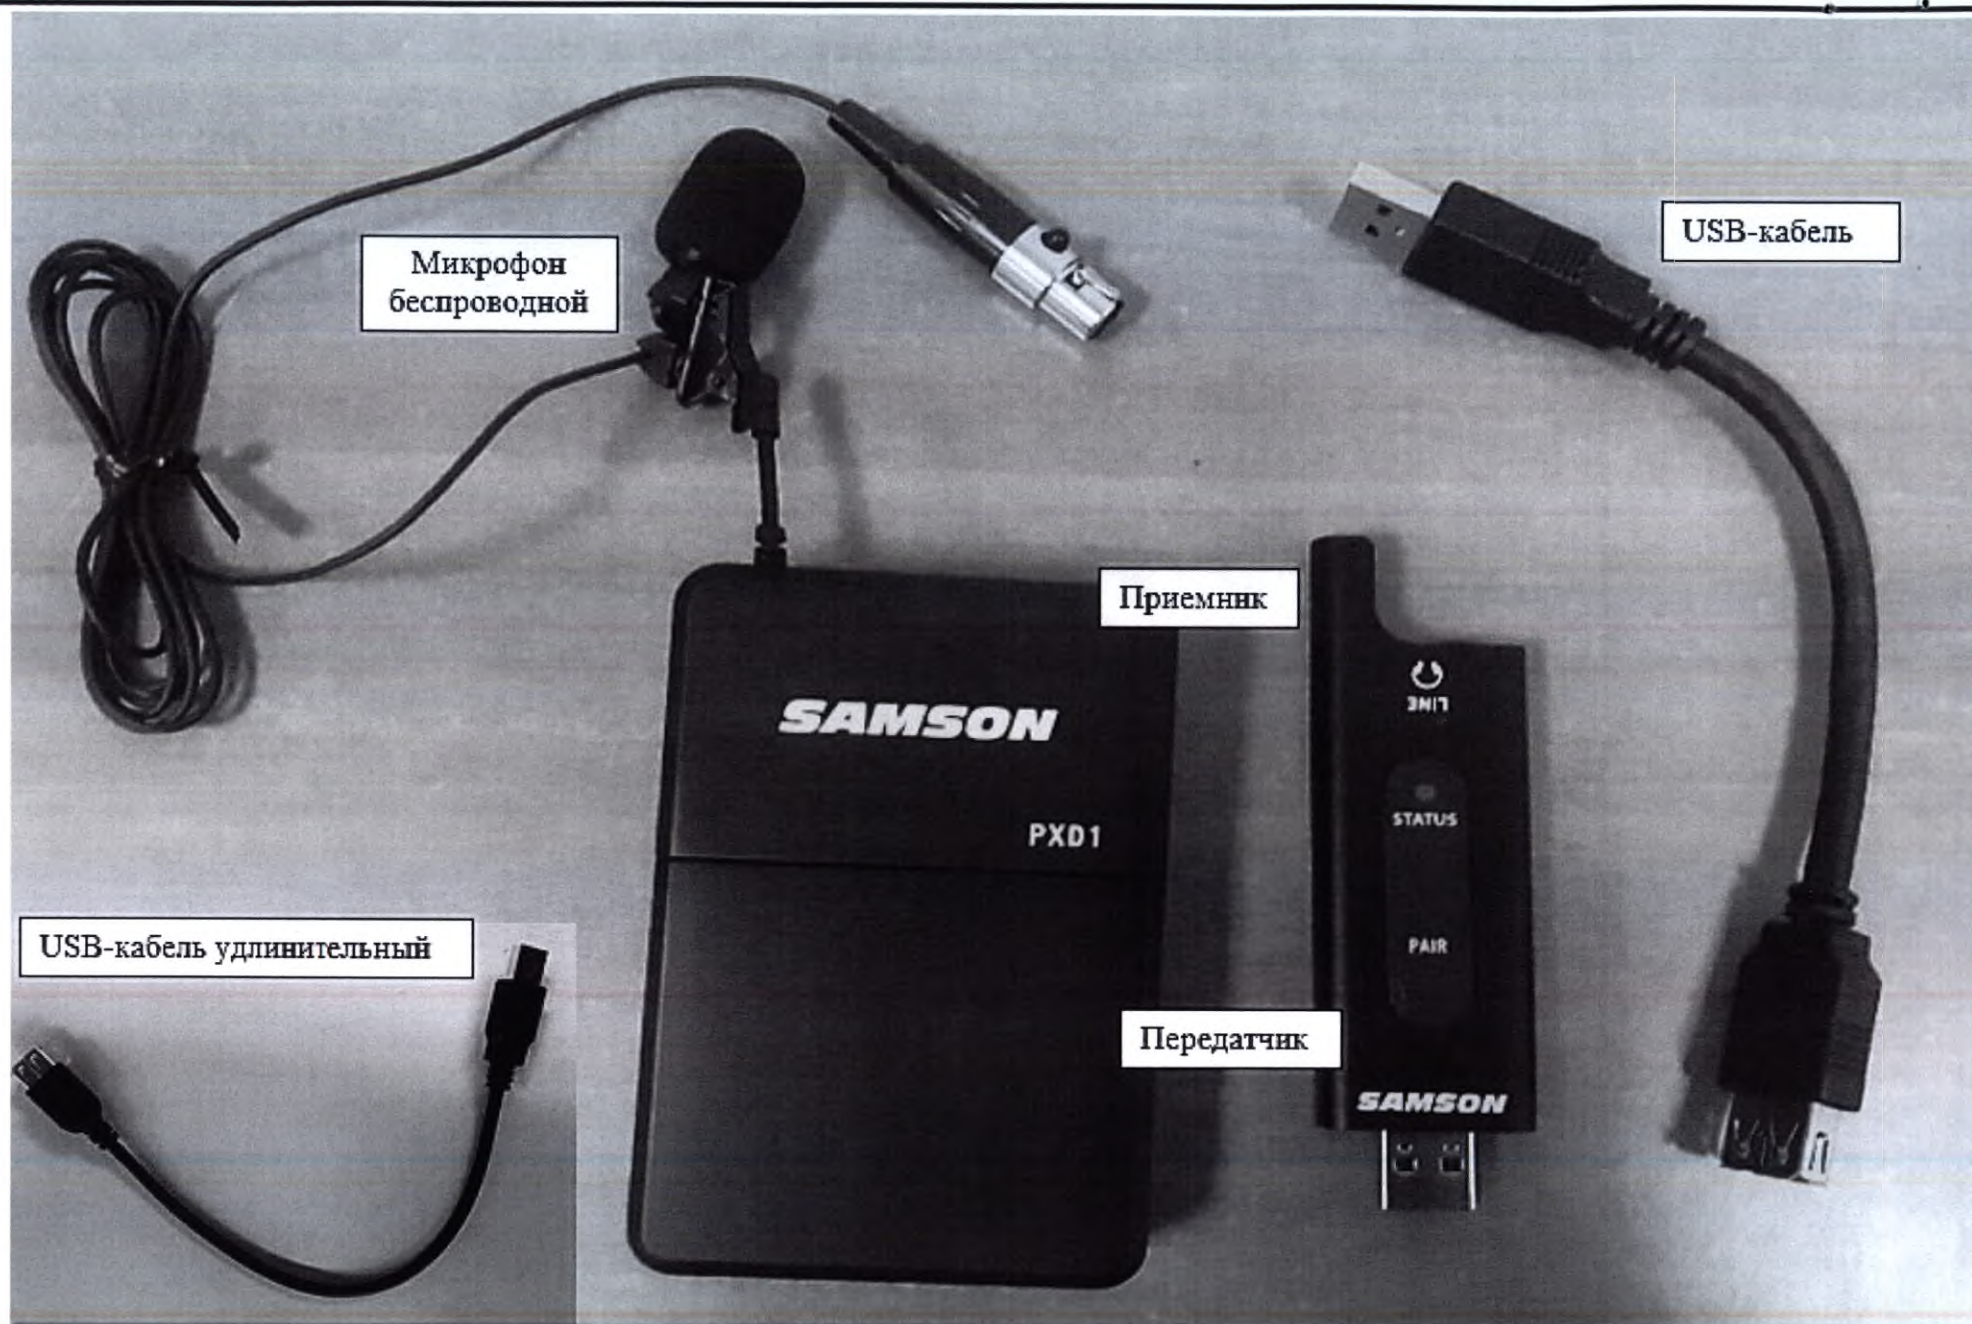

Комплект для подключения микрофона беспроводного.




Комплект из двух аккумуляторов встраиваемых (U-Bank)




Комплект из четырех аккумуляторов встраиваемых (U-Bank).



Комплект из четыре х аккумуляторов встраиваемых (U-Bank). Вид с открытыми отсеками для аккумуляторов

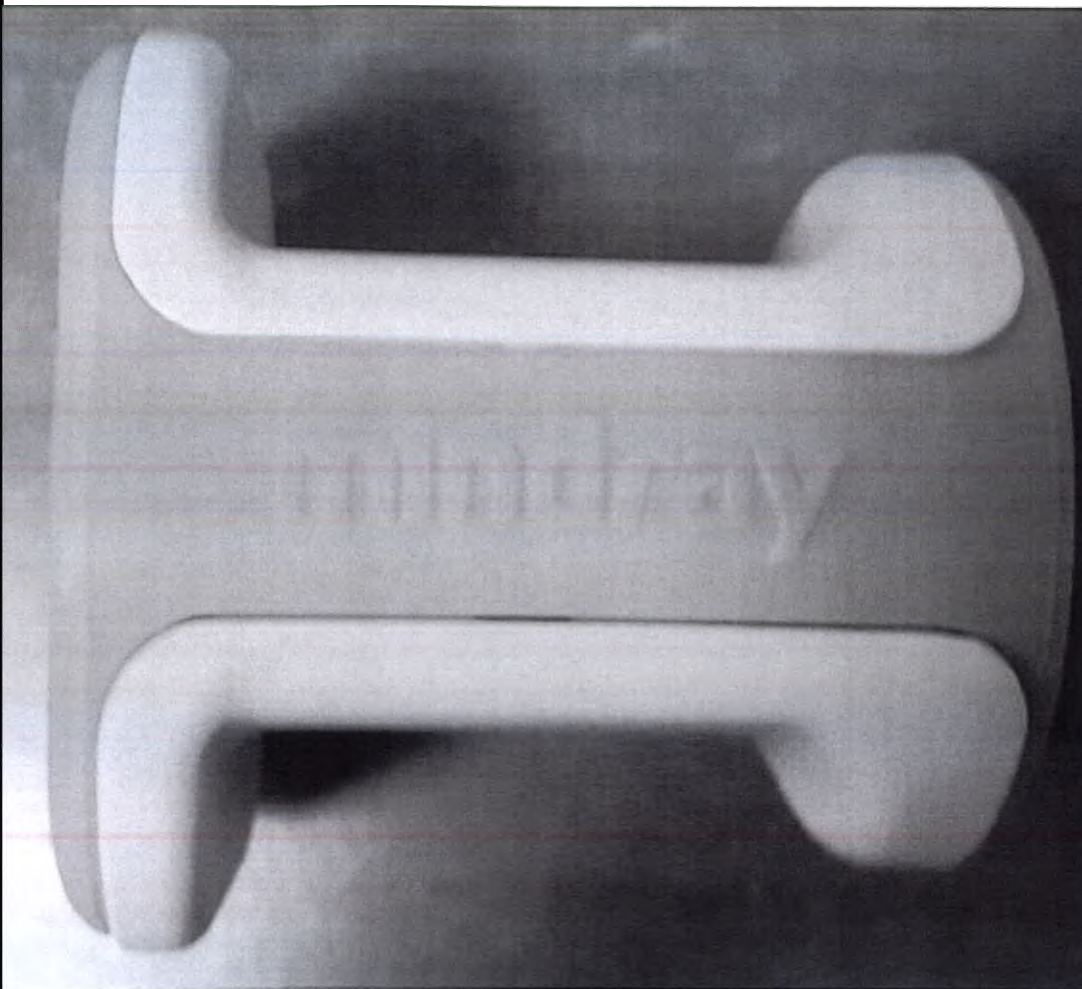

Устройство для игл намагничивающее. Вид спереди.

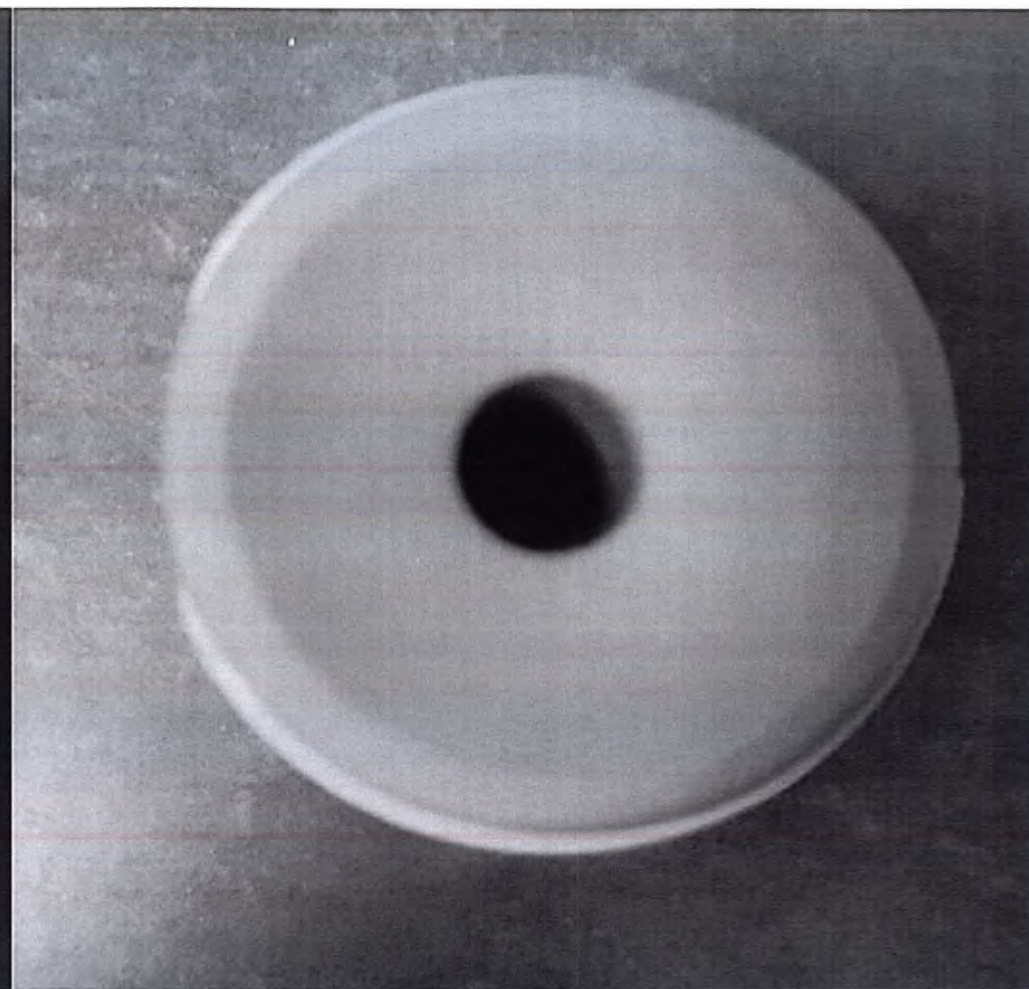


Устройство для игл намагничивающее. Вид сверху.







Датчики ультразвуковые:

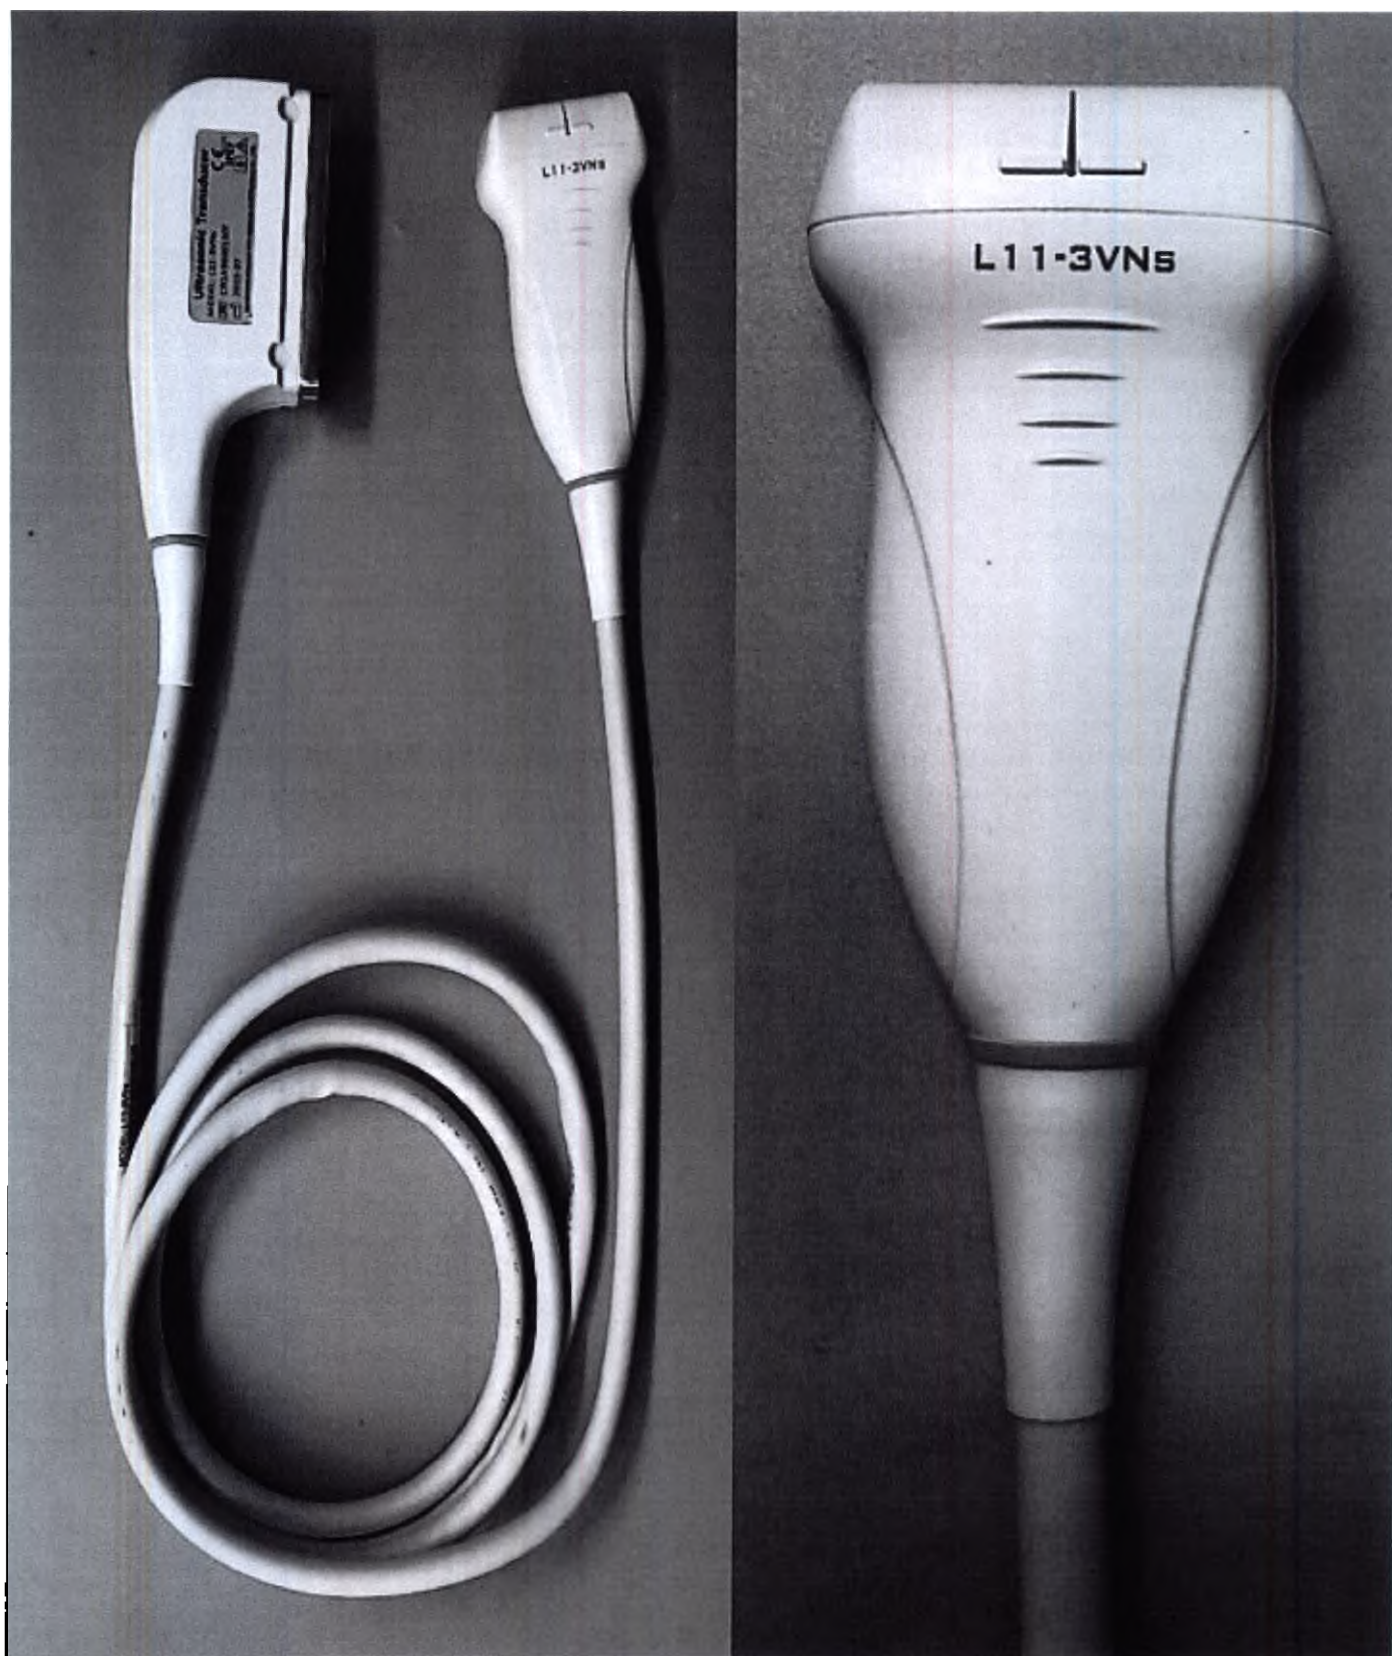


Датчик ультразвуковой линейный L11-3VNs

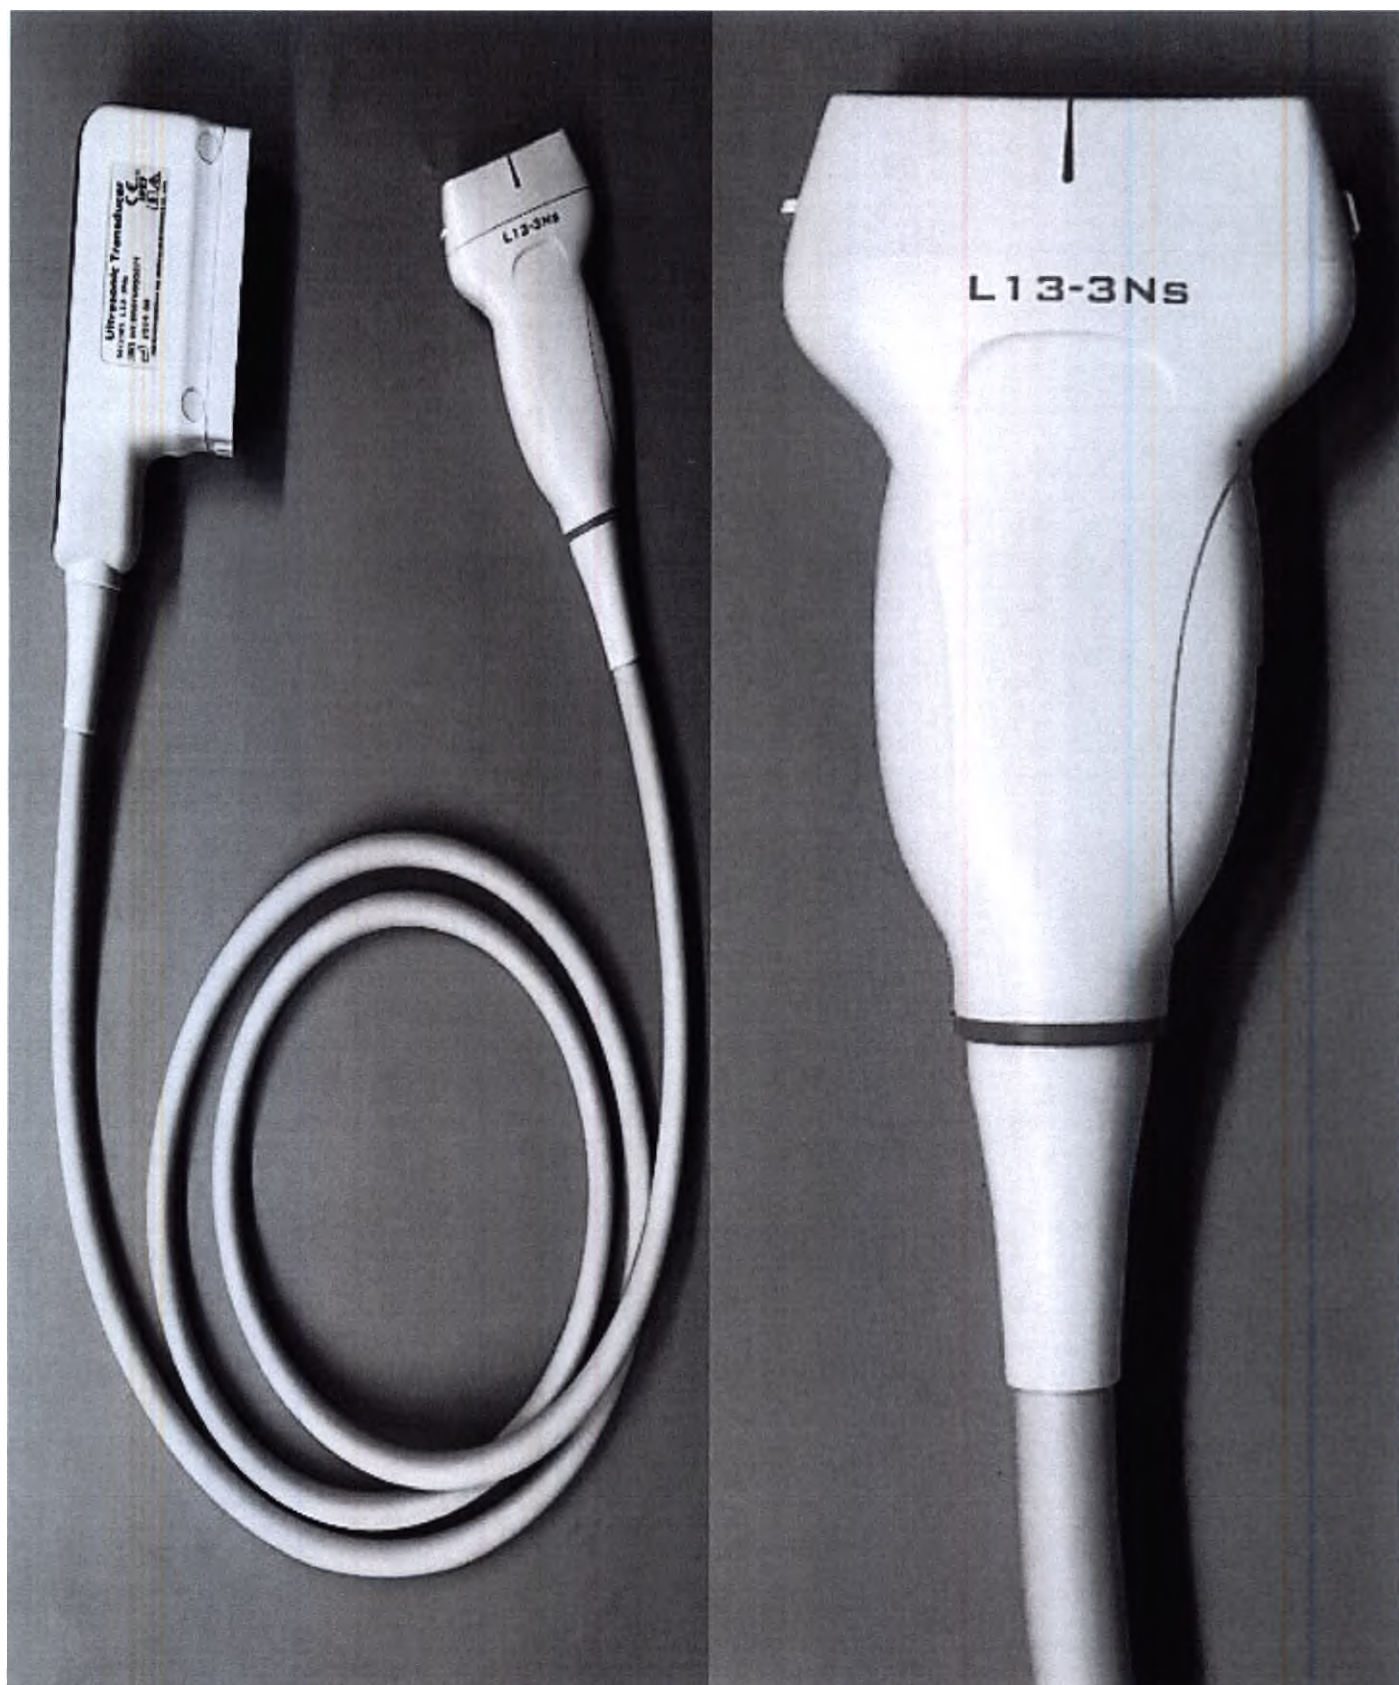

Датчик ультразвуковой линейный L13-3Ns

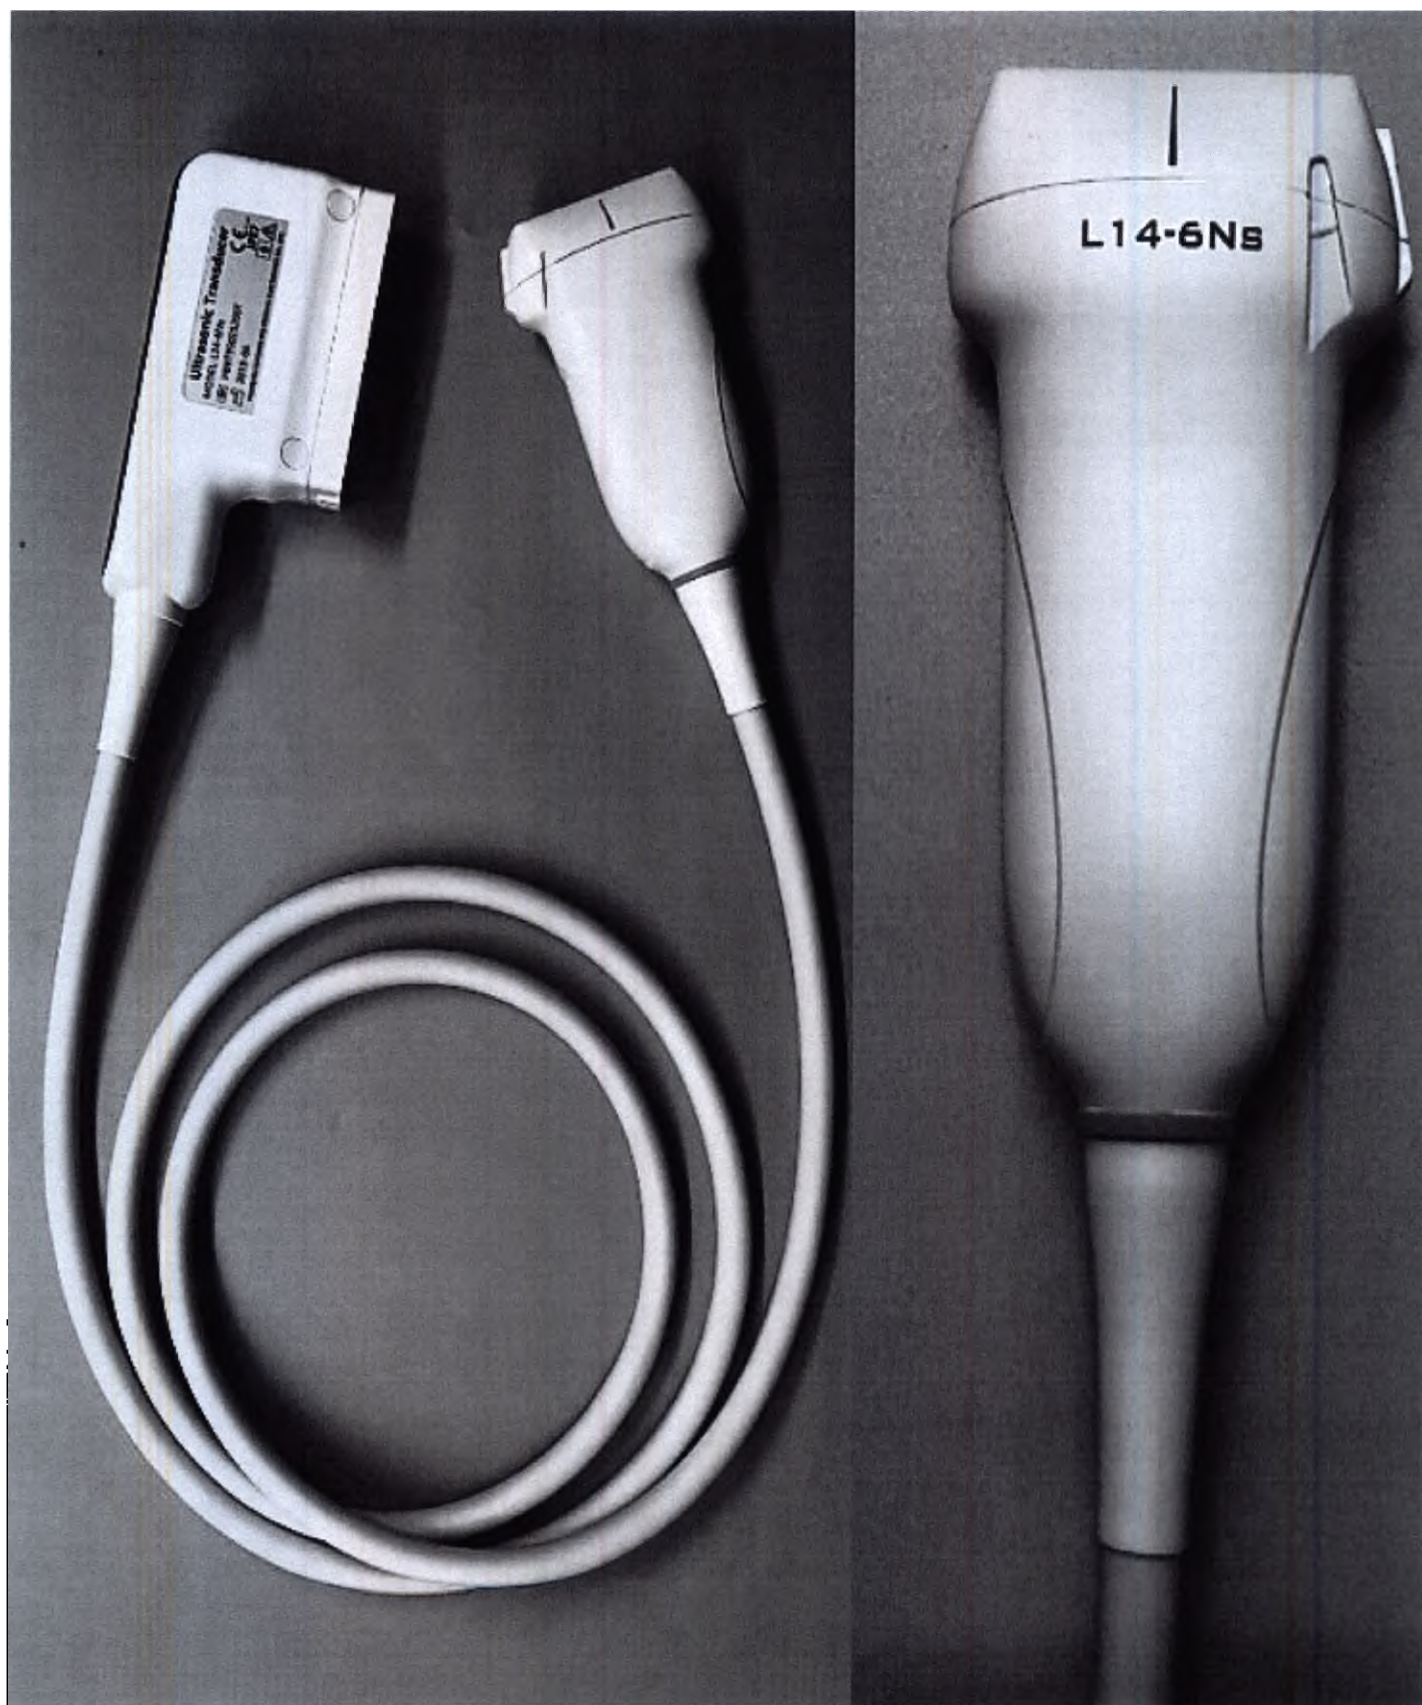


Датчик ультразвуковой линейный L14-6Ns

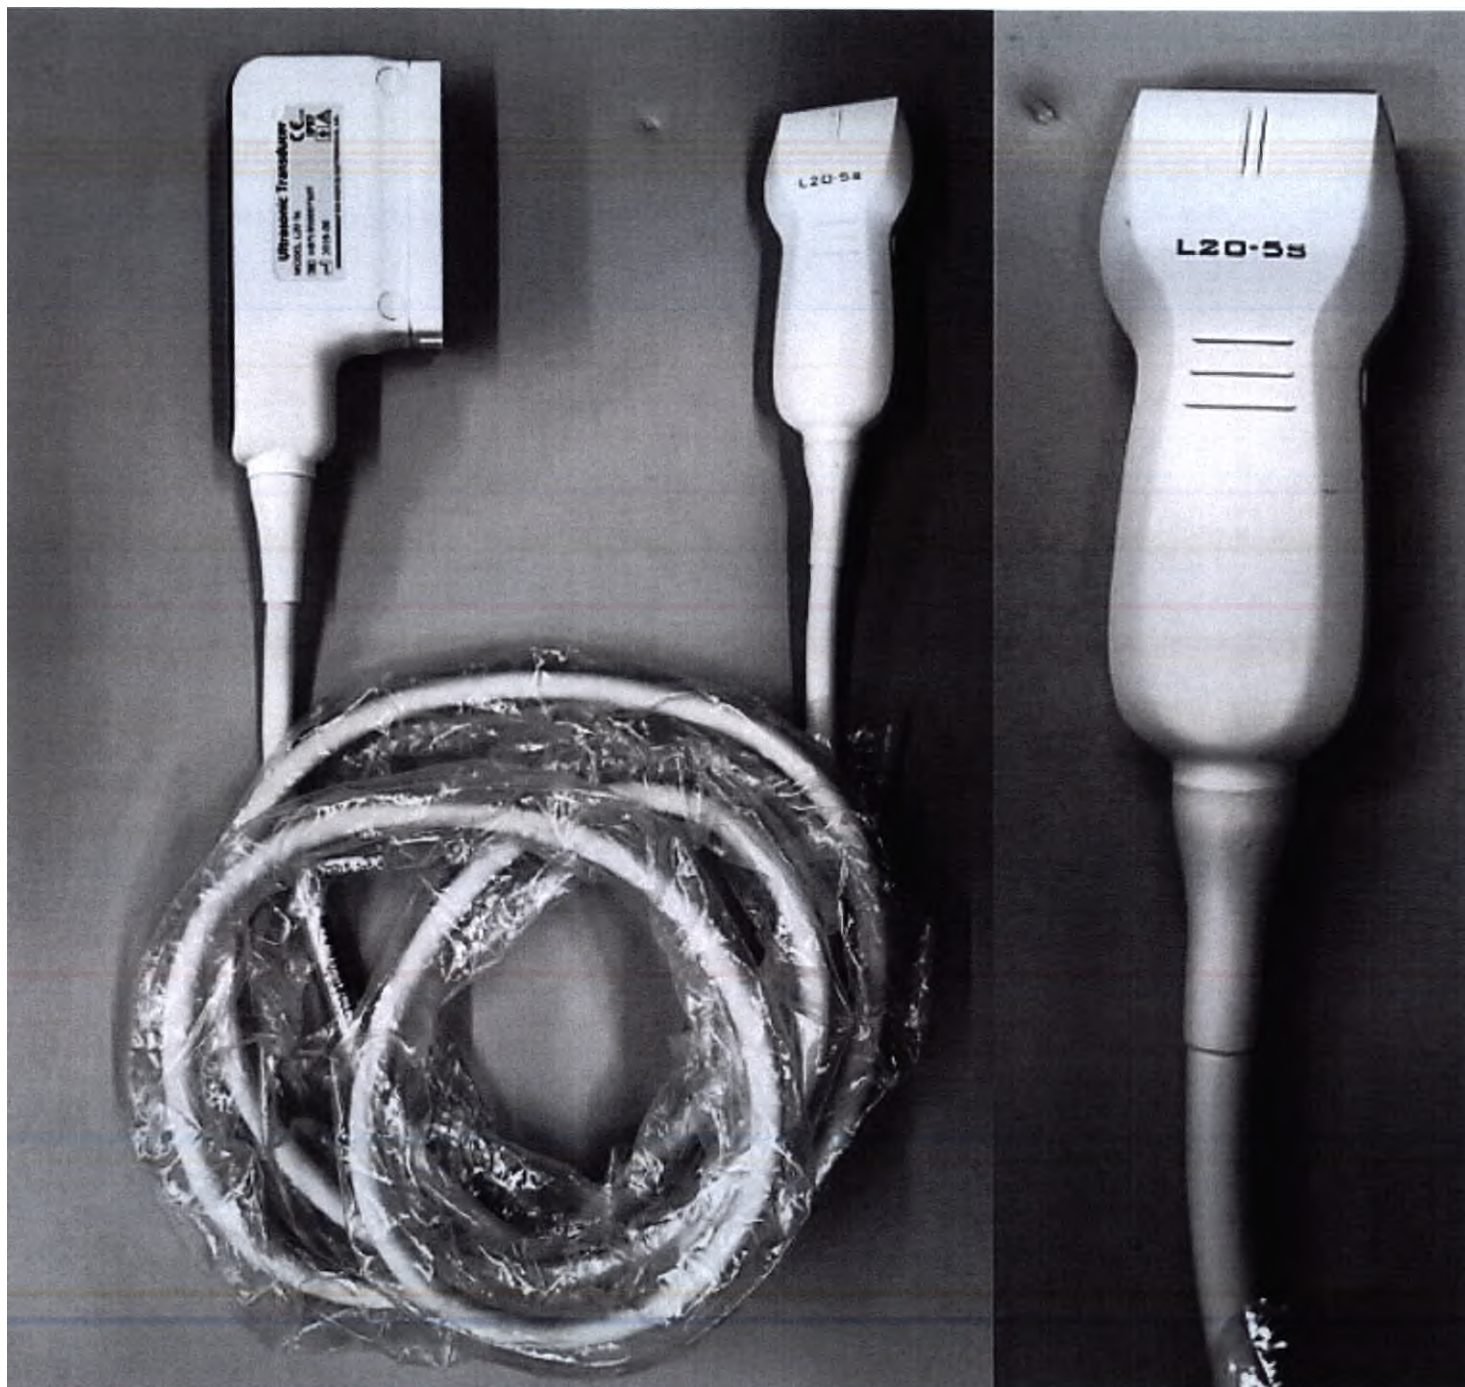


Датчик ультразвуковой линейный L20-5s




Датчик ультразвуковой линейный L12-3RCs

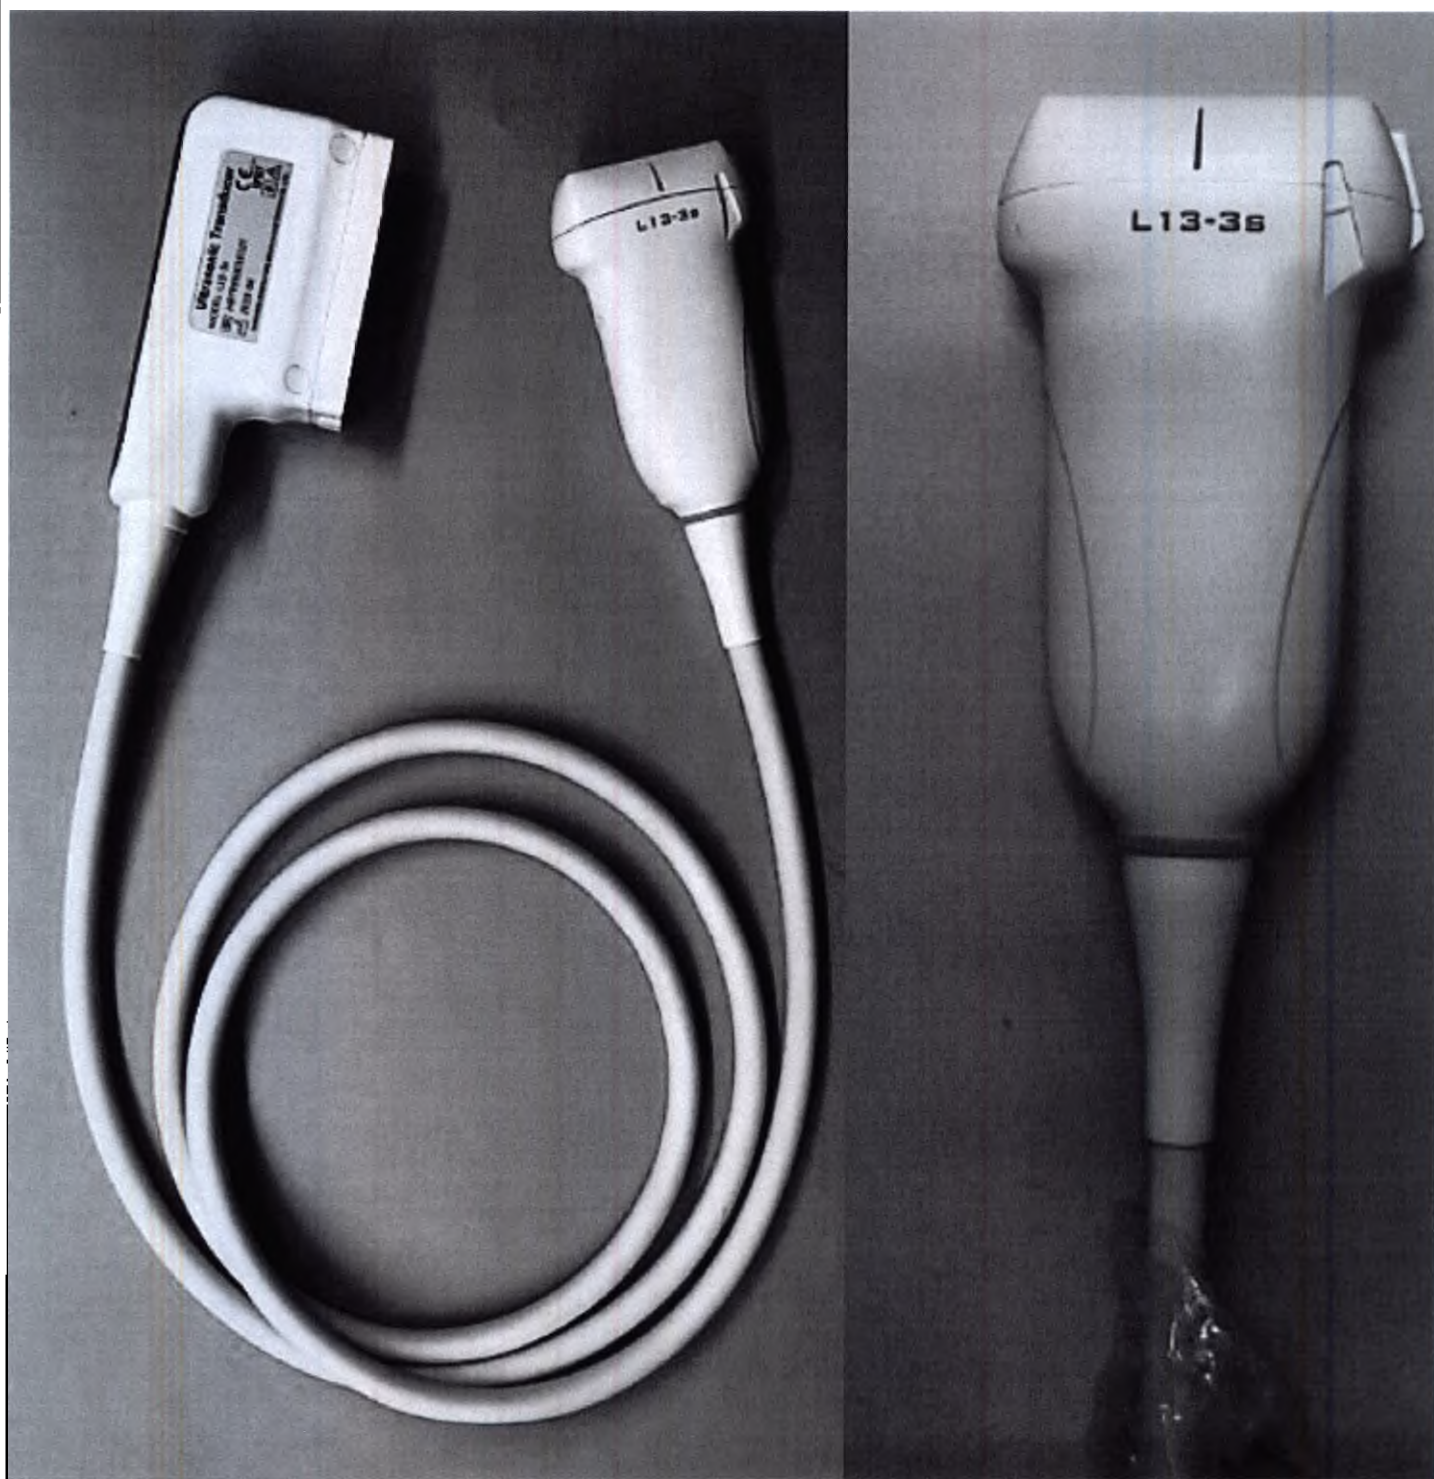


Датчик ультразвуковой линейный L13-3s

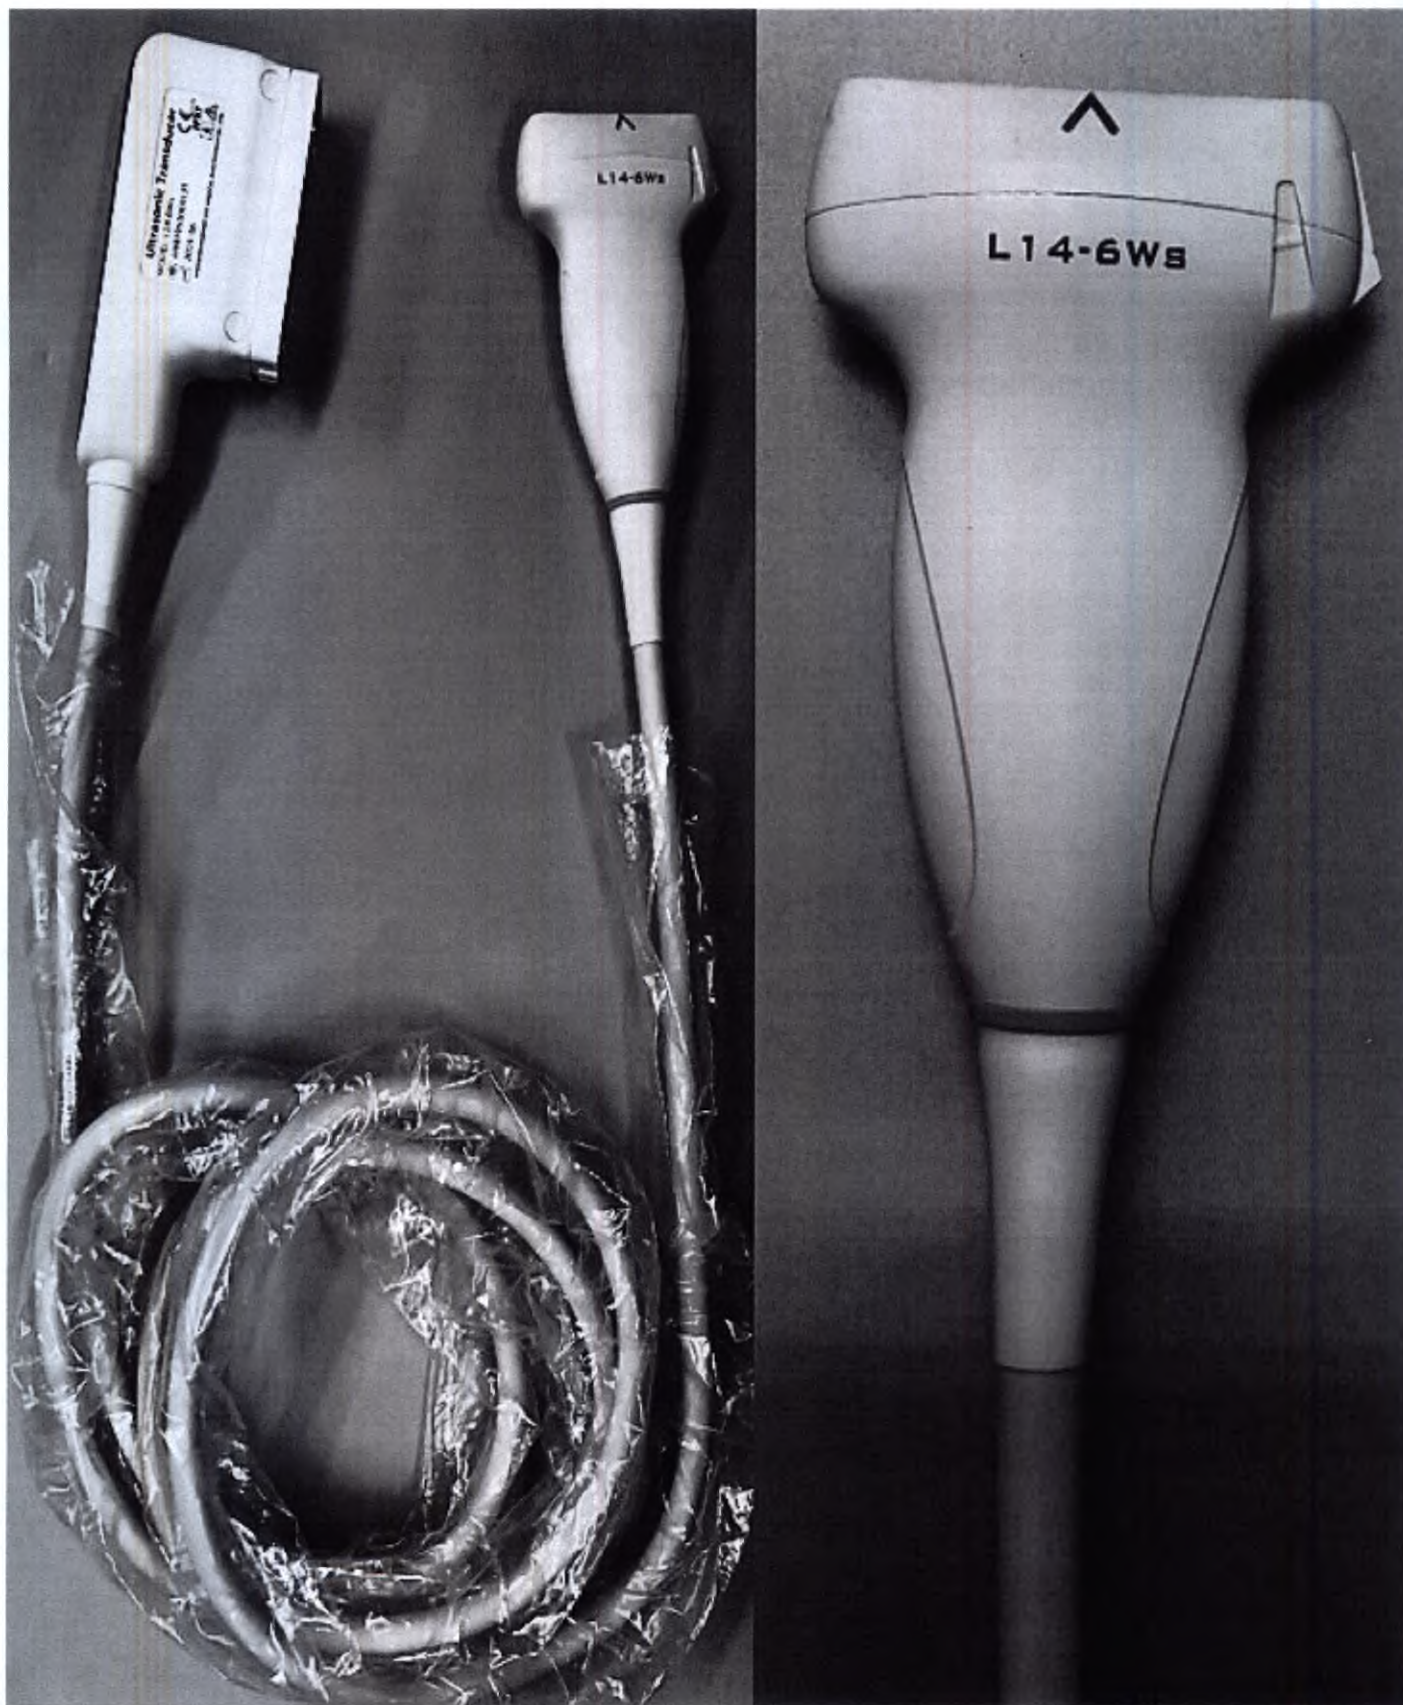


Датчик ультразвуковой линейный L14-6Ws

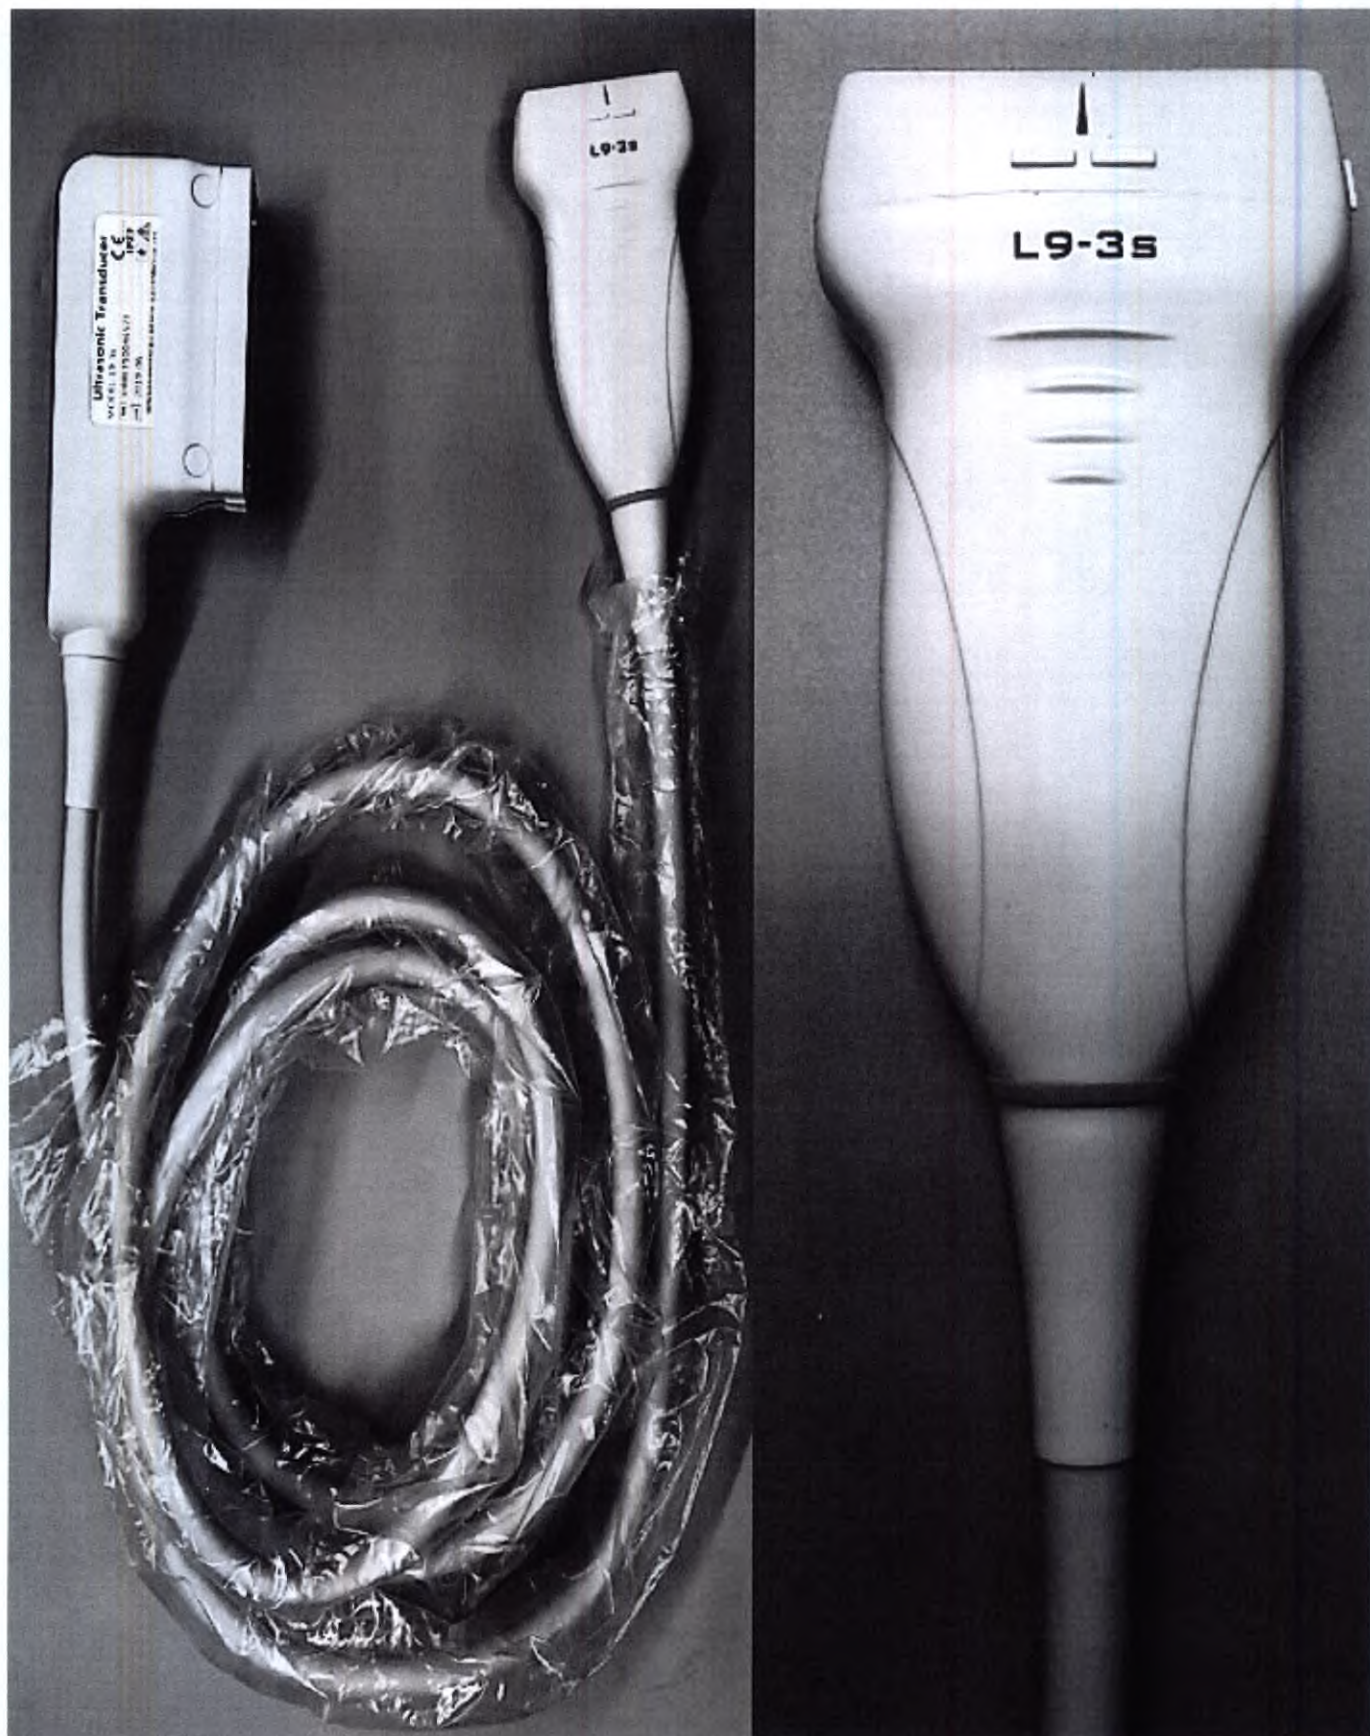


Датчик ультразвуковой линейный L9-3s

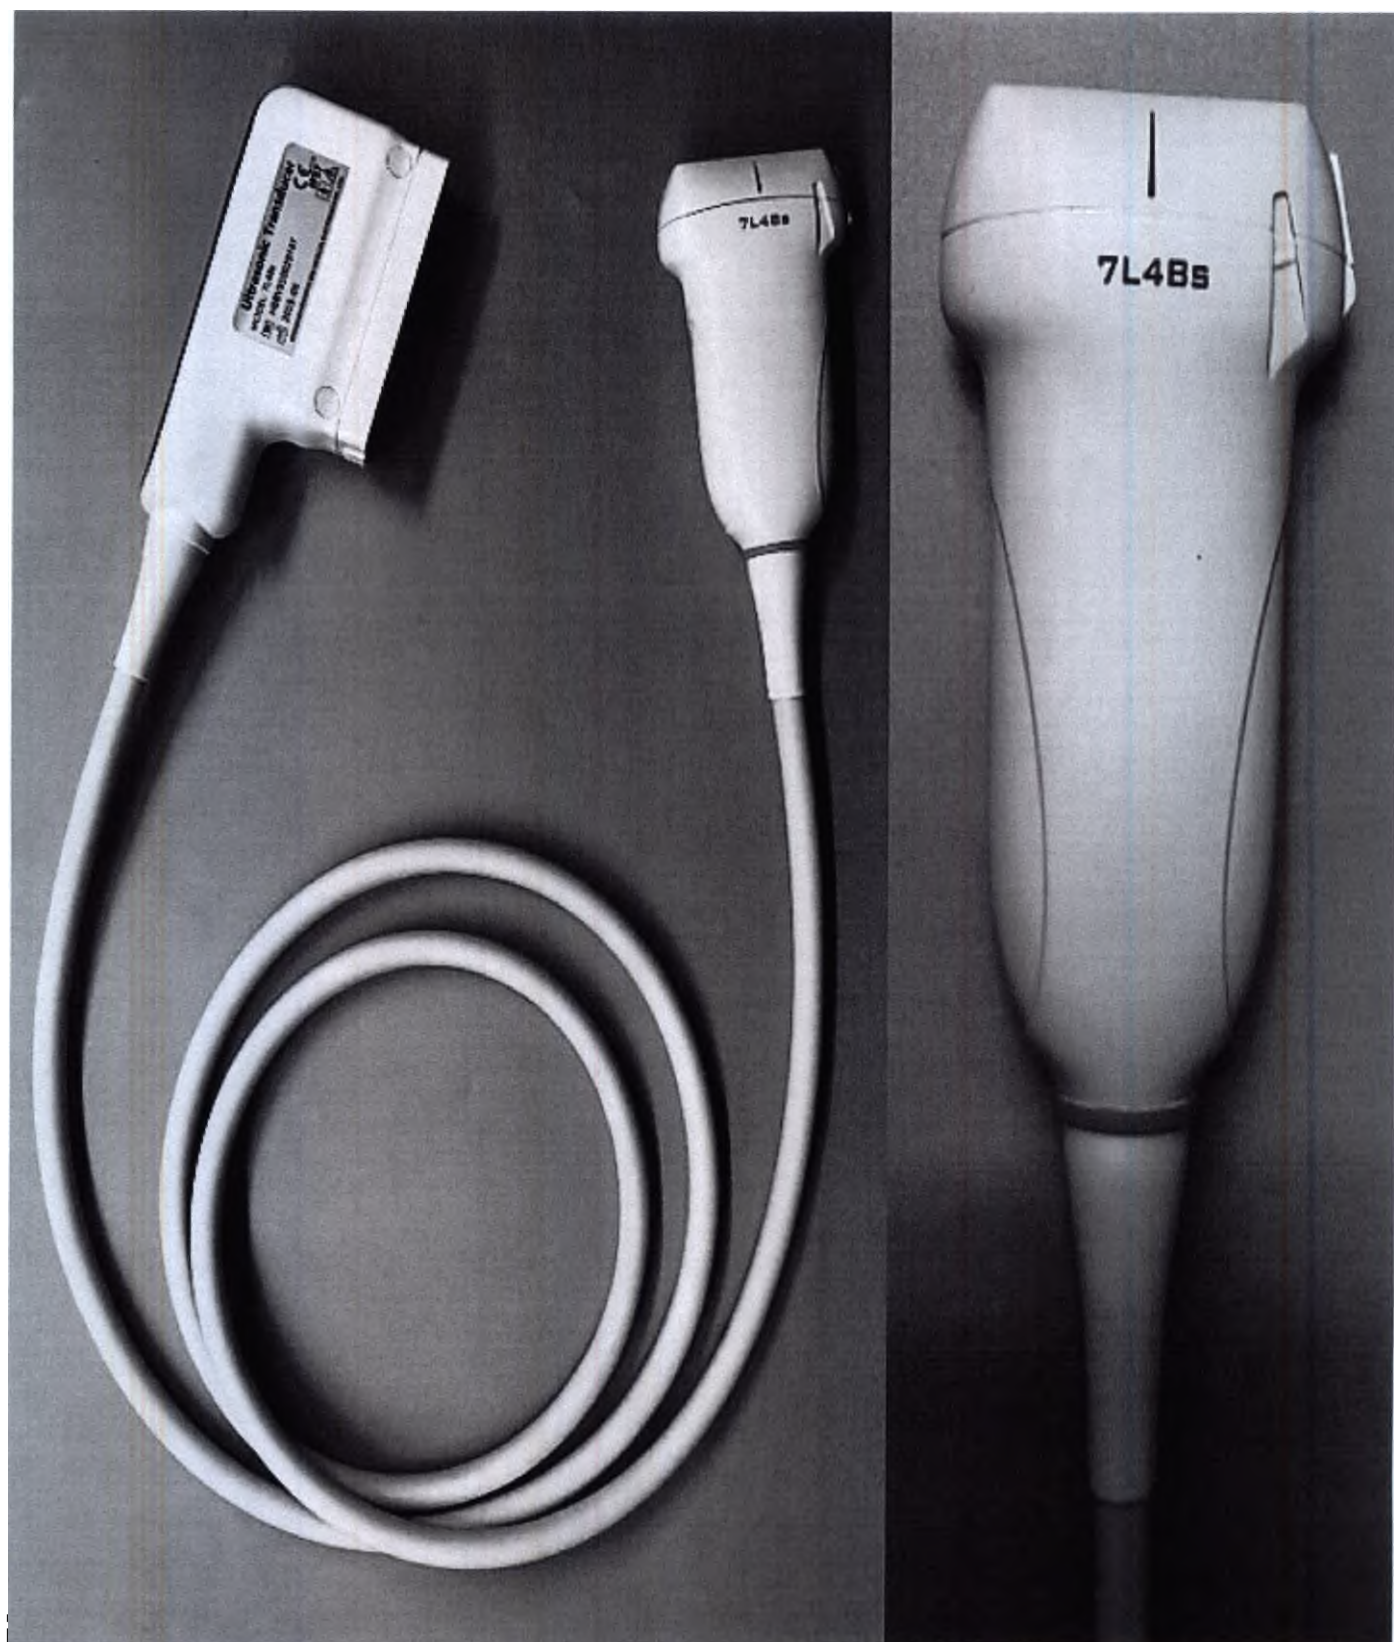


Датчик ультразвуковой линейный 7L4Bs

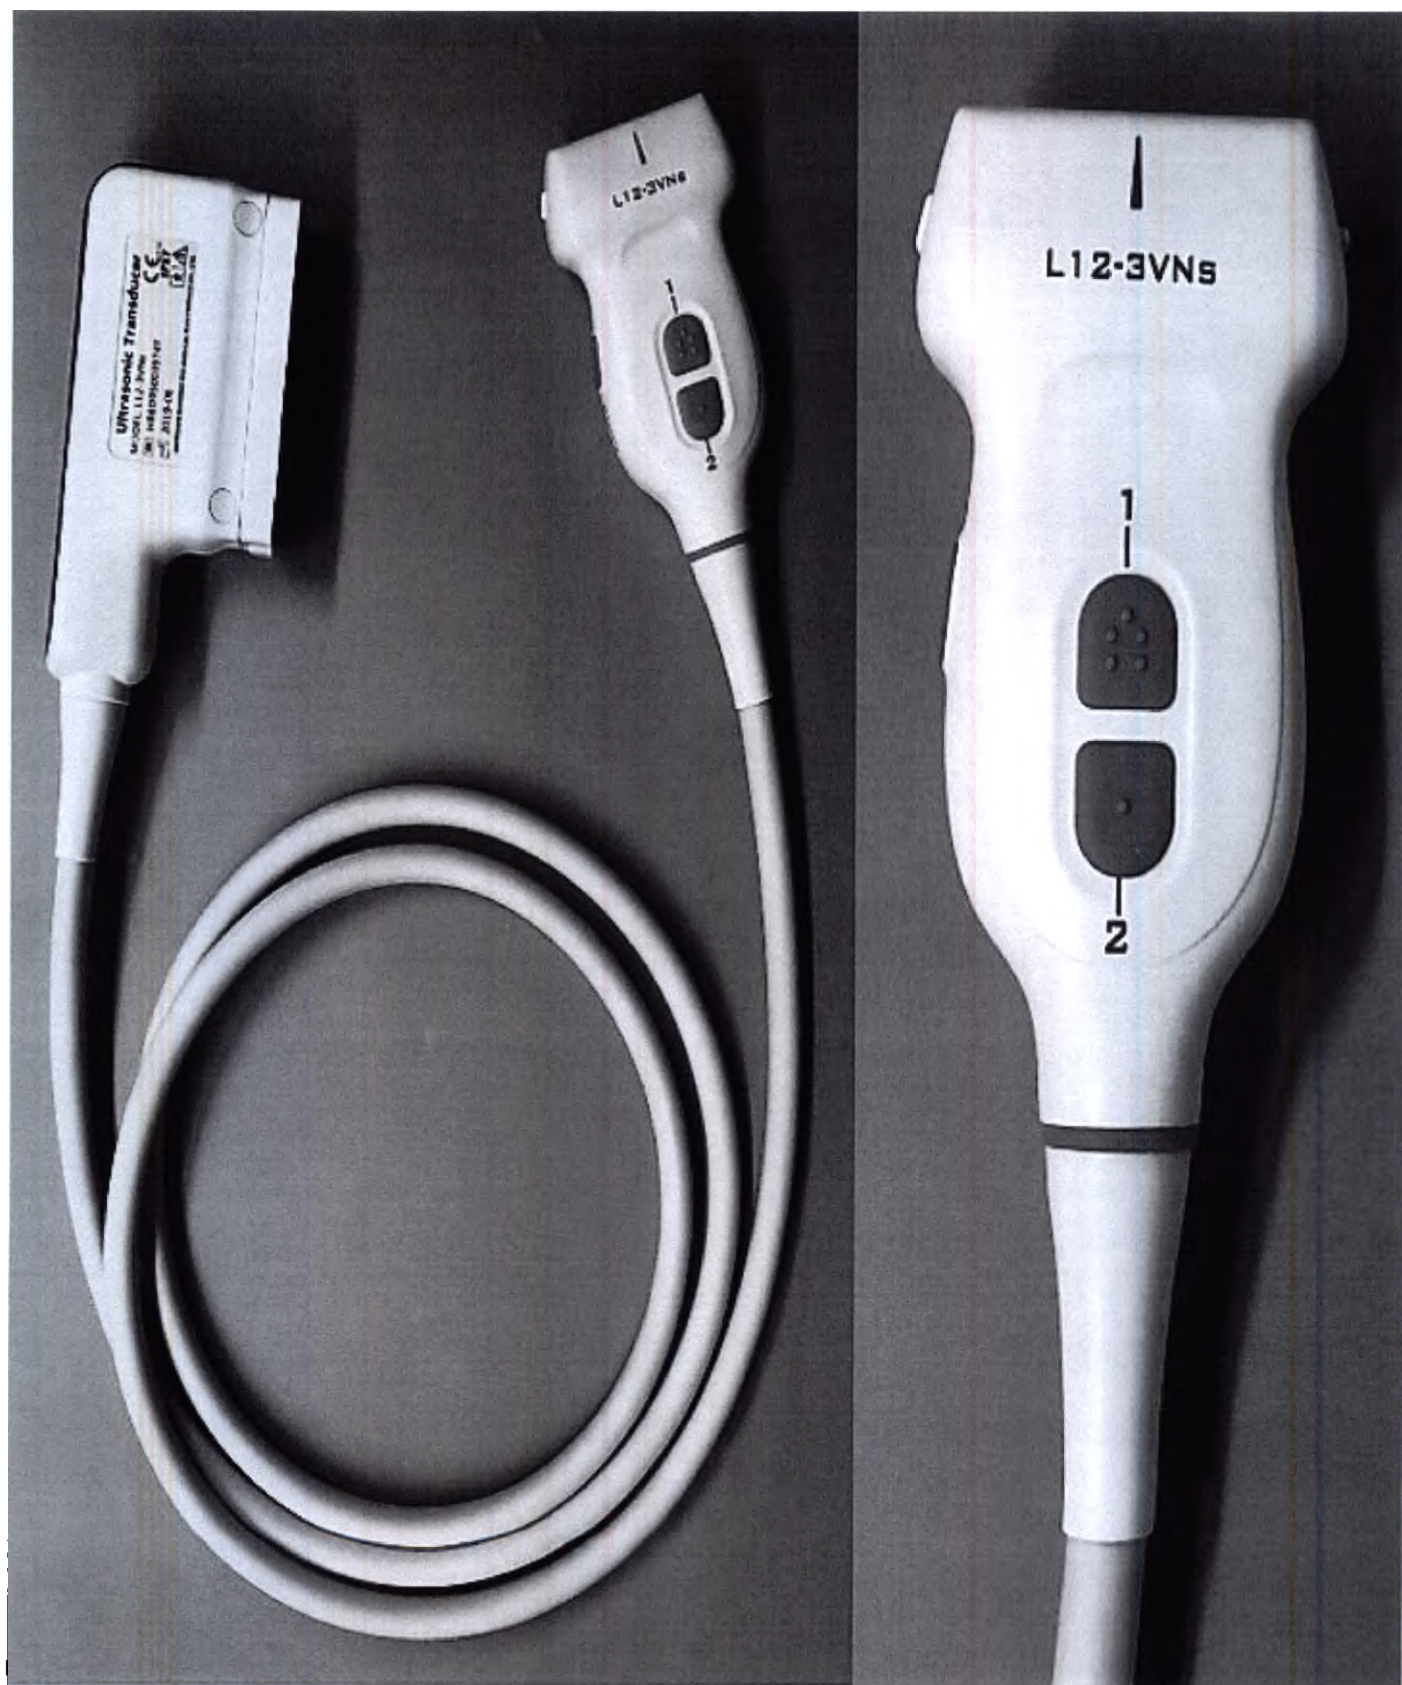


Датчик ультразвуковой линейный L12-3VNs

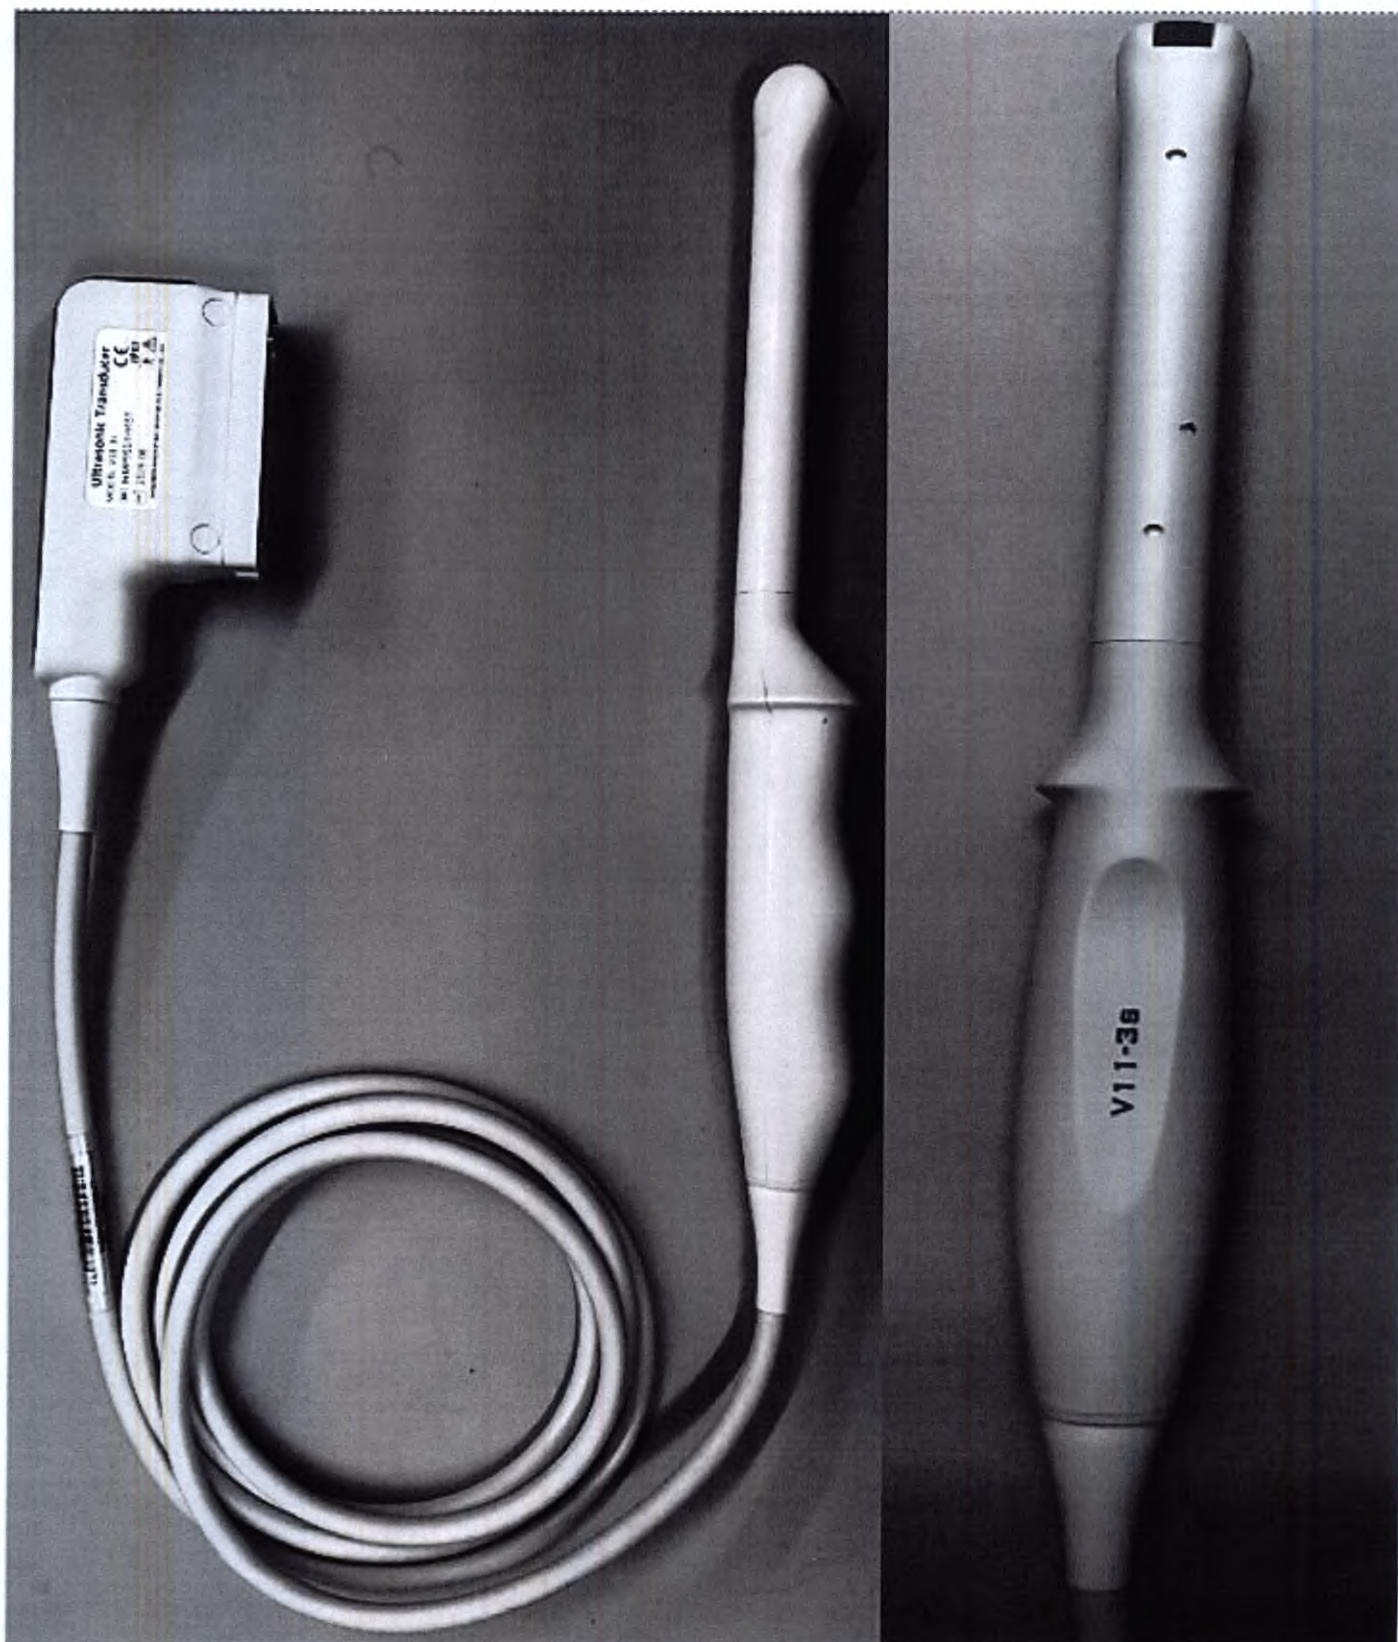


Датчик ультразвуковой внутриполостной V11-3s

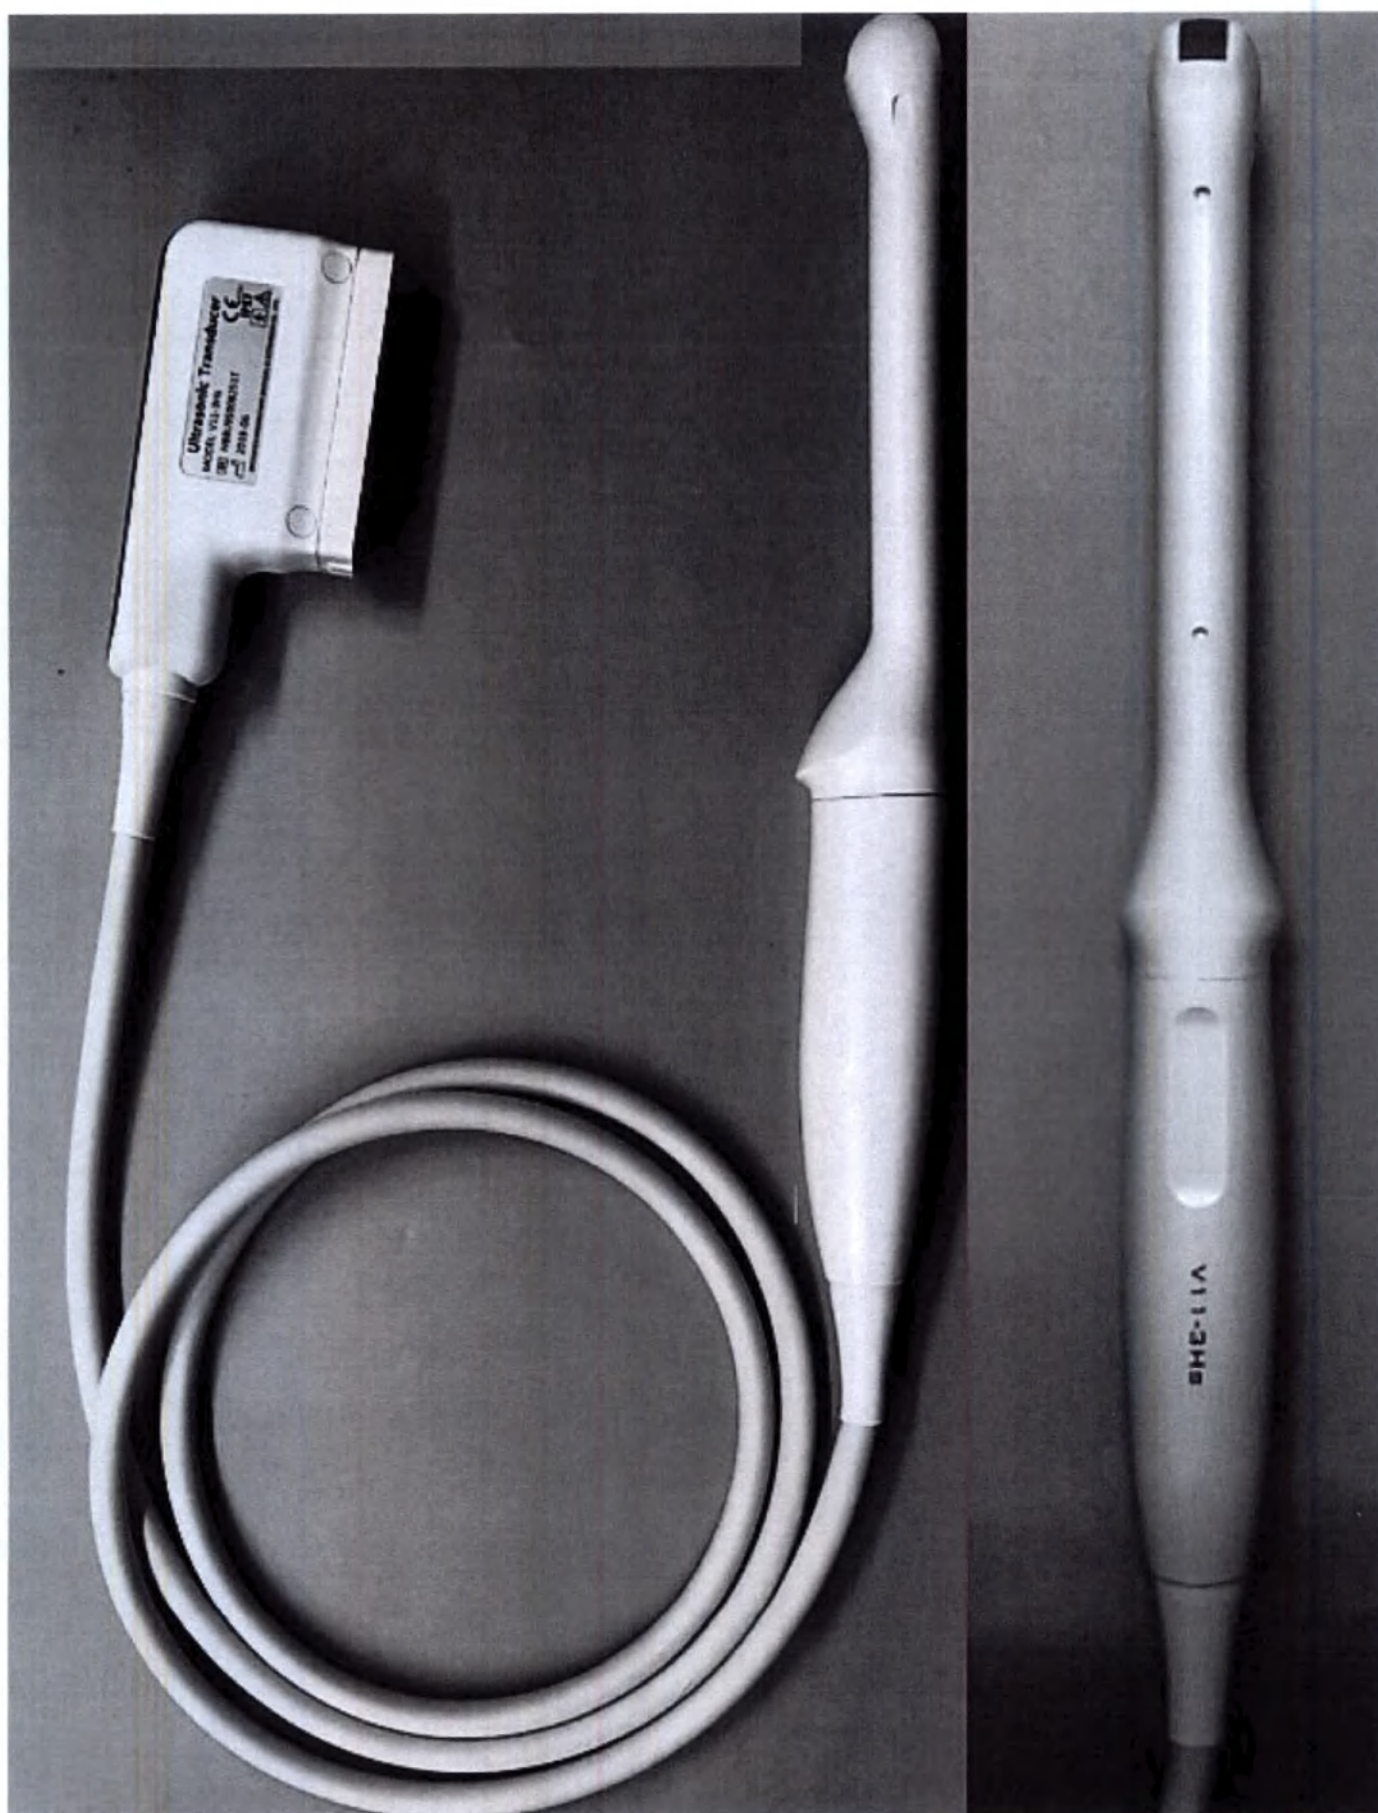

Датчик ультразвуковой внутриполостной V11-3Hs

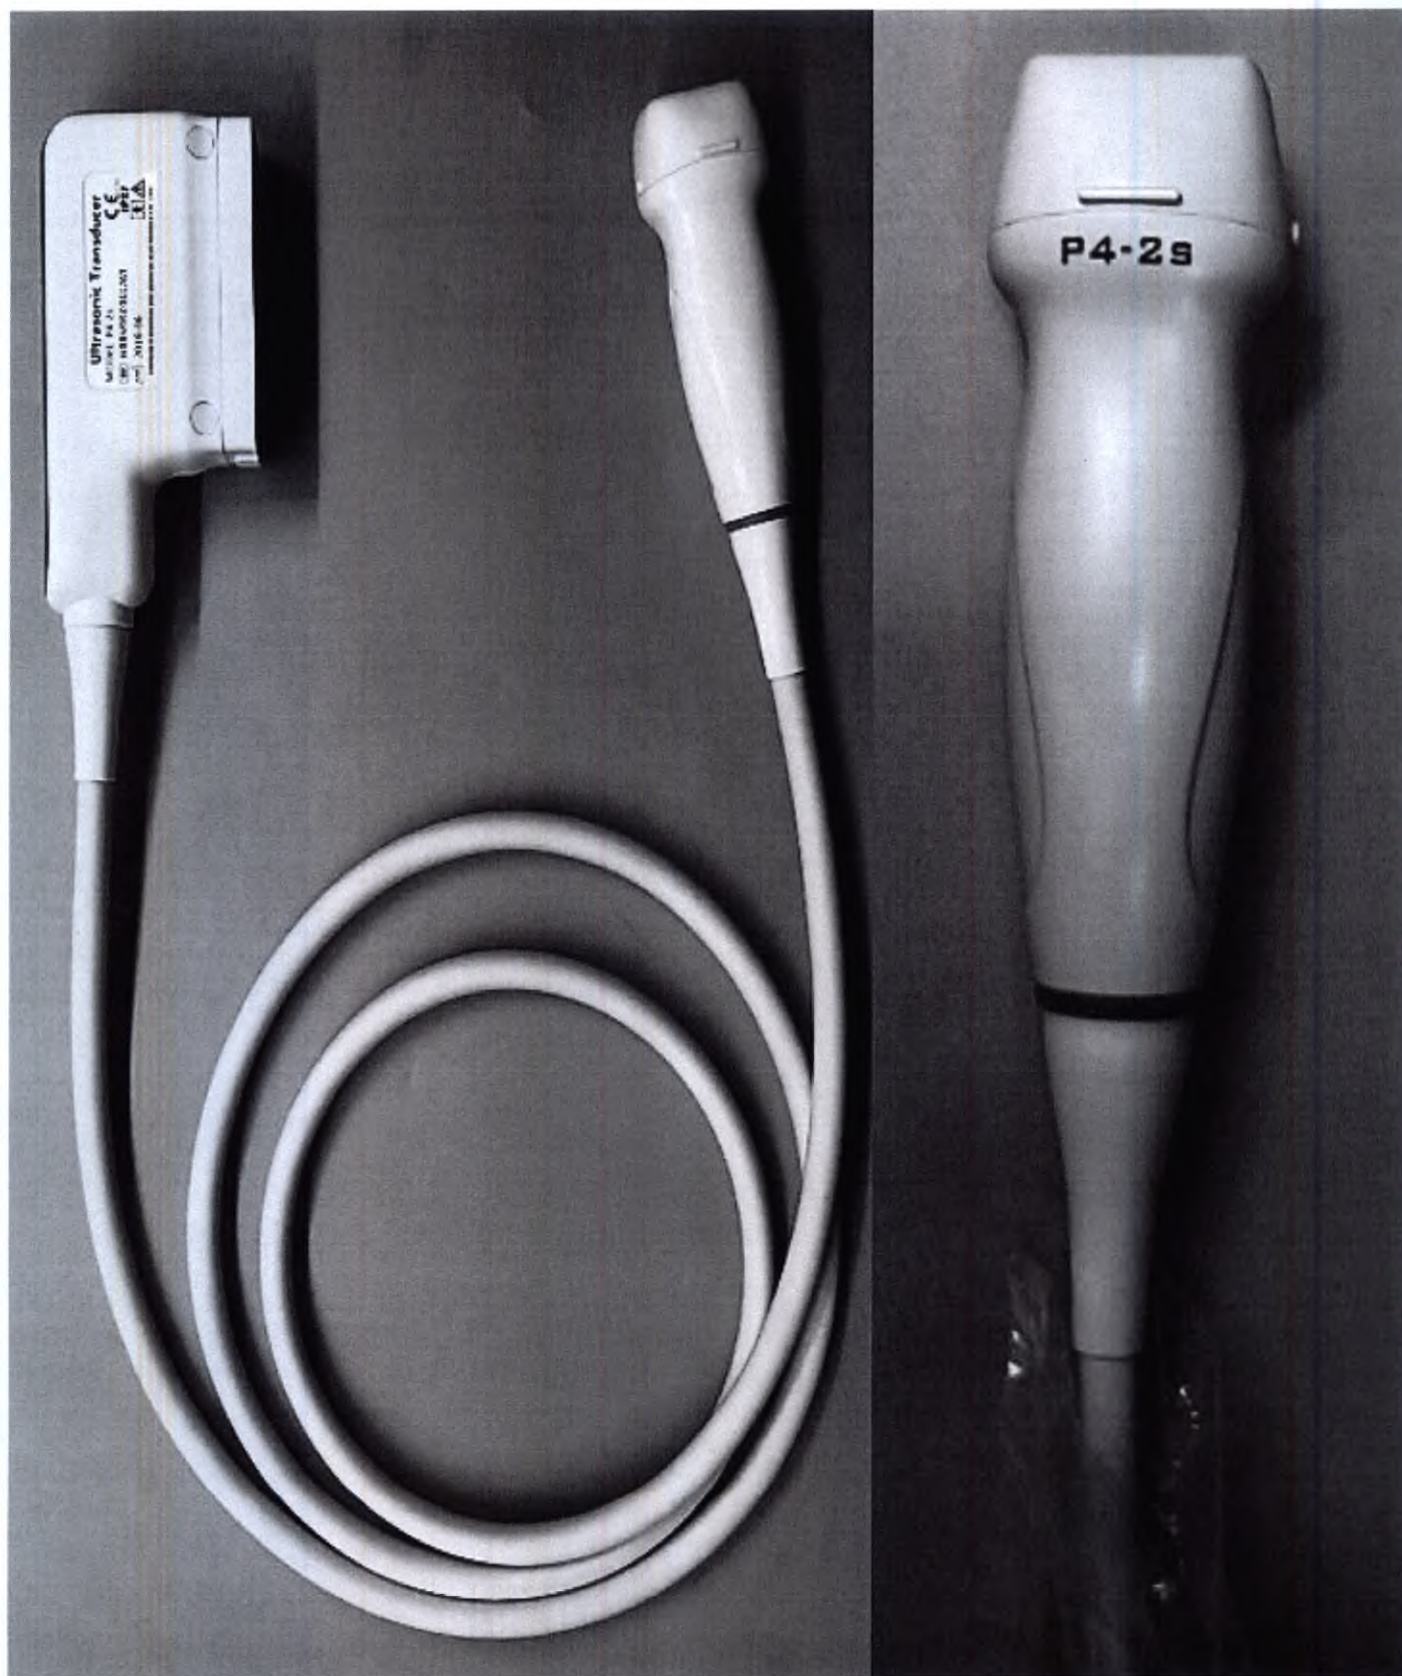


Датчик ультразвуковой секторный фазированный P4-2s

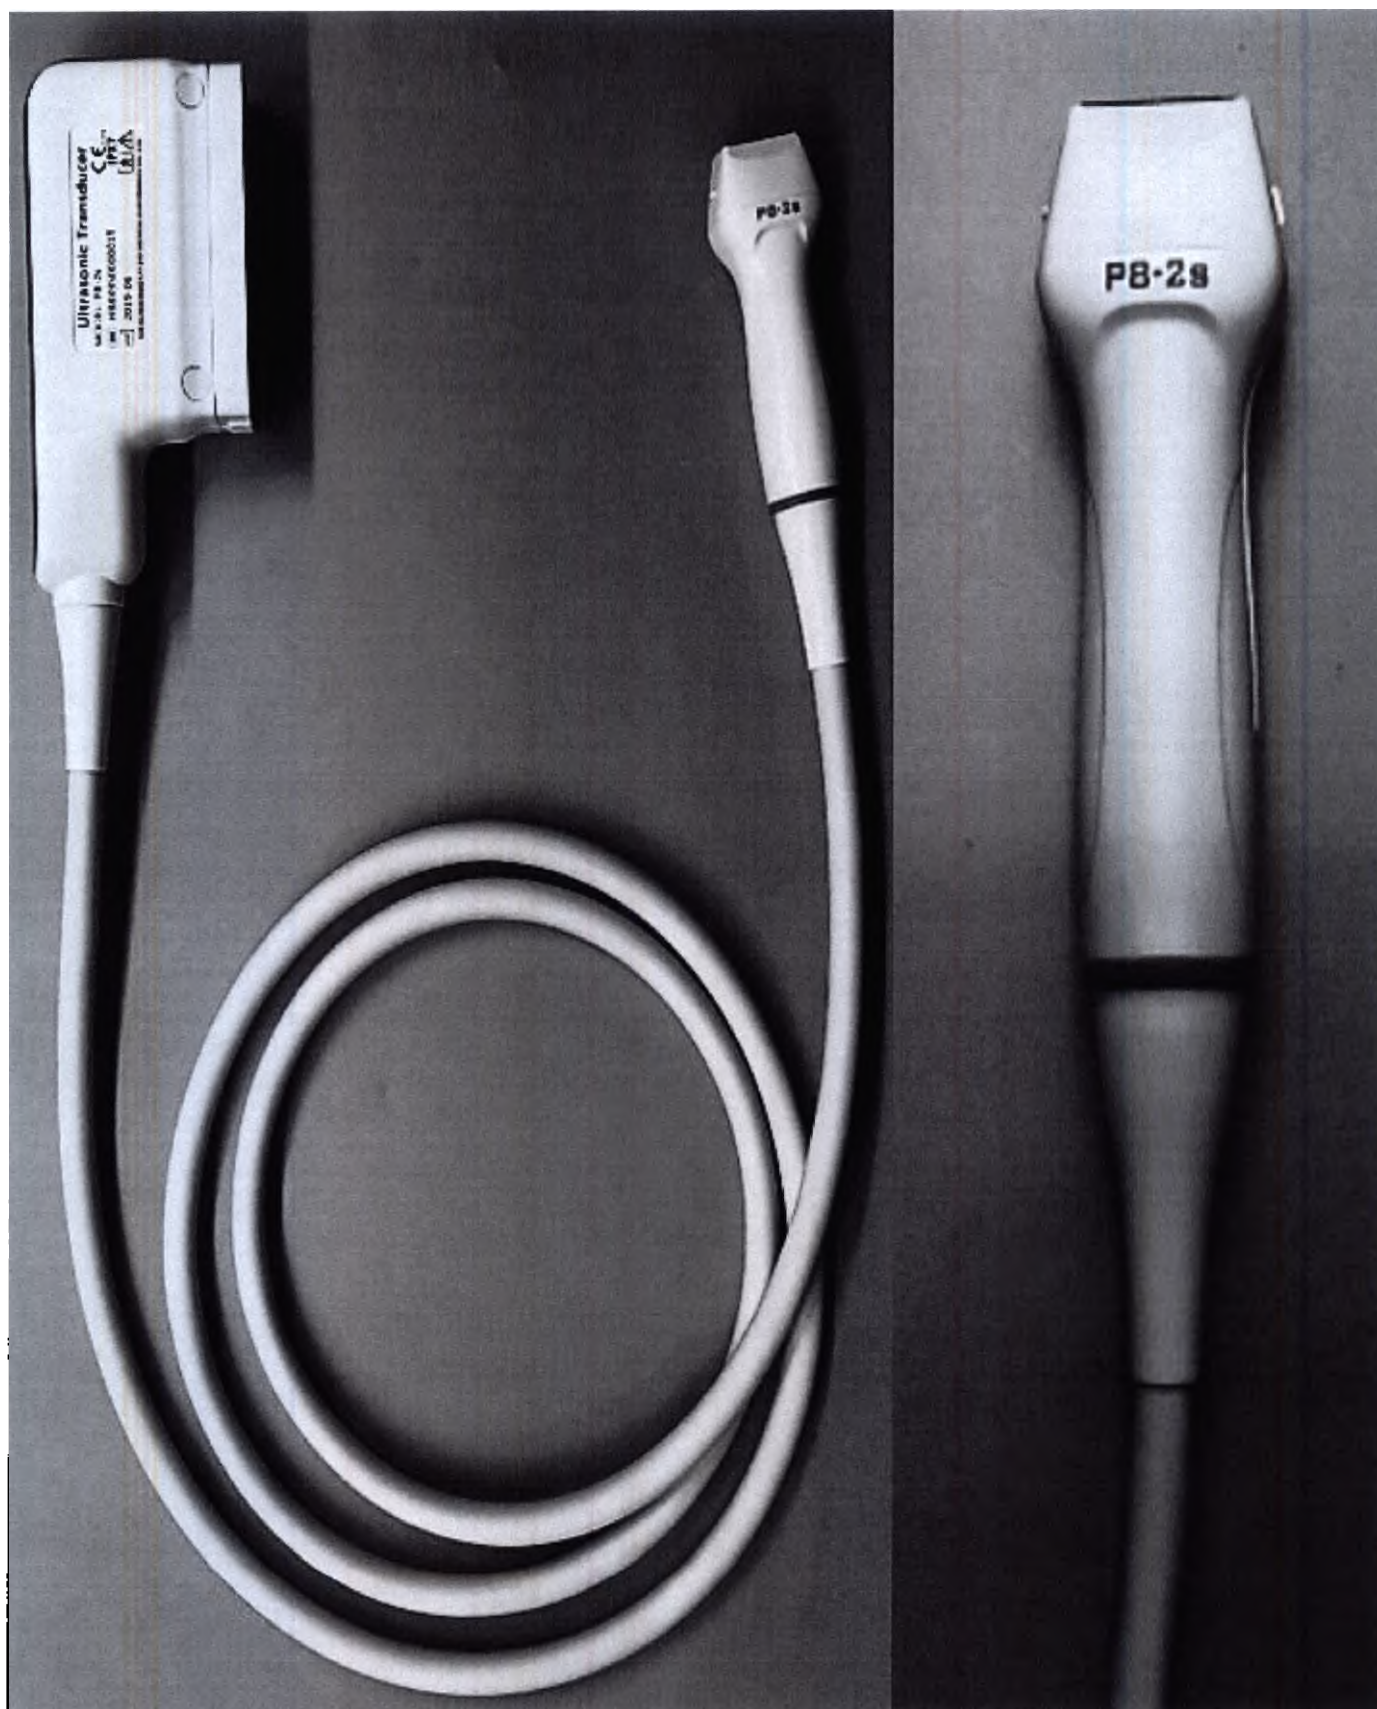


Датчик ультразвуковой секторный фазированный P8-2s




Датчик ультразвуковой конвексный C5-1s

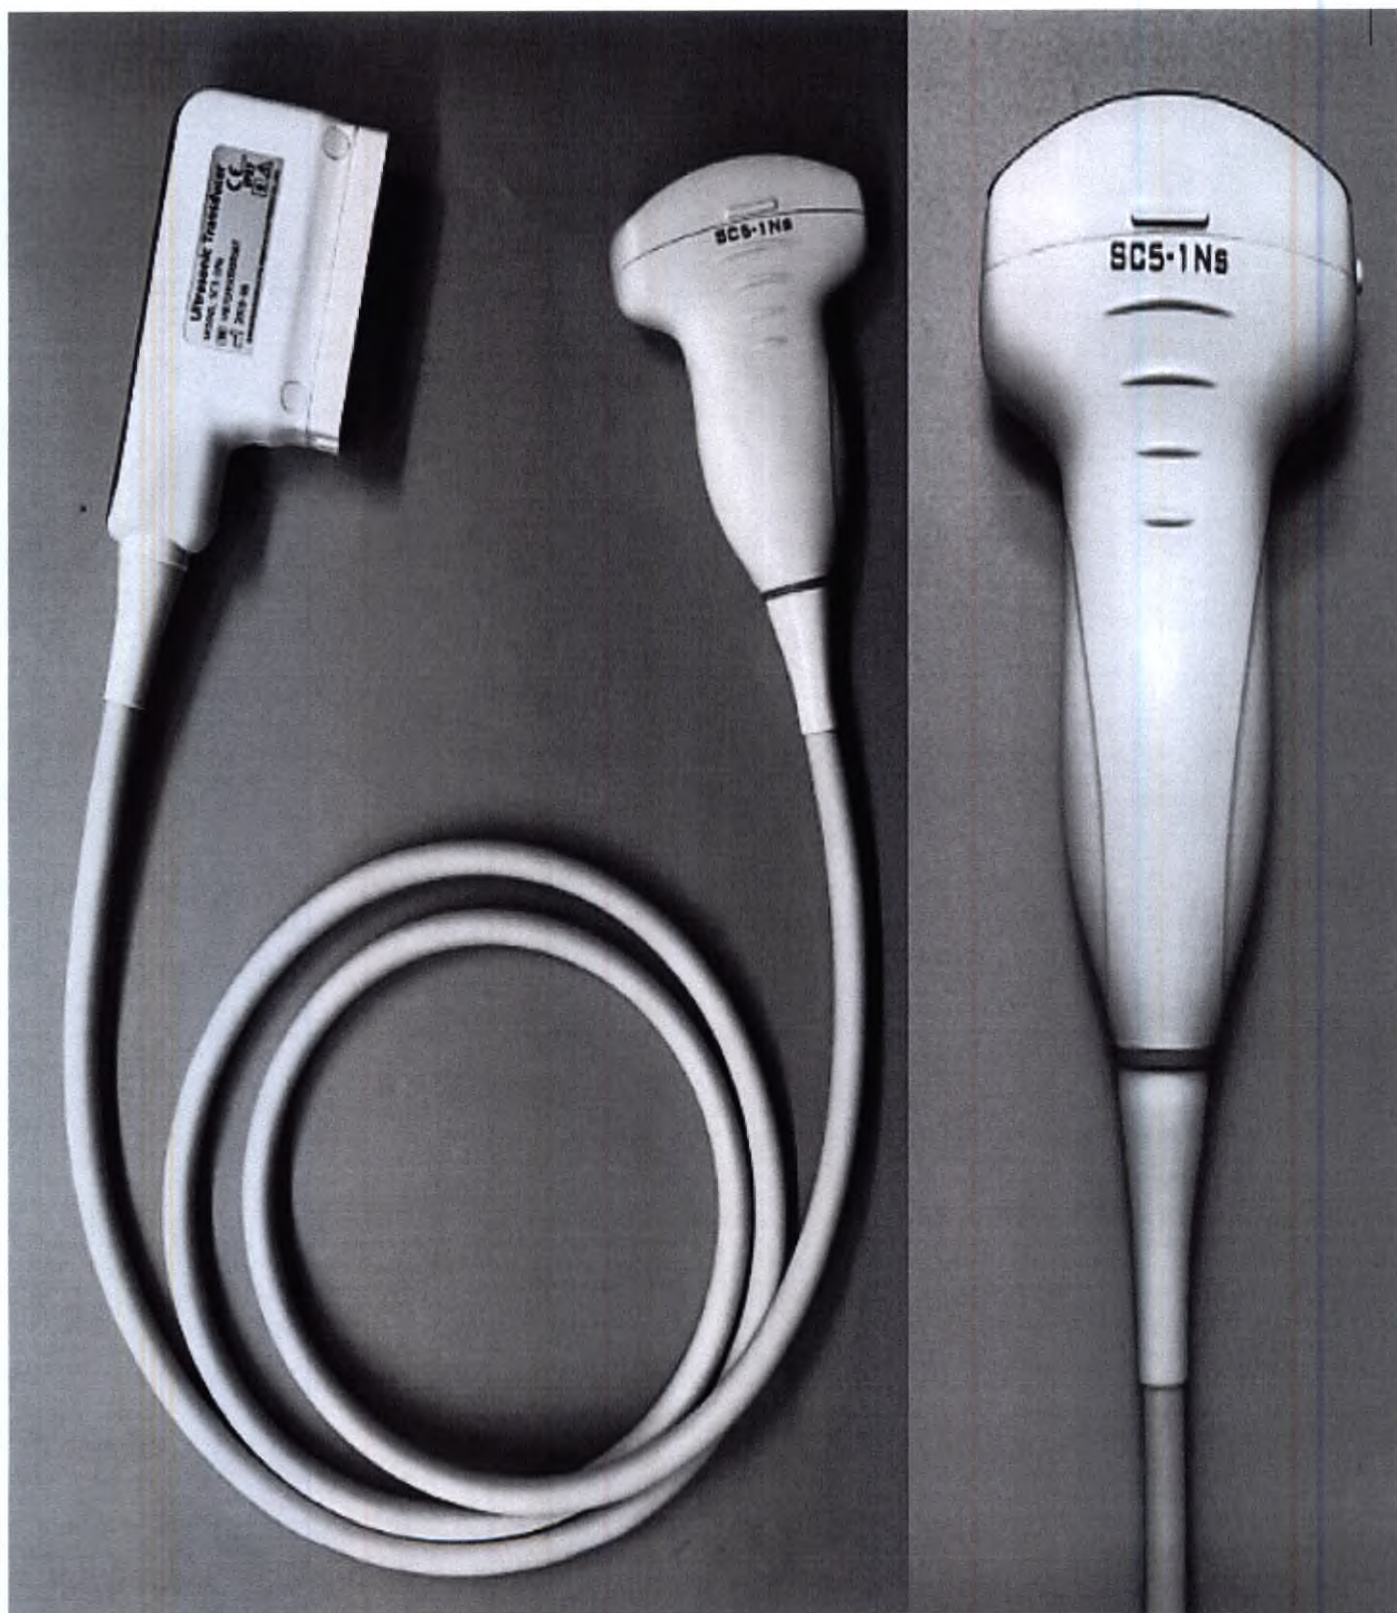

Датчик ультразвуковой секторный фазированный Р10-4s

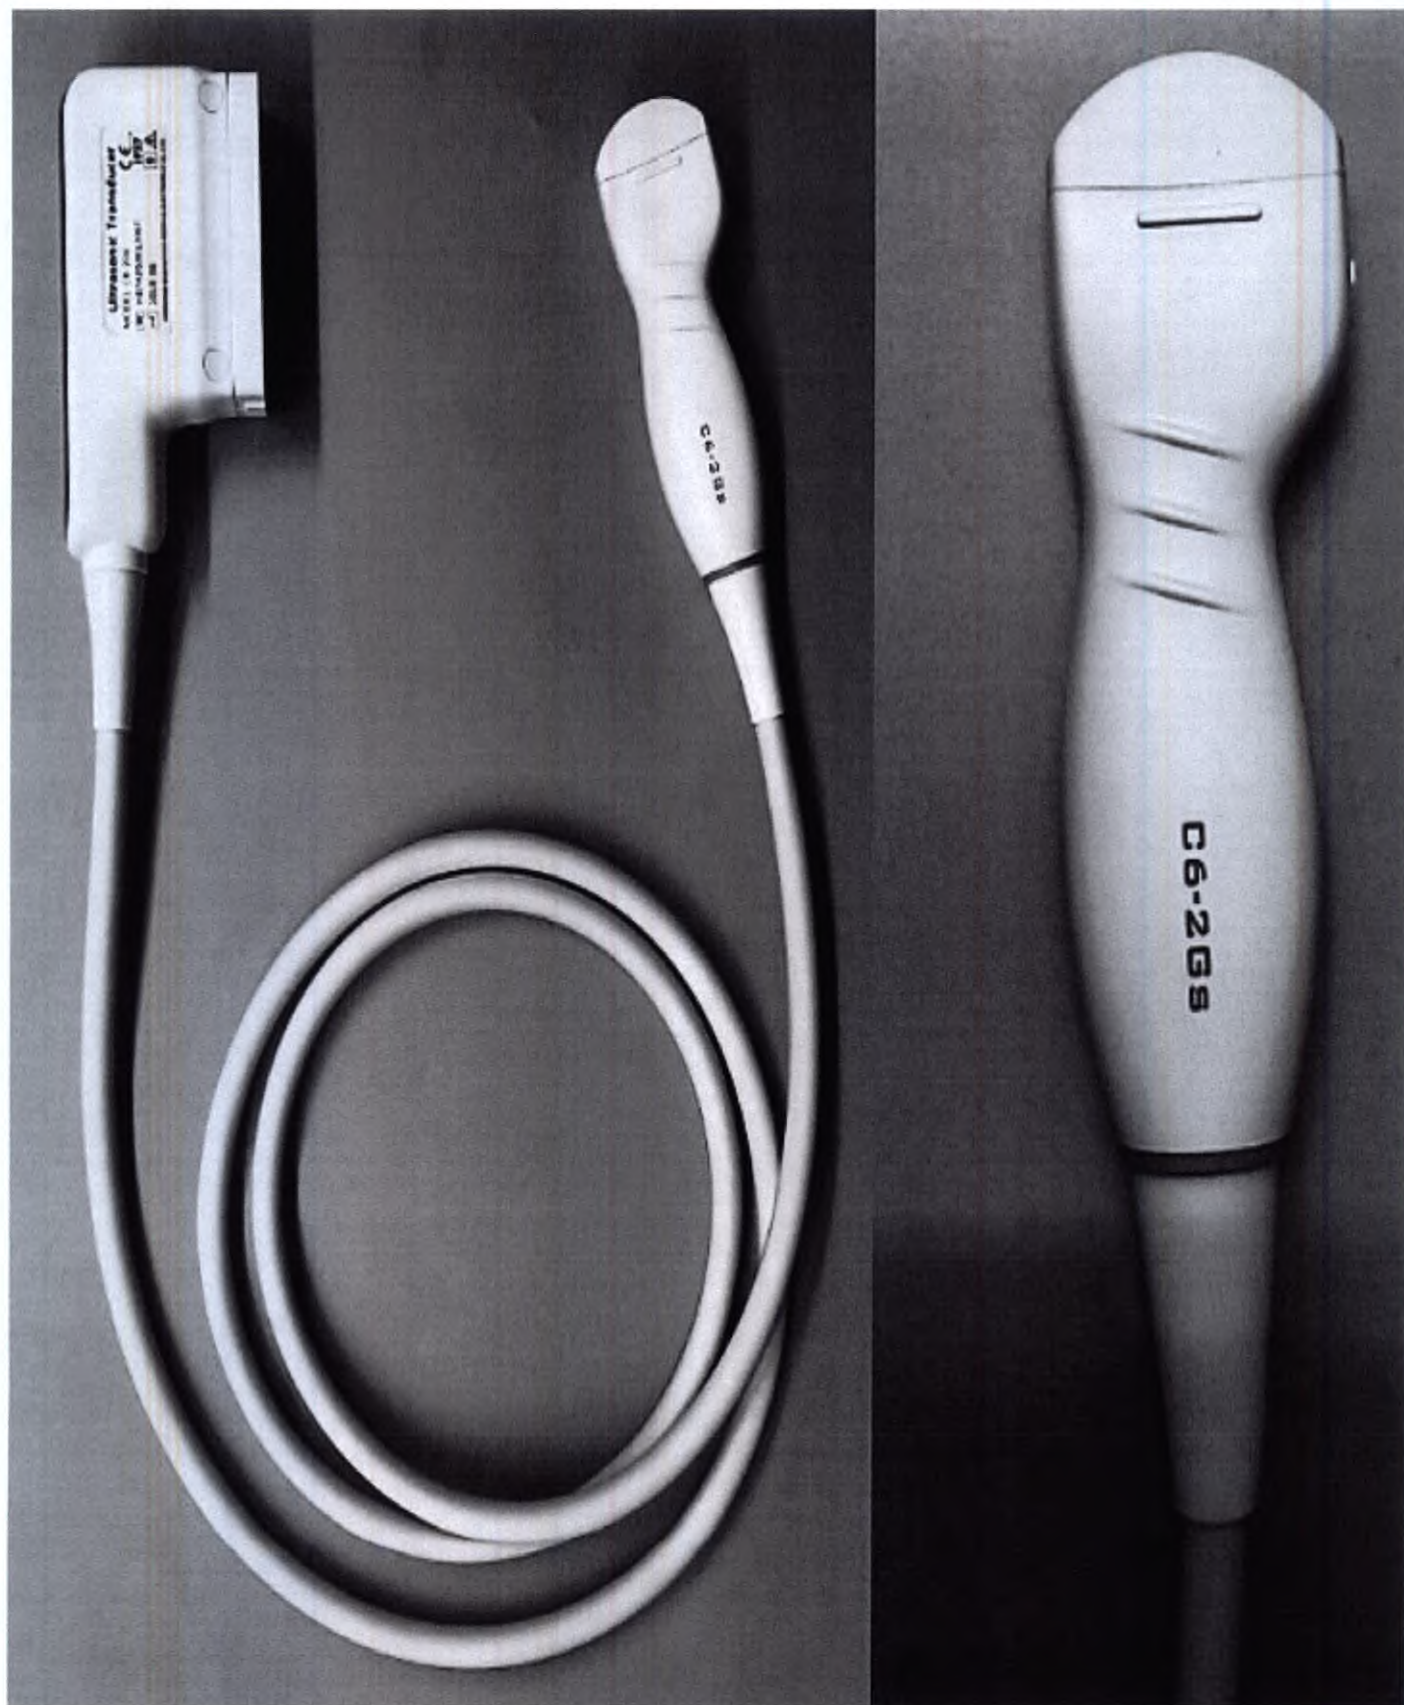


Датчик ультразвуковой конвексный C6-2Gs

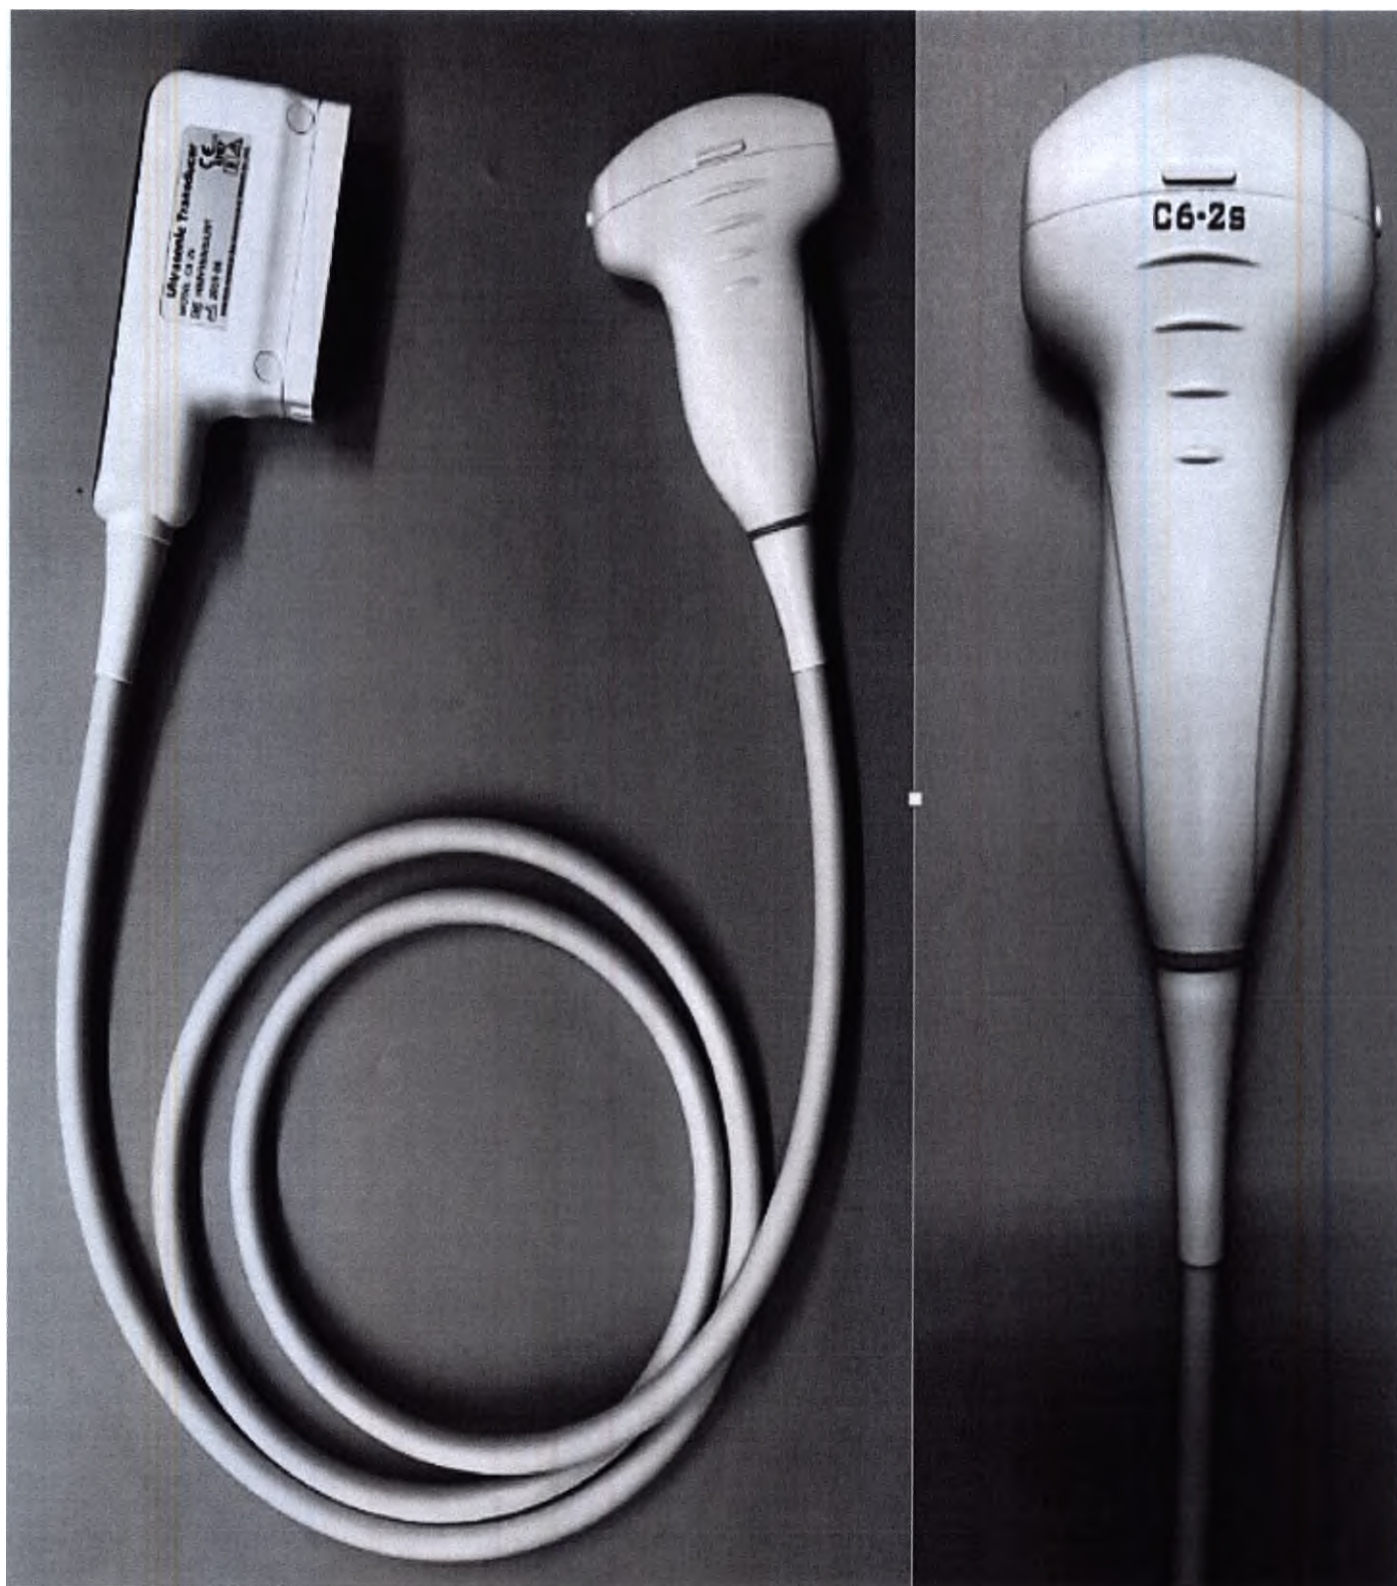


Датчик ультразвуковой конвексный C6-2s




Датчик ультразвуковой конвексный C4-1s

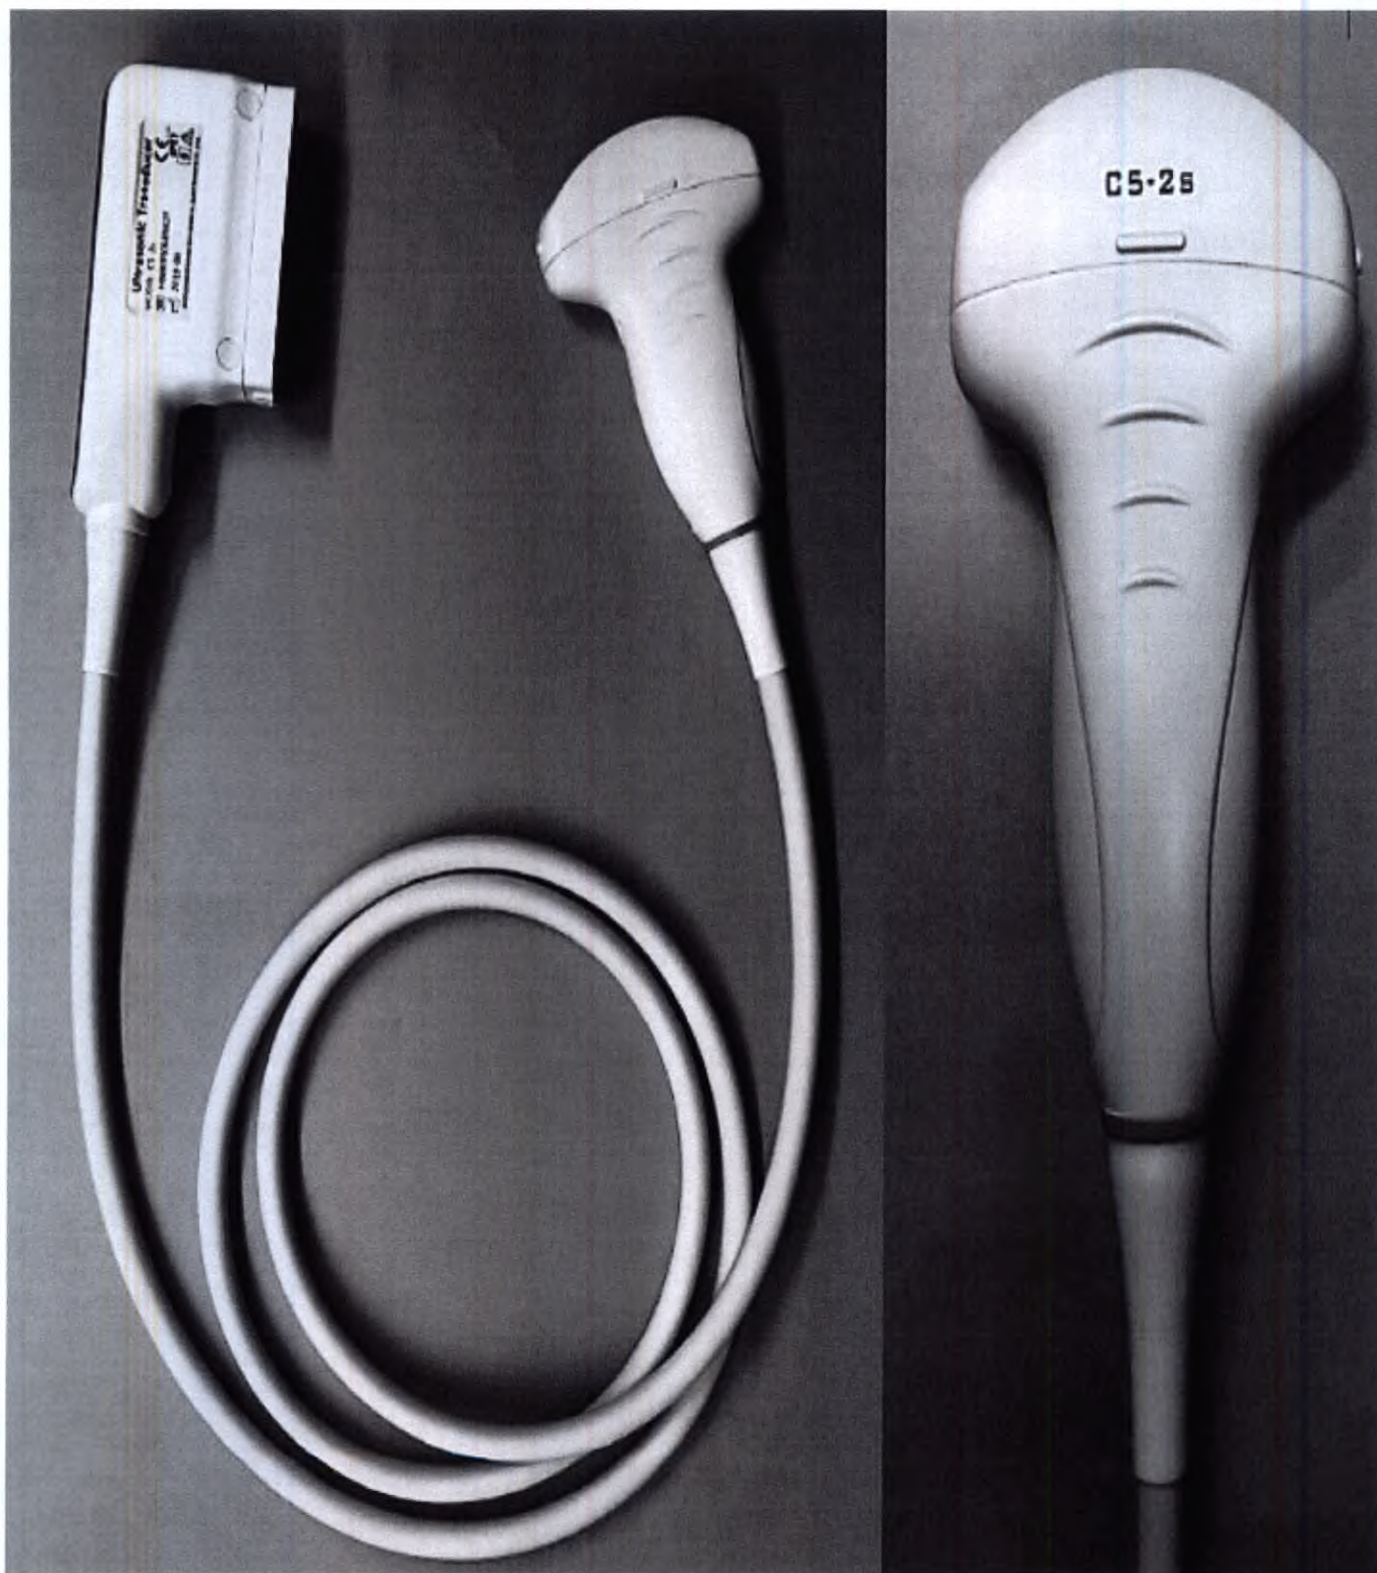


Датчик ультразвуковой конвексный С5-2s

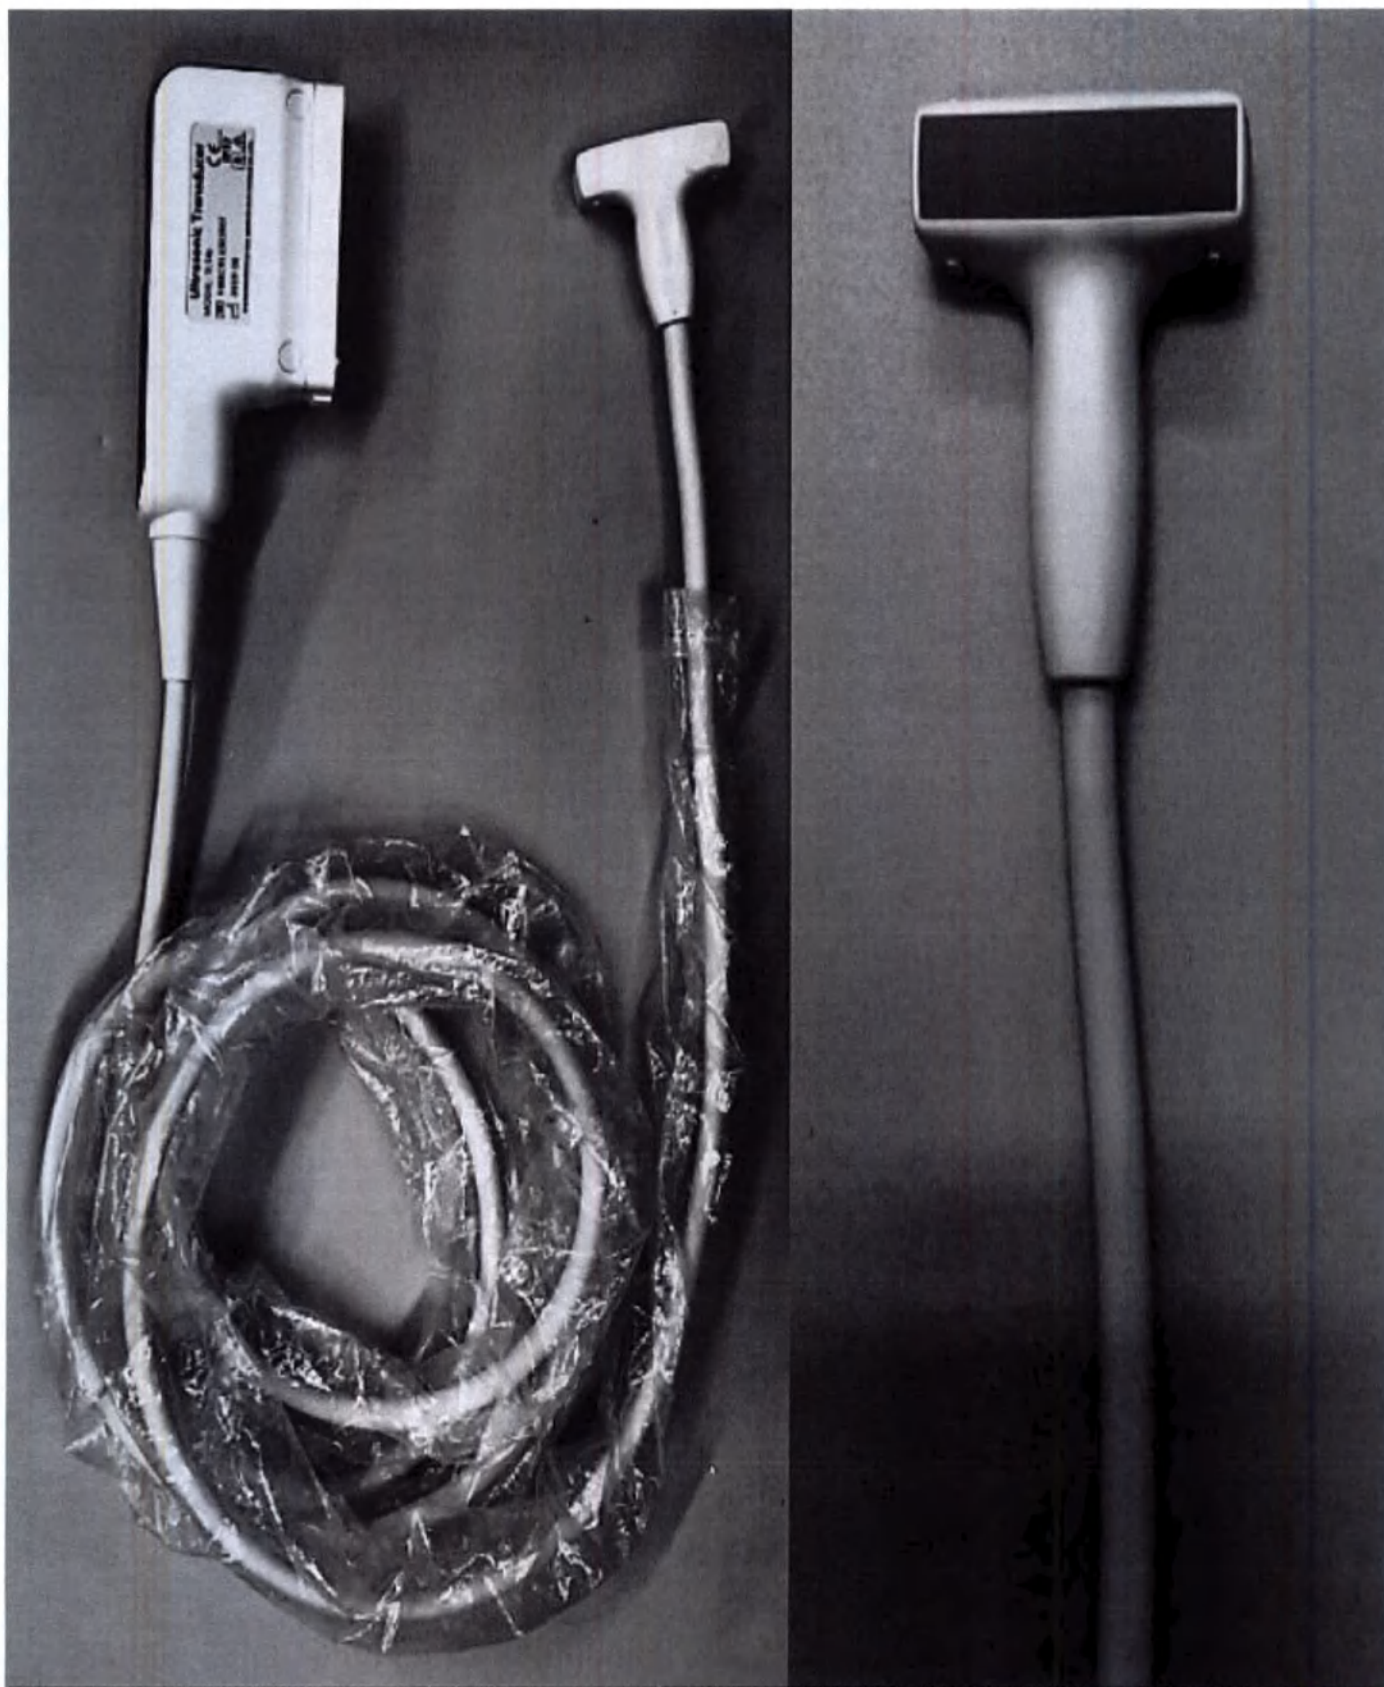

Датчик ультразвуковой интраоперационный 7LT4s

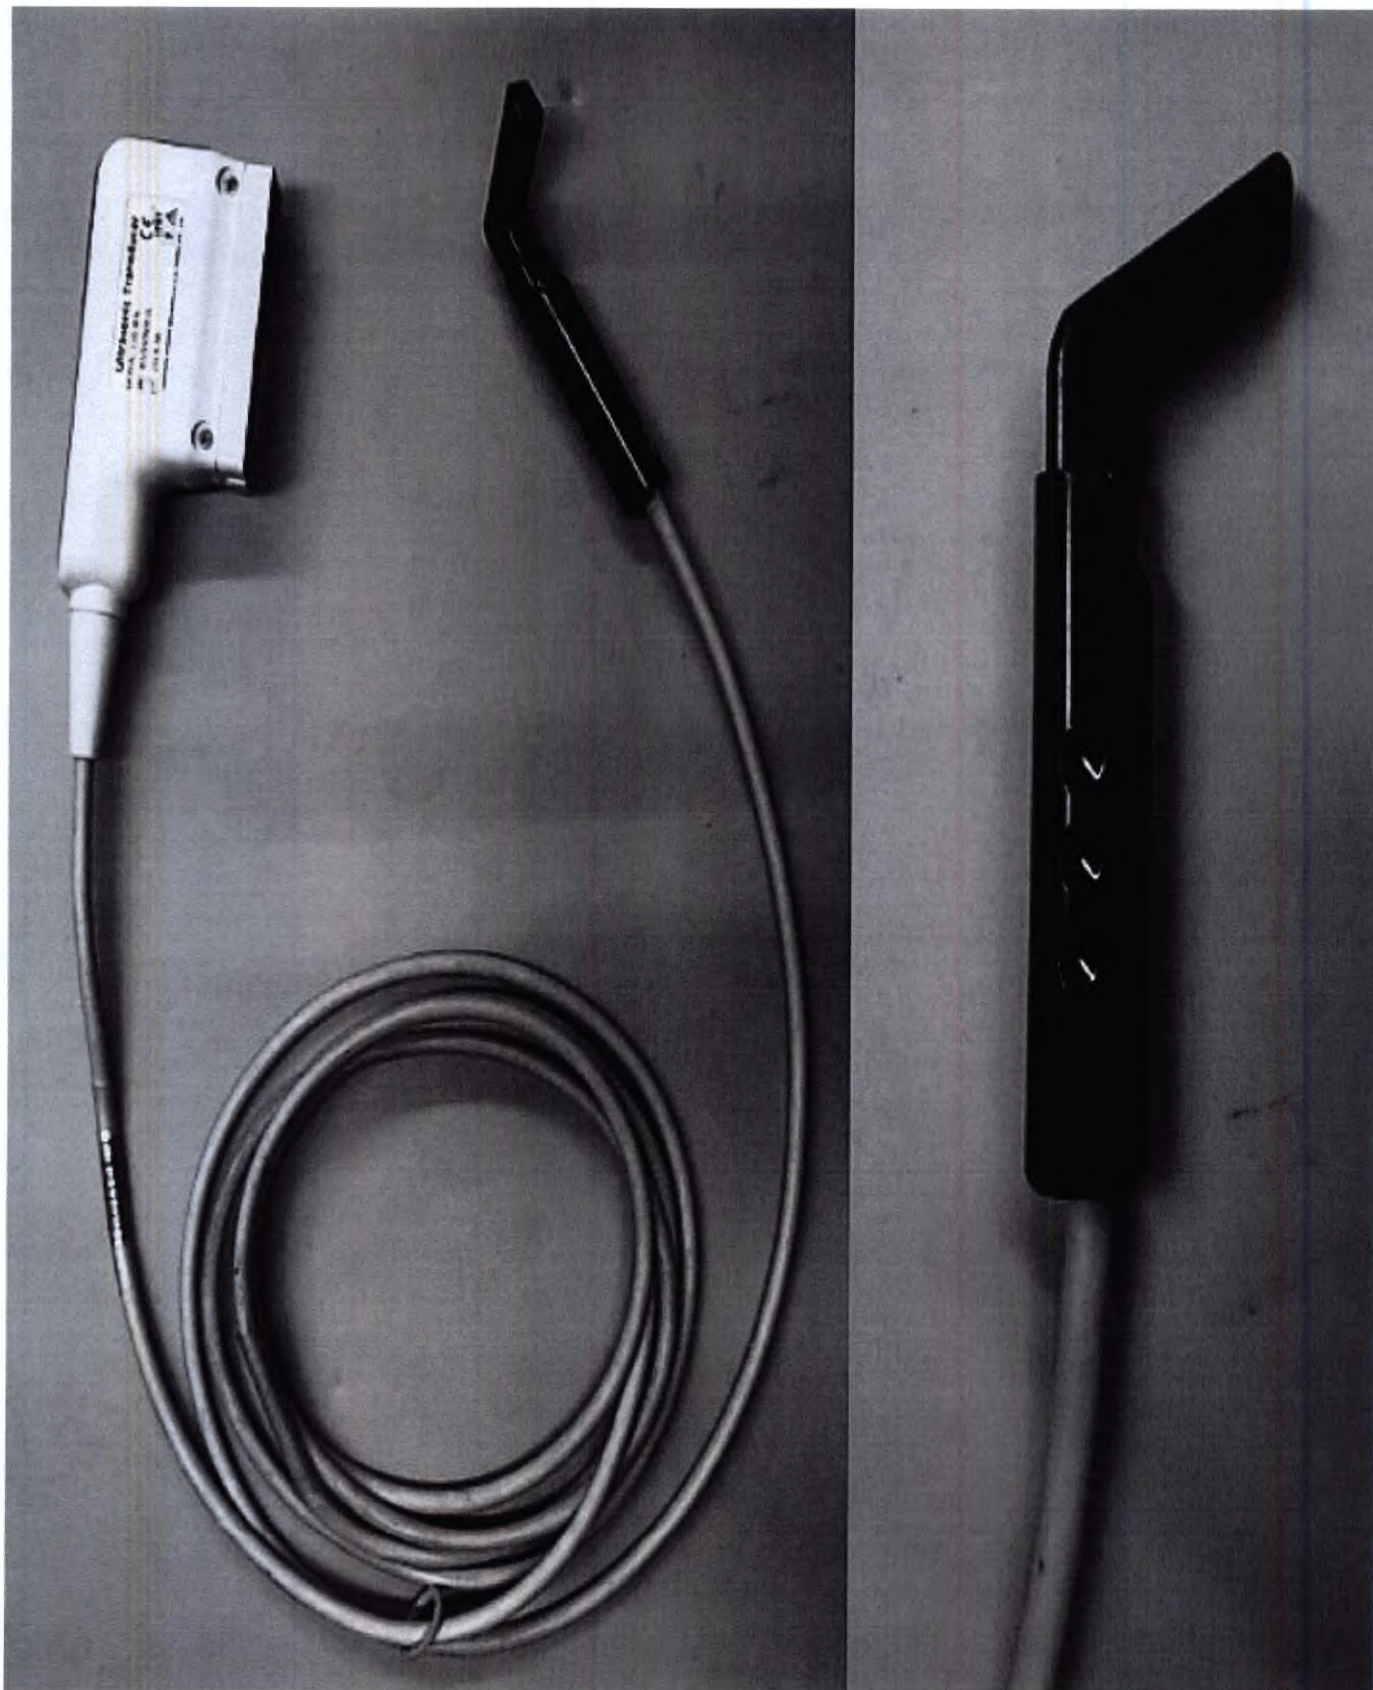

Датчик ультразвуковой интраоперационный L16-4Hs

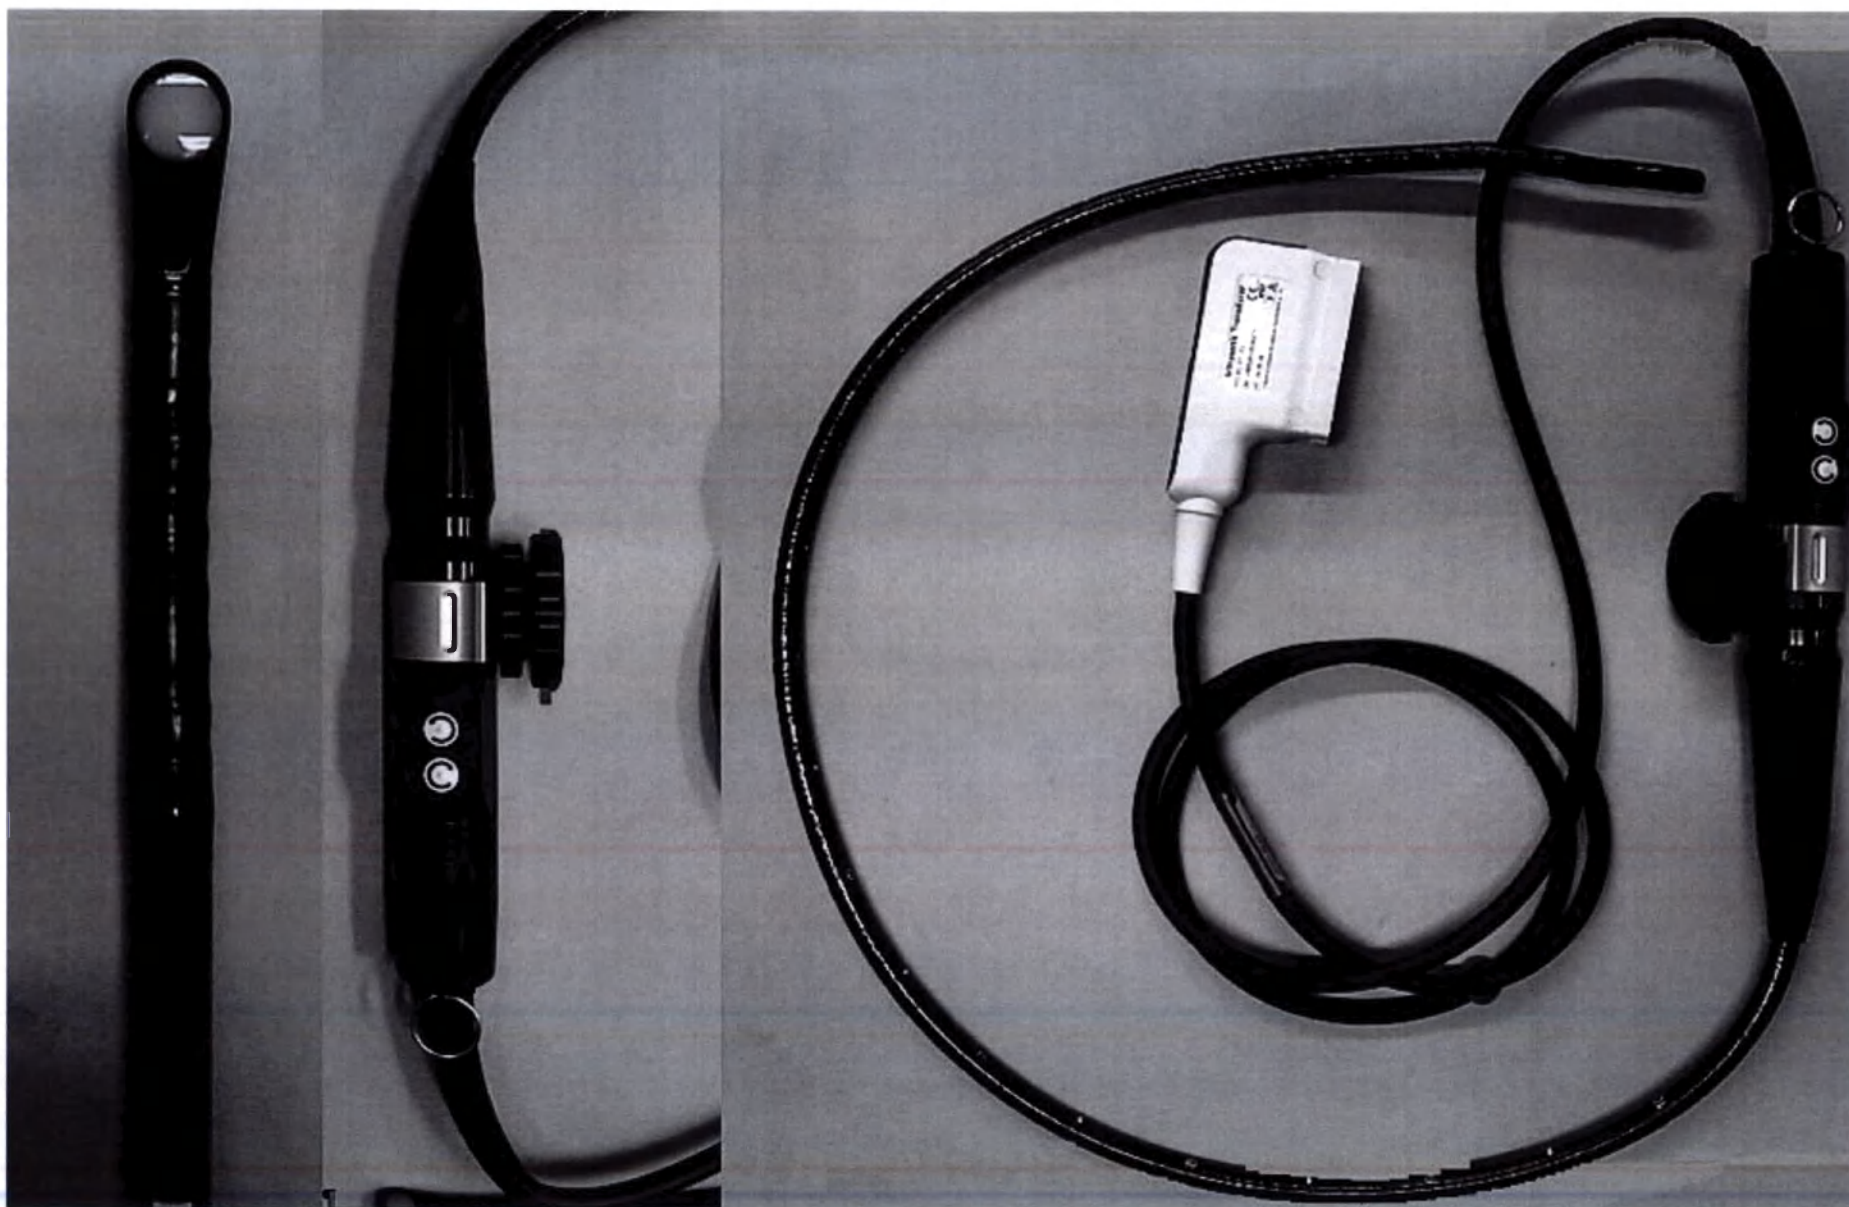

Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный Р7-3Тс



Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный Р7-3Ts в кейсе для транспортировки



Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный P8-3Ts




Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный Р8-3Ts в кейсе для транспортировки

Насадки биопсийные:


Вид 1

Вид 2


Насадка биопсийная металлическая, с несъемной направляющей для игл NGB-004

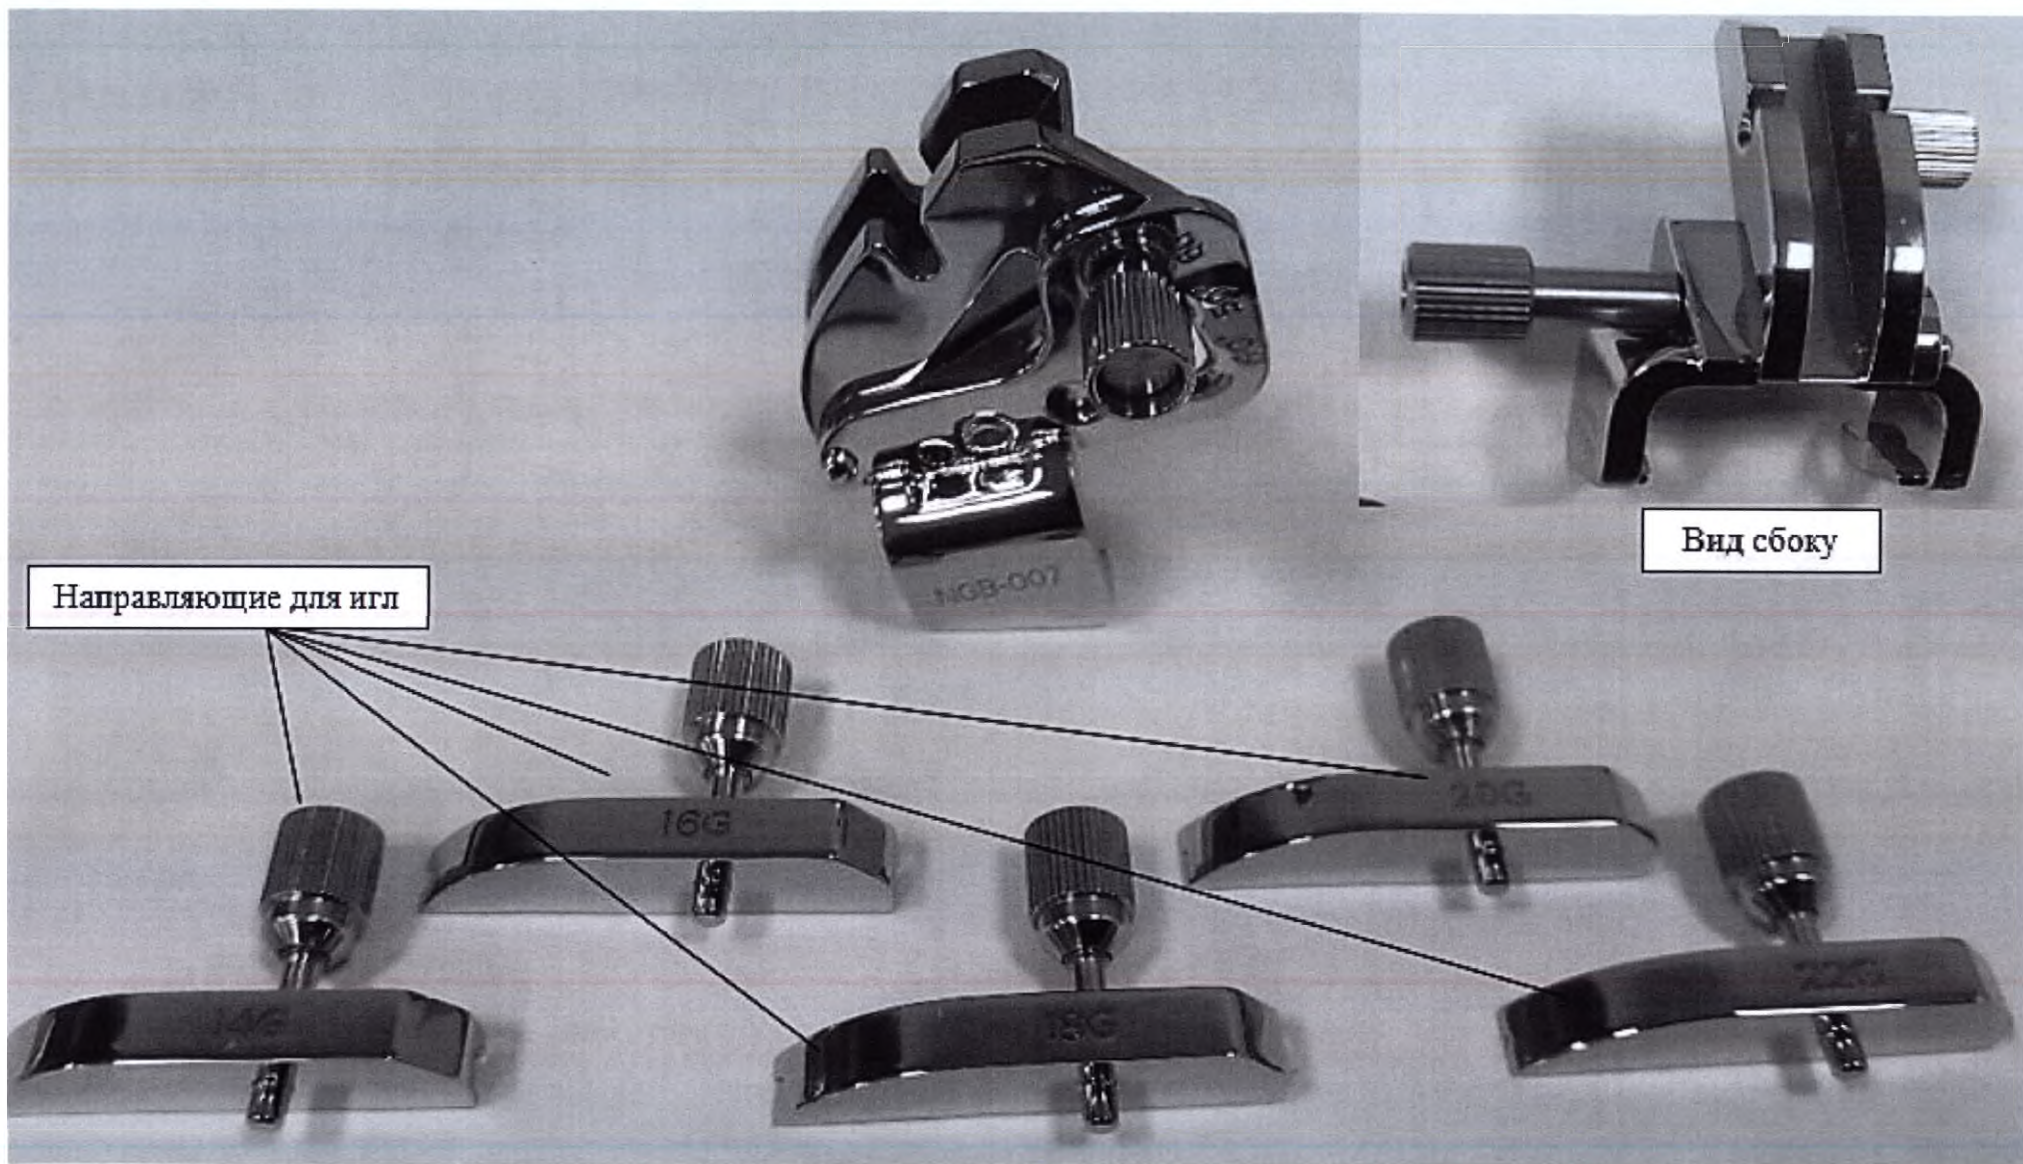

Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-007

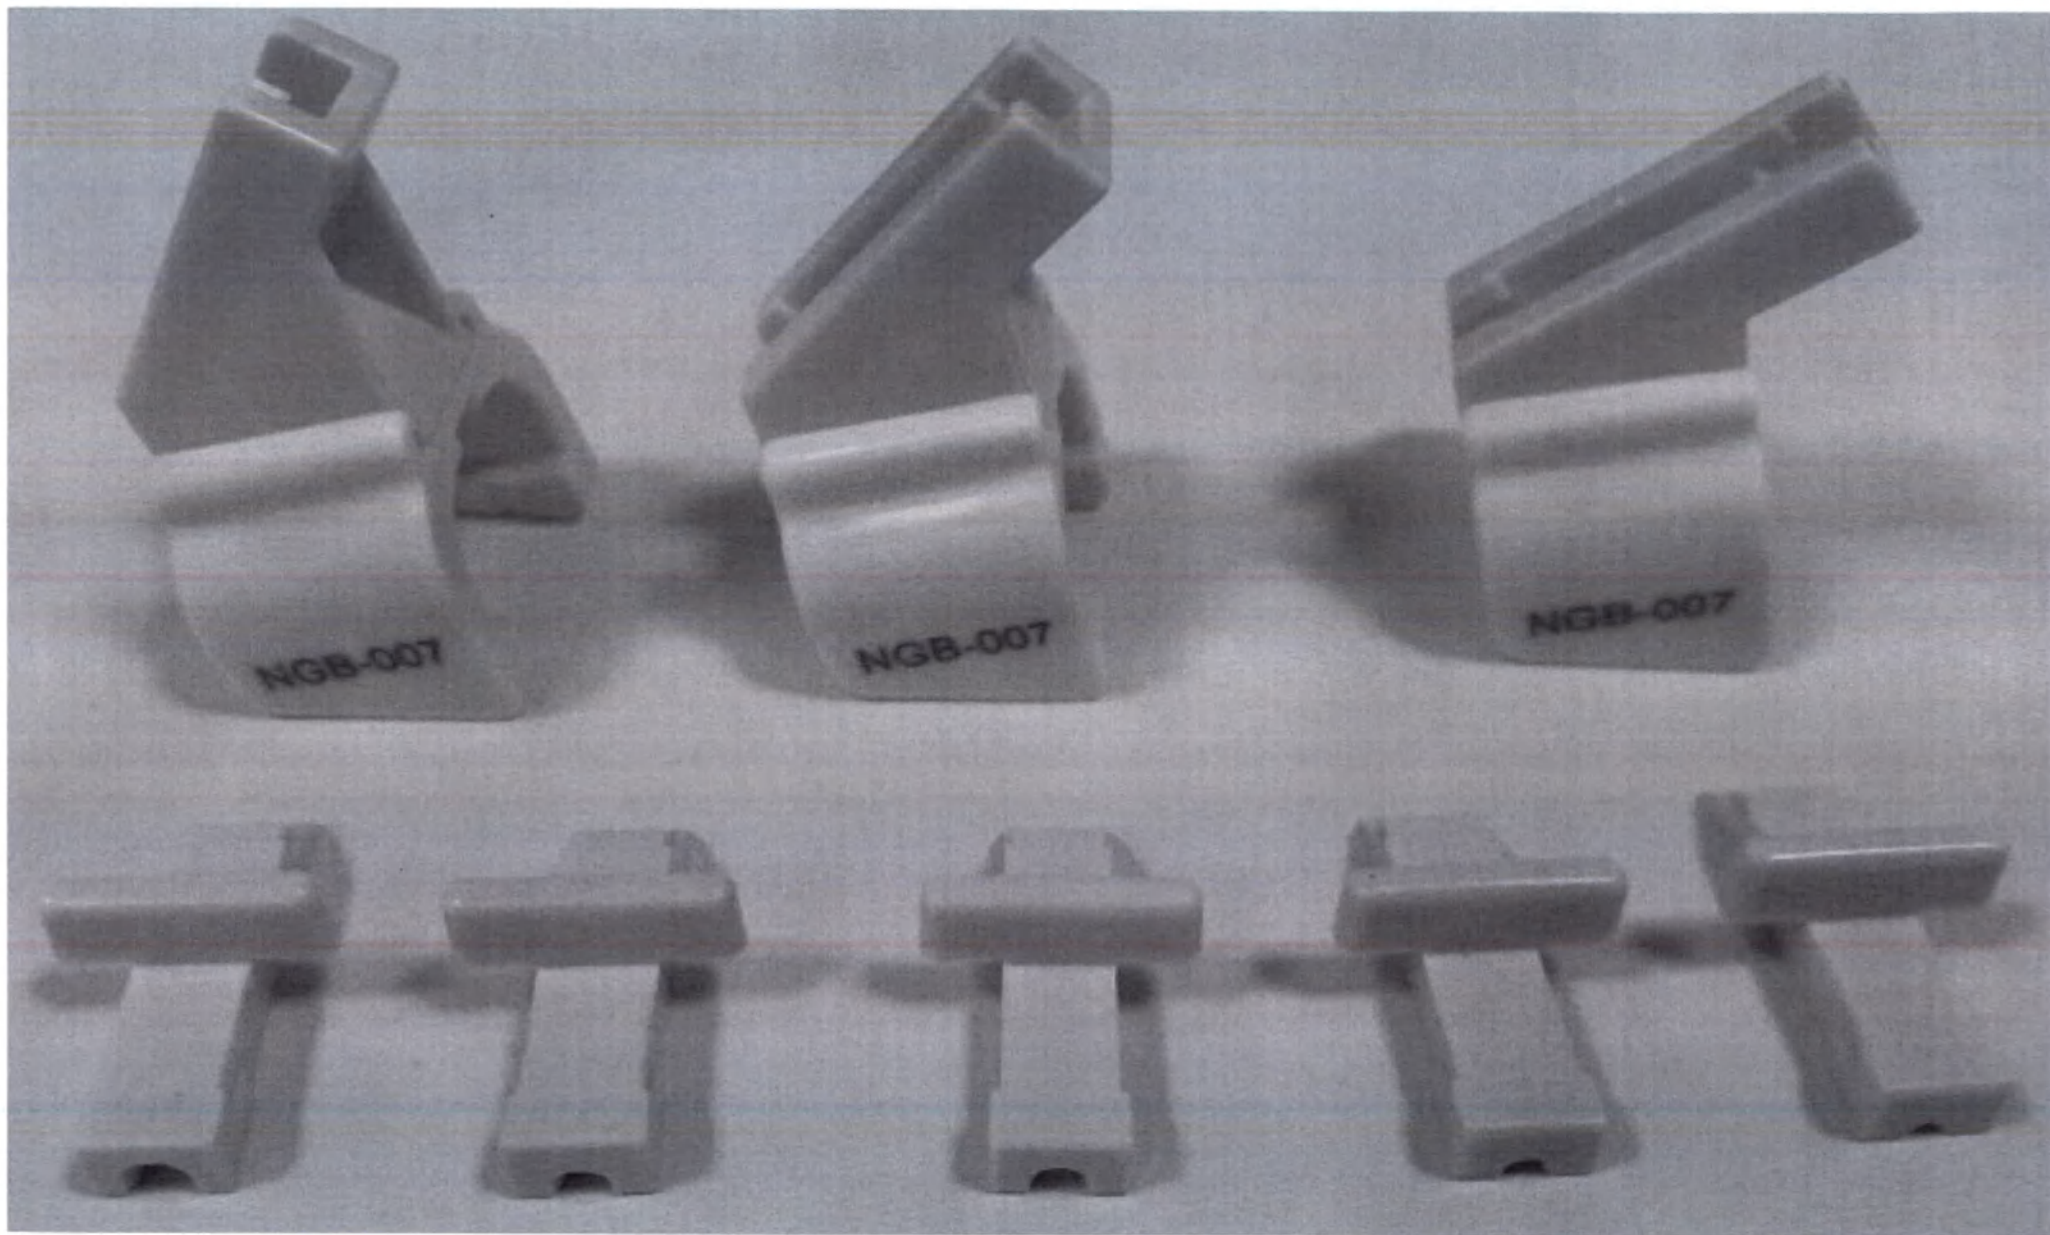


Насадка биопсийная пластиковая, со съемной направляющей для игл NGB-007

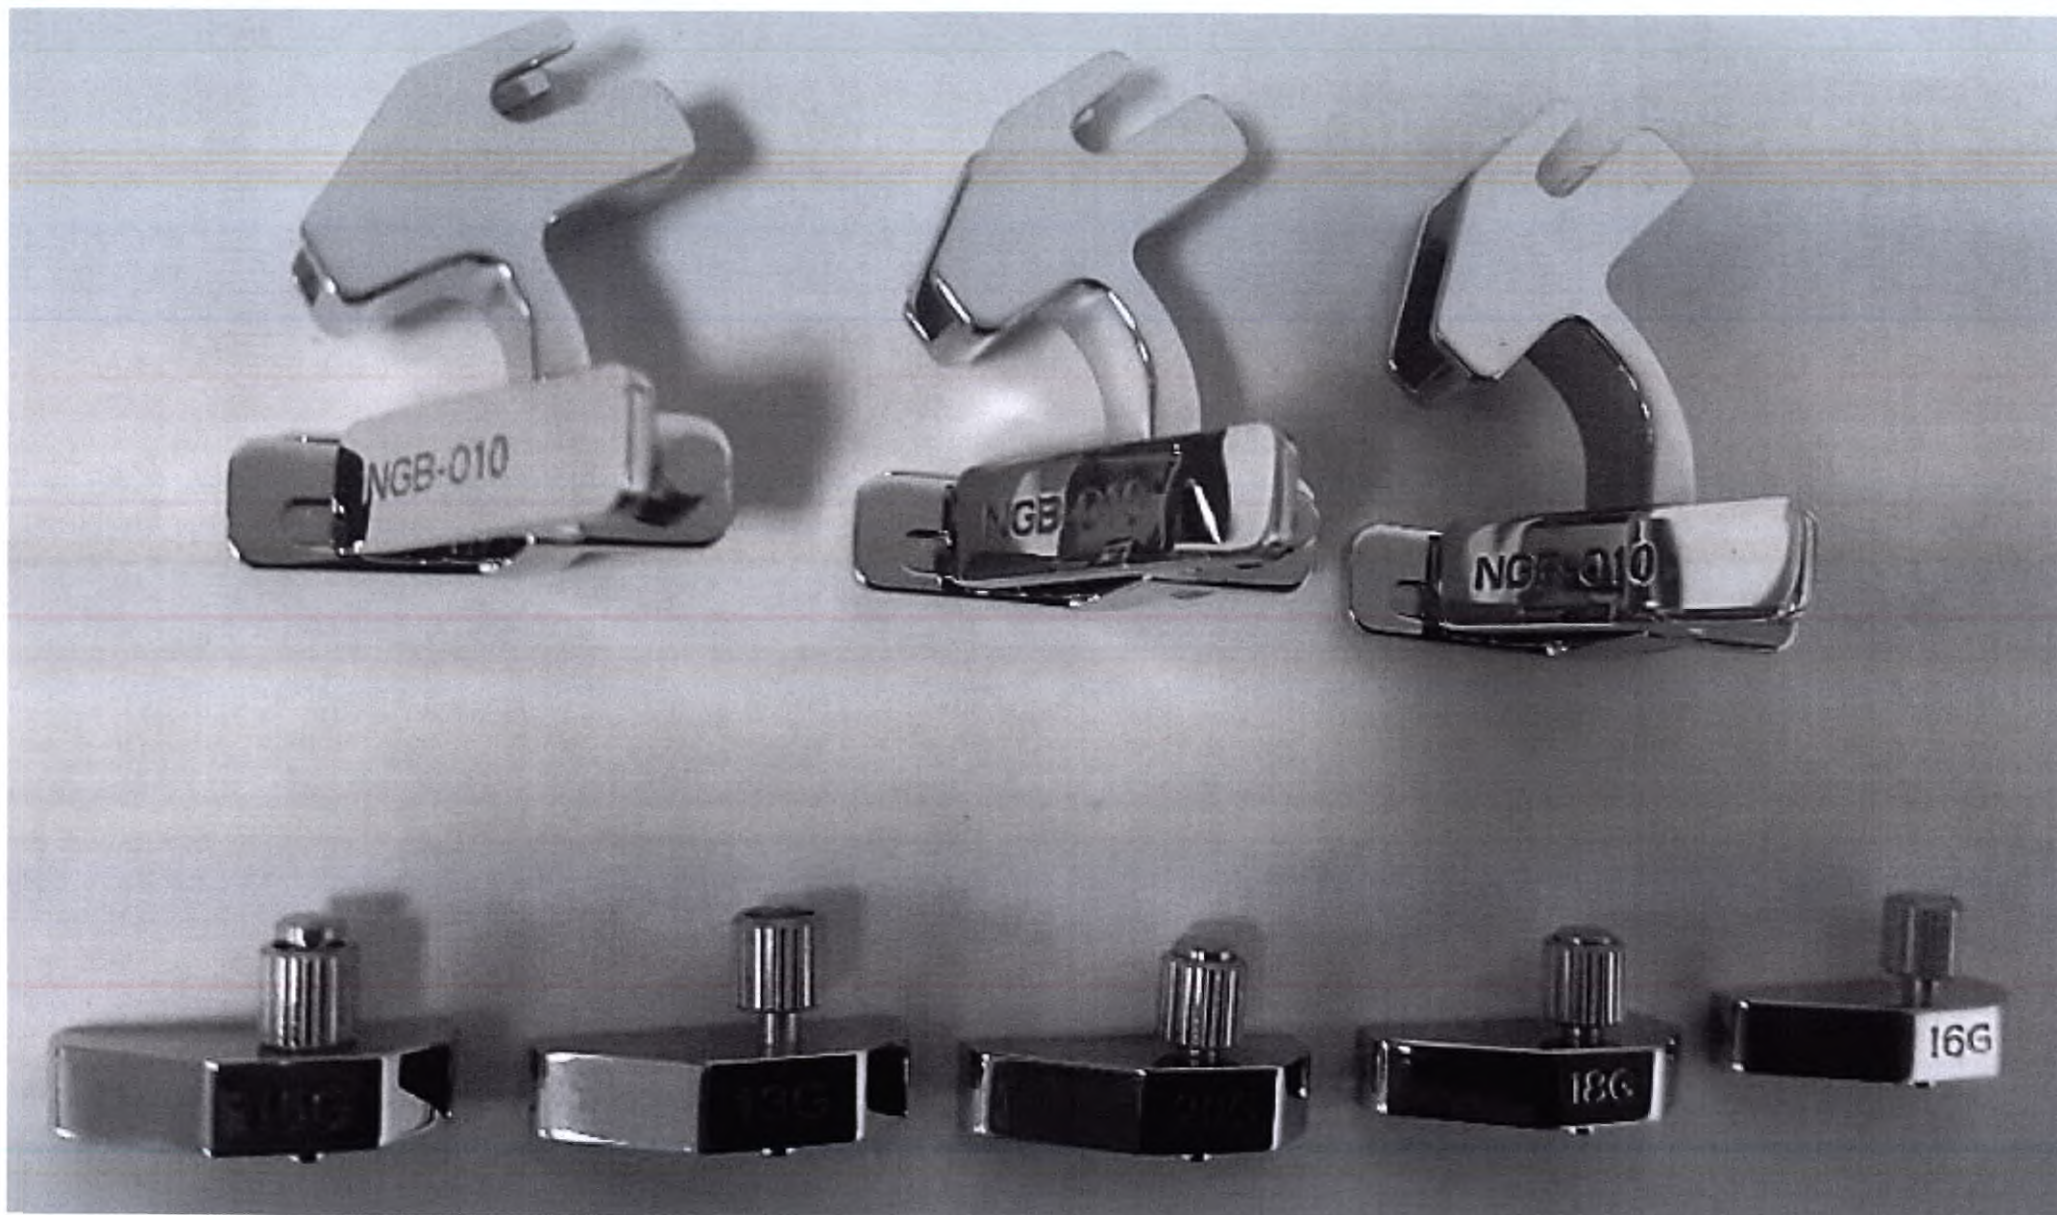


Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-010



Насадка биопсийная металлическая, с несъемной направляющей для игл NGB-011

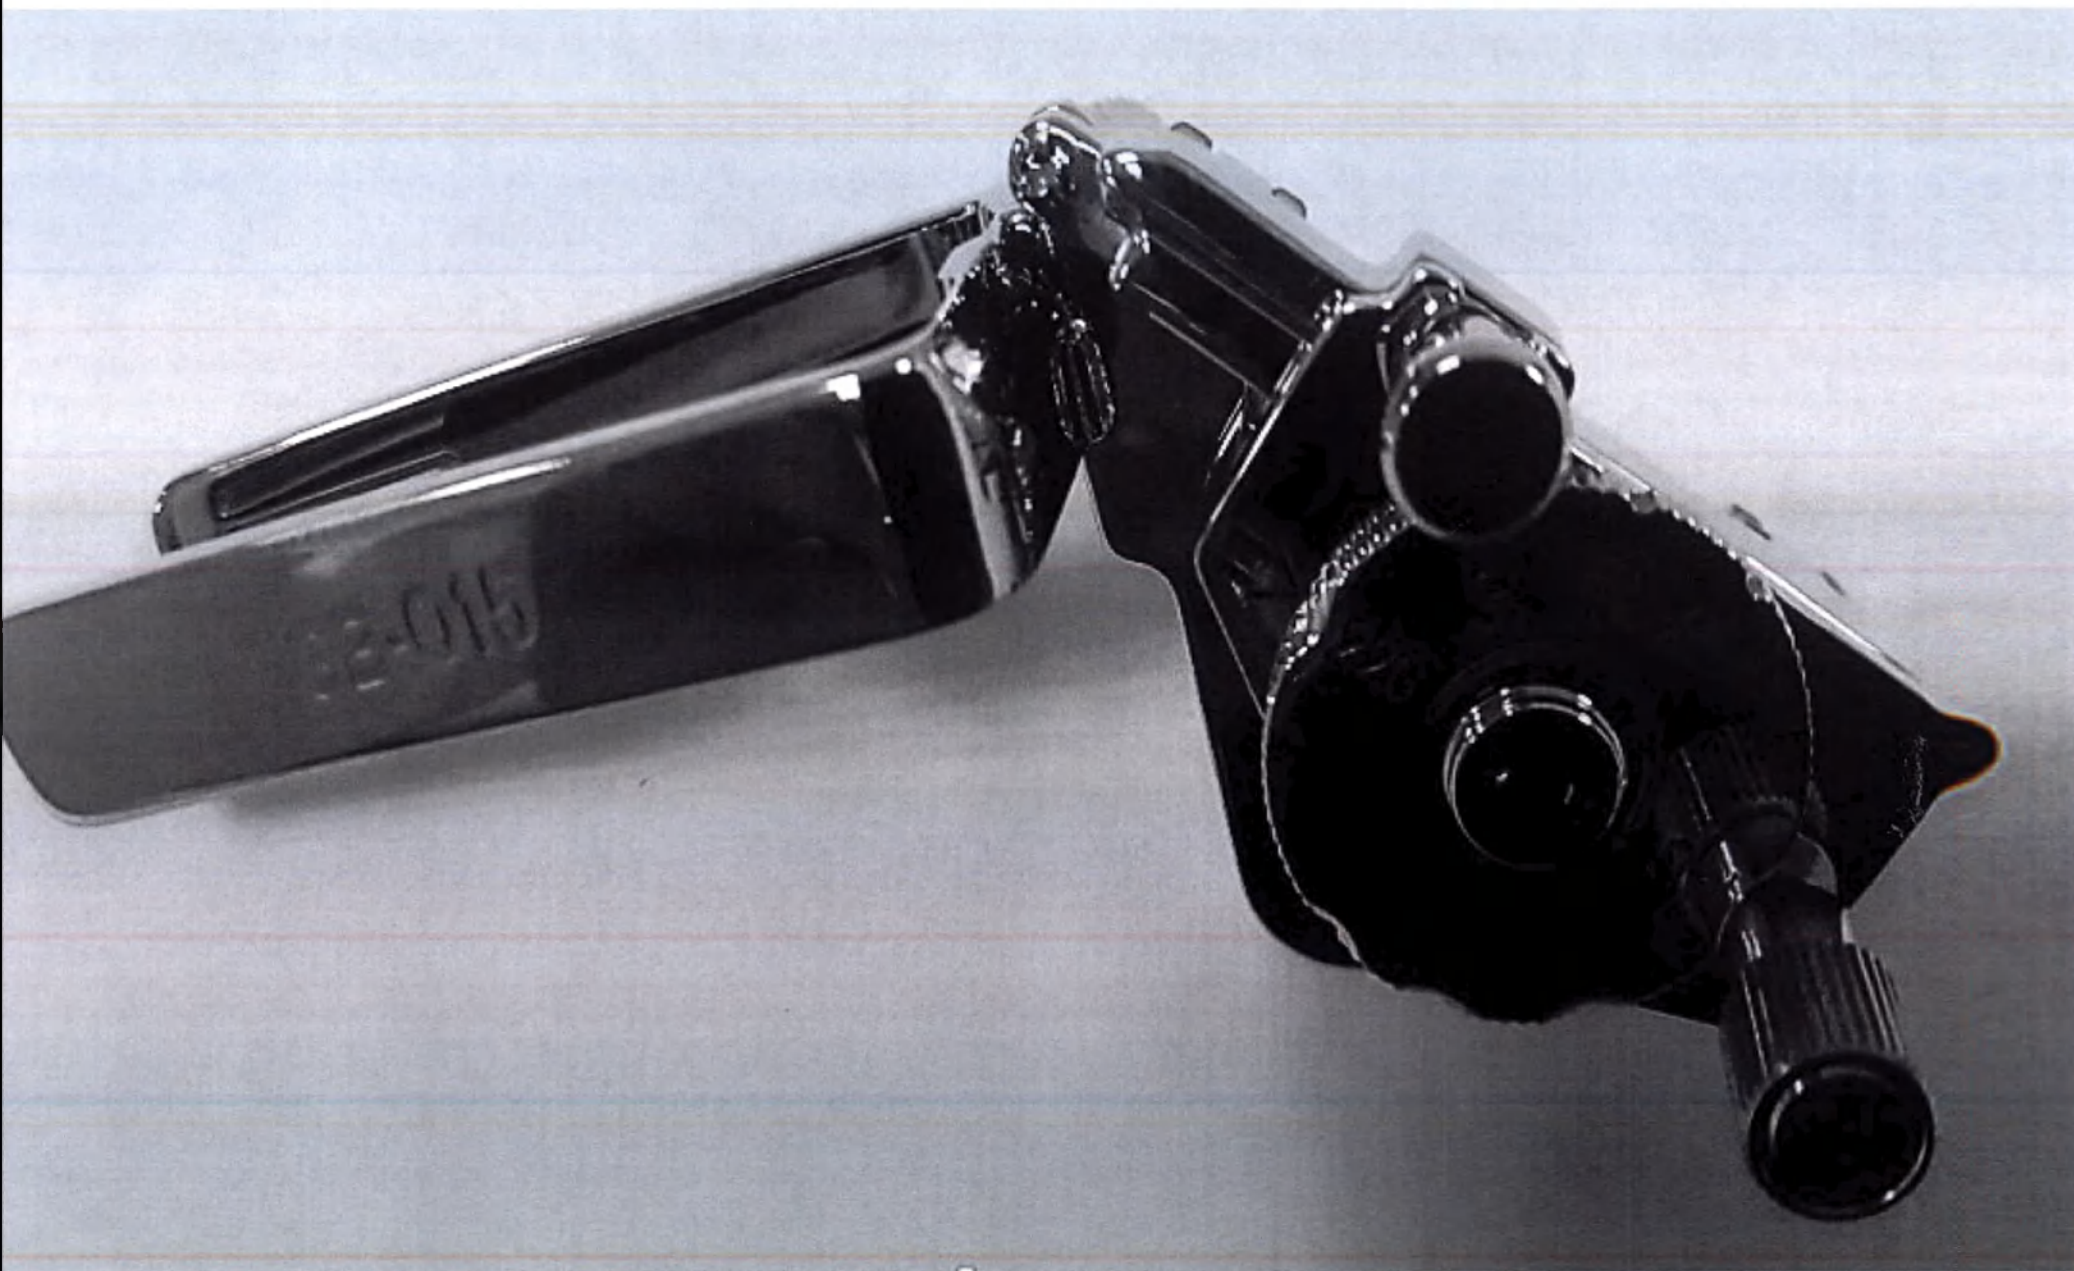


Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-015

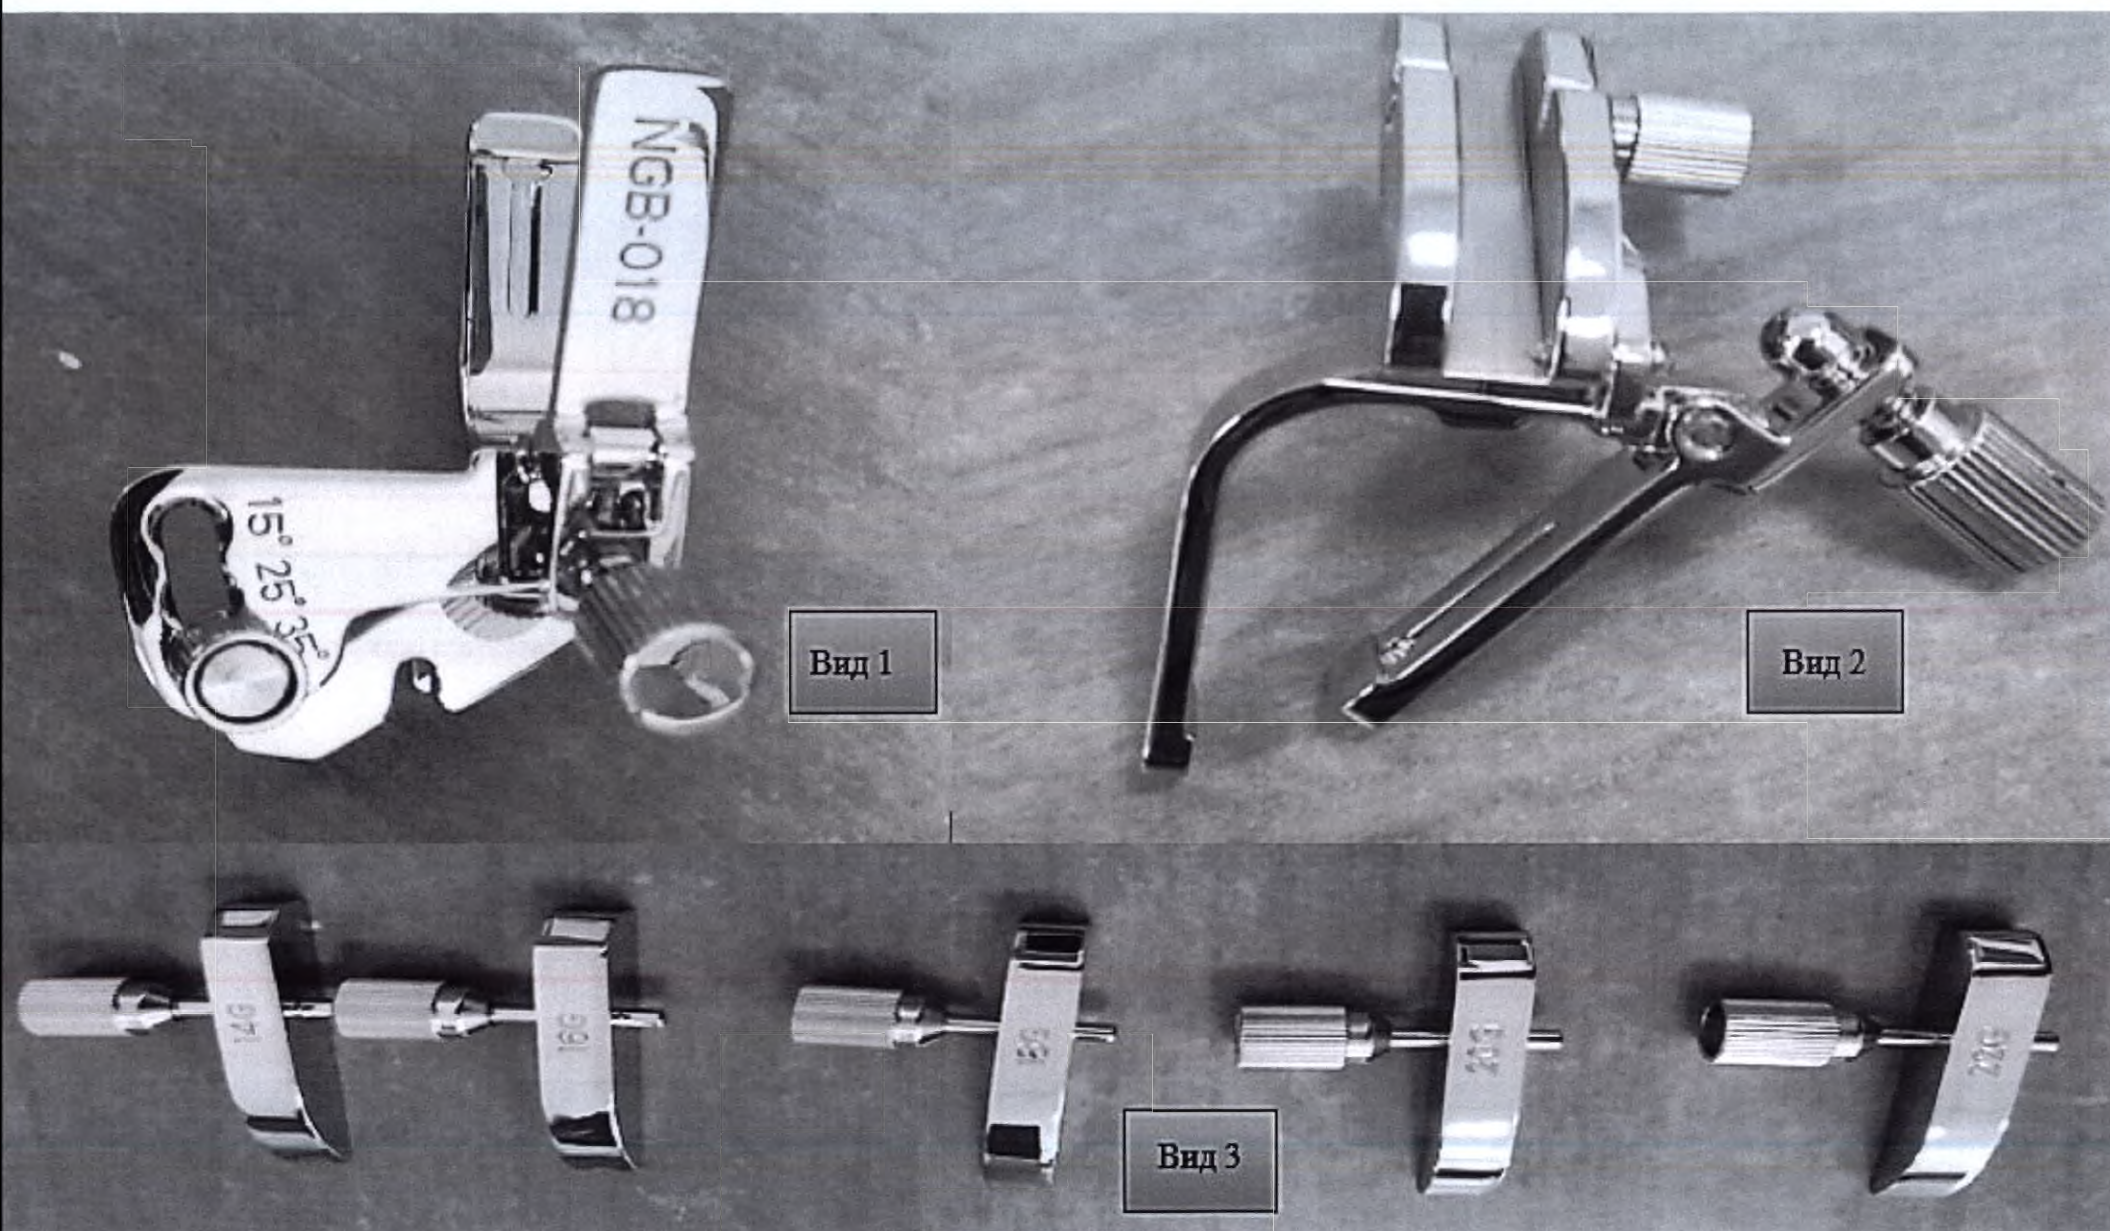

Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-018




Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-022

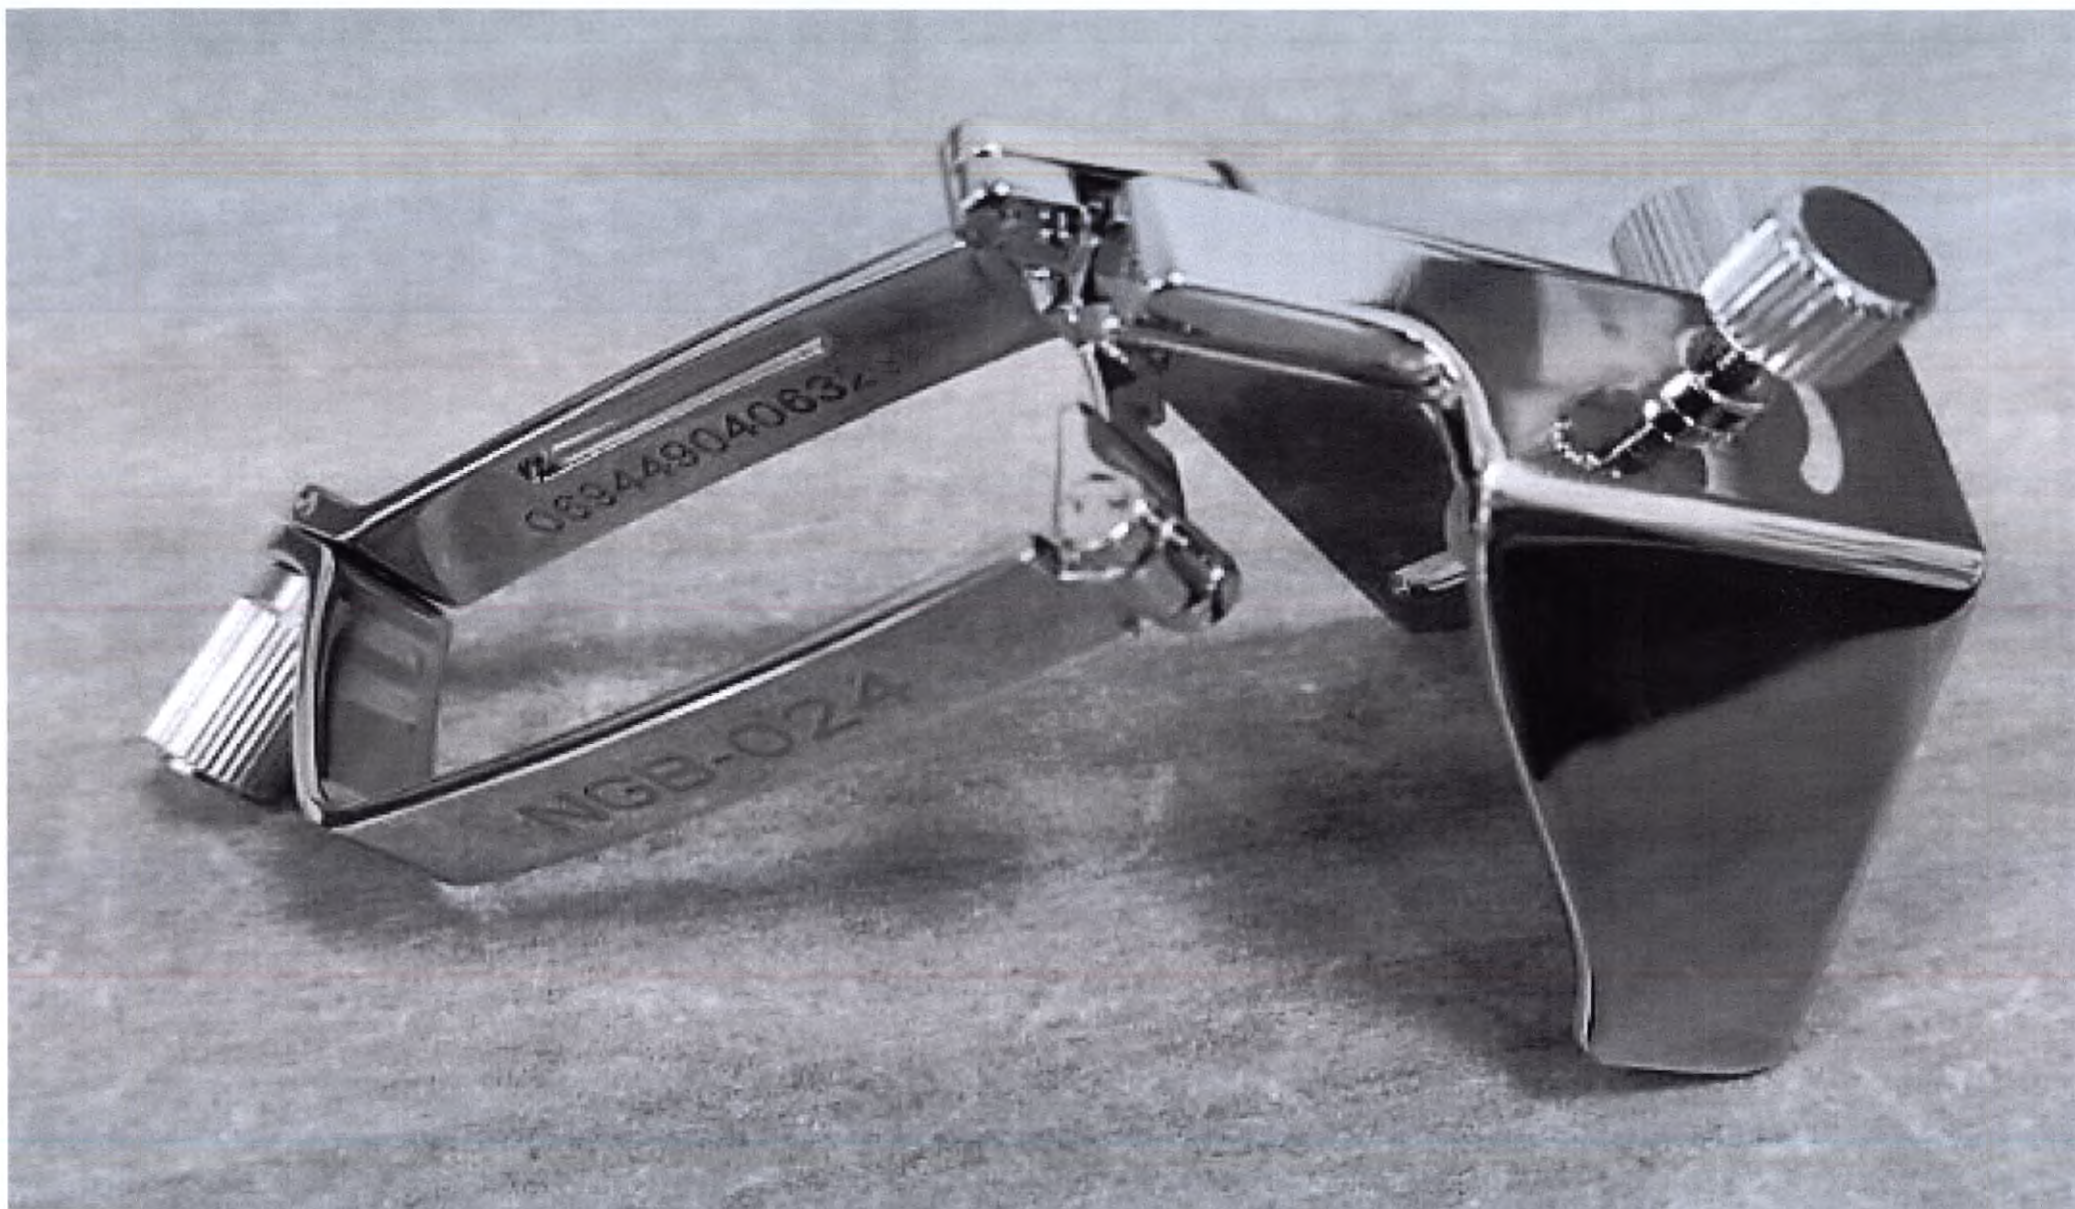

Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-024




Вид 1

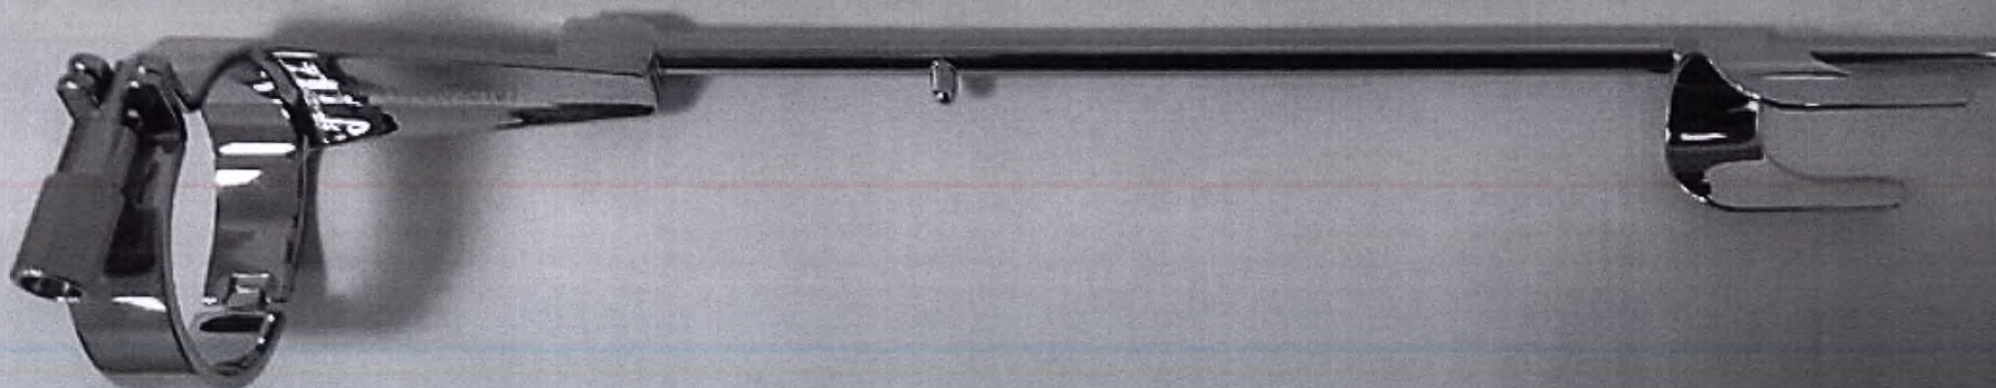

Вид 2

Насадка биопсийная металлическая, с несъемной направляющей для игл NGB-025

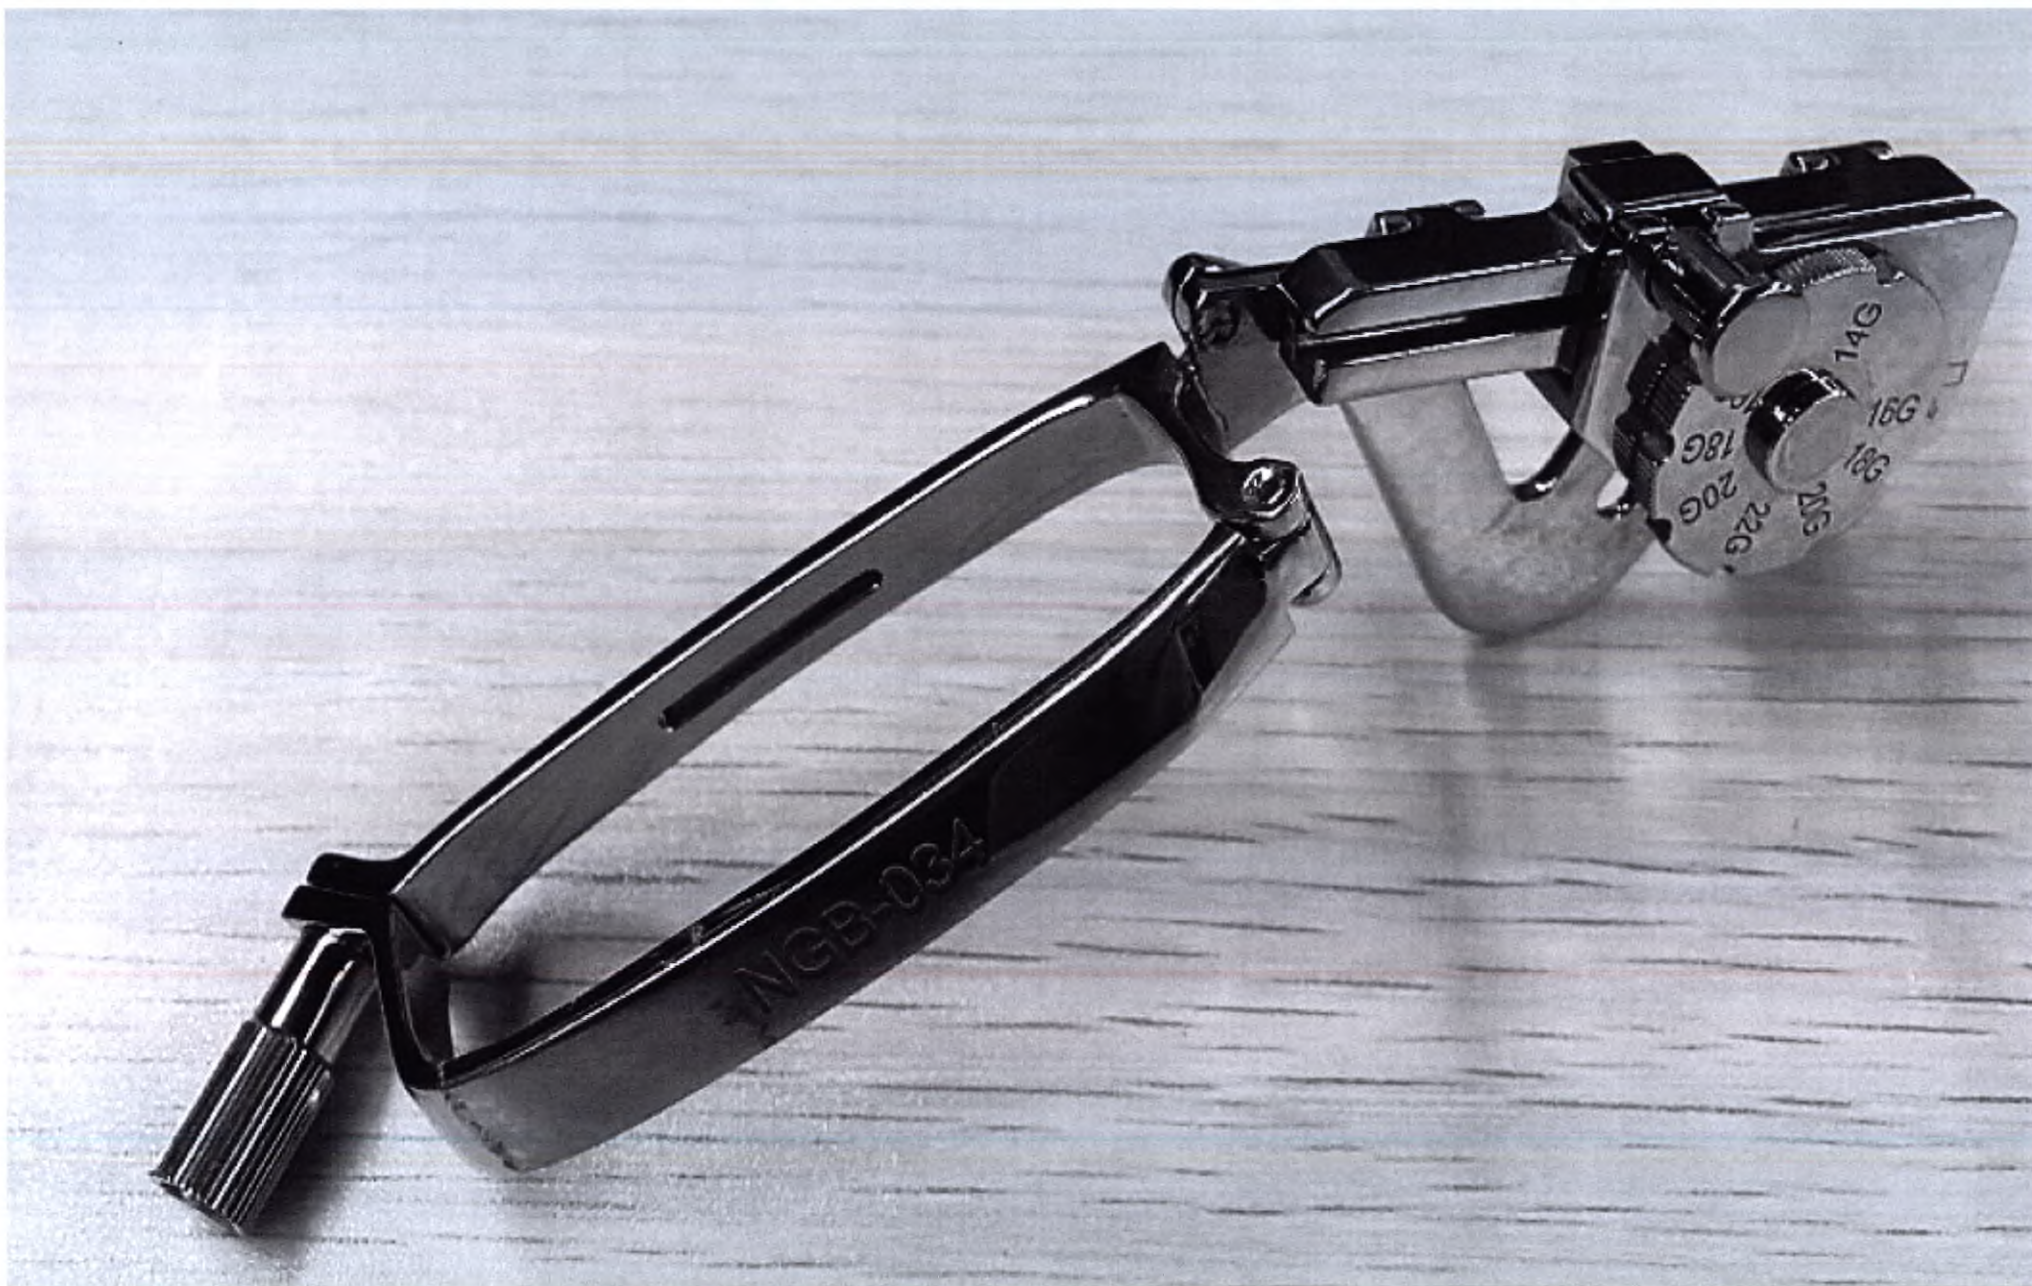


Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-034



Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-036



Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-043

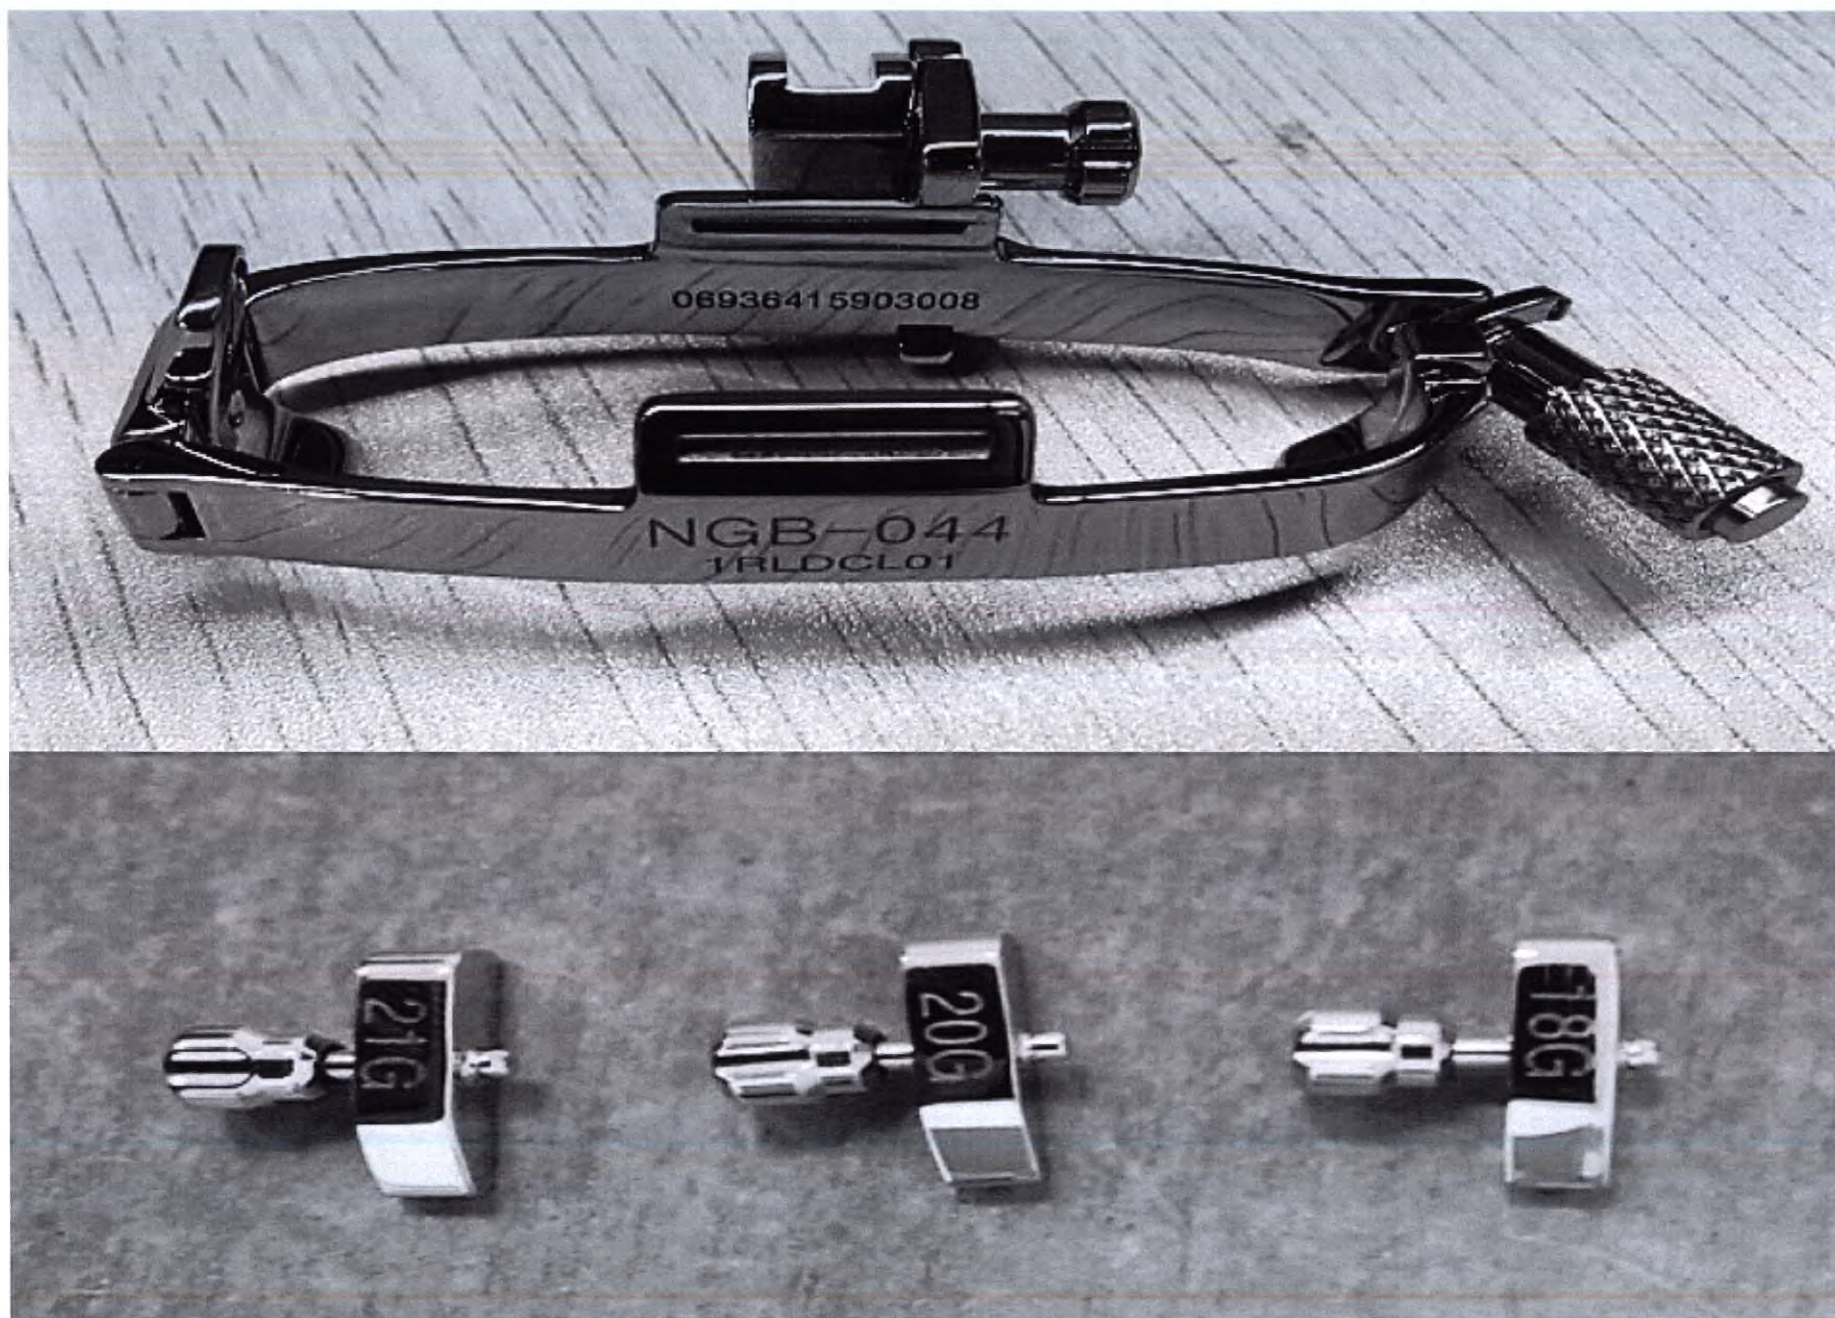


Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-044



Насадка биопсийная металлическая, с несъемной направляющей для игл NGB-045



Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-053

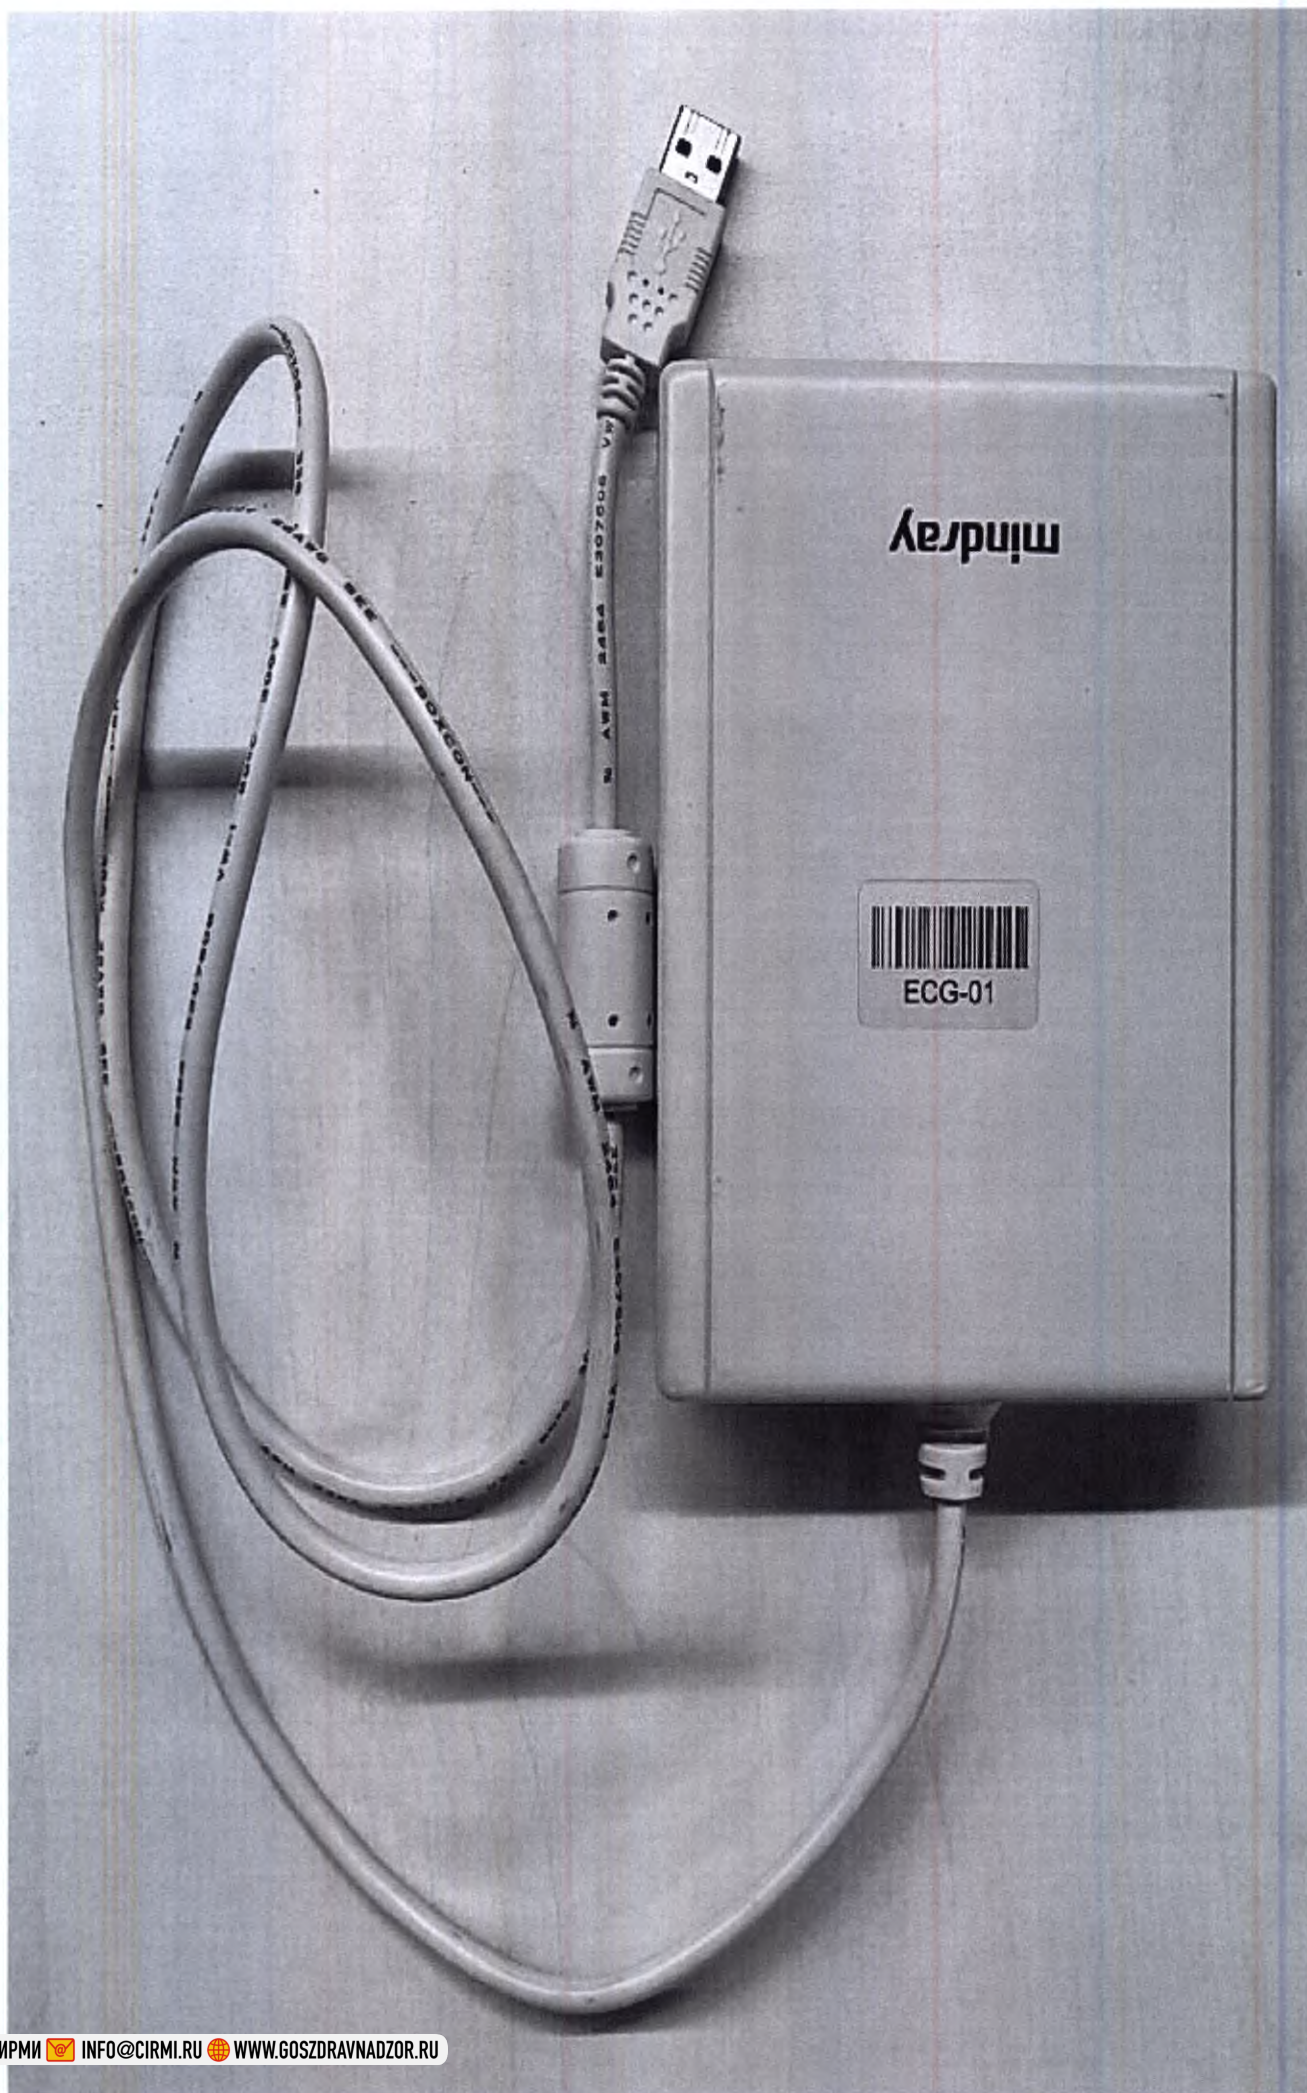

Модуль ЭКГ (ECG Module)

**Кабель DB9
(COM)**

Модуль ЭКГ

**Кабель ЭКГ магистральный
3/5 отведений взрослый/детский**


Кабель BNS

**Провод ЭКГ на 3 отведения
взрослый/детский**

Модуль ЭКГ (ECG Module), в составе

Винт,
закручивающийся
вручную

Винт М3х5

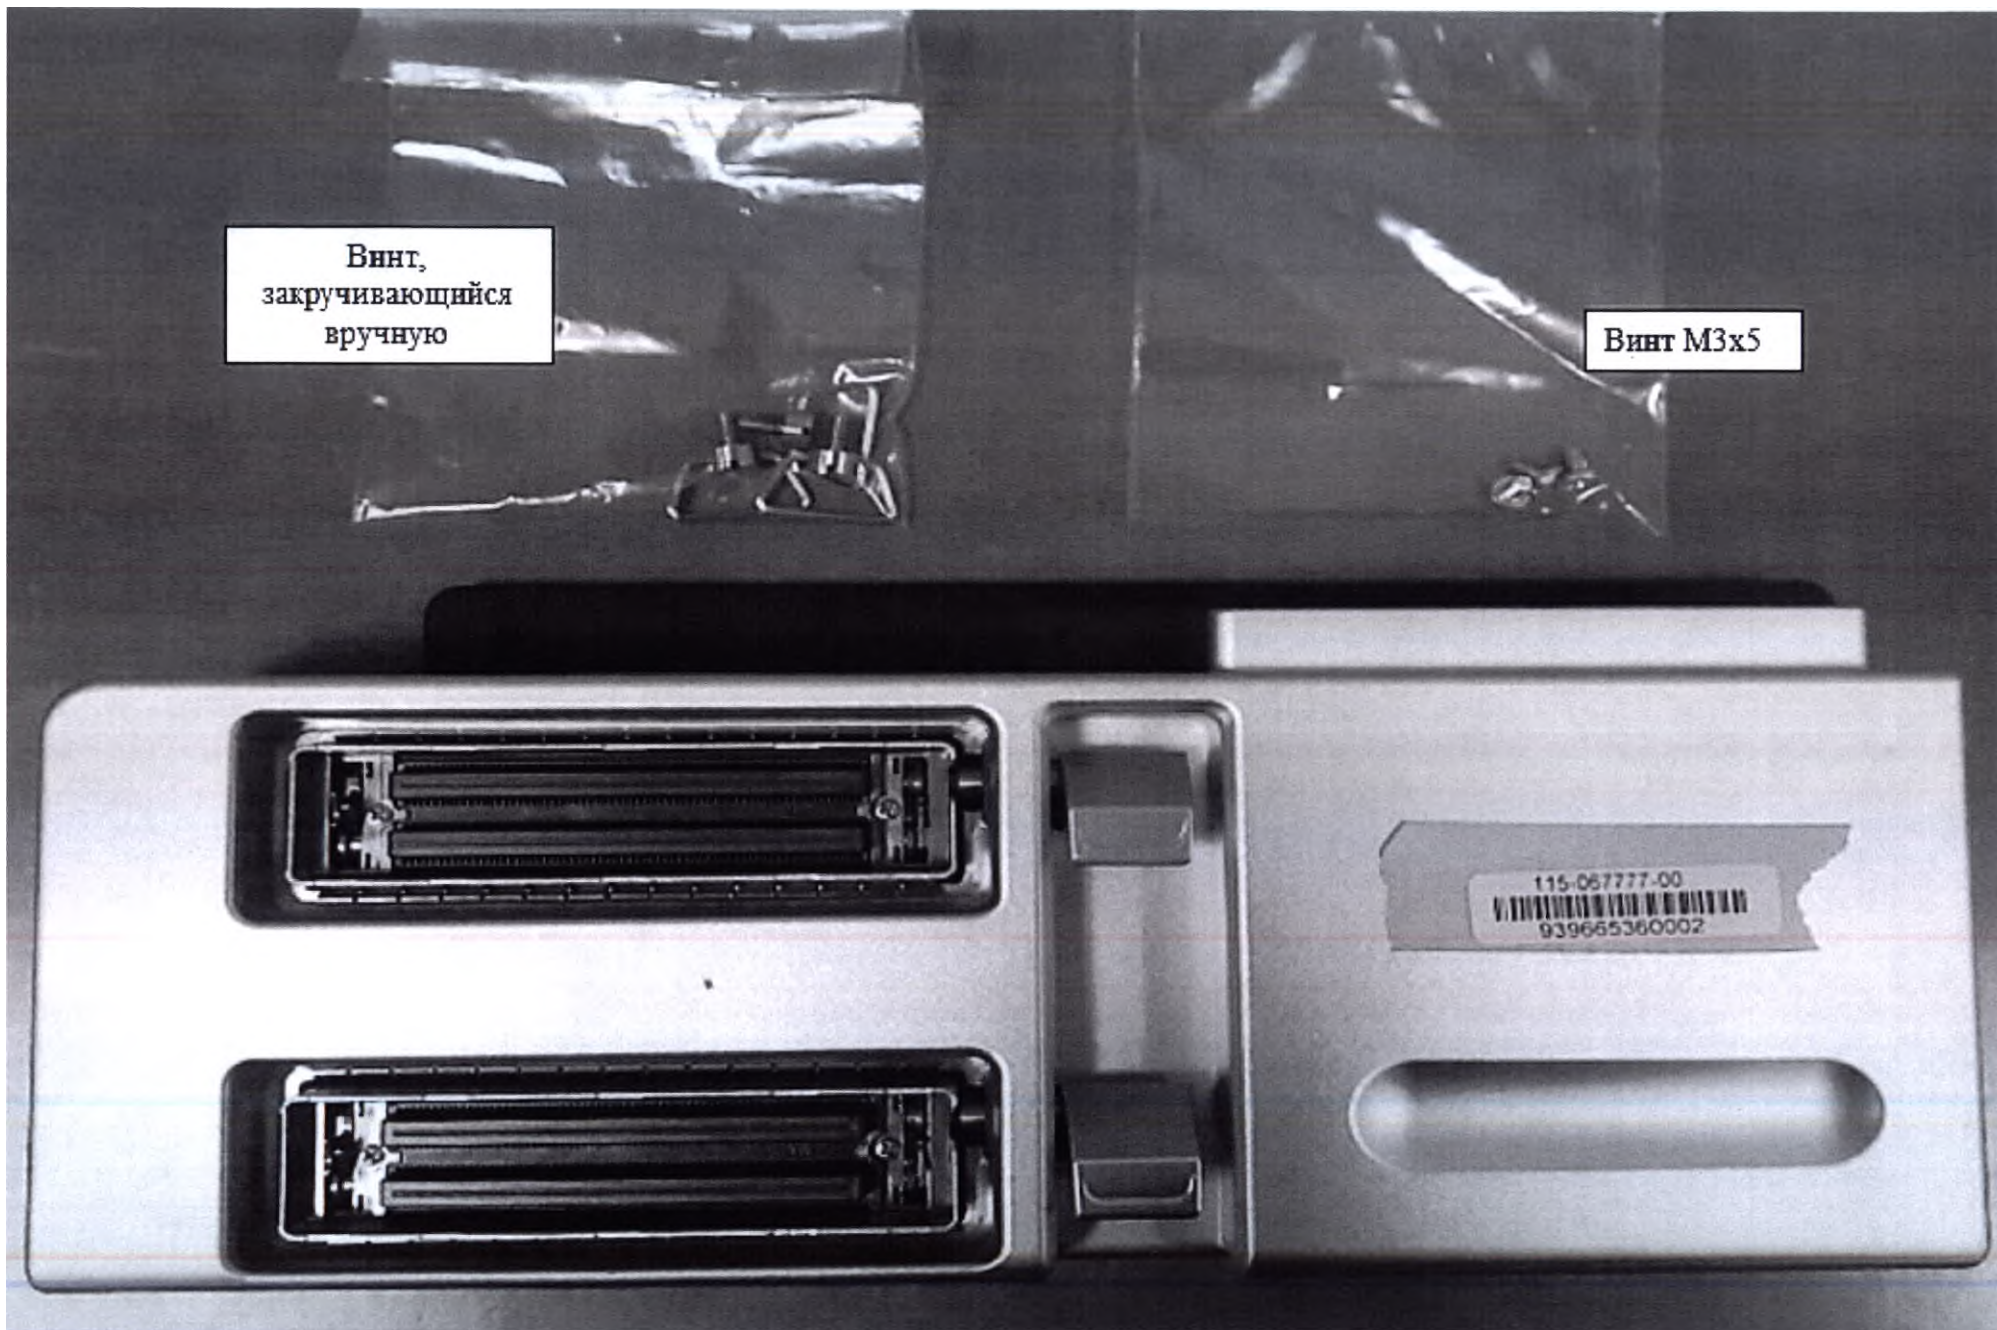



Модуль-разветвитель на два порта для подключения датчиков




Модуль-разветвитель на два порта для подключения датчиков. Вид сбоку




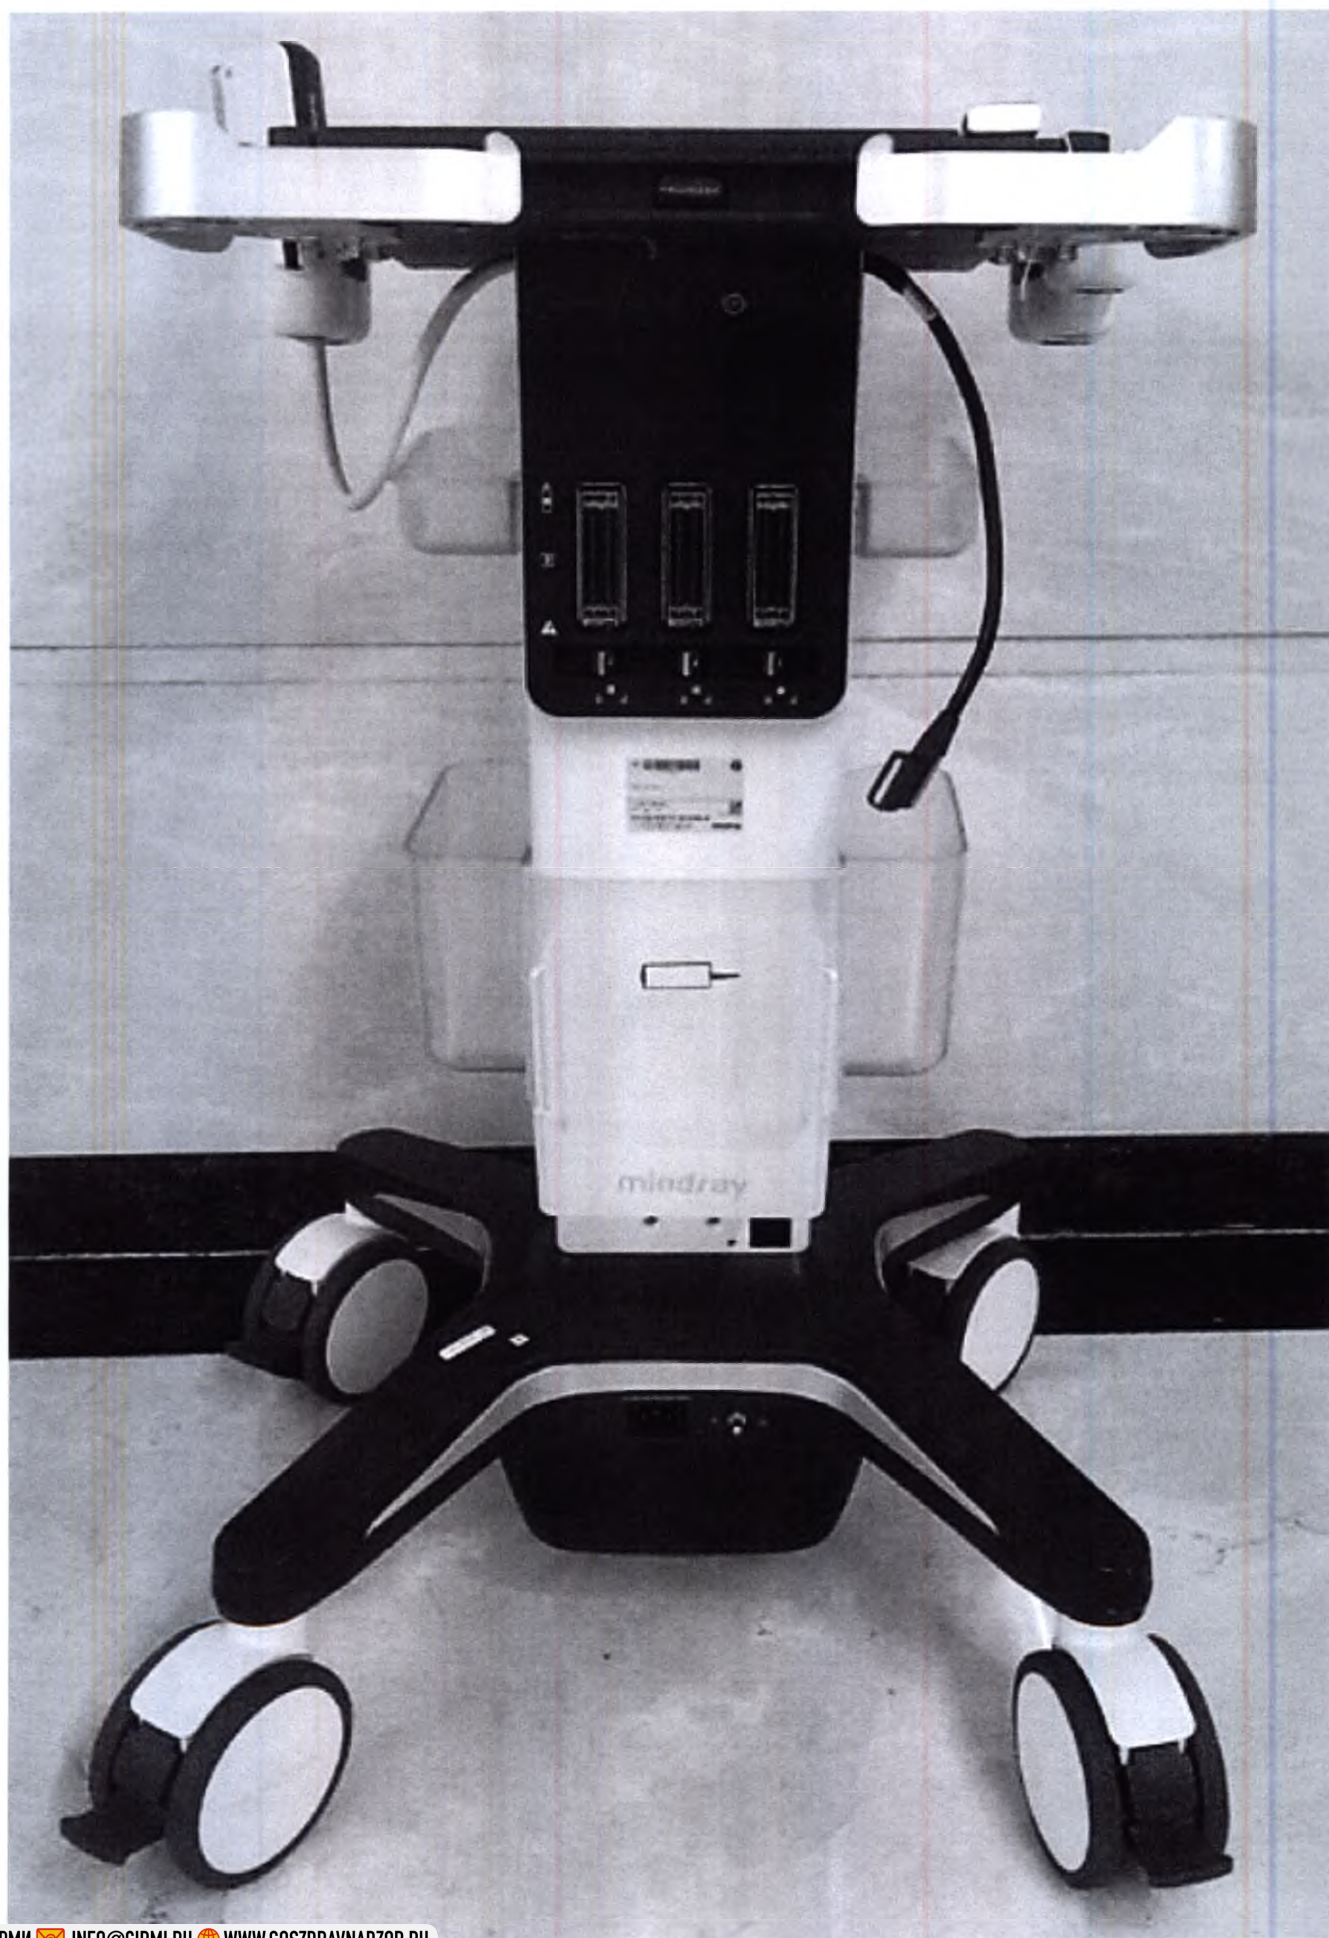


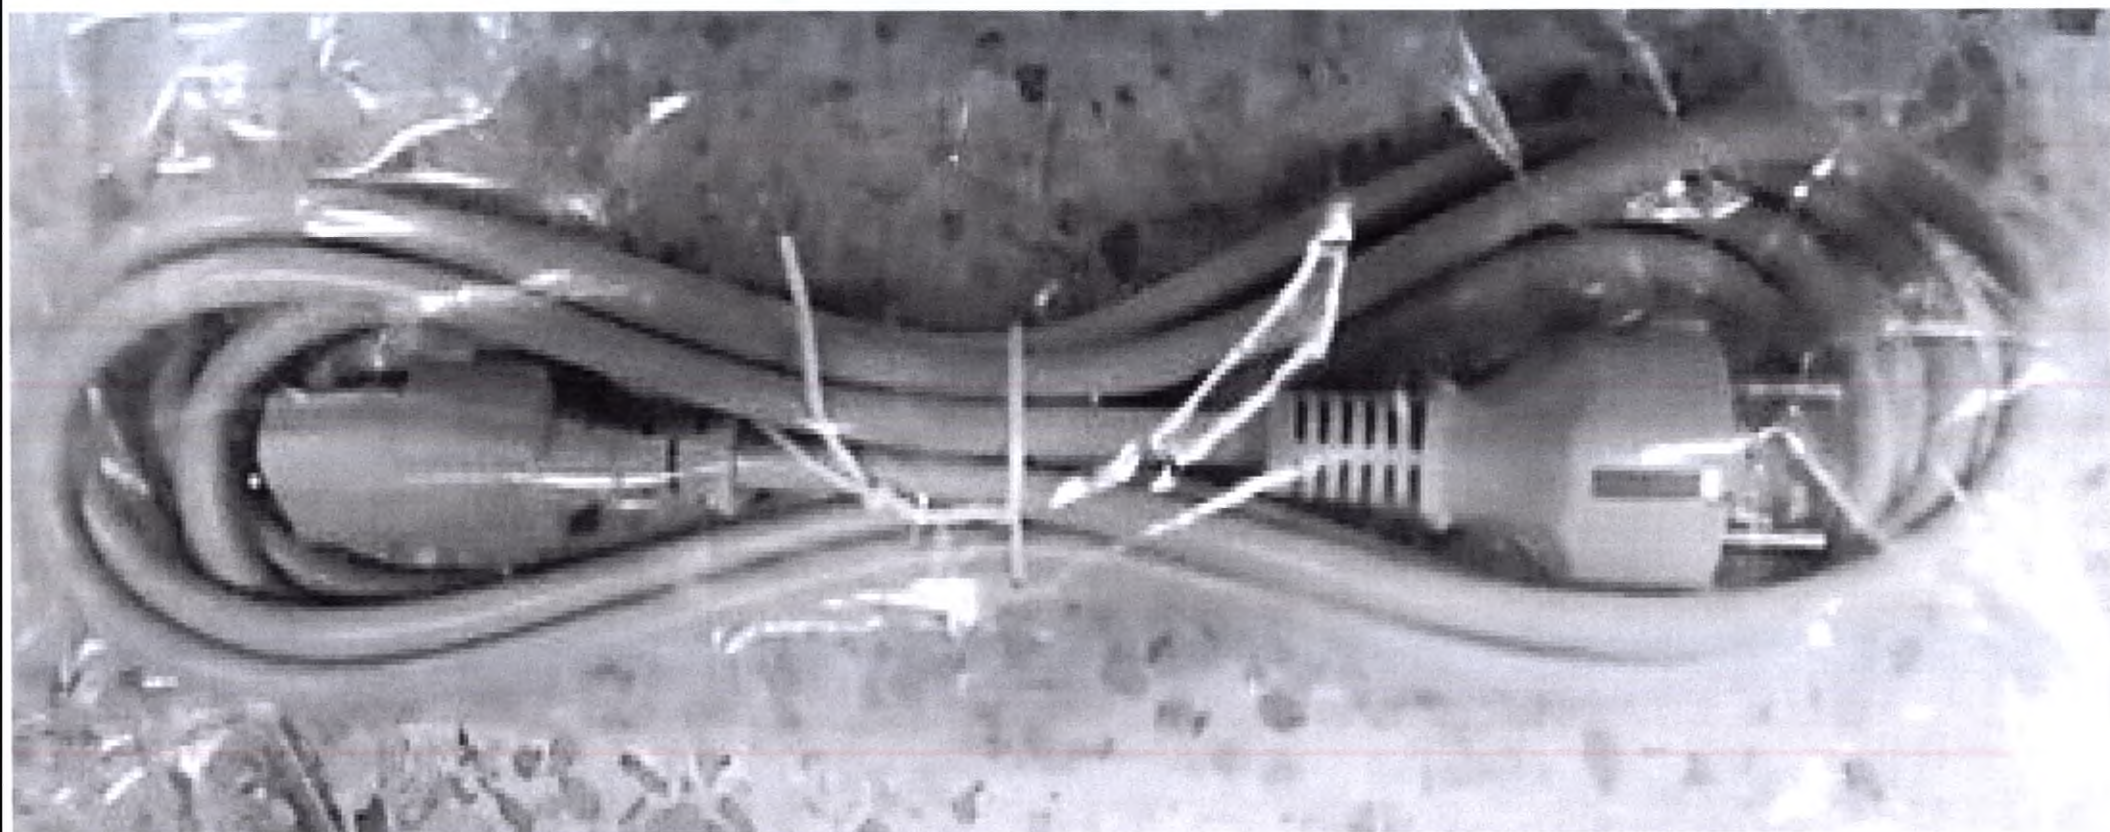


Кабель питания для тележки

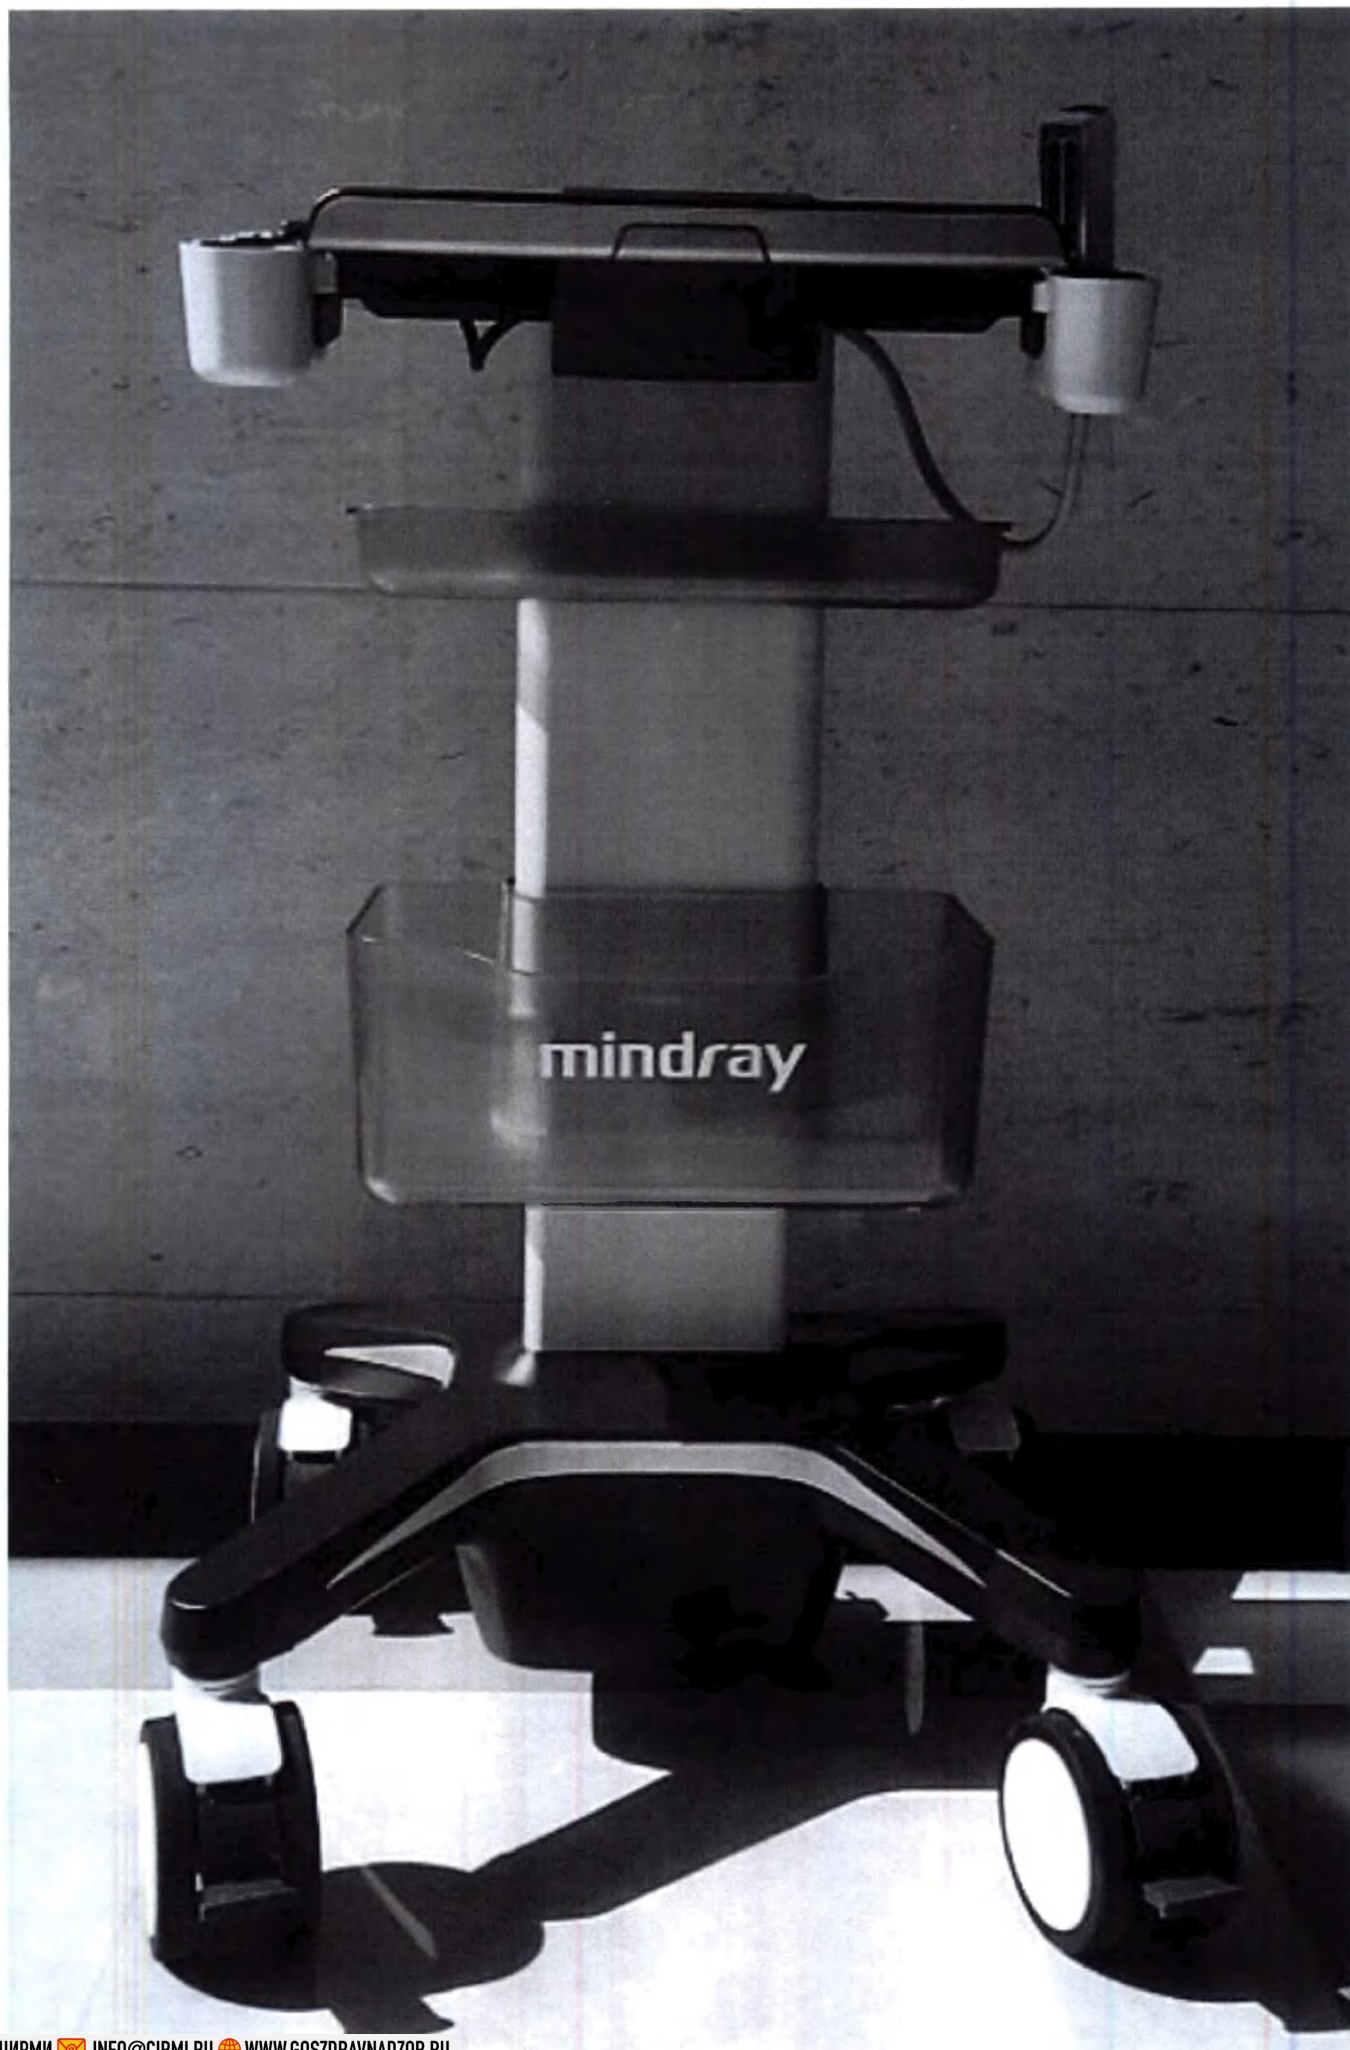

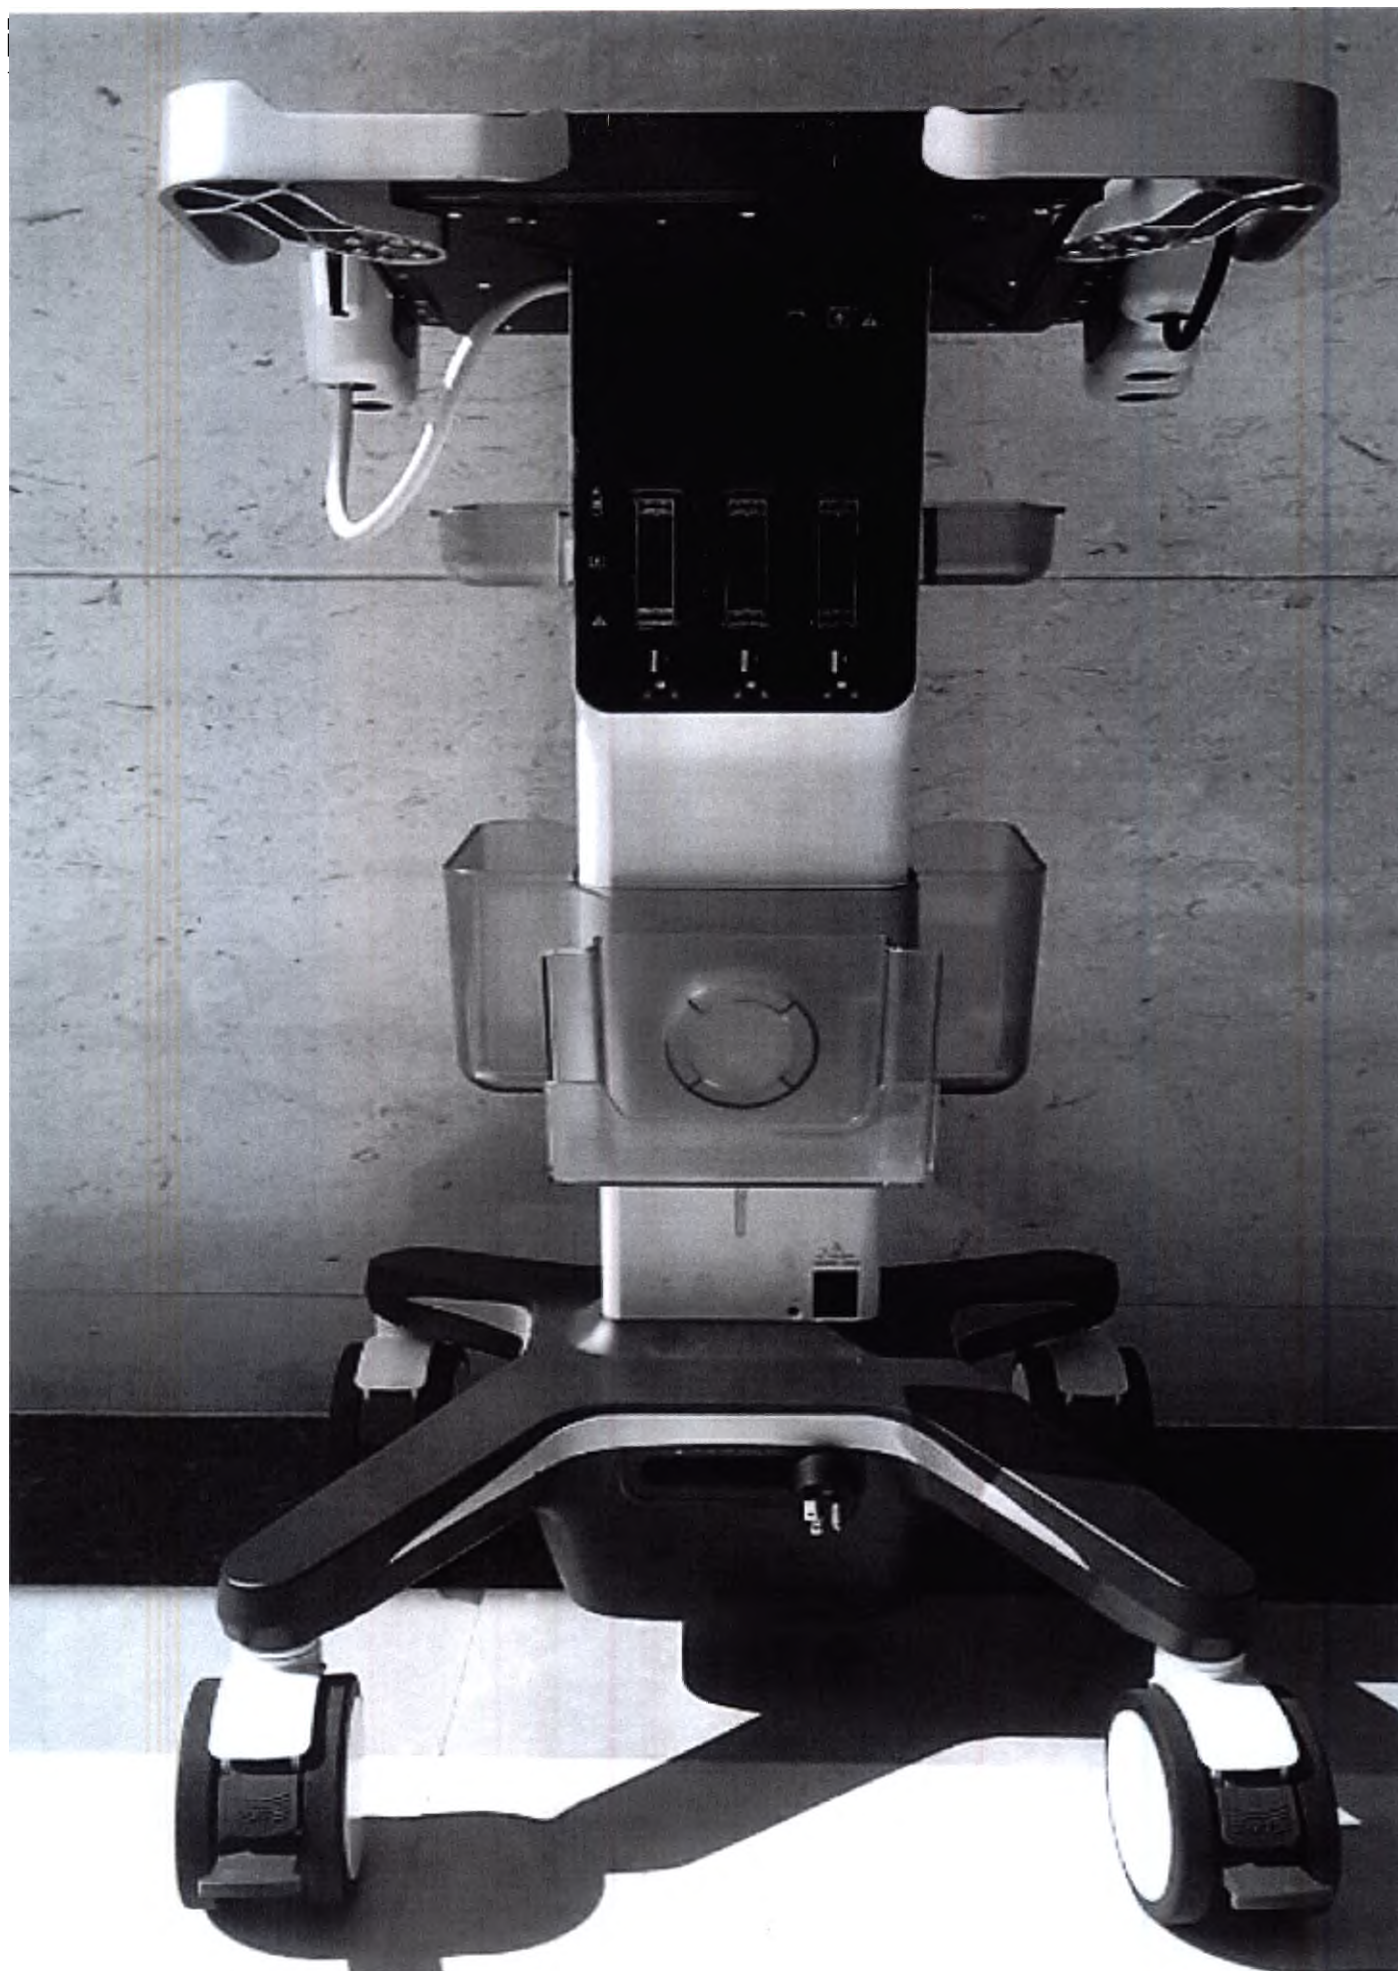


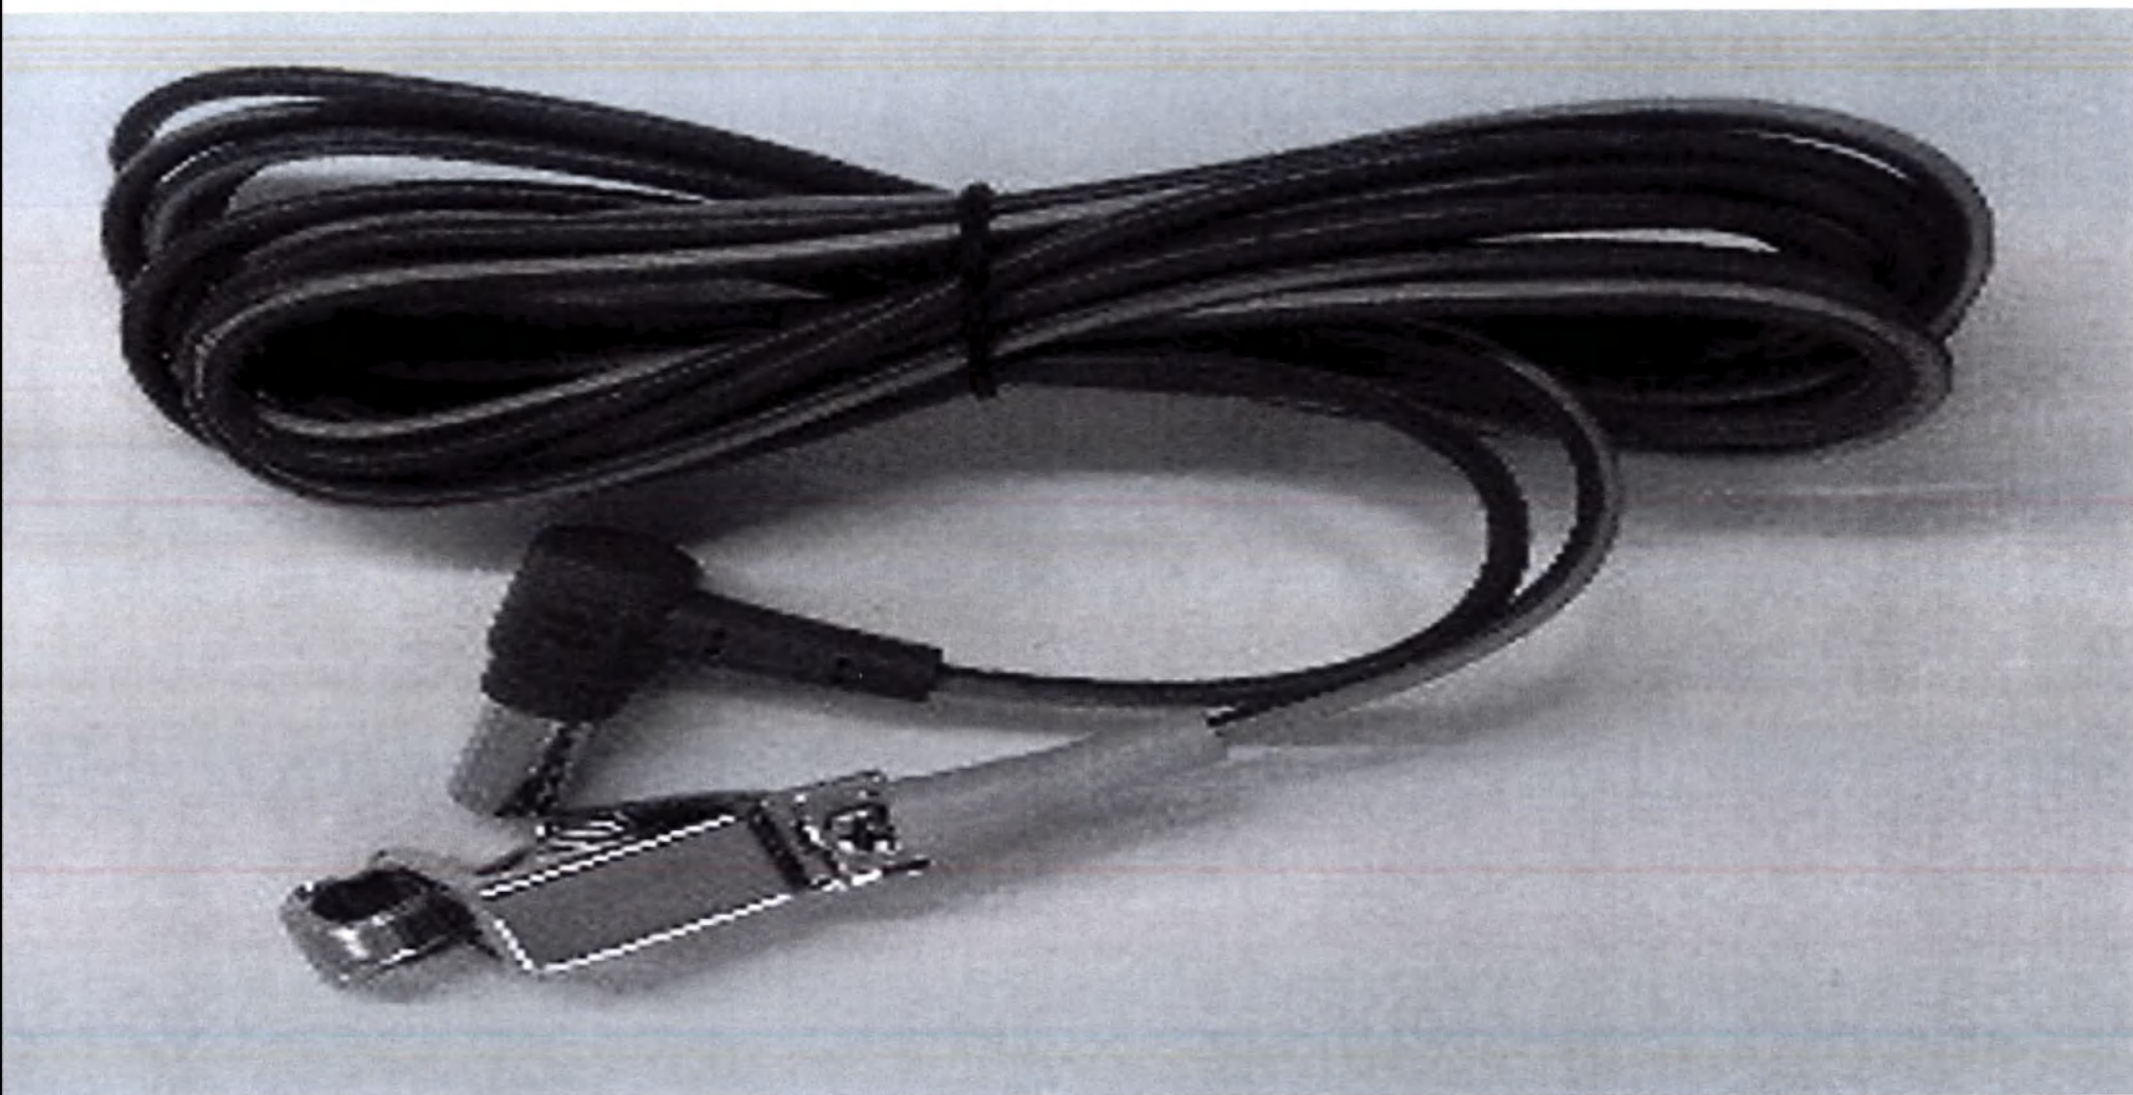


Кабель заземления

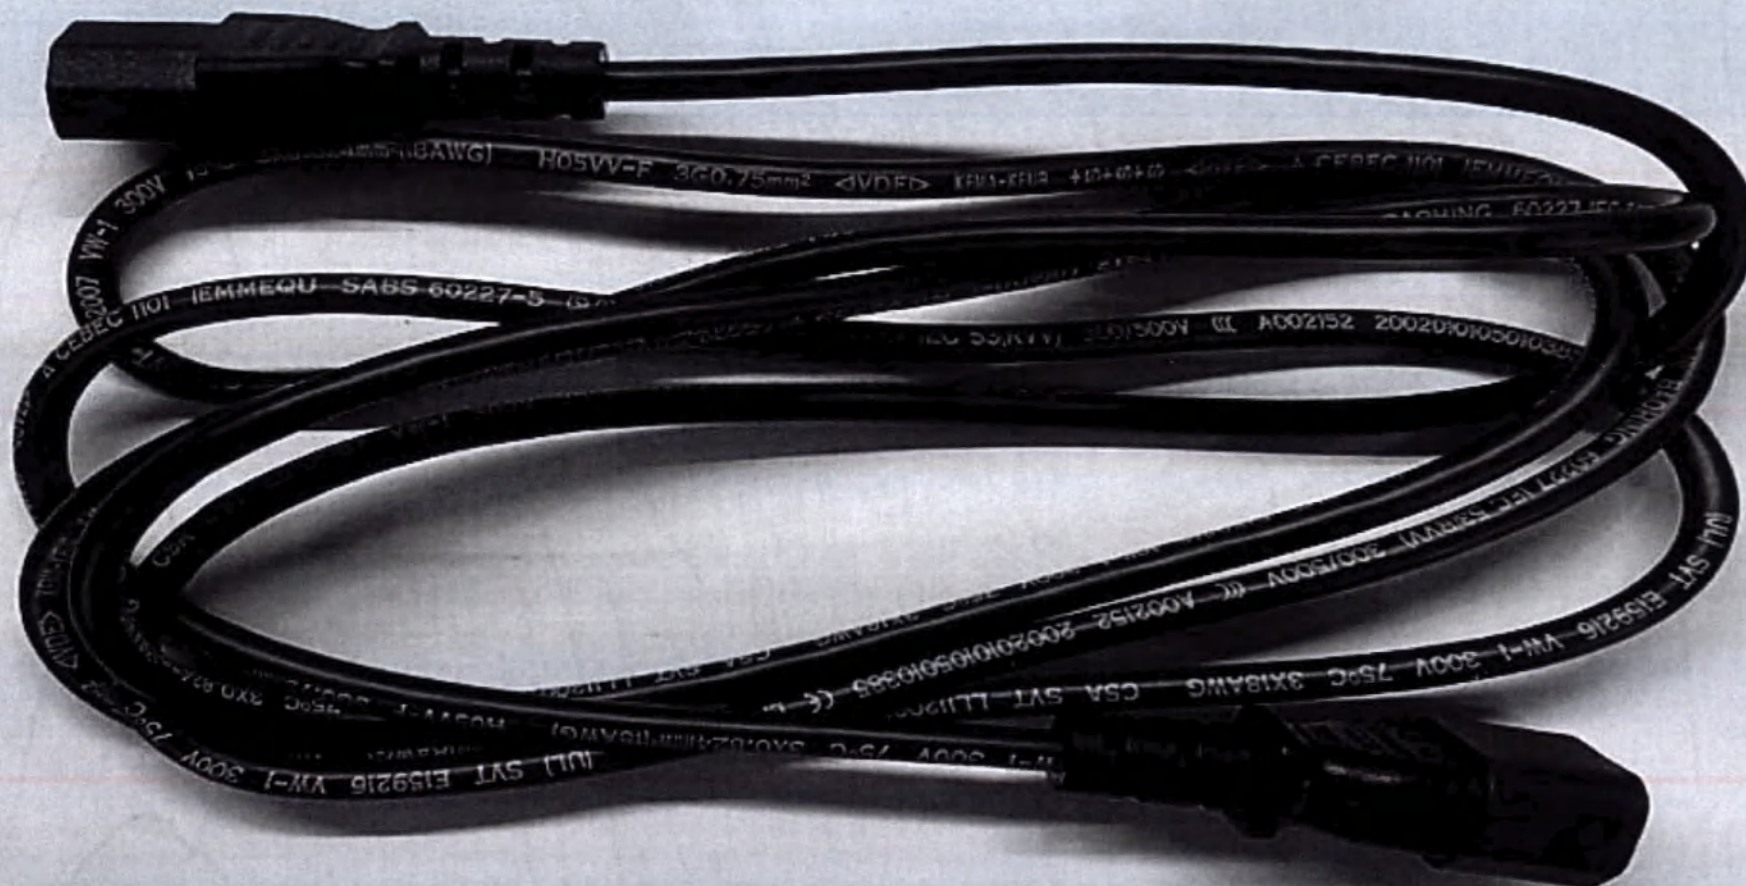


Кабель питания для периферийных устройств

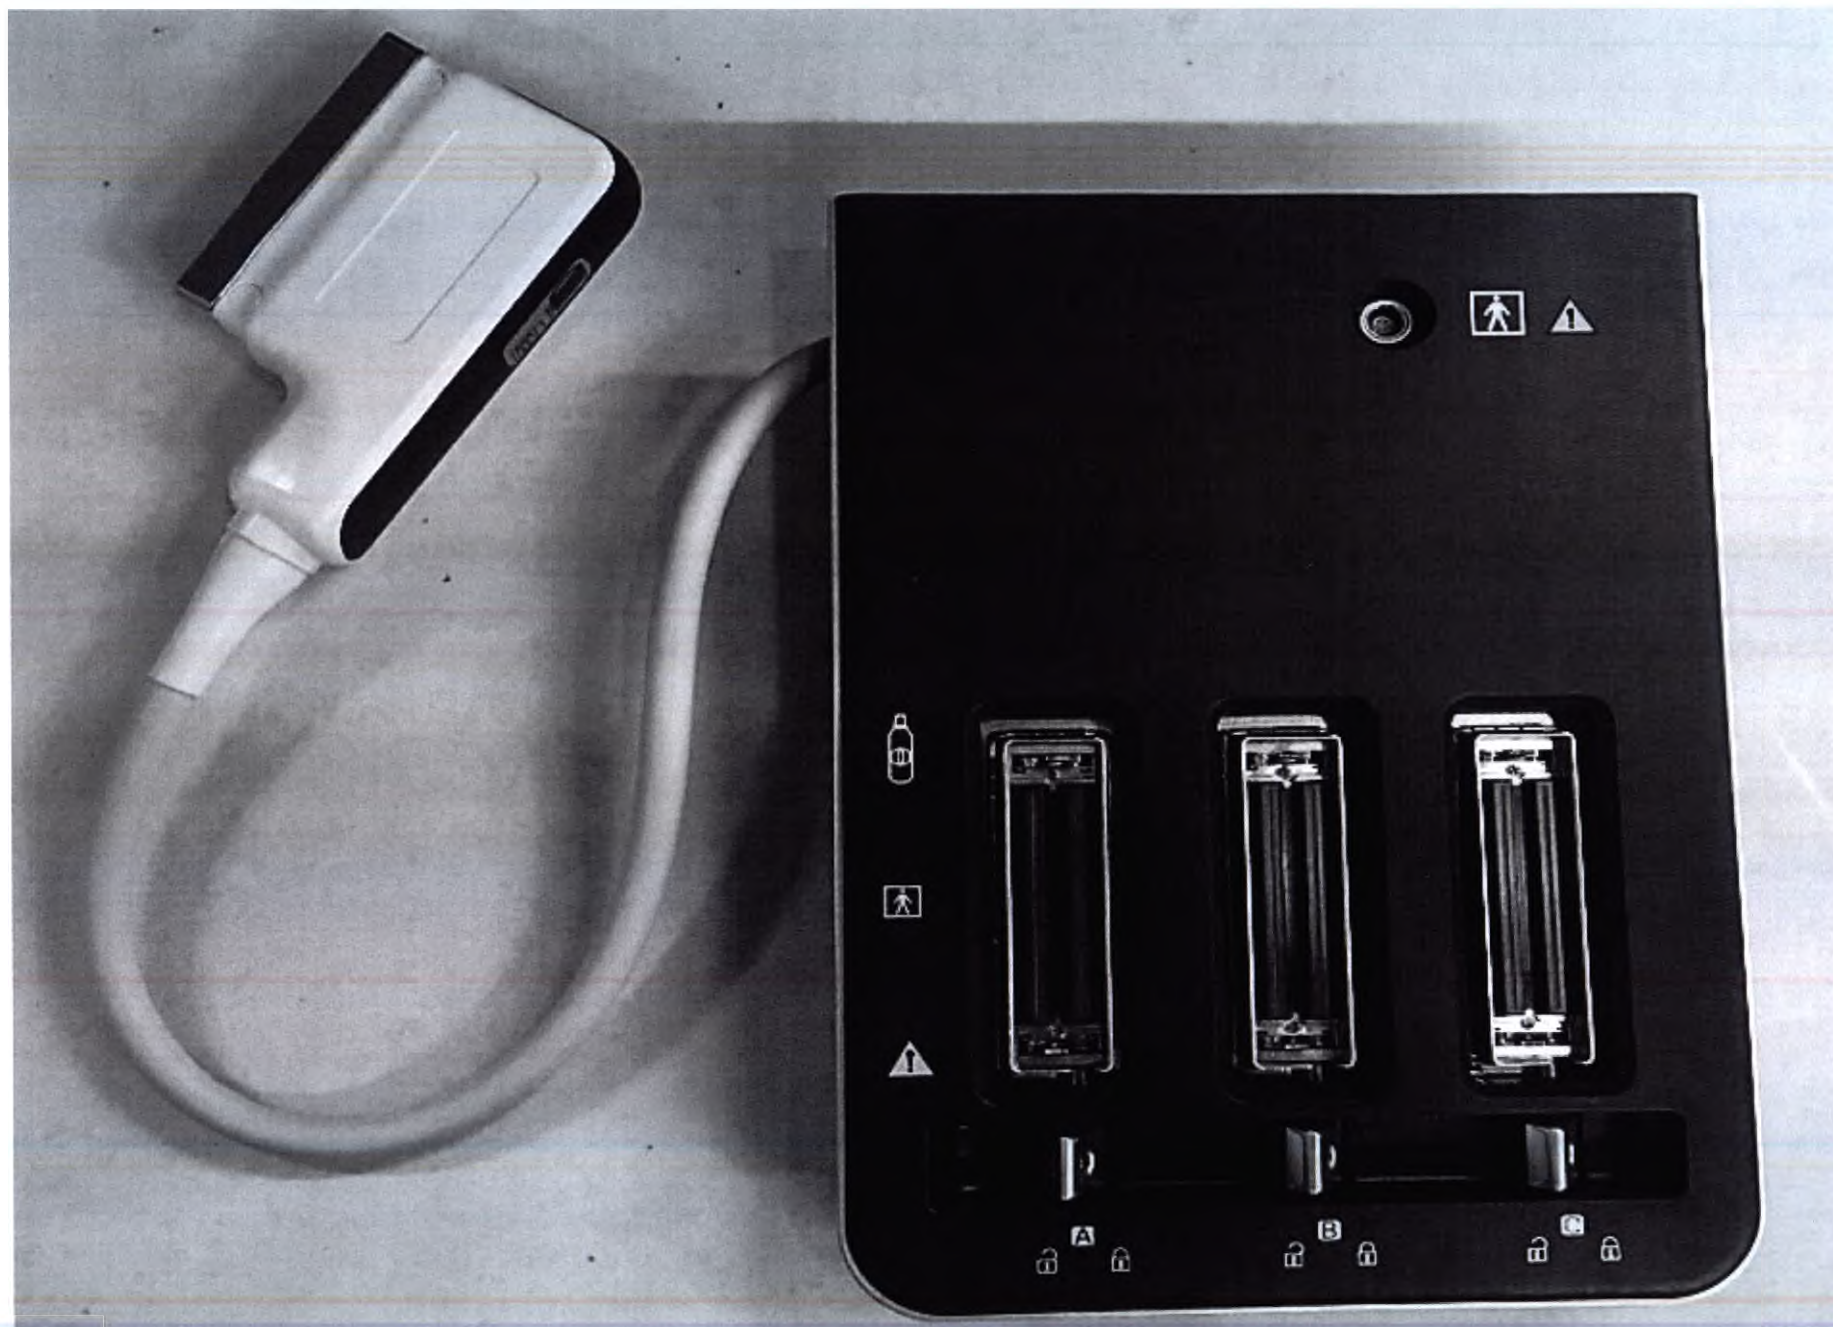


Разветвитель для подключения датчиков, включая порт для карандашного датчика

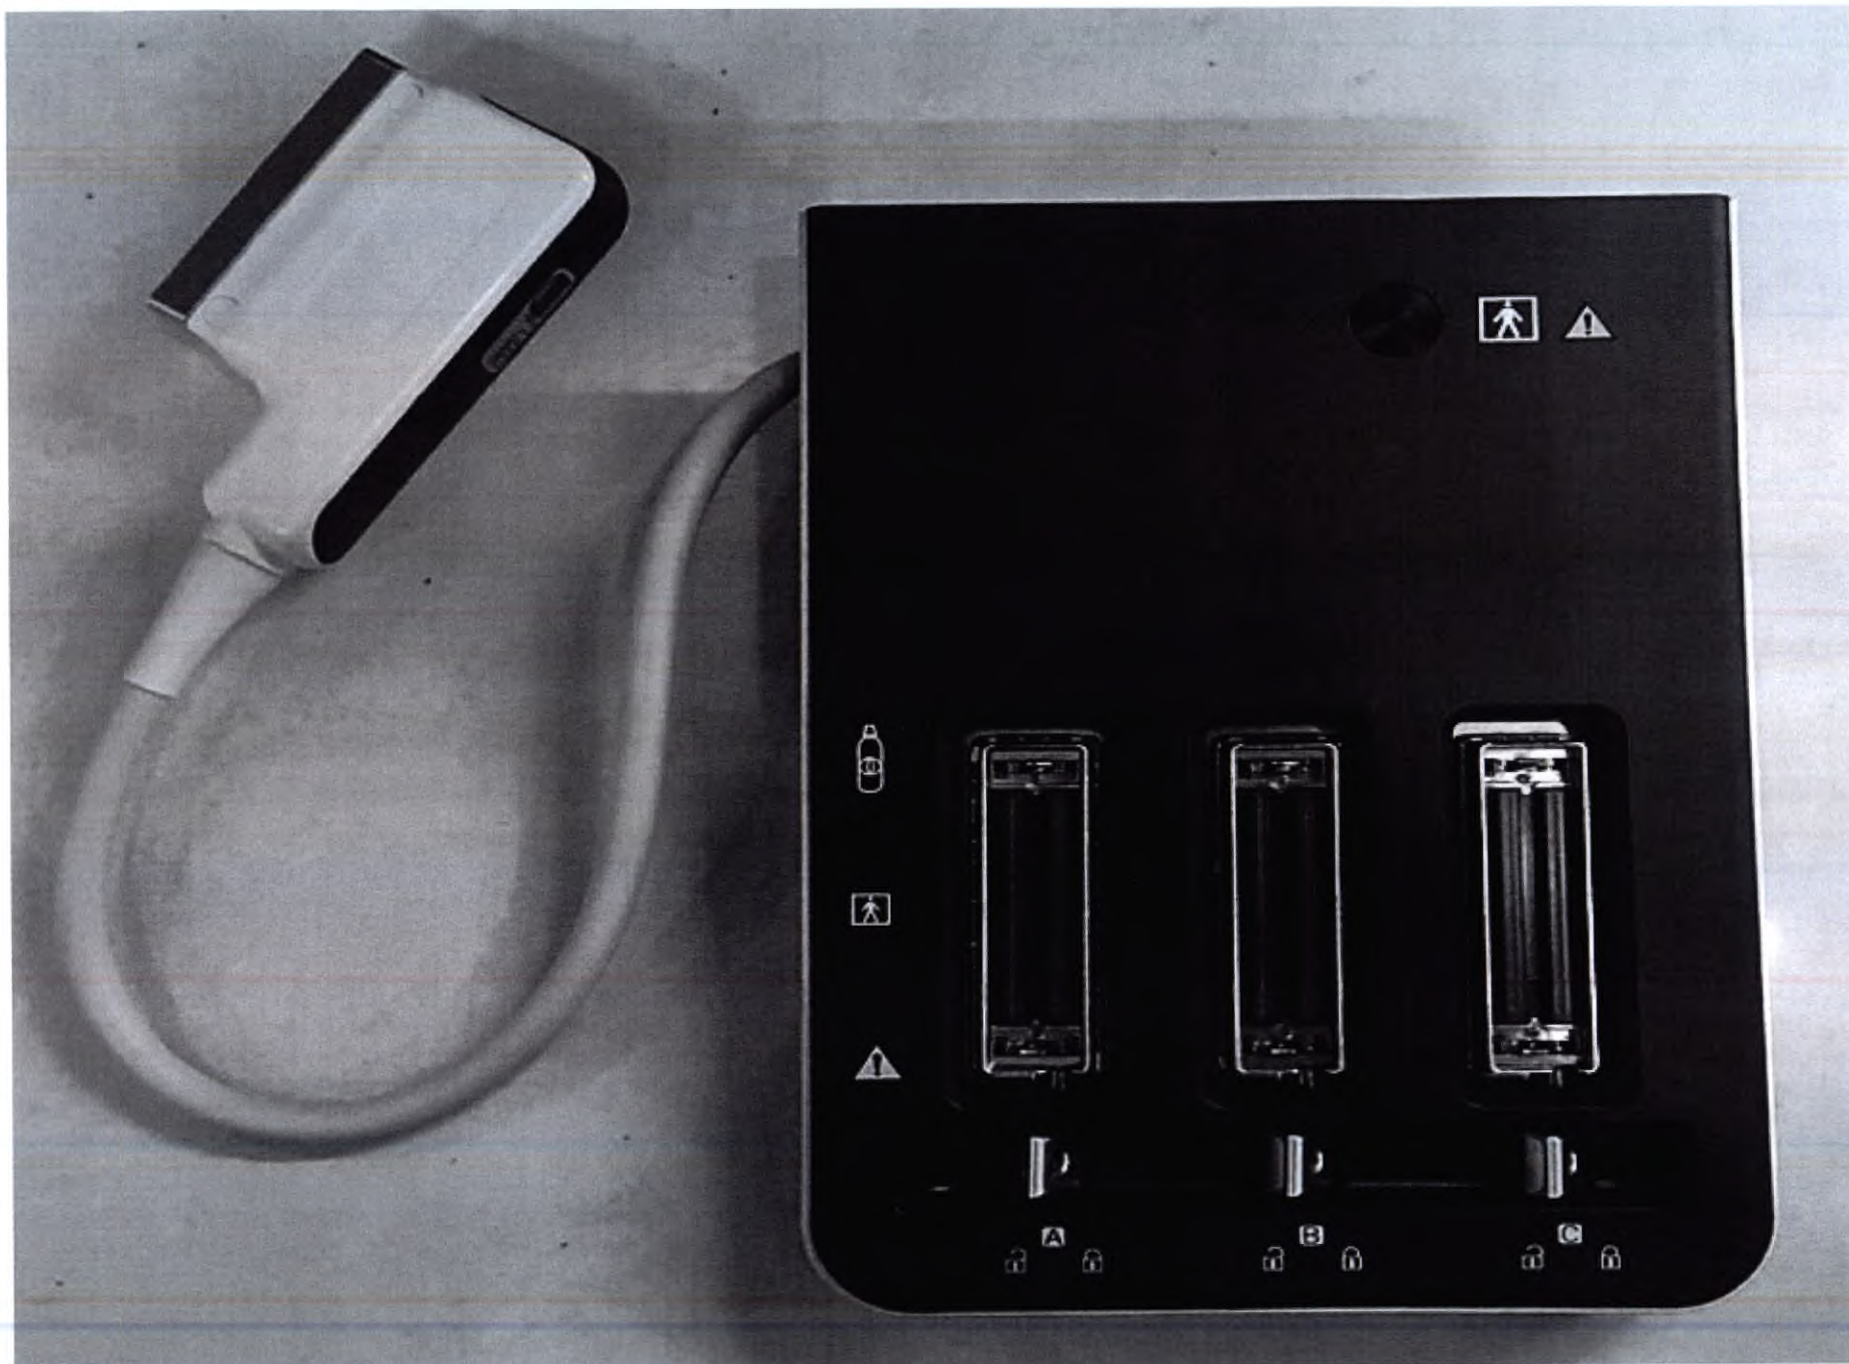


Разветвитель для подключения датчиков, без порта для карандашного датчика

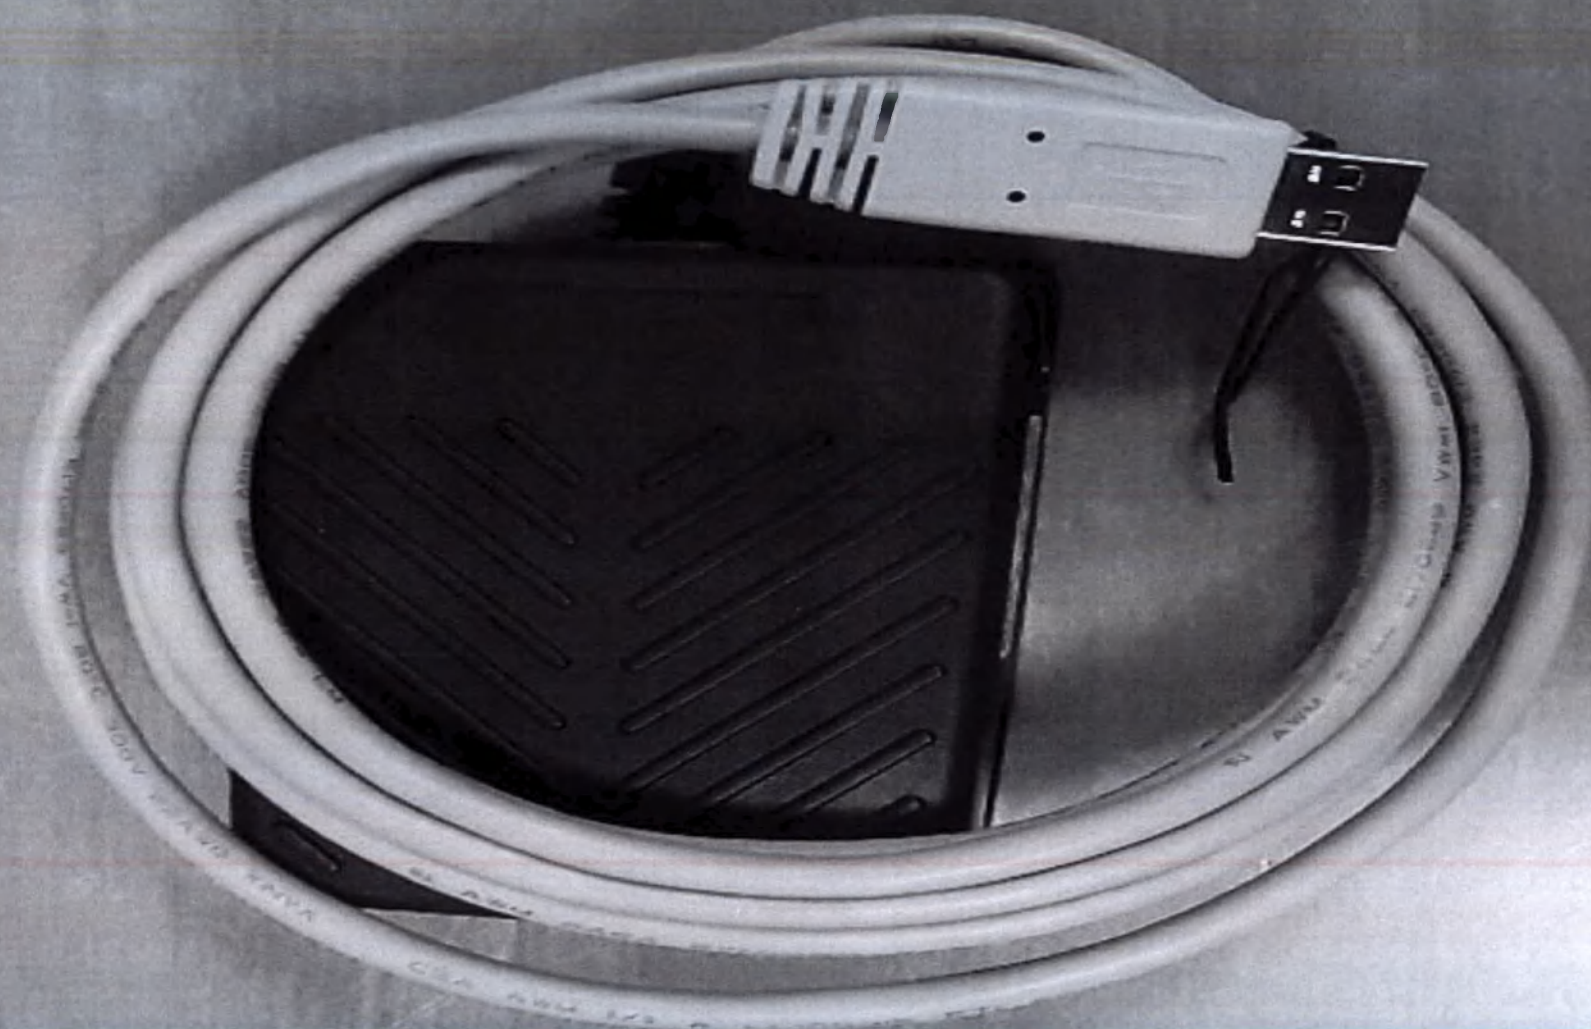

Ножной переключатель, 1 клавиша.

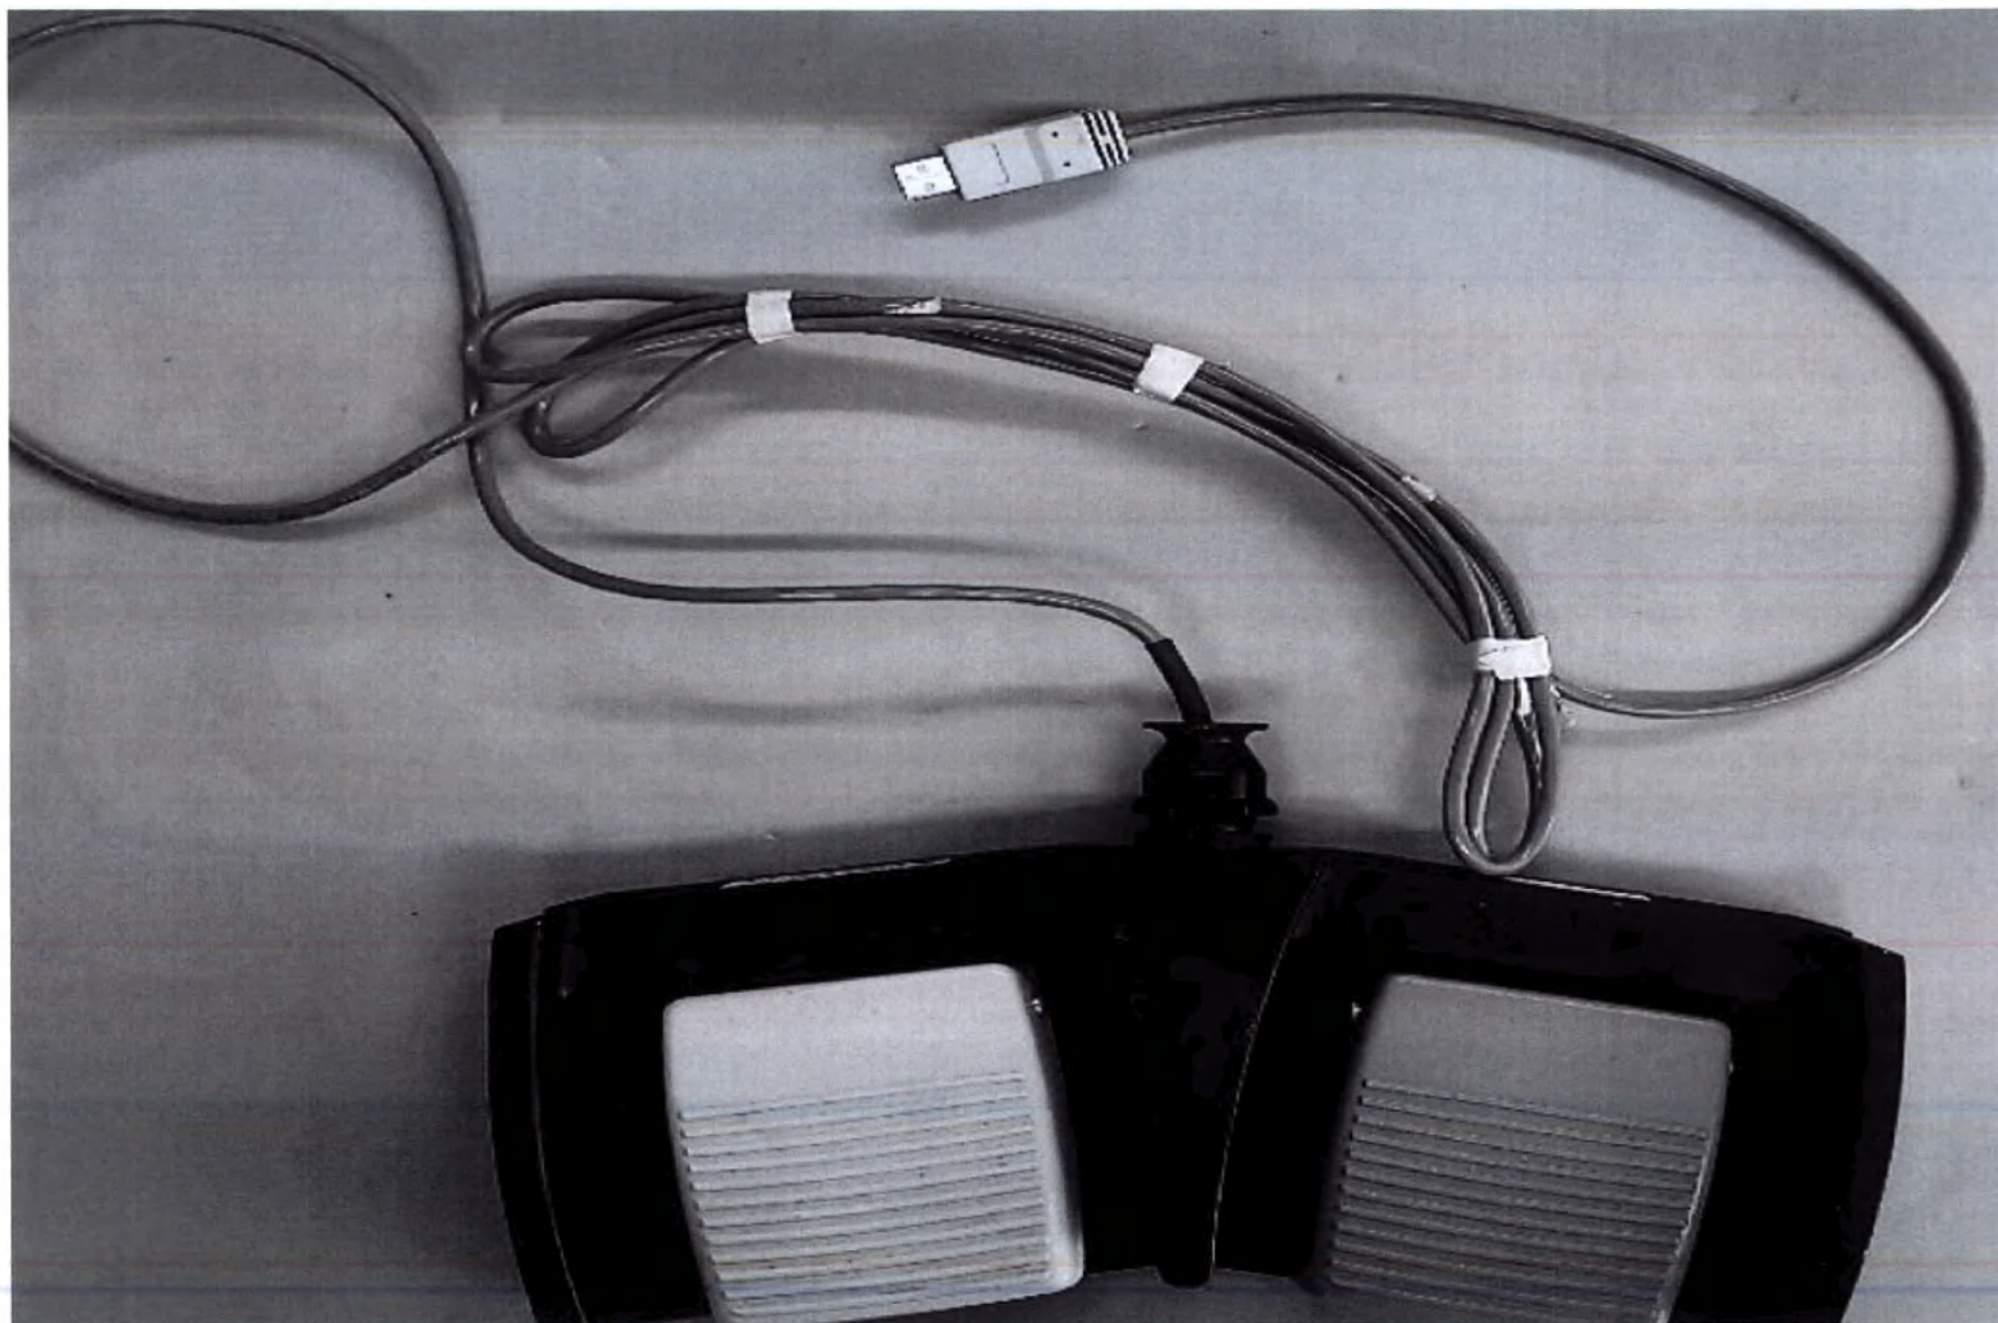


Ножной переключатель, 2 клавиши.

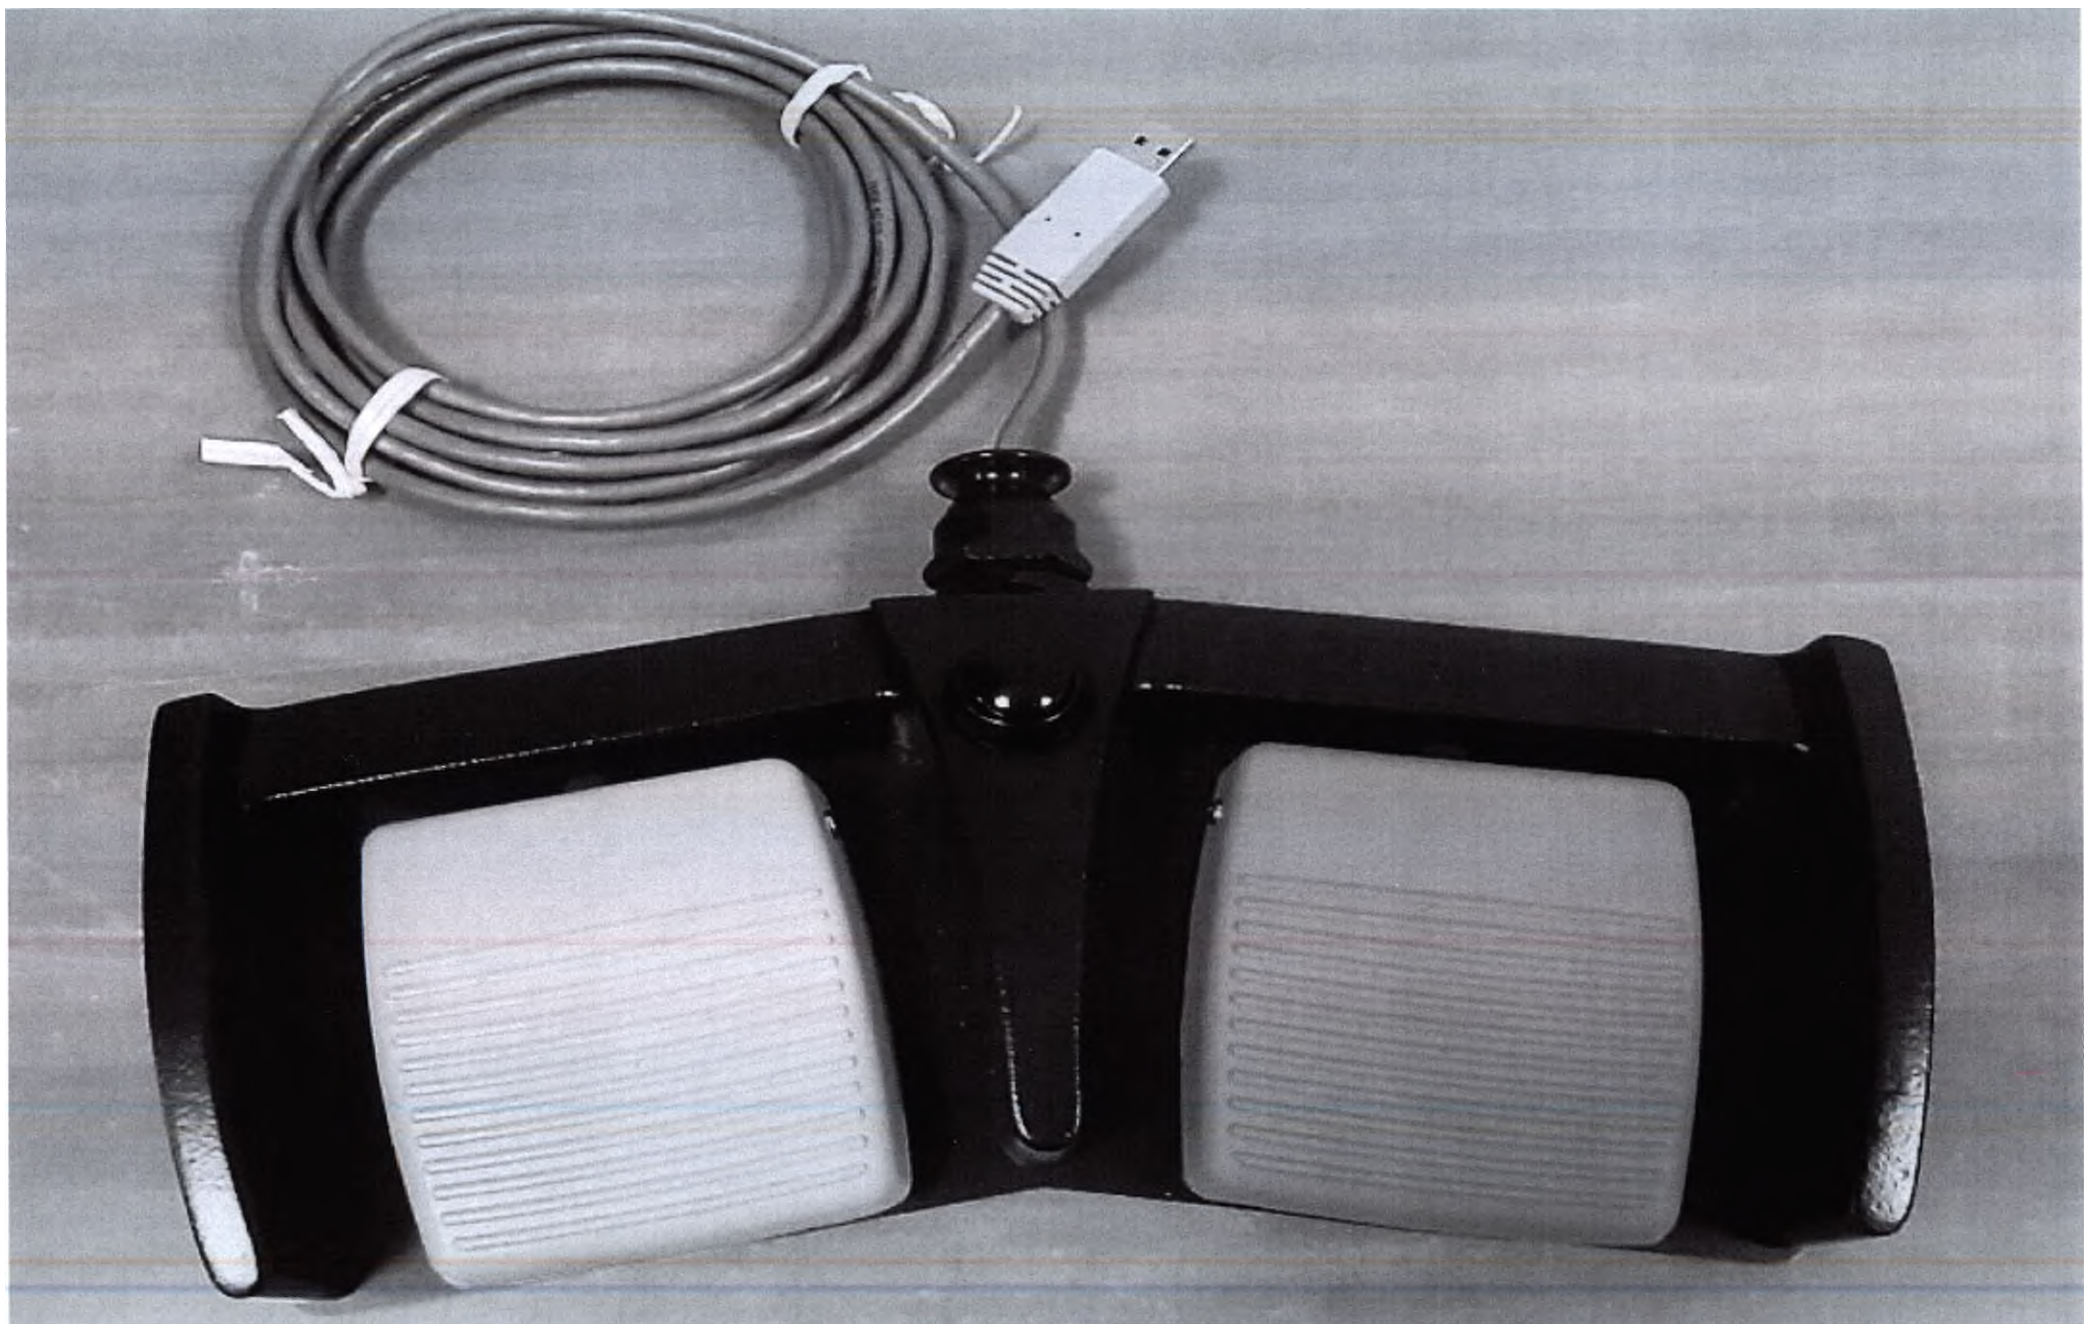


Ножной переключатель, 3 клавиши.

Примеры упаковок:

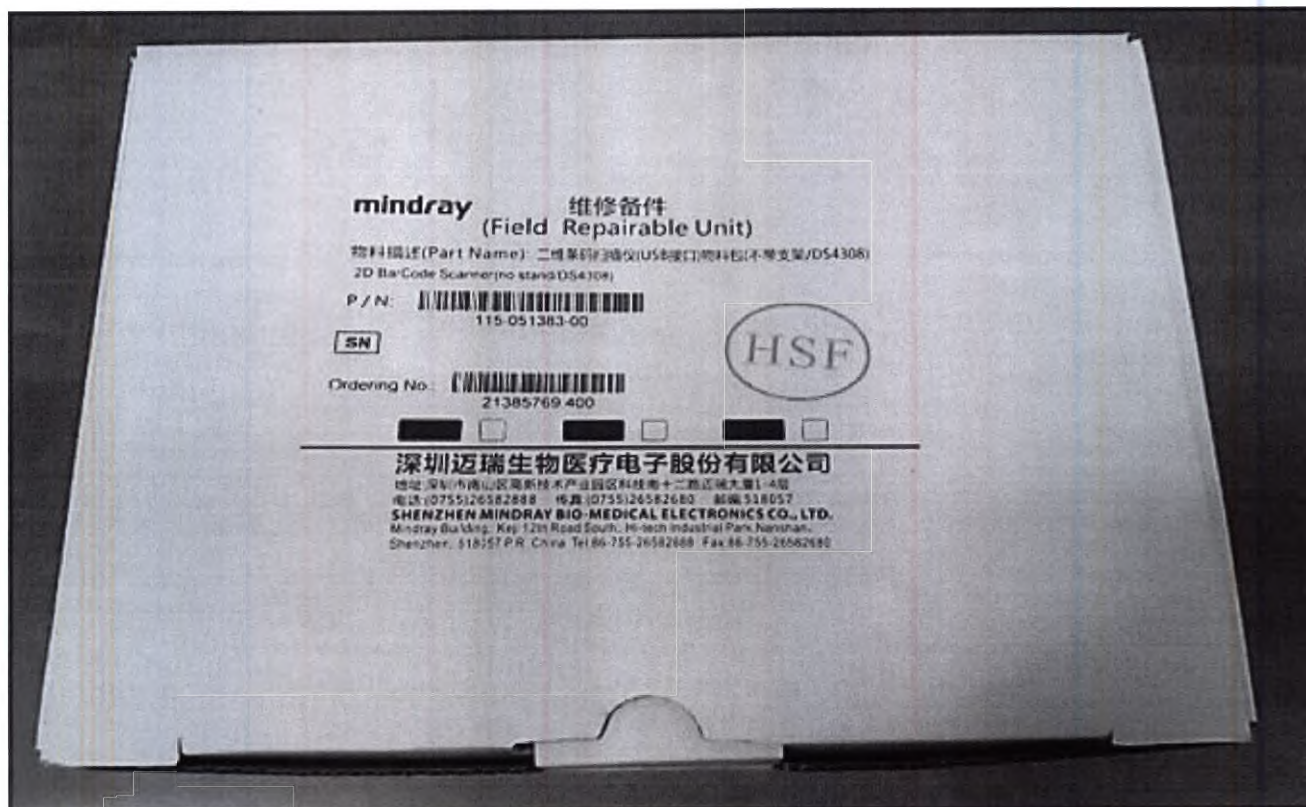


Сканеры штрих-кодов.
Потребительская упаковка. Вид сверху.

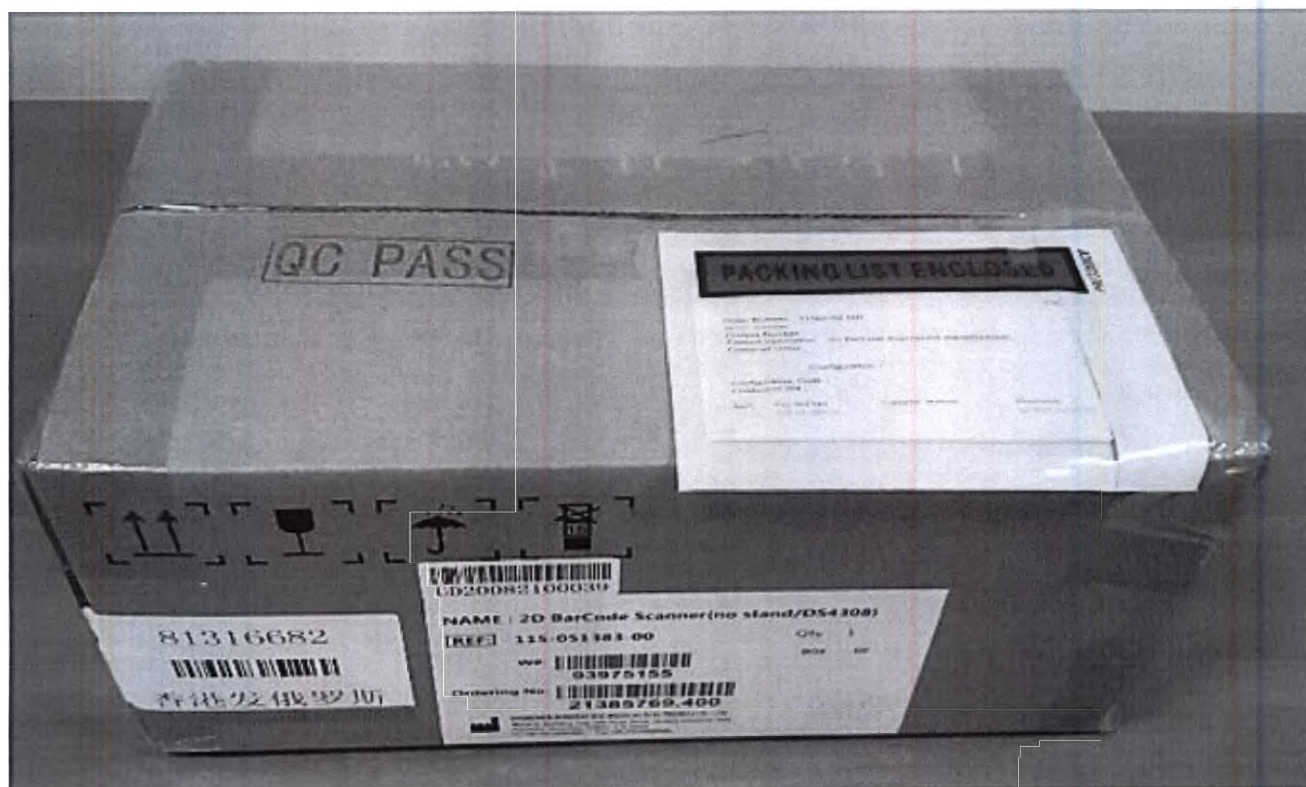


Сканеры штрих-кодов.
Гранспортная упаковка. Вид сбоку.



Комплект для подключения микрофона беспроводного. Потребительская упаковка. Вид сбоку

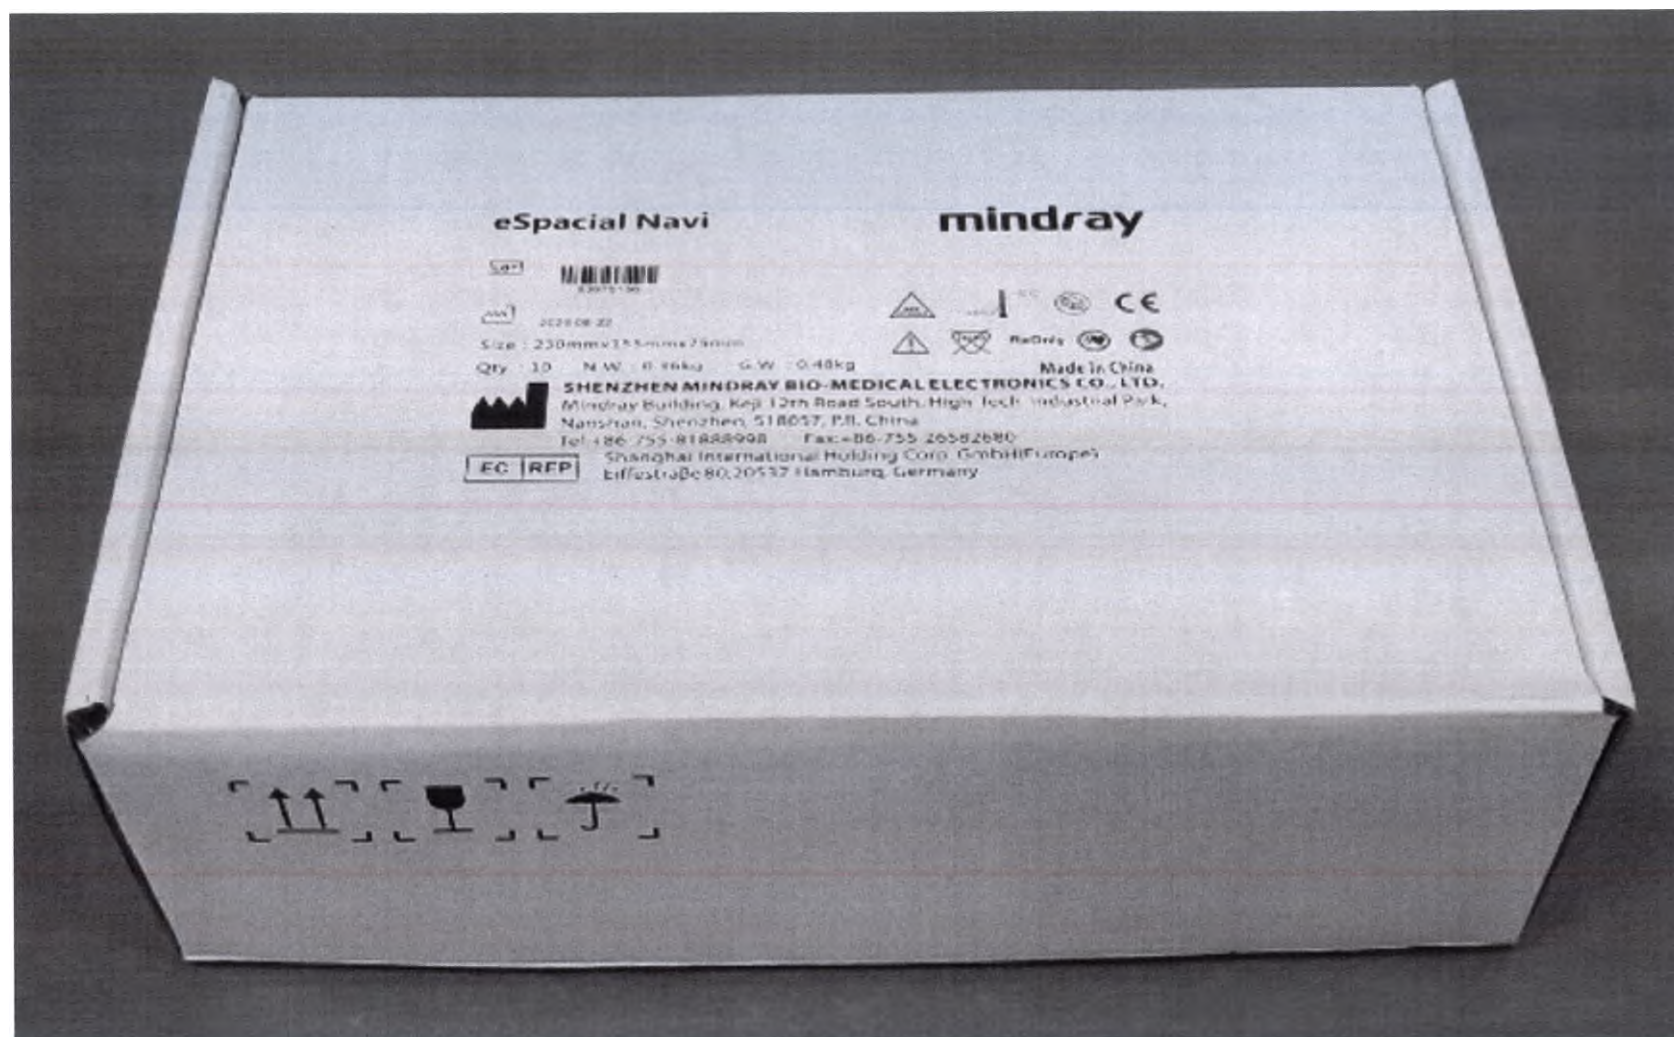


Устройство для игл намагничивающее. Потребительская упаковка. Вид сверху.

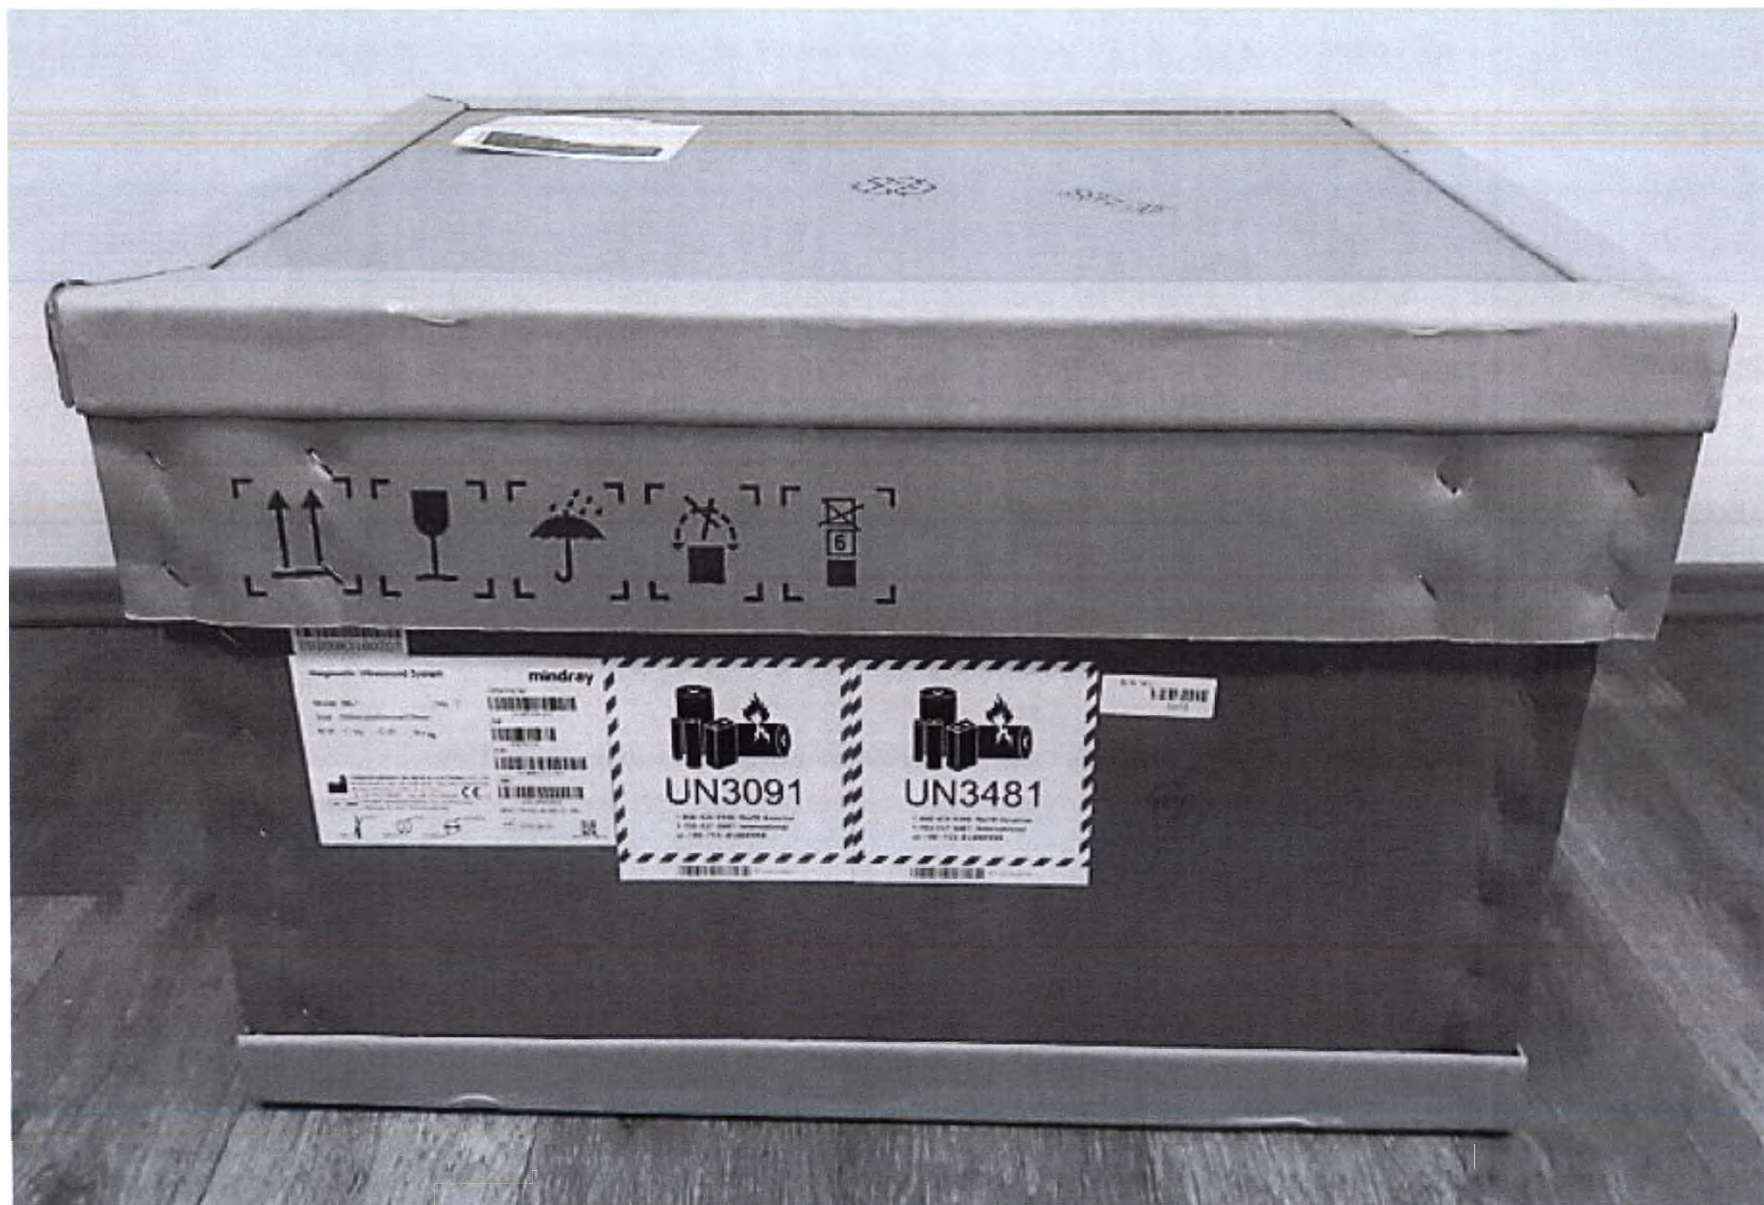

Транспортная упаковка:

Кейс для транспортировки. Вместе с кейсом для транспортировки упаковывается: Основной блок, Накладка на панель управления с переводом на русский язык, Адаптер питания AC-DC, Кабель питания адаптера AC-DC, Накладка на панель управления защитная.

**Пример упаковки
Датчиков ультразвуковых**

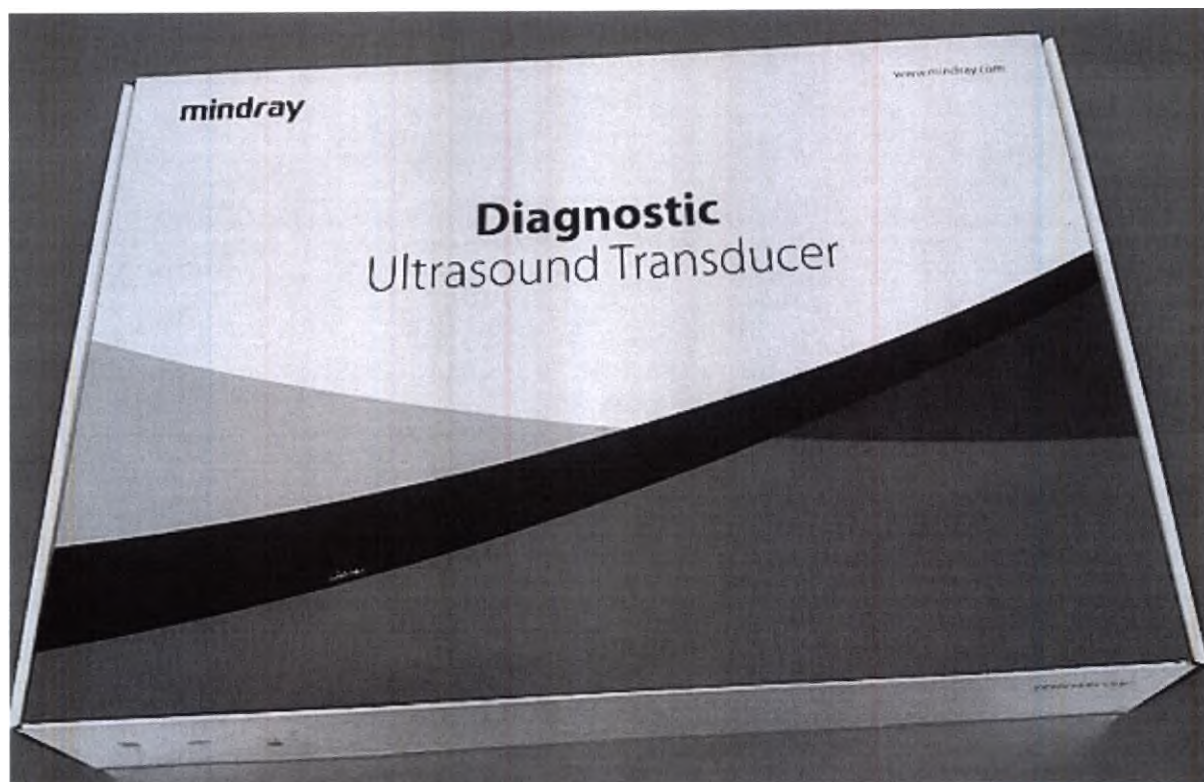

Потребительская упаковка. Вид сверху 1.



Потребительская упаковка. Вид сверху 2.

mindray
Healthcare within reach

DIAGNOSTIC Ultrasonic Transducer

7LT4s



Ordering No. 03345791

VW 97109011

PIN 120 021859 00

ML YOS100286

2020-02-21



IC1:04457690141854
111 001221
121 PIN YOS100286

Ultrasonic Transducer

CE
Qty.: 1

N.W.: 0.6 kg

G.W.: 1.5 kg

Size: 450mmx280mmx80mm

-20°C 50°C

10% 95%


50 DaPa 100 DaPa

SHENZHEN MINDRAY MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, No. 17th Road South, High-tech Industrial Park,
Hongshan, Shenzhen, 518057, P. R. China
Tel: +86-755-83333333 Fax: +86-755-21122000


Shanghai International Medical Corp. (Shanghai) Co., Ltd.
Erfenstrasse 60, 20537 Hamburg, Germany
Made in China

www.mindray.com

Потребительская упаковка. Вид снизу

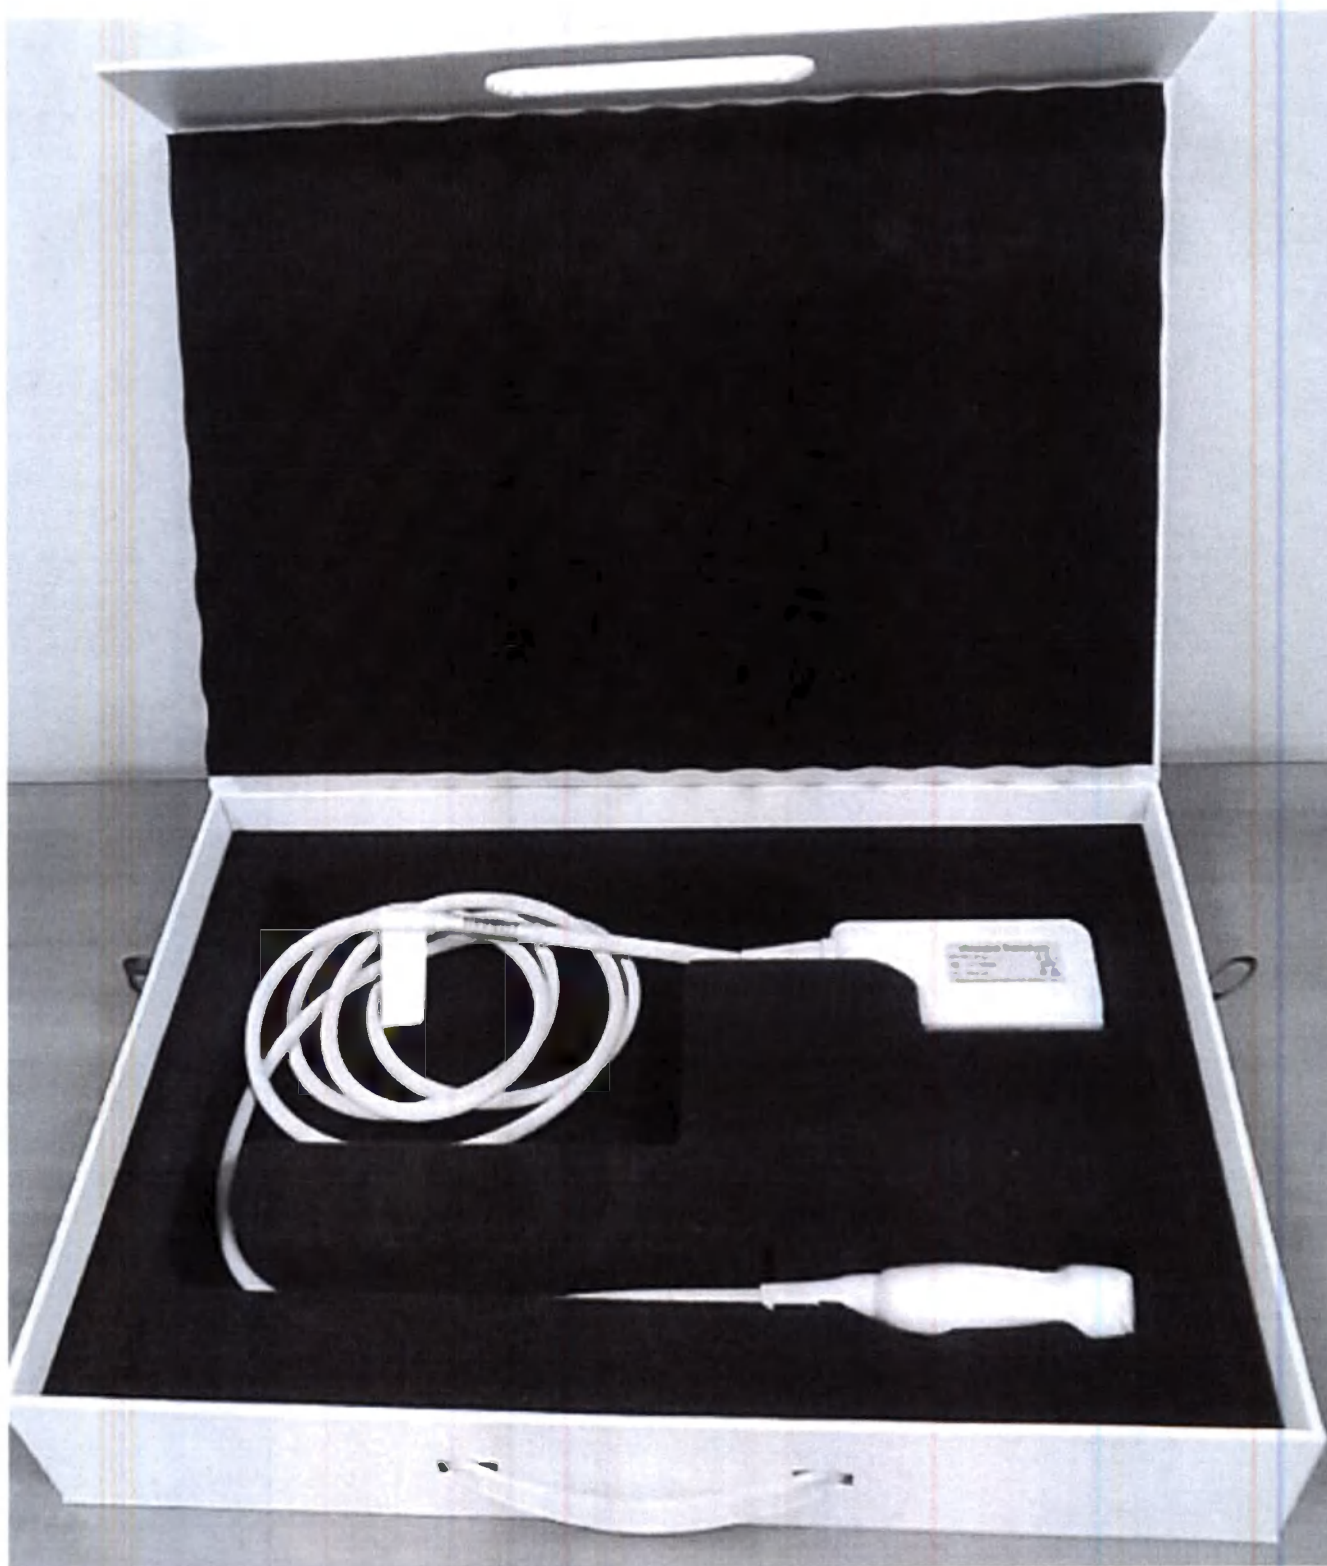

Потребительская упаковка. Вид внутри 1

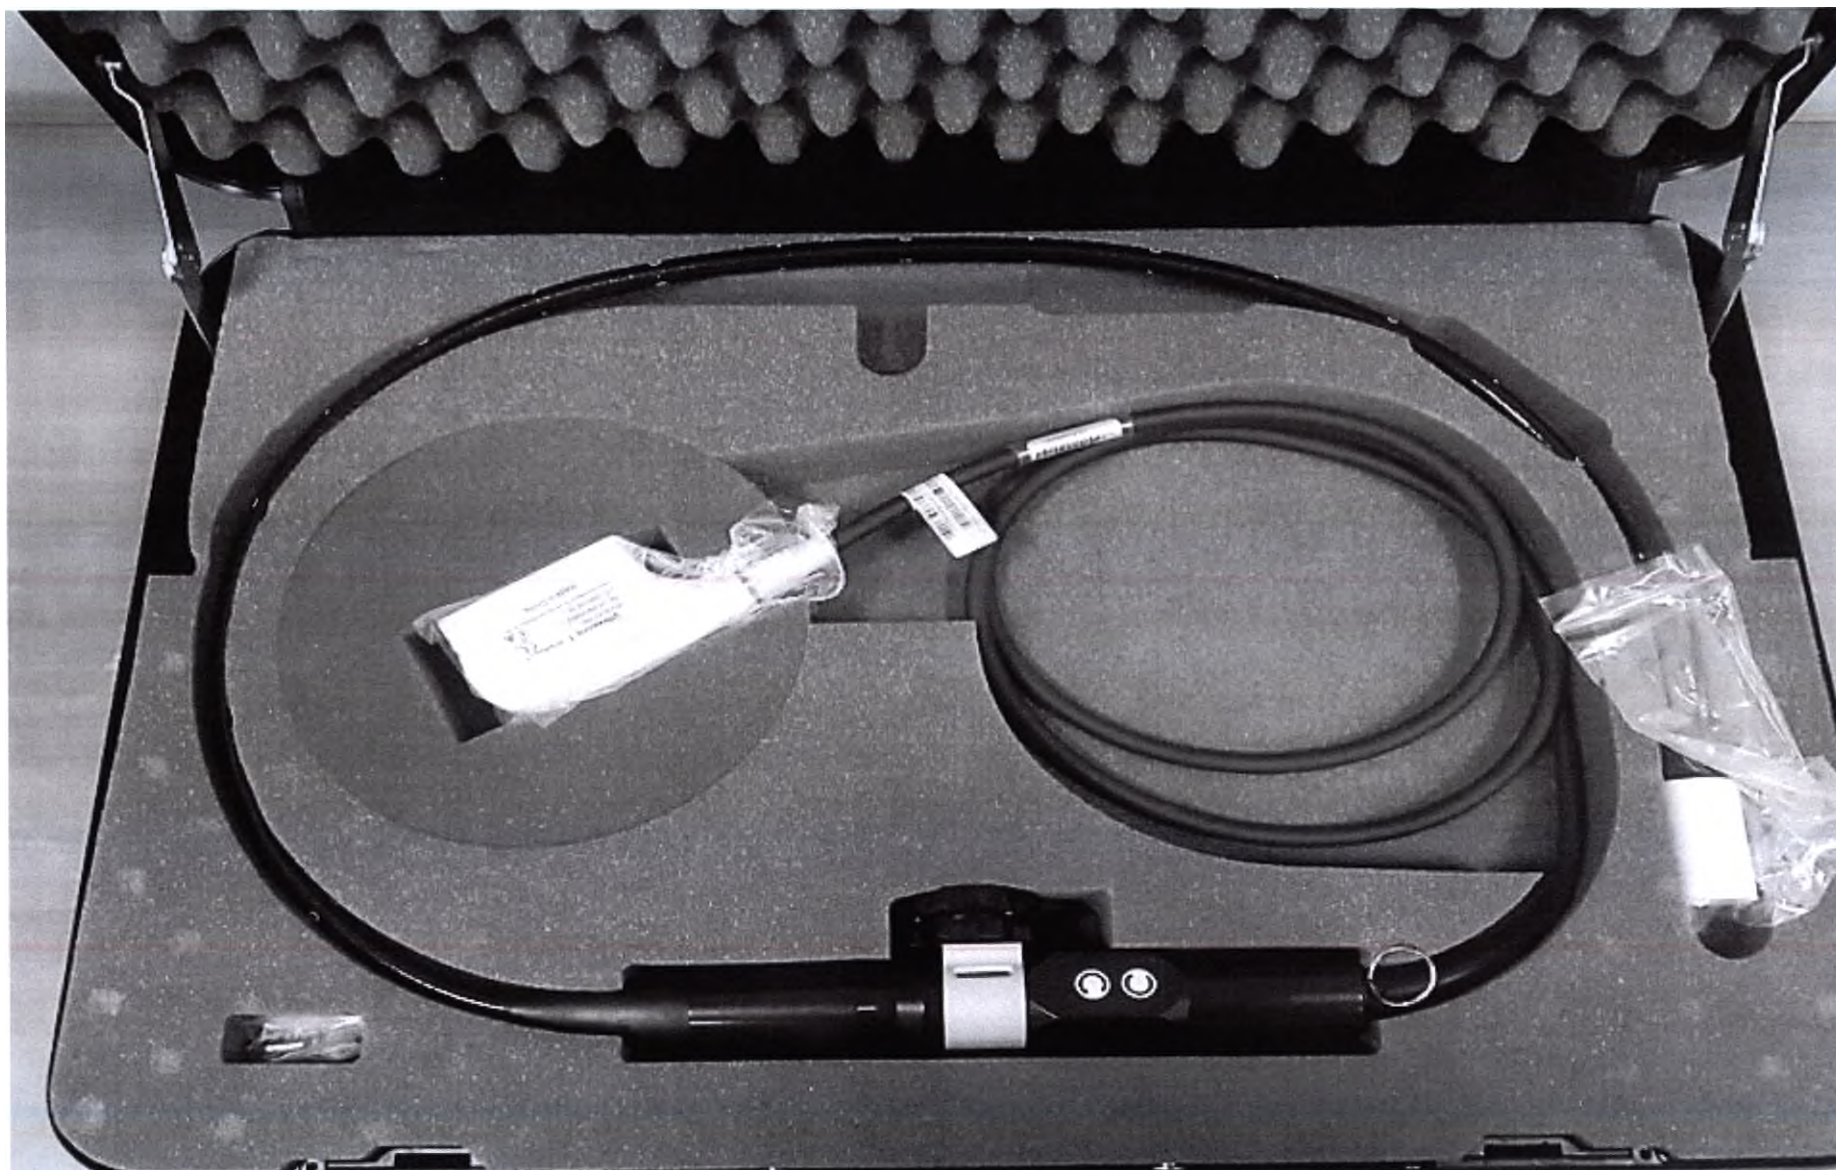

Кейс для транспортировки датчиков:
Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный Р7-3Ts,
Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный Р8-3Ts.
Вид внутри



Кейс для транспортировки датчиков:
Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный Р7-3Ts,
Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный Р8-3Ts,
в транспортной упаковке. Вид сверху

Пример упаковки Насадки биопсийные:




Потребительская упаковка. Вид сверху



Транспортная упаковка. Вид сверху.

Пример упаковки Модуль ЭКГ (ECG Module)

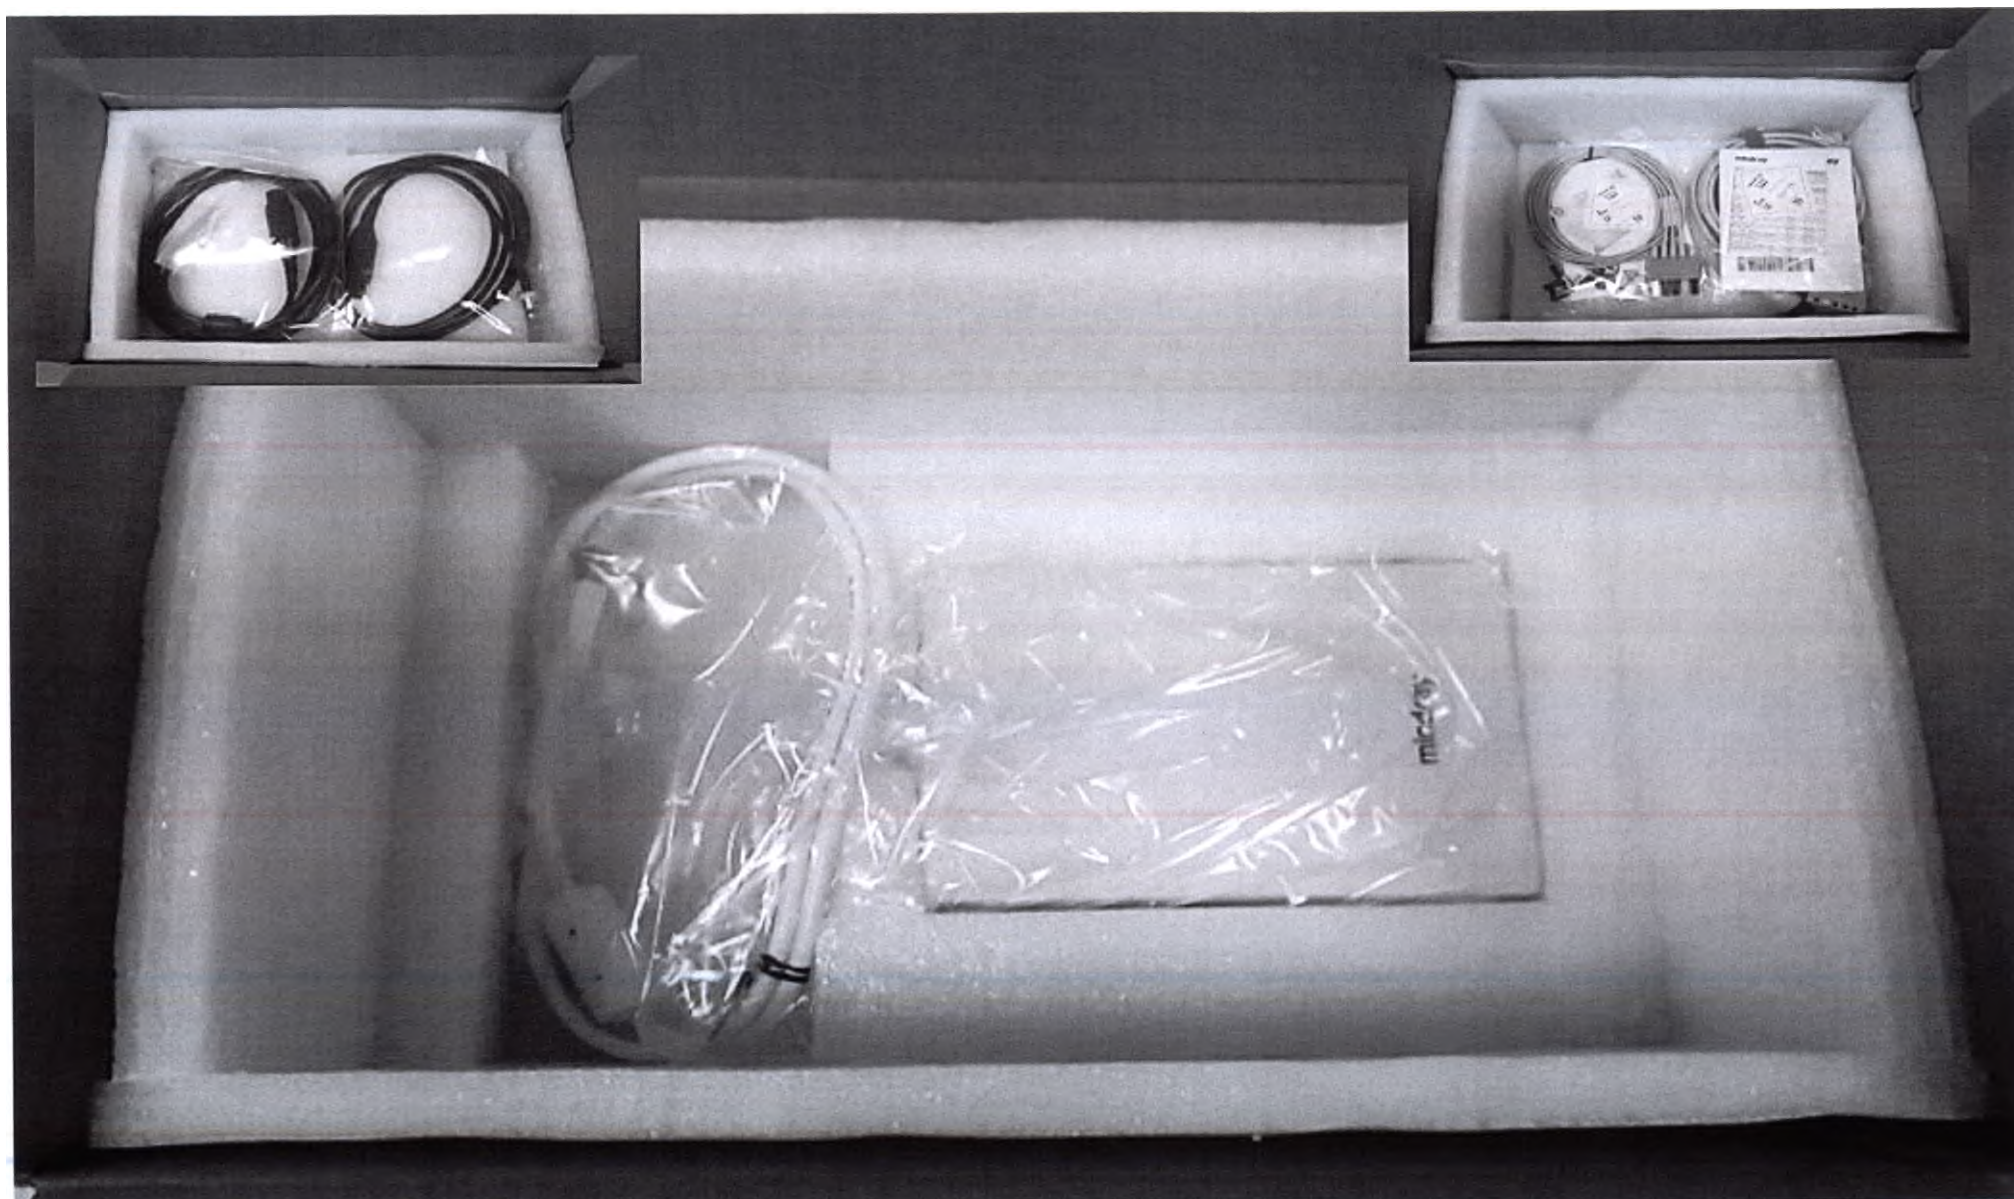

Модуль ЭКГ (ECG Module). Транспортная упаковка. Вид внутри.




Модуль ЭКГ (ECG Module), вместе упаковывается: Кабель ЭКГ магистральный 3/5 отведений взрослый/ детский и Провод ЭКГ на 3 отведения взрослый/детский, типа зажим; Кабель для вывода цифрового видеосигнала с разъемом типа DB 9 (COM) и Кабель для вывода аналогового видеосигнала с разъемом типа BNS. Транспортная упаковка. Вид сбоку.




Модуль-разветвитель на два порта для подключения датчиков. Потребительская упаковка. Вид сверху

Пример упаковки Ножной переключатель

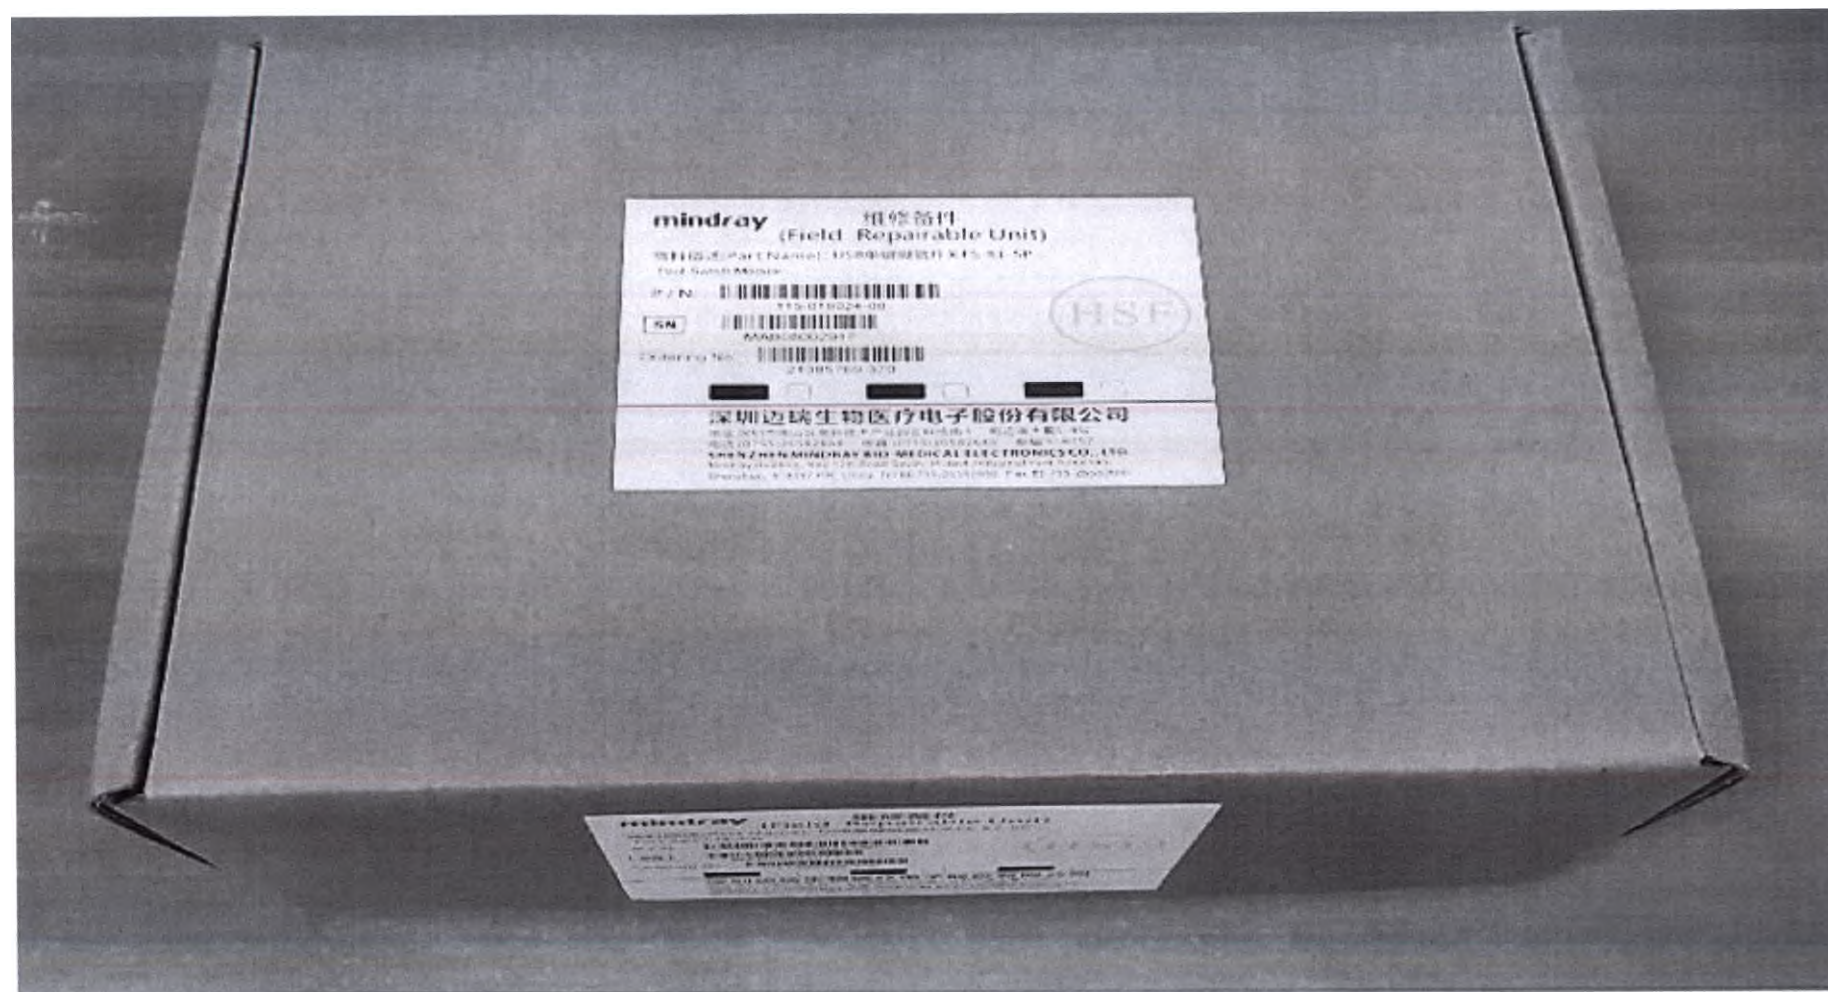


Ножной переключатель: 1 клавиша, 2 клавиши, 3 клавиши. Потребительская упаковка. Вид сверху

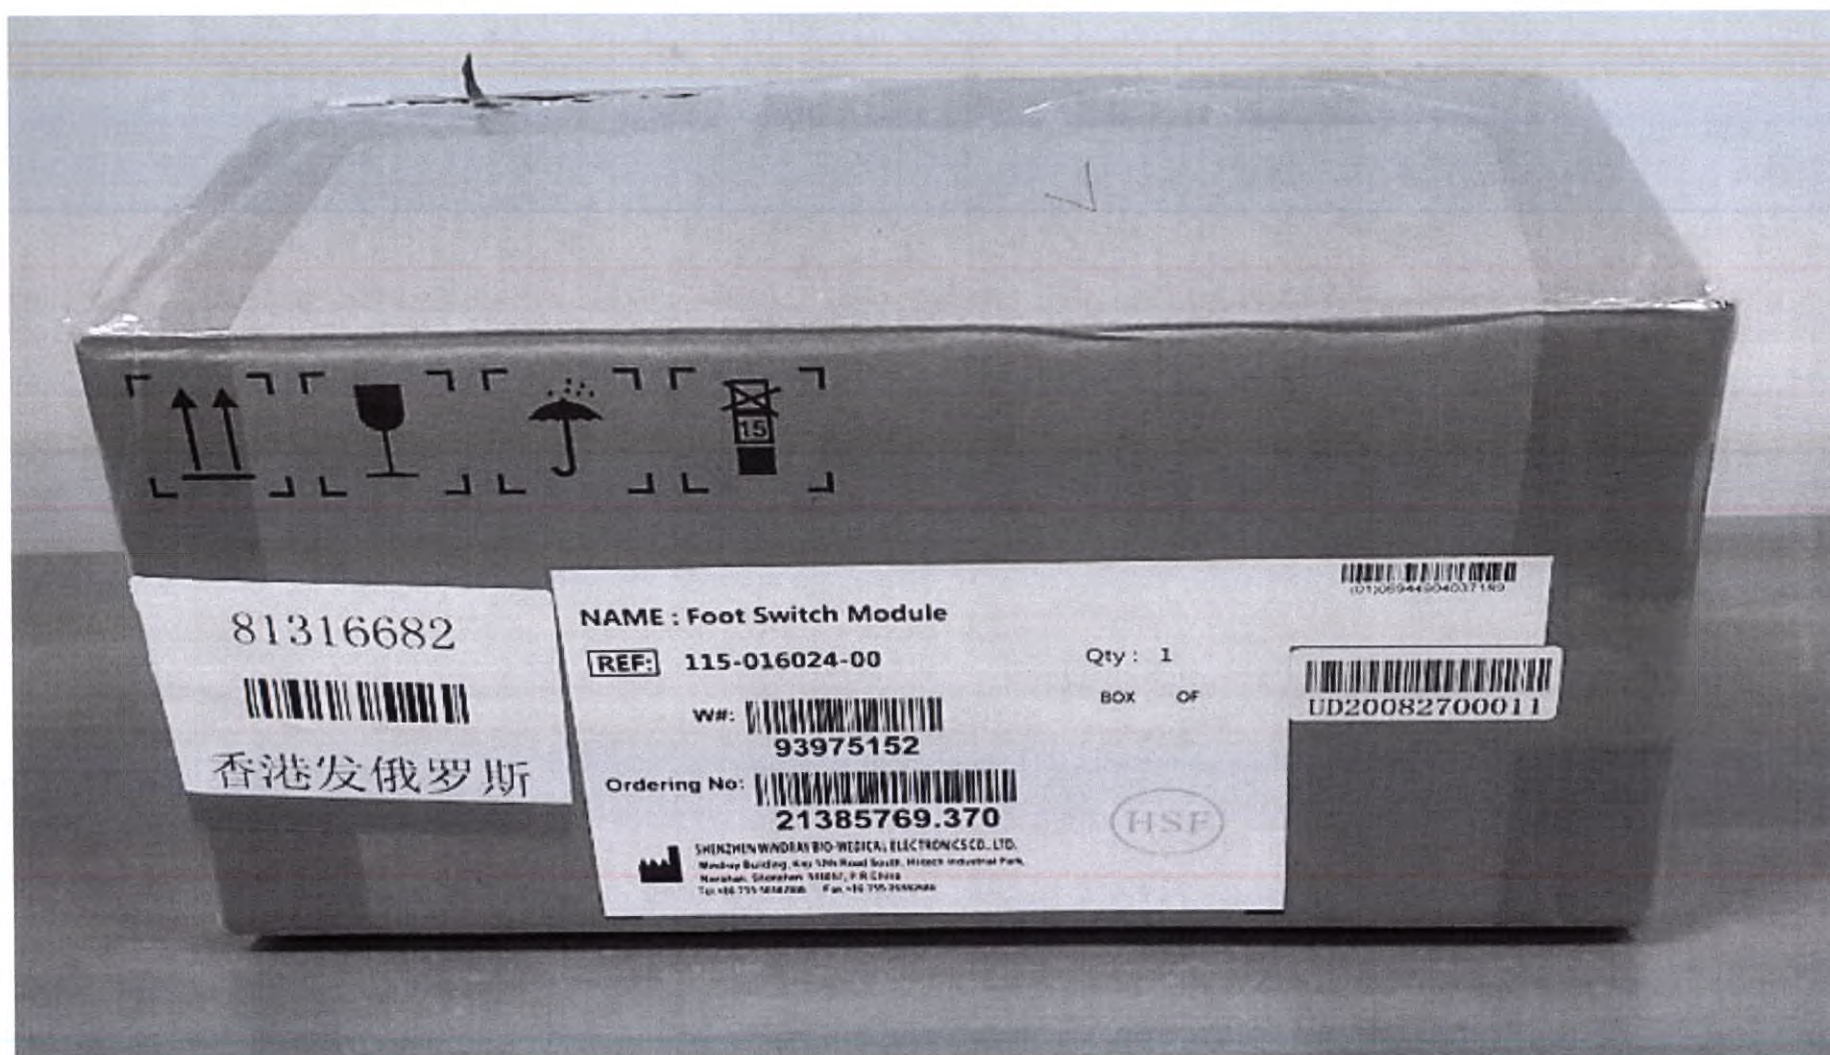

Ножной переключатель: 1 клавиша, 2 клавиши, 3 клавиши. Транспортная упаковка. Вид сверху.

Пример упаковки Тележка мобильная МТЗ

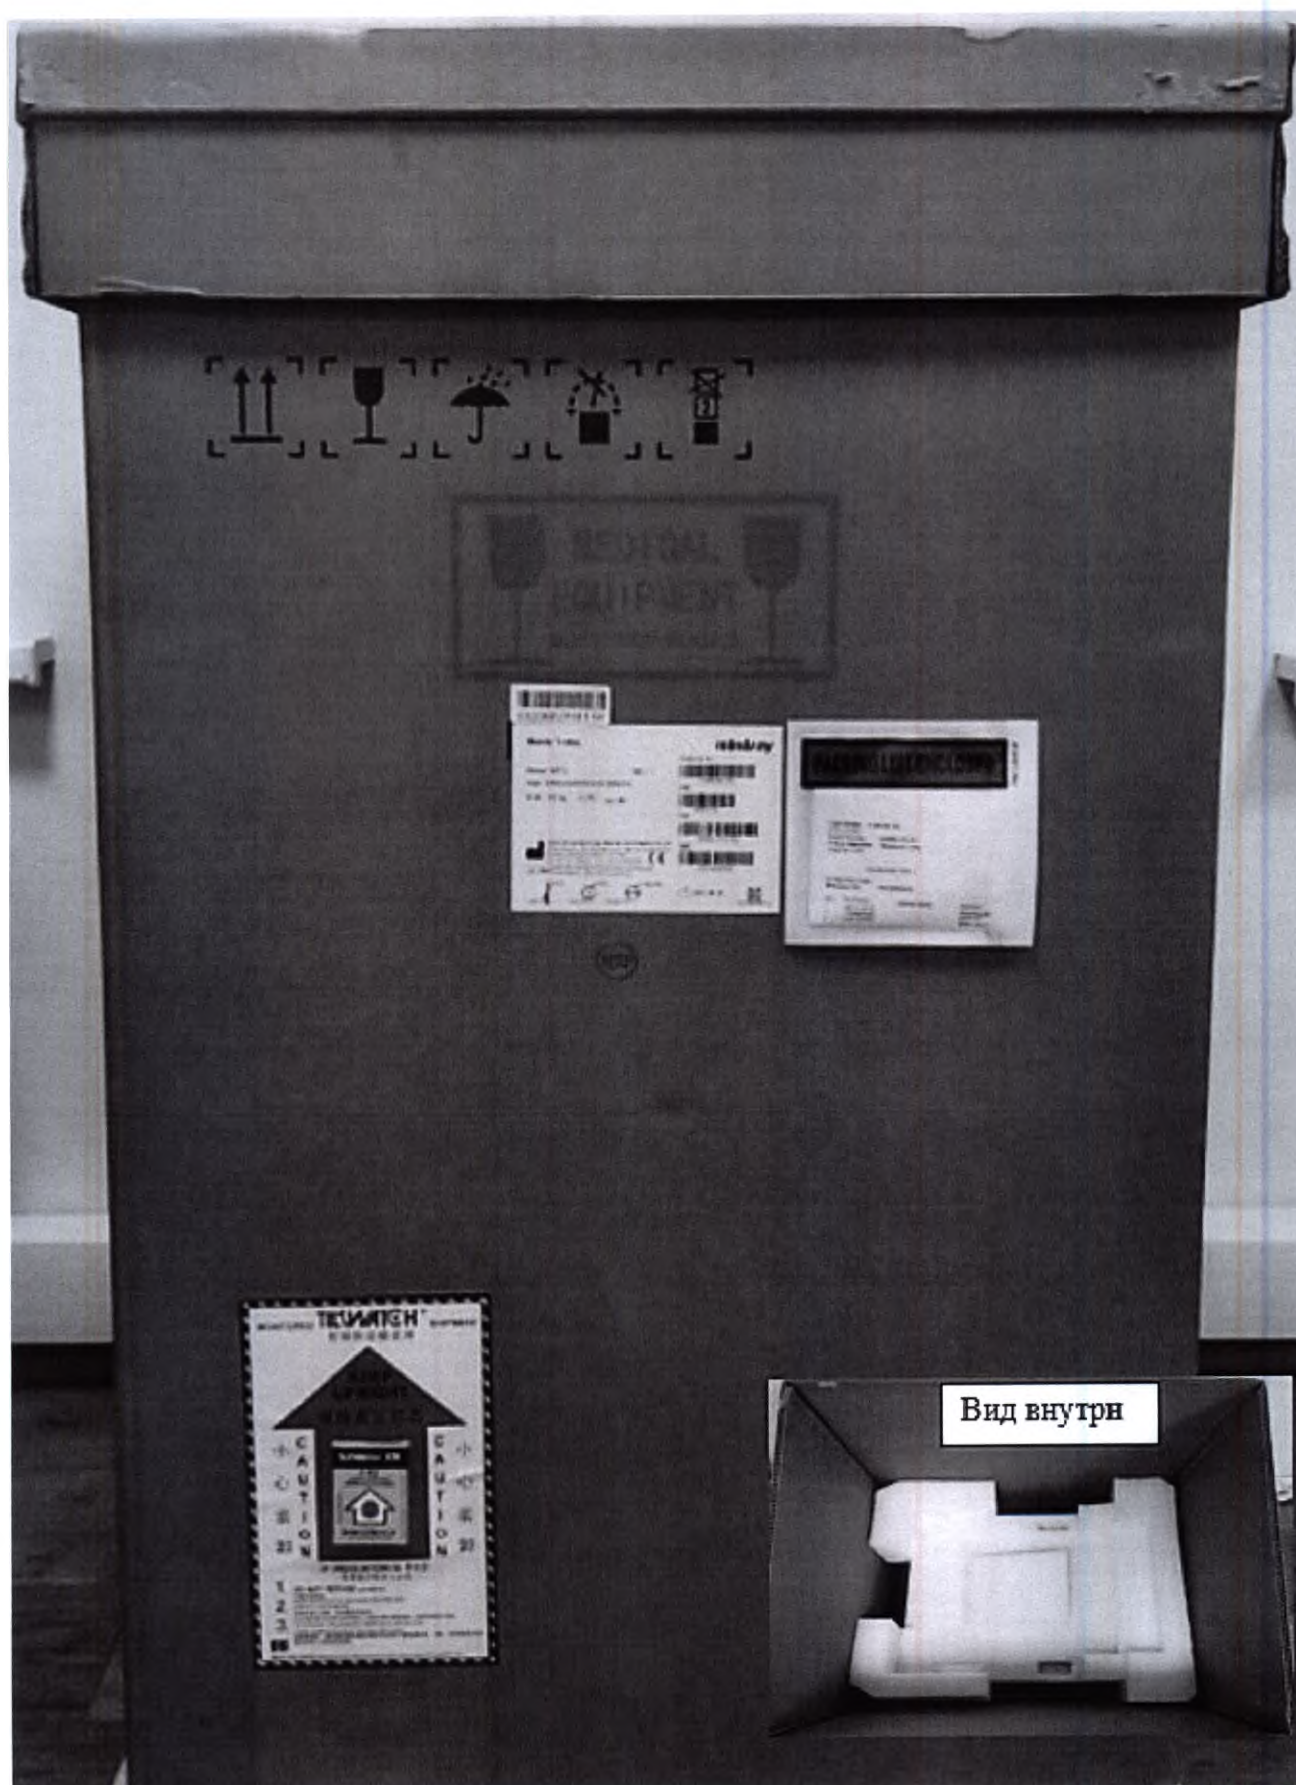

Пример макета маркировки на изделиях:
Основной блок

mindray

Diagnostic Ultrasound System

Model: XXXXXXXX



00000000



XXXXXXXX

19V 7.9A(MAX.)



047-033350-00(1.0)



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China



Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

XXXXXXXX

Пример макета маркировочной этикетки на корпусе, на английском языке.

Наименование изделия на русском языке

Модель: XXX

Регистрационное удостоверение

№ РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX года



Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. («Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.»), KHP
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, 518057
Shenzhen, People's Republic of China

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «Миндрей Медикал Рус»


Адрес: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д.16, стр.5, антресоль 4, помещение I, ком. 7, 11А

Тел.: (499) 553-60-36, факс: (499) 553-60-39


E-mail: info.ru@mindray.com

Пример макета дополнительной маркировочной этикетки на корпусе, на русском языке.

**Пример макета маркировочной этикетки на корпусе
Датчиков ультразвуковых**

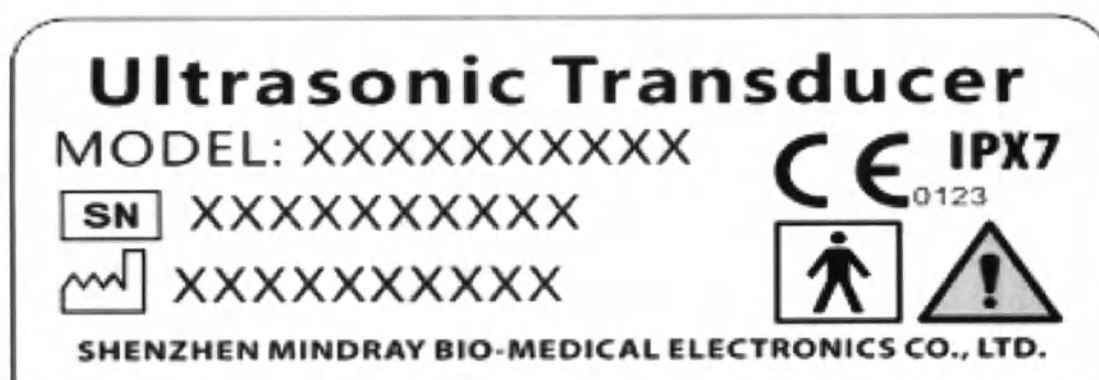

Пример макета маркировочной этикетки на корпусе, на английском языке.

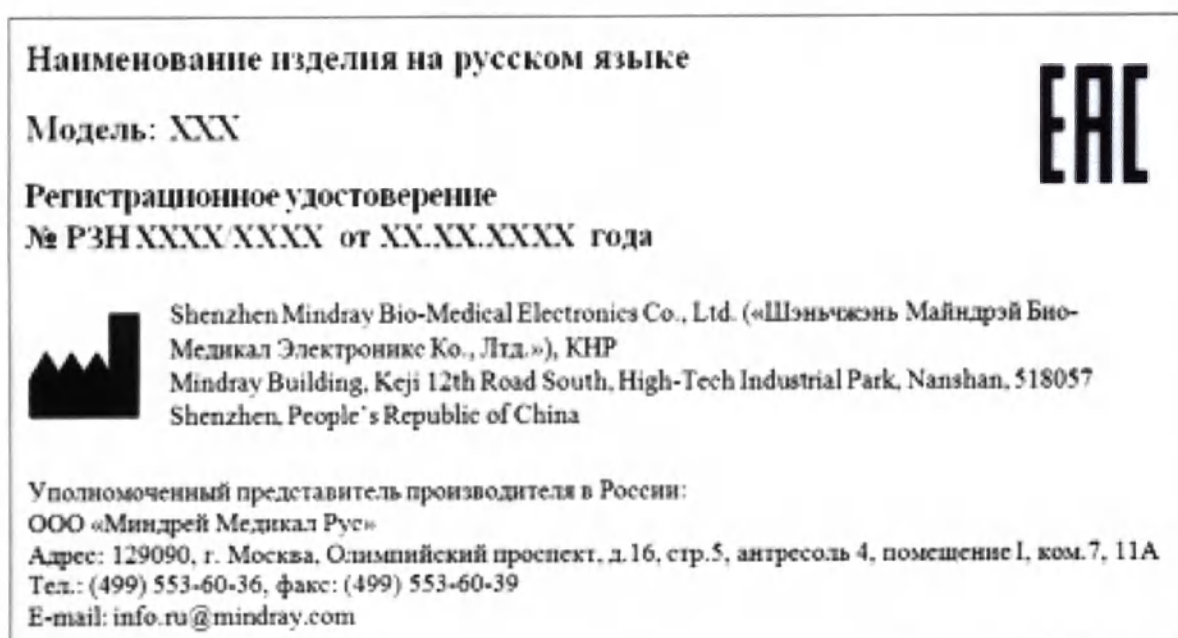

Пример макета дополнительной маркировочной этикетки на корпусе, на русском языке.

**Пример макета маркировочной этикетки на корпусе
комплекта для подключения микрофона беспроводного**



Пример макета маркировки передатчика на
английском языке



Пример макета маркировки передатчика на
русском языке




Пример макета маркировки приемника на
английском языке



Пример макета маркировки приемника на
русском языке

Пример макета маркировочной этикетки на корпусе Модуля ЭКГ

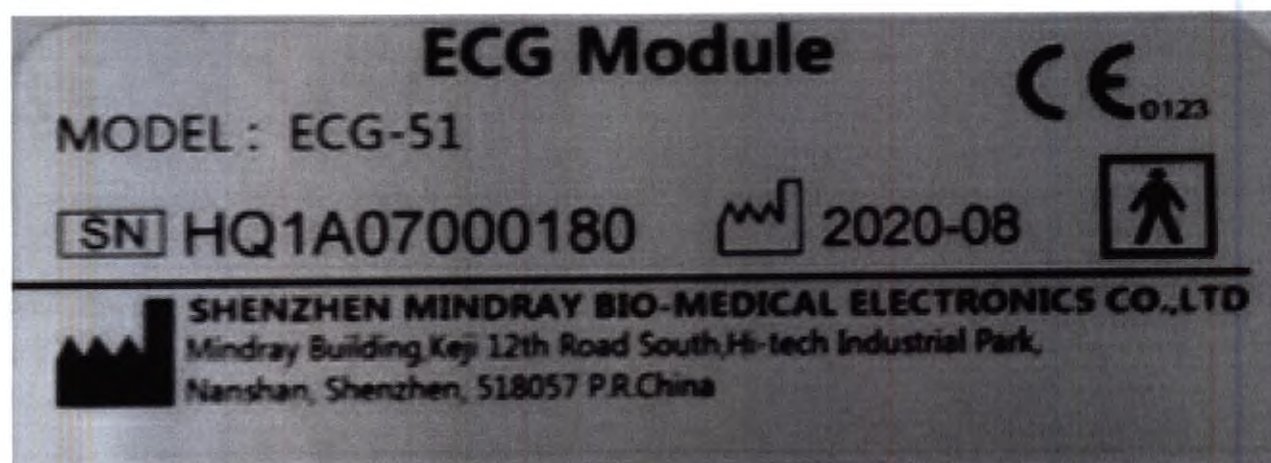


Пример макета маркировочной этикетки на корпусе, на английском языке.

Наименование изделия на русском языке		EAC
Модель: XXX		
Регистрационное удостоверение № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX года		
	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. («Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.»), КНР Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, 518057 Shenzhen, People's Republic of China	
Уполномоченный представитель производителя в России: ООО «Миндрей Медикал Рус» Адрес: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д.16, стр.5, антресоль 4, помещение I, ком.7, 11А Тел.: (499) 553-60-36, факс: (499) 553-60-39 E-mail: info.ru@mindray.com		

Пример макета дополнительной этикетки на корпусе модуля ЭКГ
на русском языке

Пример макета маркировочной этикетки на корпусе модуля-разветвителя на два порта для подключения датчиков

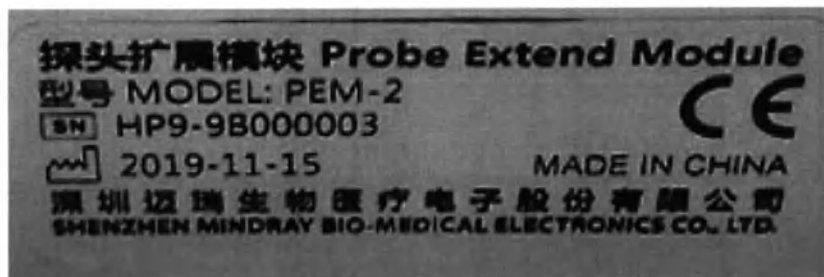

Пример макета маркировки на корпусе модуля-разветвителя на два порта для подключения датчиков на английском языке




Пример макета дополнительной этикетки на корпусе модуля-разветвителя на два порта для подключения датчиков на русском языке

Пример макета маркировочной этикетки на корпусе Тележки мобильной МТЗ



Пример макета маркировочной этикетки на корпусе, на английском языке.

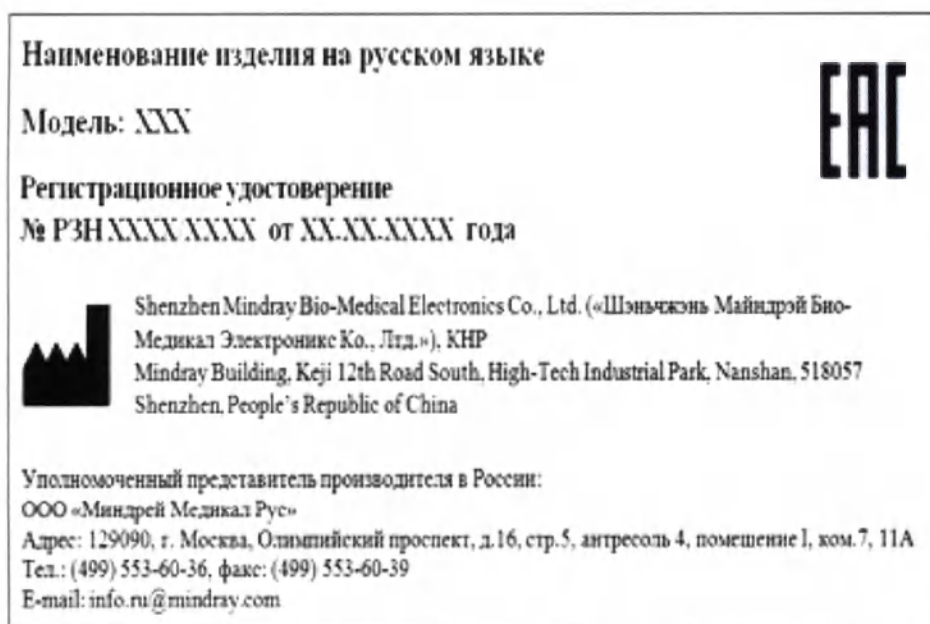

Пример макета дополнительной этикетки на корпусе тележки мобильной МТЗ на русском языке

Пример макета маркировочной этикетки на упаковке.
Сканеров штрих-кодов

NAME : 2D BarCode Scanner(no stand/DS4308)

REF: 115-051383-00 Qty: 1

W#: 
93975155 BOX OF

Ordering No: 
21385769.400

 **SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.**
Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R.China
Tel: +86-755-56582888 Fax: +86-755-26582680



Пример макета маркировочной этикетки на упаковке, на английском языке.

Наименование: Сканнер штрих-кодов 2D

Регистрационное удостоверение
№ РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX года

REF XXX-XXX Кол-во ____

W# 
XXXXXXXXXXXX



Ordering No.: XX-XXXXXXXXXX

 **Shenzhen mindray bio-medical electronics co., ltd.**
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, 518057
Shenzhen, P.R. China
Тел.: +86 755 81888998 Факс: +86 755 26582680
ООО «Миндрей Медикал Рус»
Адрес: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д.16, стр.5, антресоль 4,
помещение I, ком.7, 11А
Тел.: (499) 553-60-36, факс: (499) 553-60-39
E-mail: info.ru@mindray.com


RUS REP

Пример макета маркировочной этикетки на упаковке, на русском языке.

**Пример макета маркировочной этикетки на упаковке.
Комплект для подключения микрофона беспроводного**

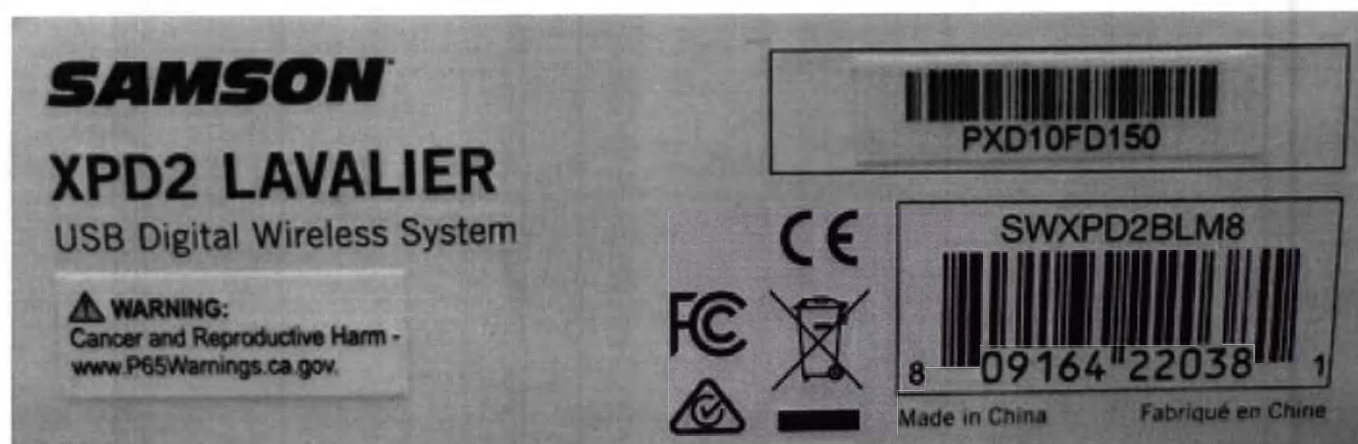

Пример макета маркировочной этикетки на упаковке, на английском языке.

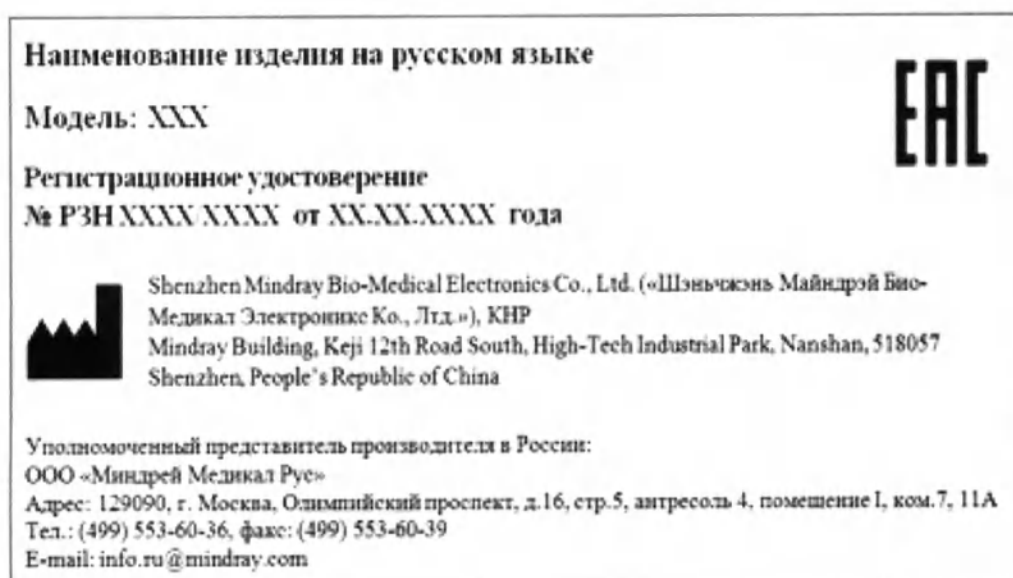

**Пример макета дополнительной этикетки на упаковке комплекта для подключения
микрофона беспроводного на русском языке**

Пример макета маркировочной этикетки на упаковке.
Устройство для игл намагничивающее




Пример макета маркировочной этикетки на упаковке, на английском языке.

Наименование изделия на русском языке		
Модель: XXX		
Регистрационное удостоверение № РЗН XXXX XXXX от XX.XX.XXXX года		
	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. («Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.»), КНР Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, 518057 Shenzhen, People's Republic of China	
Уполномоченный представитель производителя в России: ООО «Миндрей Медикал Рус» Адрес: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д.16, стр.5, антресоль 4, помещение I, ком.7, 11А Тел.: (499) 553-60-36, факс: (499) 553-60-39 E-mail: info.ru@mindray.com		

Пример макета дополнительной этикетки устройства для игл намагничивающего

Пример макета маркировочной этикетки на упаковке. Кейс для транспортировки

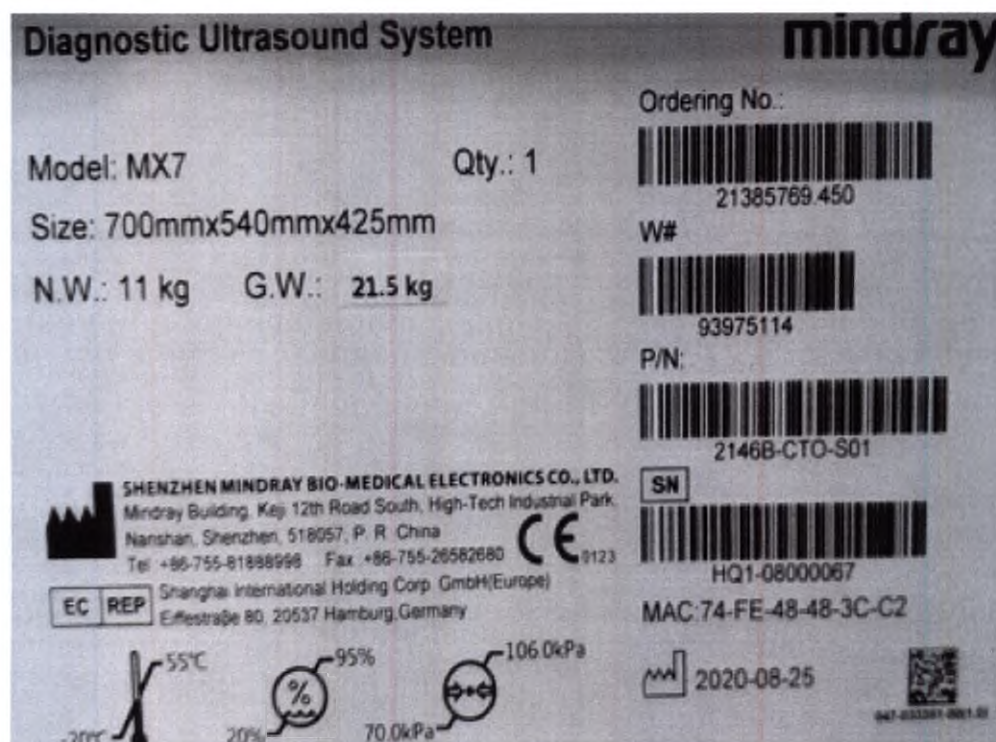

Пример макета маркировочной этикетки на упаковке, на английском языке.



Пример макета маркировочной этикетки на упаковке, на русском языке.

Датчики ультразвуковые

Пример макета маркировочной этикетки на упаковке.
Датчики ультразвуковые

XXXXXX			
		Ordering No.: XX-XXXXXXXXXX	
			
		W#: XXXXXXXX	
			
		P/N: XXX-XXXXXX-XX	
			
		SN: XX-XXXXXXXX	
 XXXX-XX-XX			
		(01)00000000000000 (21)XXXXXX (11)00000000	
Ultrasonic Transducer			
N.W.: X.XX kg		G.W.: X.XX kg	
Size: XXXmmxXXXmmxXXXmm			
 XX°C		 XX%	
		XX.XXPa	
 SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. Mindray Building, Keji 12th Road South, HighTech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China Tel: +8675581888998 Fax: +8675526582680 Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe) Elffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany			
		Made in China	


Пример макета маркировочной этикетки на упаковке, на английском языке.

XXXXXX			
		Ordering No.: XX-XXXXXXXXXX	
			
		W#: XXXXXXXX	
			
		P/N: XXX-XXXXXX-XX	
			
		SN: XX-XXXXXXXX	
 XXXX-XX-XX			
		(01)00000000000000 (21)XXXXXX (11)00000000	
Датчик Ультразвуковой			
Регистрационное удостоверение			
№ РЭН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX года			
И-во: __ Масса Нетто: __ кг Масса Брутто: __ кг			
Размер: XXXмм x XXXмм x XXXмм			
 XX°C		 XX%	
		XX.XXPa	
 Shenzhen mindray bio-medical electronics co., ltd. Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, 518057 Shenzhen, P.R. China Tel.: +86 755 81888998 Факс: +86 755 26582680			
ООО «Миндрай Медикал Рус»			
Адрес: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 56, стр.5, антресоли 4, помещение I, ком.7, 51А			
Тел.: (499) 553-60-36, факс: (499) 553-60-39			
E-mail: info.rus@mindray.com			
		Made in China	

Пример макета маркировочной этикетки на упаковке, на русском языке.

Насадки биопсийные с направляющей для игл

Пример макета маркировочной этикетки на упаковке.
Насадок биопсийных с направляющей для игл

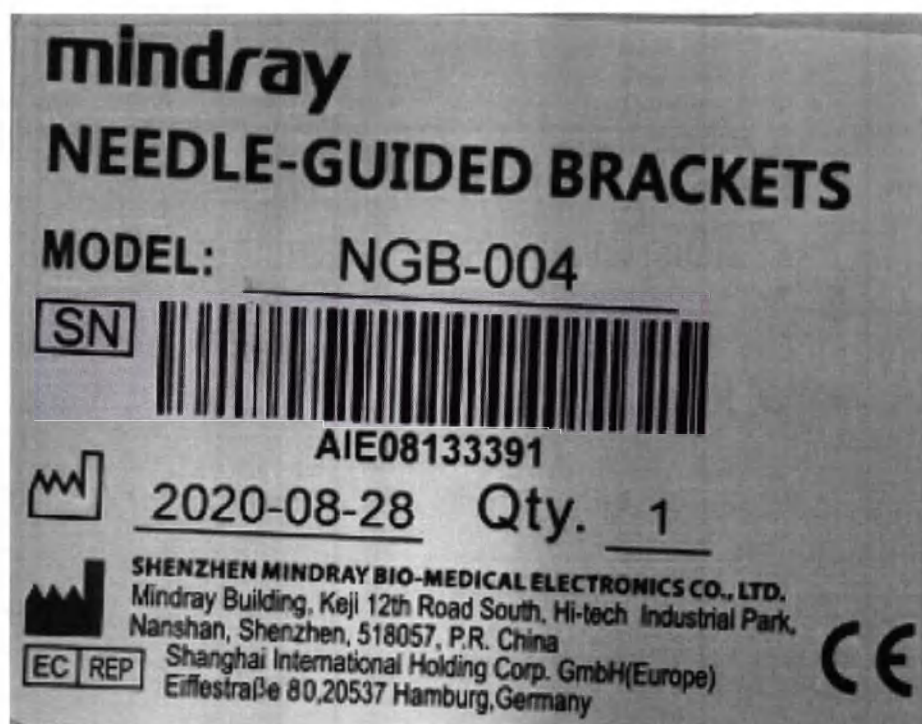

Пример макета маркировочной этикетки на упаковке, на английском языке.



Пример макета маркировочной этикетки на упаковке, на русском языке.

Пример макета маркировочной этикетки на упаковке. Модуль ЭКГ



Пример макета маркировочной этикетки на упаковке, на английском языке.




Пример макета маркировочной этикетки на упаковке, на русском языке.

**Пример макета маркировочной этикетки на упаковке.
Модуль-разветвитель на два порта для подключения датчиков**



Пример макета маркировочной этикетки на упаковке, на английском языке.

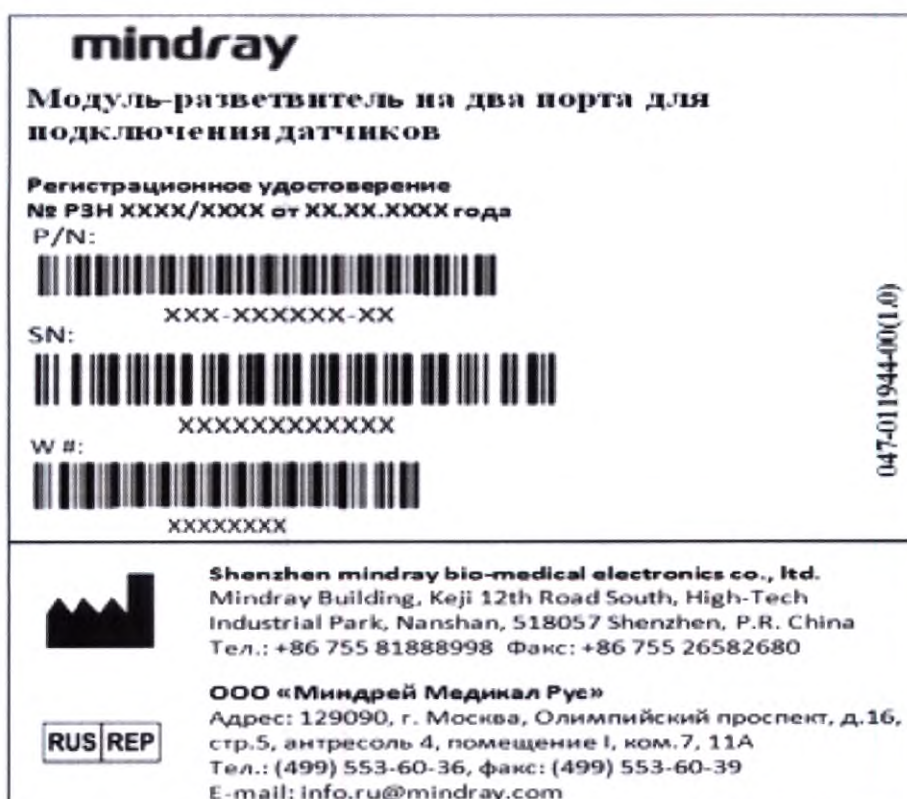

Пример макета маркировочной этикетки на упаковке, на русском языке.

**Пример макета маркировочной этикетки на упаковке.
Ножной переключатель: 1 клавиша, 2 клавиши, 3 клавиши**

NAME : Foot Switch Module

REF: 115-016024-00 **Qty :** 1

W#:  **BOX** **OF**

93975152

Ordering No:  **21385769.370**

 **SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.**
Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R.China
Tel:+86-755-56582688 Fax:+86-755-26582680



Пример макета маркировочной этикетки на упаковке, на английском языке.

Ножной переключатель

Регистрационное удостоверение
№ РЭН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX года

REF XXX-XXXXXX-XX **Кол-во:___**

W #:  **XXXXXXX**

Ordering NO:  **XXXXXXXX.XXX**

 **Shenzhen mindray bio-medical electronics co., ltd.**
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial
Park, Nanshan, 518057 Shenzhen, P.R. China
Тел.: +86 755 81888998 Факс: +86 755 26582680

ООО «Миндрей Медикал Рус»
Адрес: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д.16,
стр.5, антресоль 4, помещение I, ком.7, 11А
Тел.: (499) 553-60-36, факс: (499) 553-60-39
E-mail: info.ru@mindray.com

RUS REP

Пример макета маркировочной этикетки на упаковке, на русском языке.

Пример макета маркировочной этикетки на упаковке. Тележка мобильная МТЗ (без втягивающего кабеля) и Тележка мобильная МТЗ (с втягивающим кабелем)

Mobile Trolley

mindray

Model: XXXXXXXX

Size: 630mmx630mmx1080mm

Qty.: 1 N.W.: 35 kg G.W.:



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057 P. R. China




Tel: +86-755-81888998 Fax: +86-755-26582680
Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Elfenstraße 80, 20137 Hamburg Germany



00000000



XXXXXXXX



047-033375-00(2.0)



(01)00000000000000

(11)XXXXXXXX

(21)00000000

W#:




XXXXXXXX

P/N:



XXXXXXXX



XXXXXXXX

Пример макета маркировочной этикетки на упаковке, на английском языке.

Тележка мобильная МТЗ

mindray

Модель: XXXXXXXX

Регистрационное удостоверение
№ РЗН XXXX/XXXX от XXXX.XXXX года

Размер: XXXмм x XXXмм x XXXмм

К-во: __ Масса Нетто: __кг Масса Брутто: __кг

Shenzhen mindray bio-medical electronics co., ltd.
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech
Industrial Park, Nanshan, 518057 Shenzhen, P.R.
China
Tel.: +86 755 81888998 Факс: +86 755 26582680

RUS REP

ООО «Миндрей Медиал Рус»
Адрес: 129090, г. Москва, Олимпийский
проспект, д. 16, стр.5, антресоль 4, помещение 1,
ком.7, 11А
Тел.: (499) 553-60-36, факс: (499) 553-60-39
E-mail: info.ru@mindray.com

SN

Barcode for SN

00000000

Barcode for W#

XXXXXXXX

Temperature range icon: -20°C to 55°C

Humidity range icon: 10% to 75%

Pressure range icon: 70kPa to 106kPa

CE mark

0-47-033351-00 (2.0)

QR code

Barcode for registration

(01)00000000000000

(11)XXXXXXXX

(21)00000000

W#:

Barcode for W#

XXXXXXXXXXXXXXXX

P/N:

Barcode for P/N

XXXXXXXX


Barcode for P/N

XXXXXXXX

Пример макета маркировочной этикетки на упаковке, на русском языке.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью:
111 лист(а/ов)

Генеральный директор
ООО «Миндрей Медикал Рус»



Сыроева Н.В.

Чань Син