






**Мундштук картонный одноразовый к аппаратам для диагностики органов дыхания методом
спирометрии и газоанализа, без фильтра, МК-«ПАЙП»**

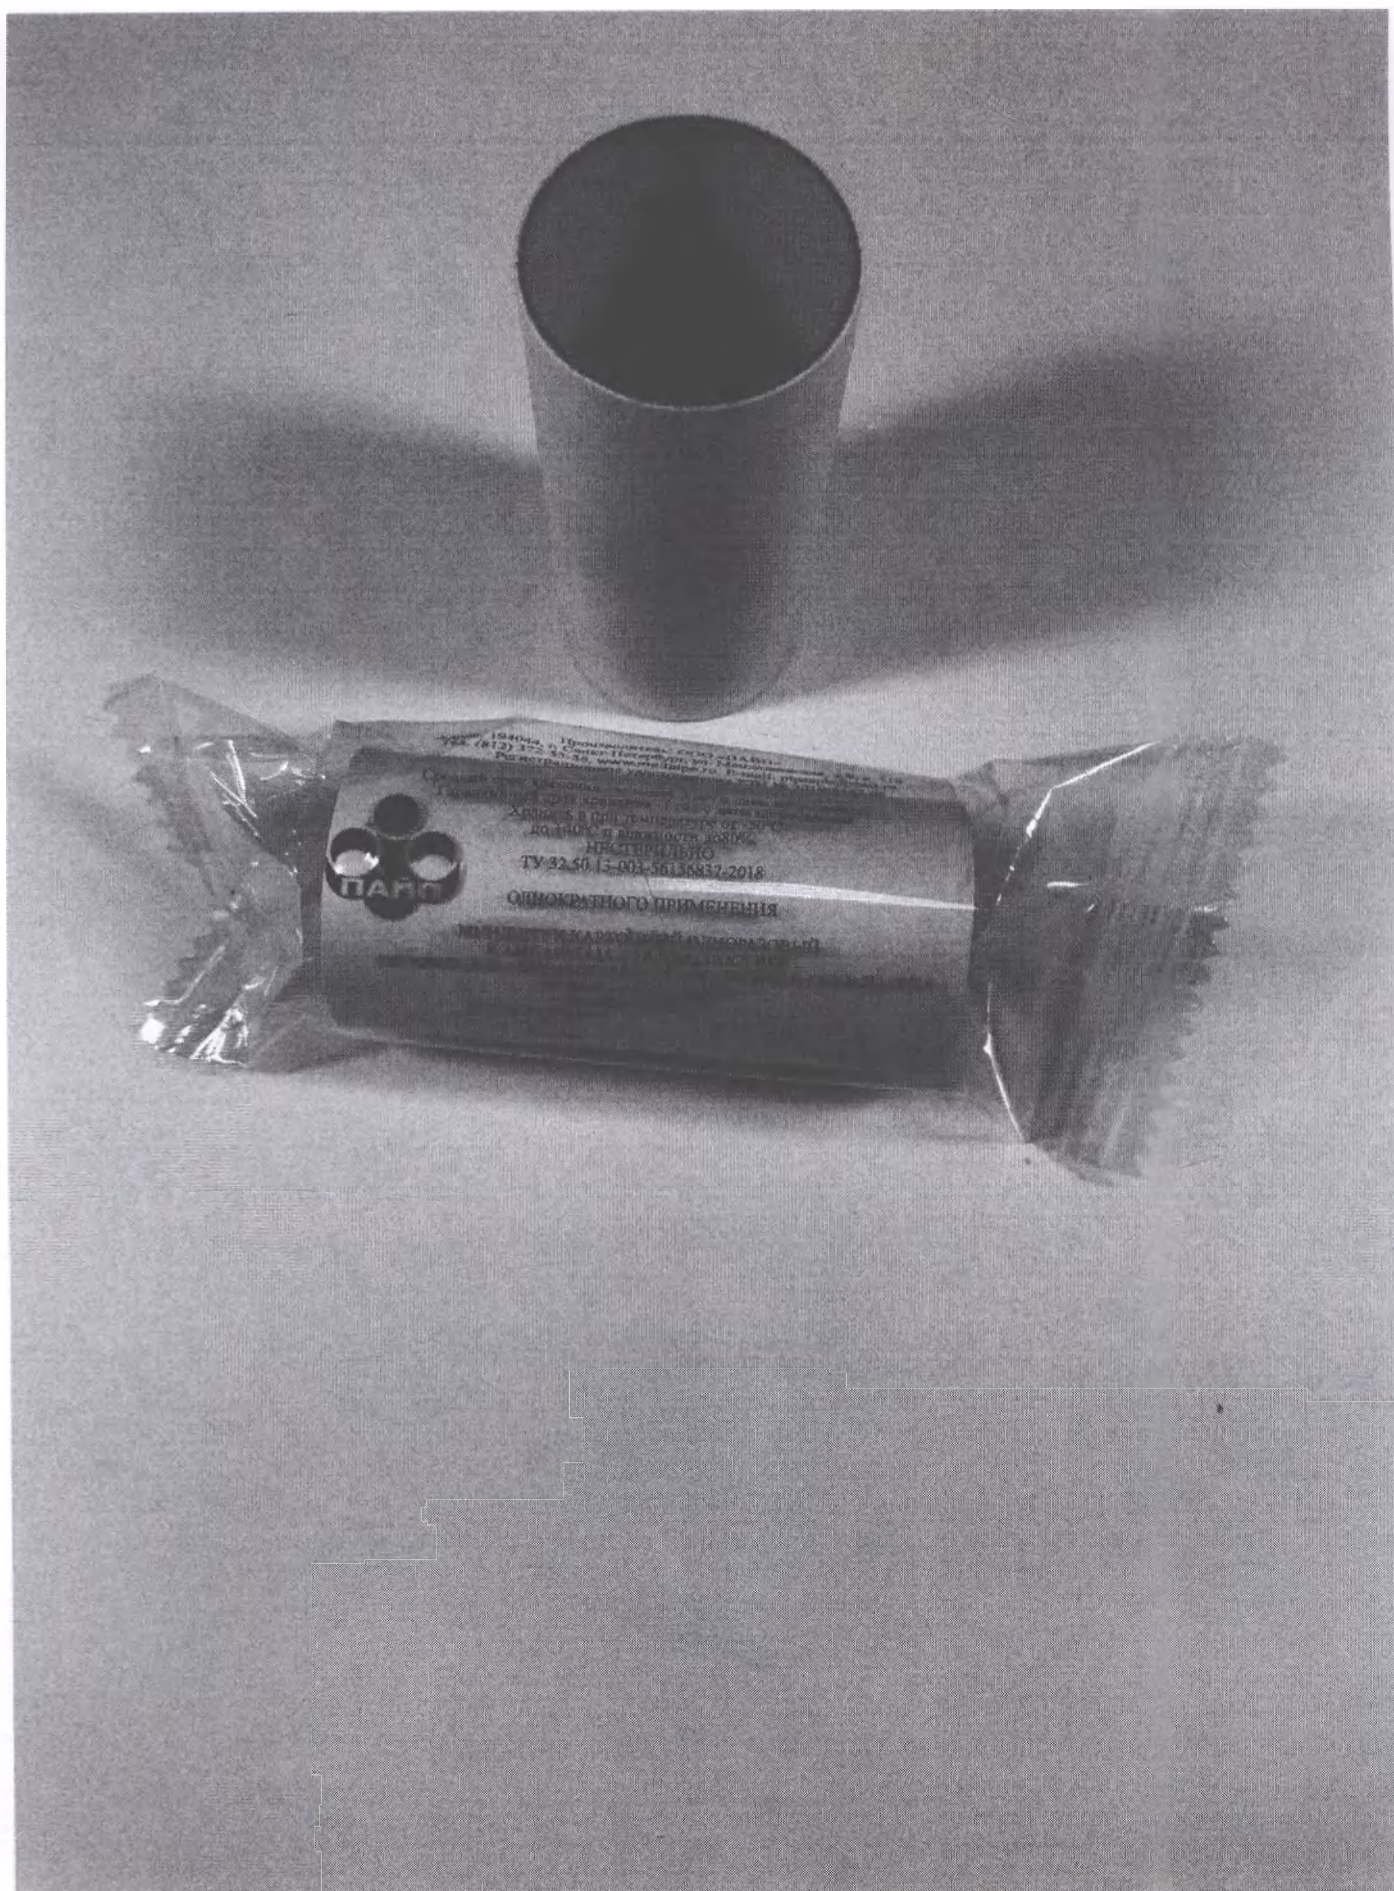


Мундштук картонный одноразовый к аппаратам для диагностики органов дыхания методом спирометрии и газоанализа, без фильтра, МКС-«ПАЙП»

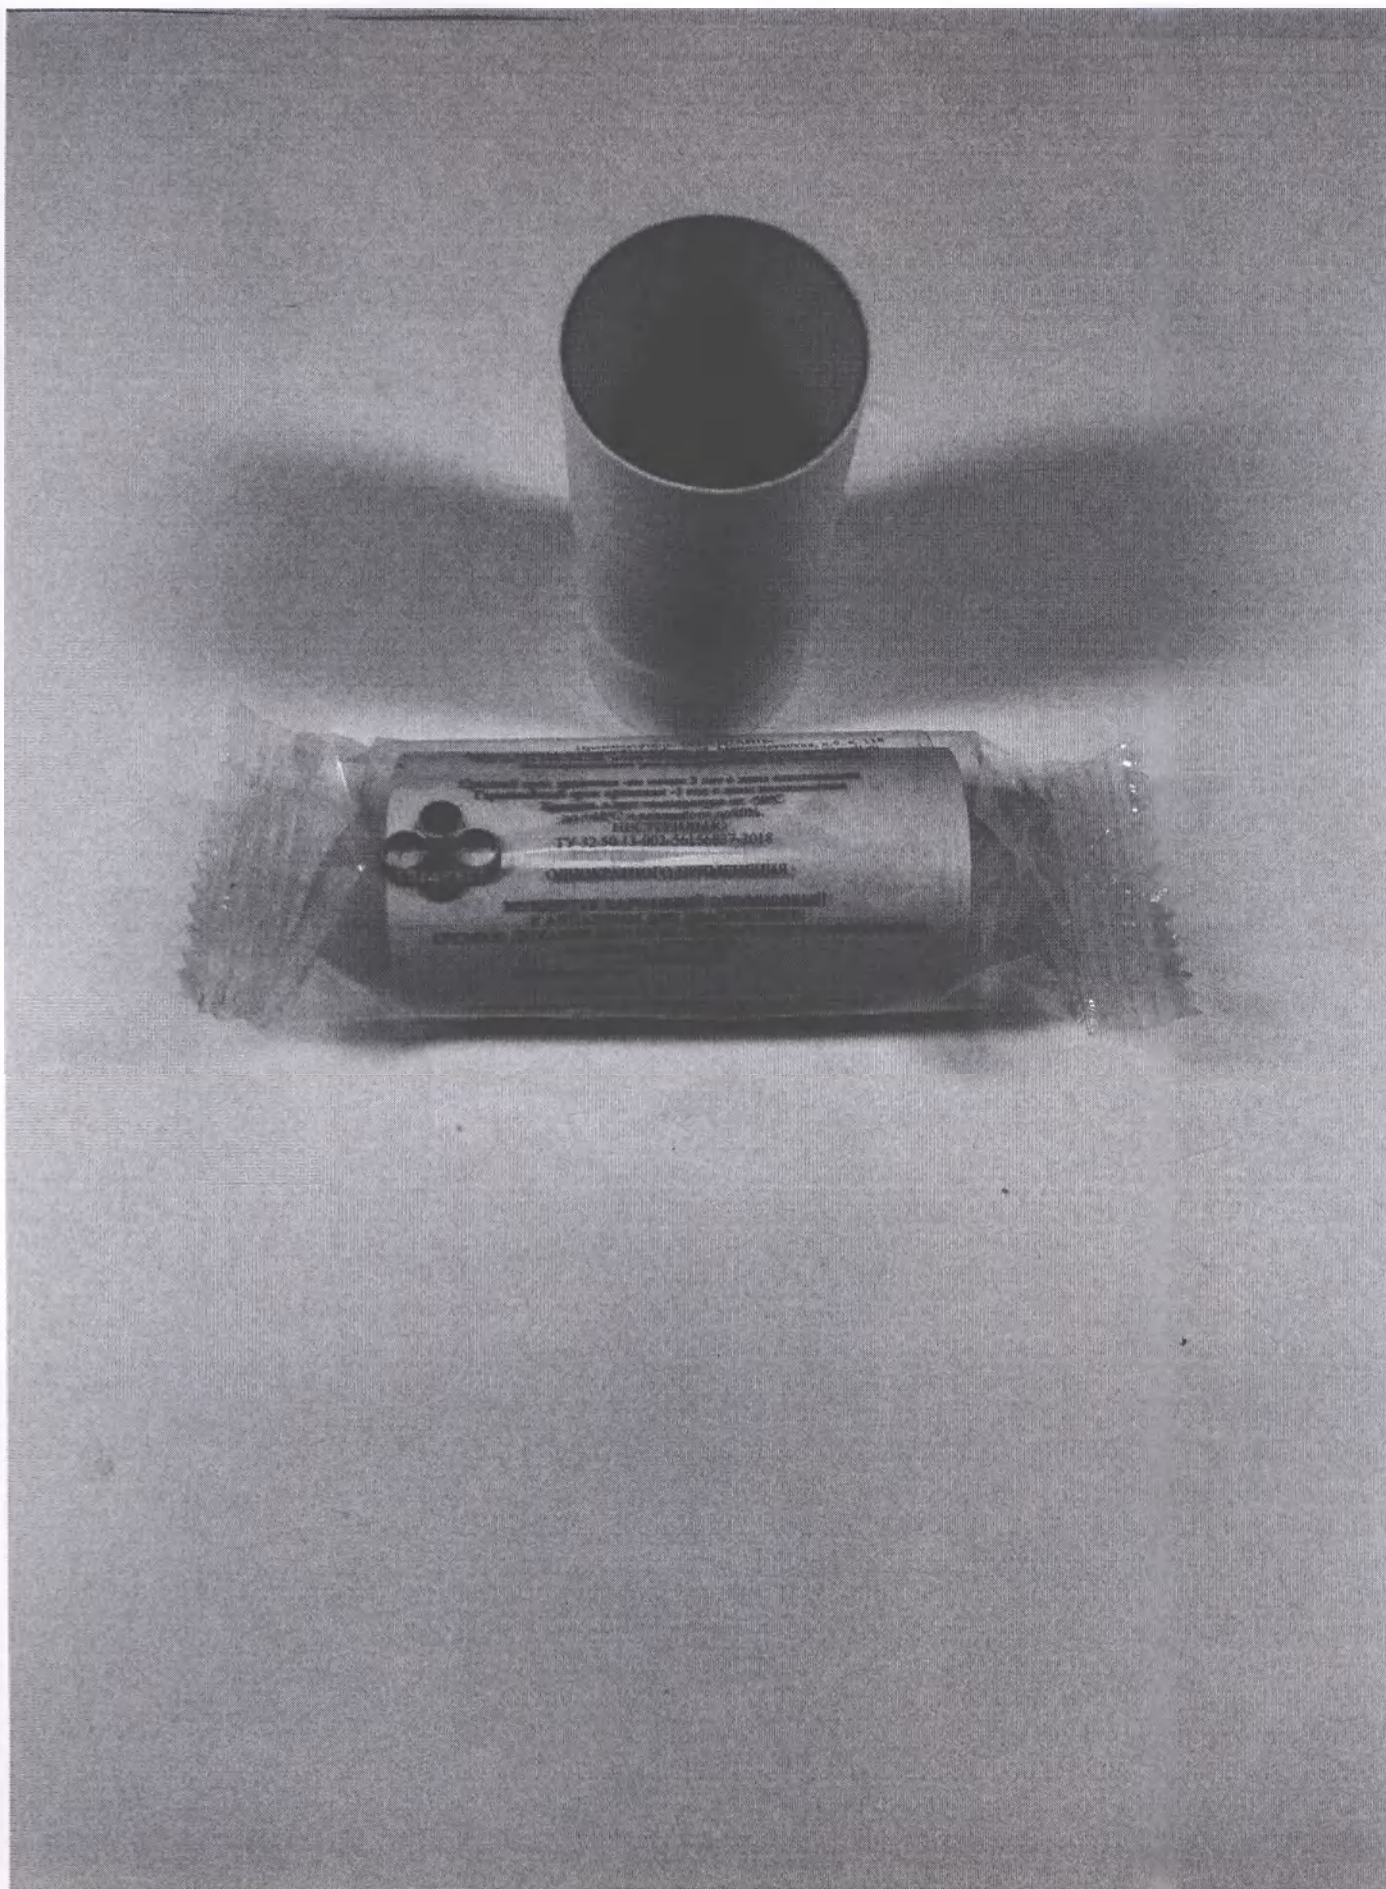


Мундштук картонный одноразовый к аппаратам для диагностики органов дыхания методом спирометрии и газоанализа, с встроенным защитным фильтром, МКФ1-«ПАЙП»

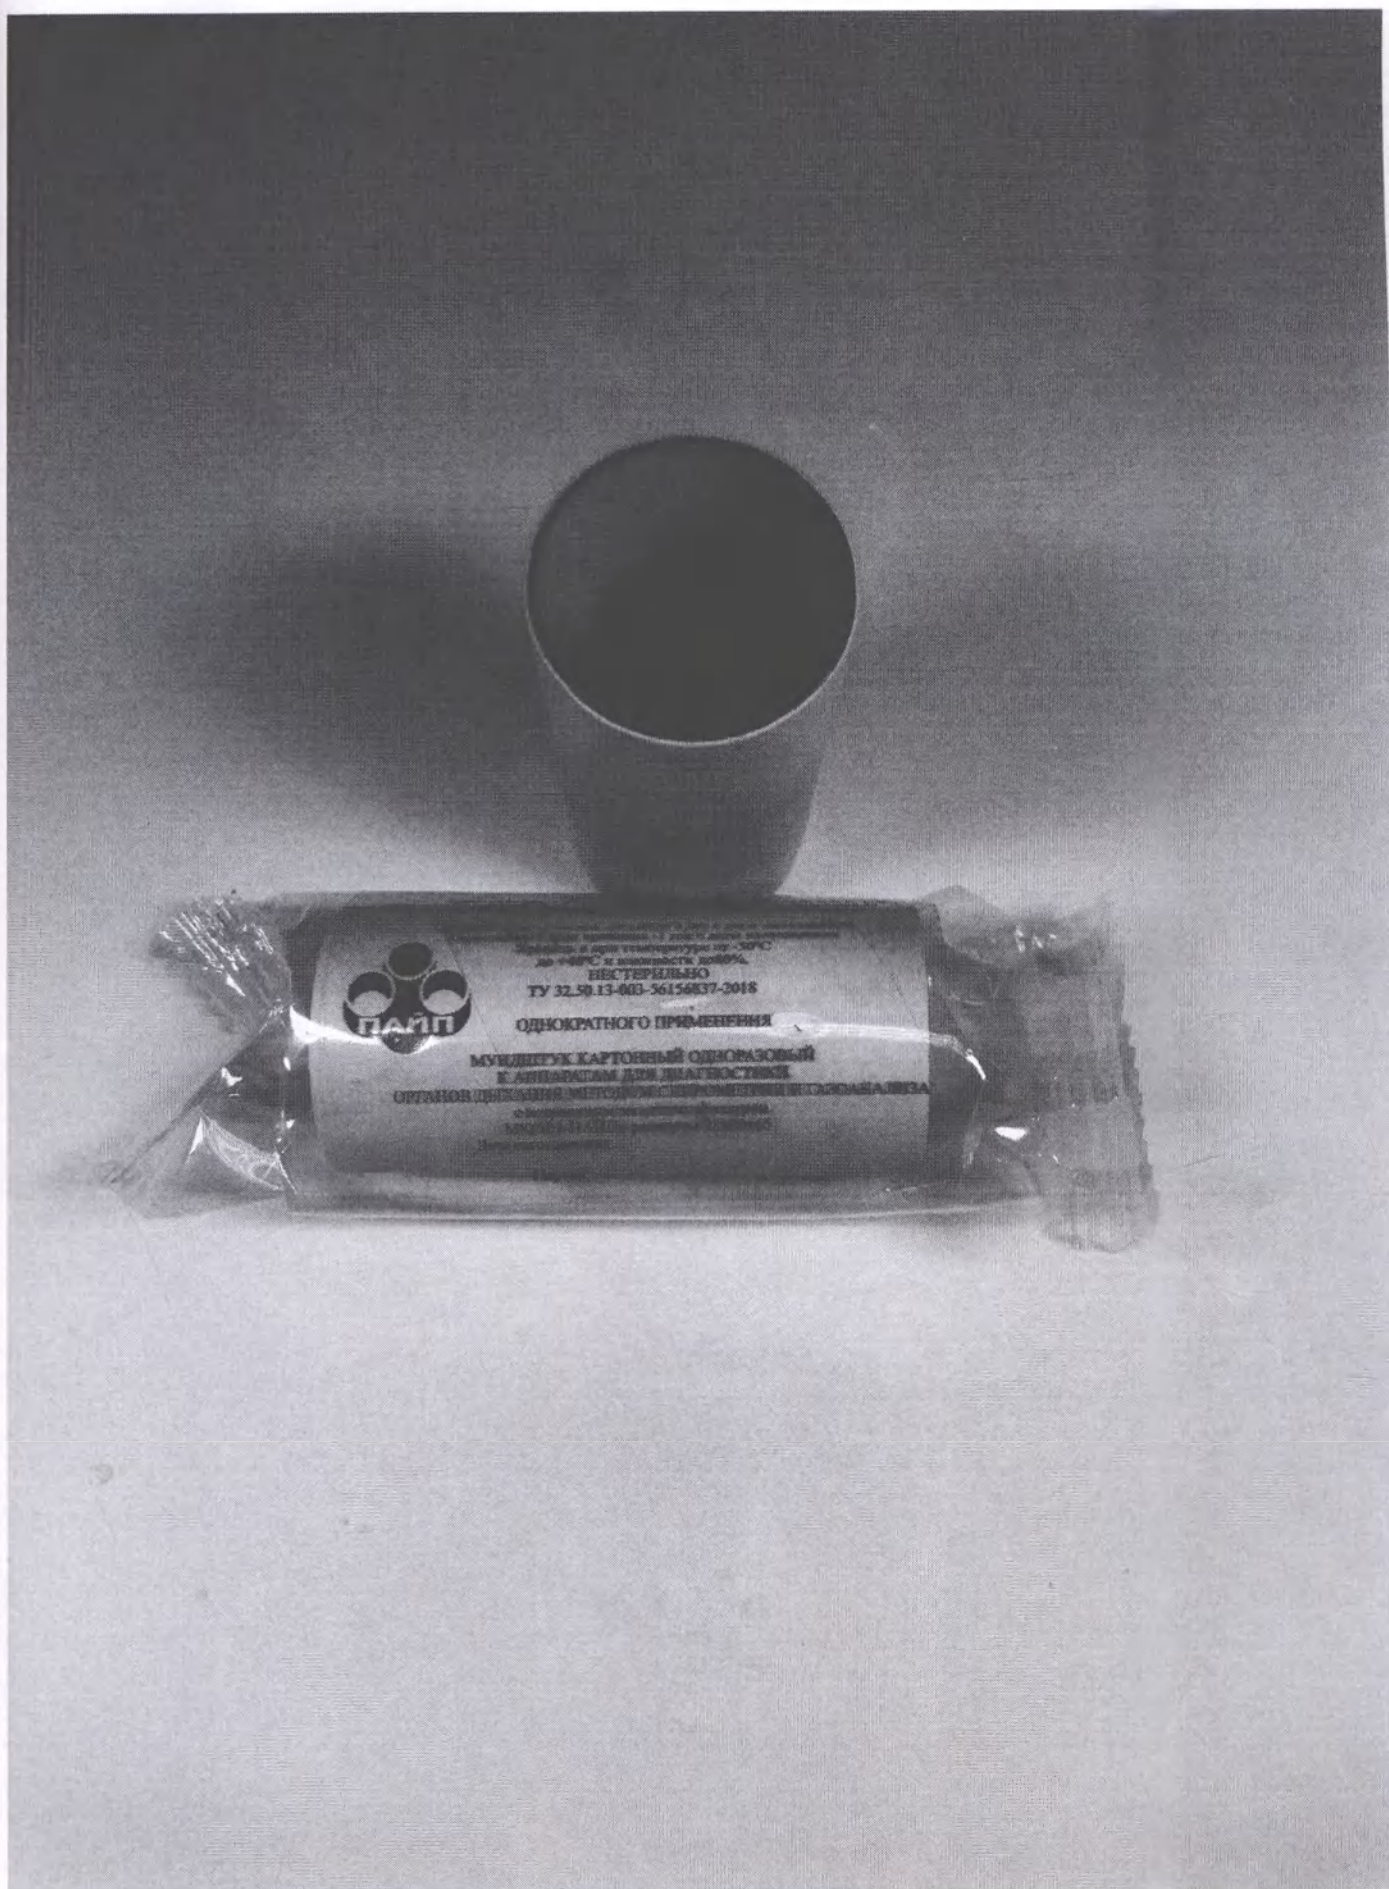


Мундштук картонный одноразовый к аппаратам для диагностики органов дыхания методом спироетрии и газоанализа, с встроенным защитным фильтром, МКСФ1-«ПАЙП»

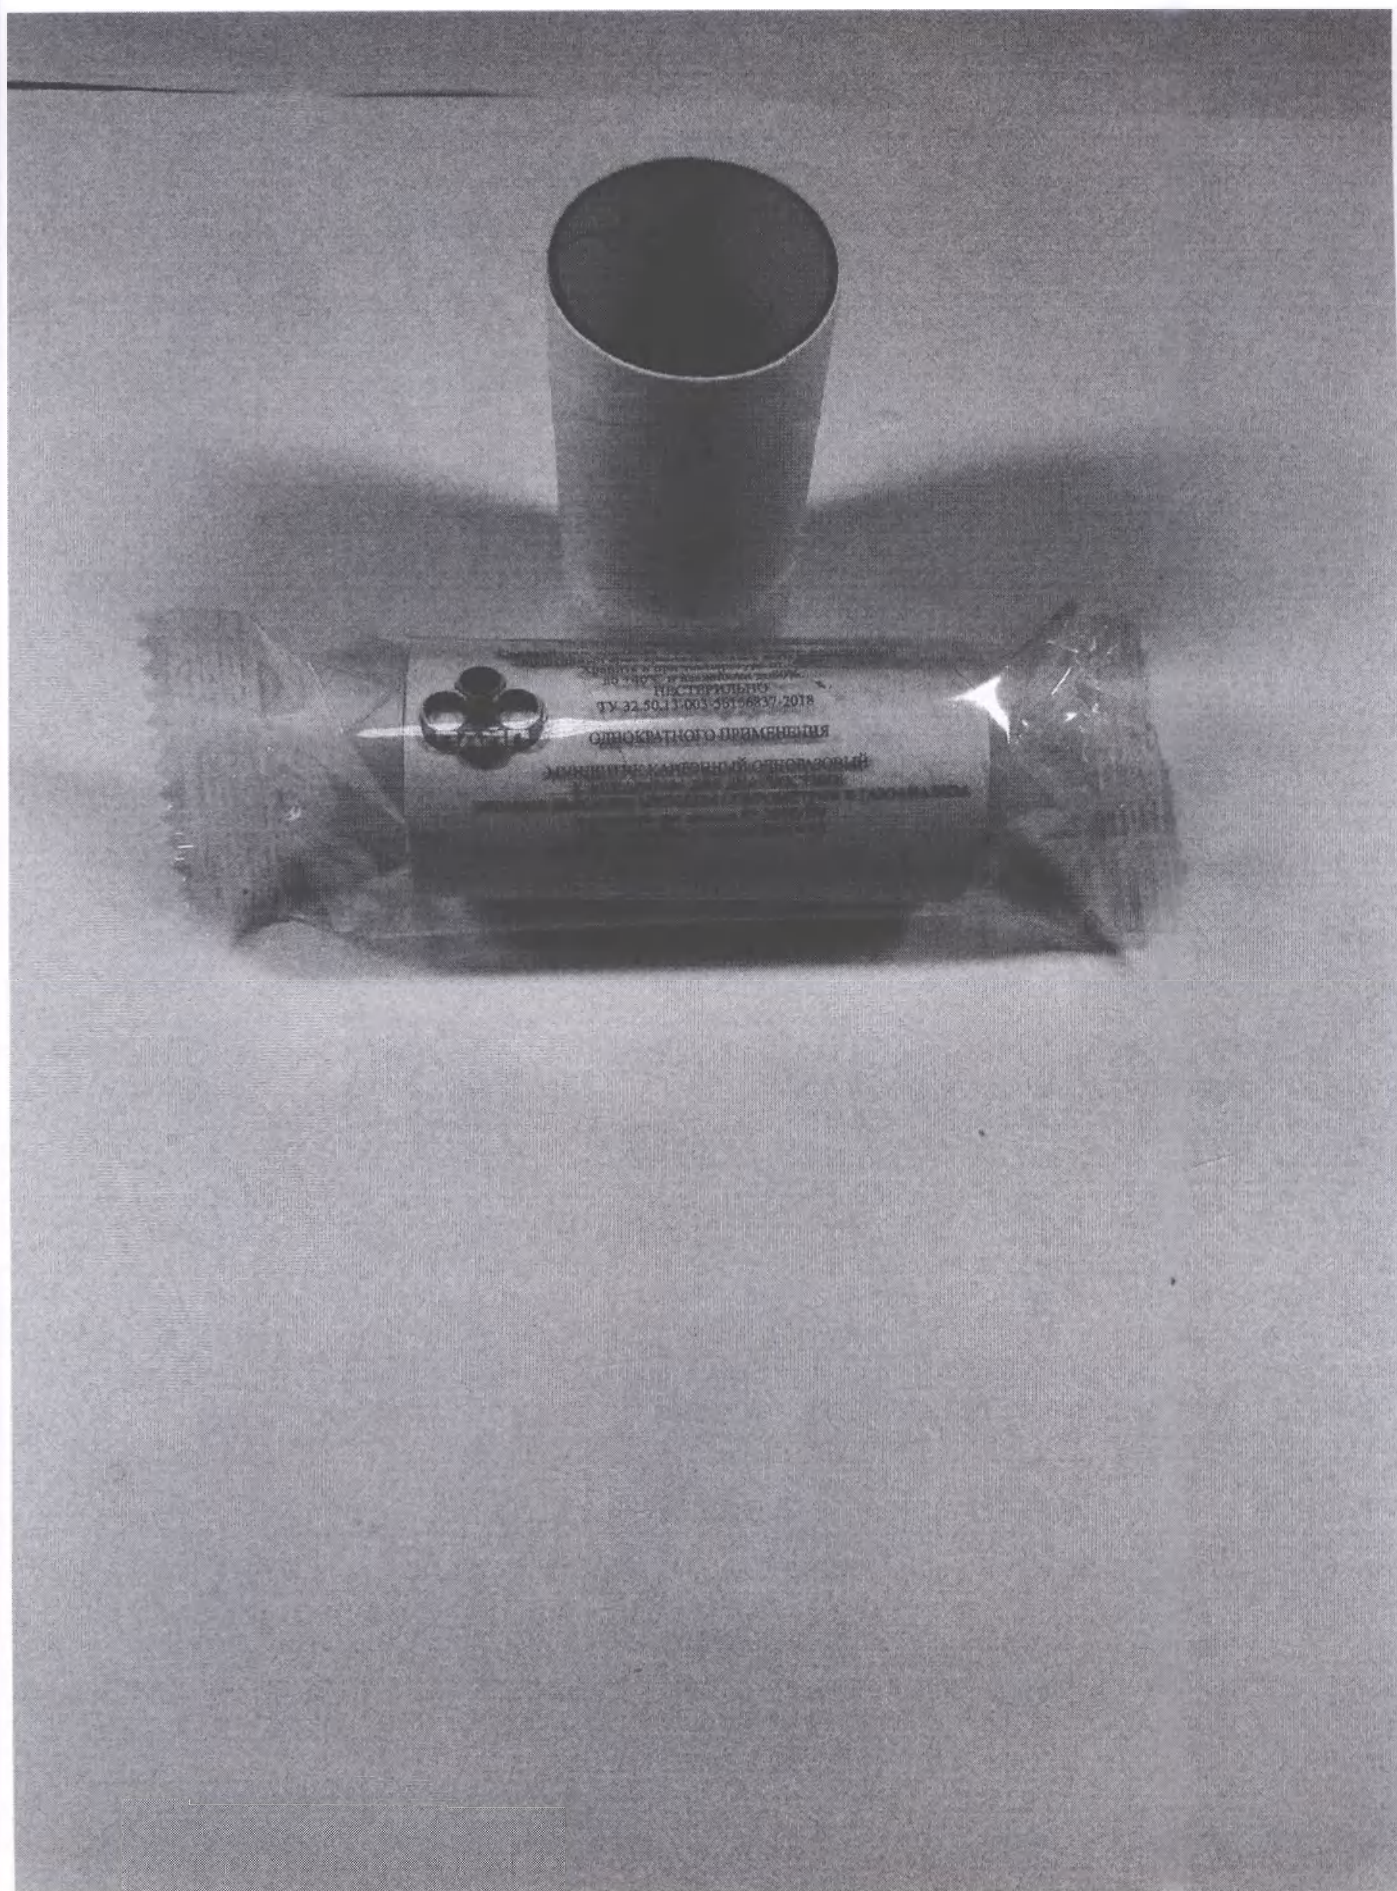


Мундштук картонный одноразовый к аппаратам для диагностики органов дыхания методом спирометрии и газоанализа, с фильтром для датчика SP-20/30/260, МКФ2-«ПАЙП»

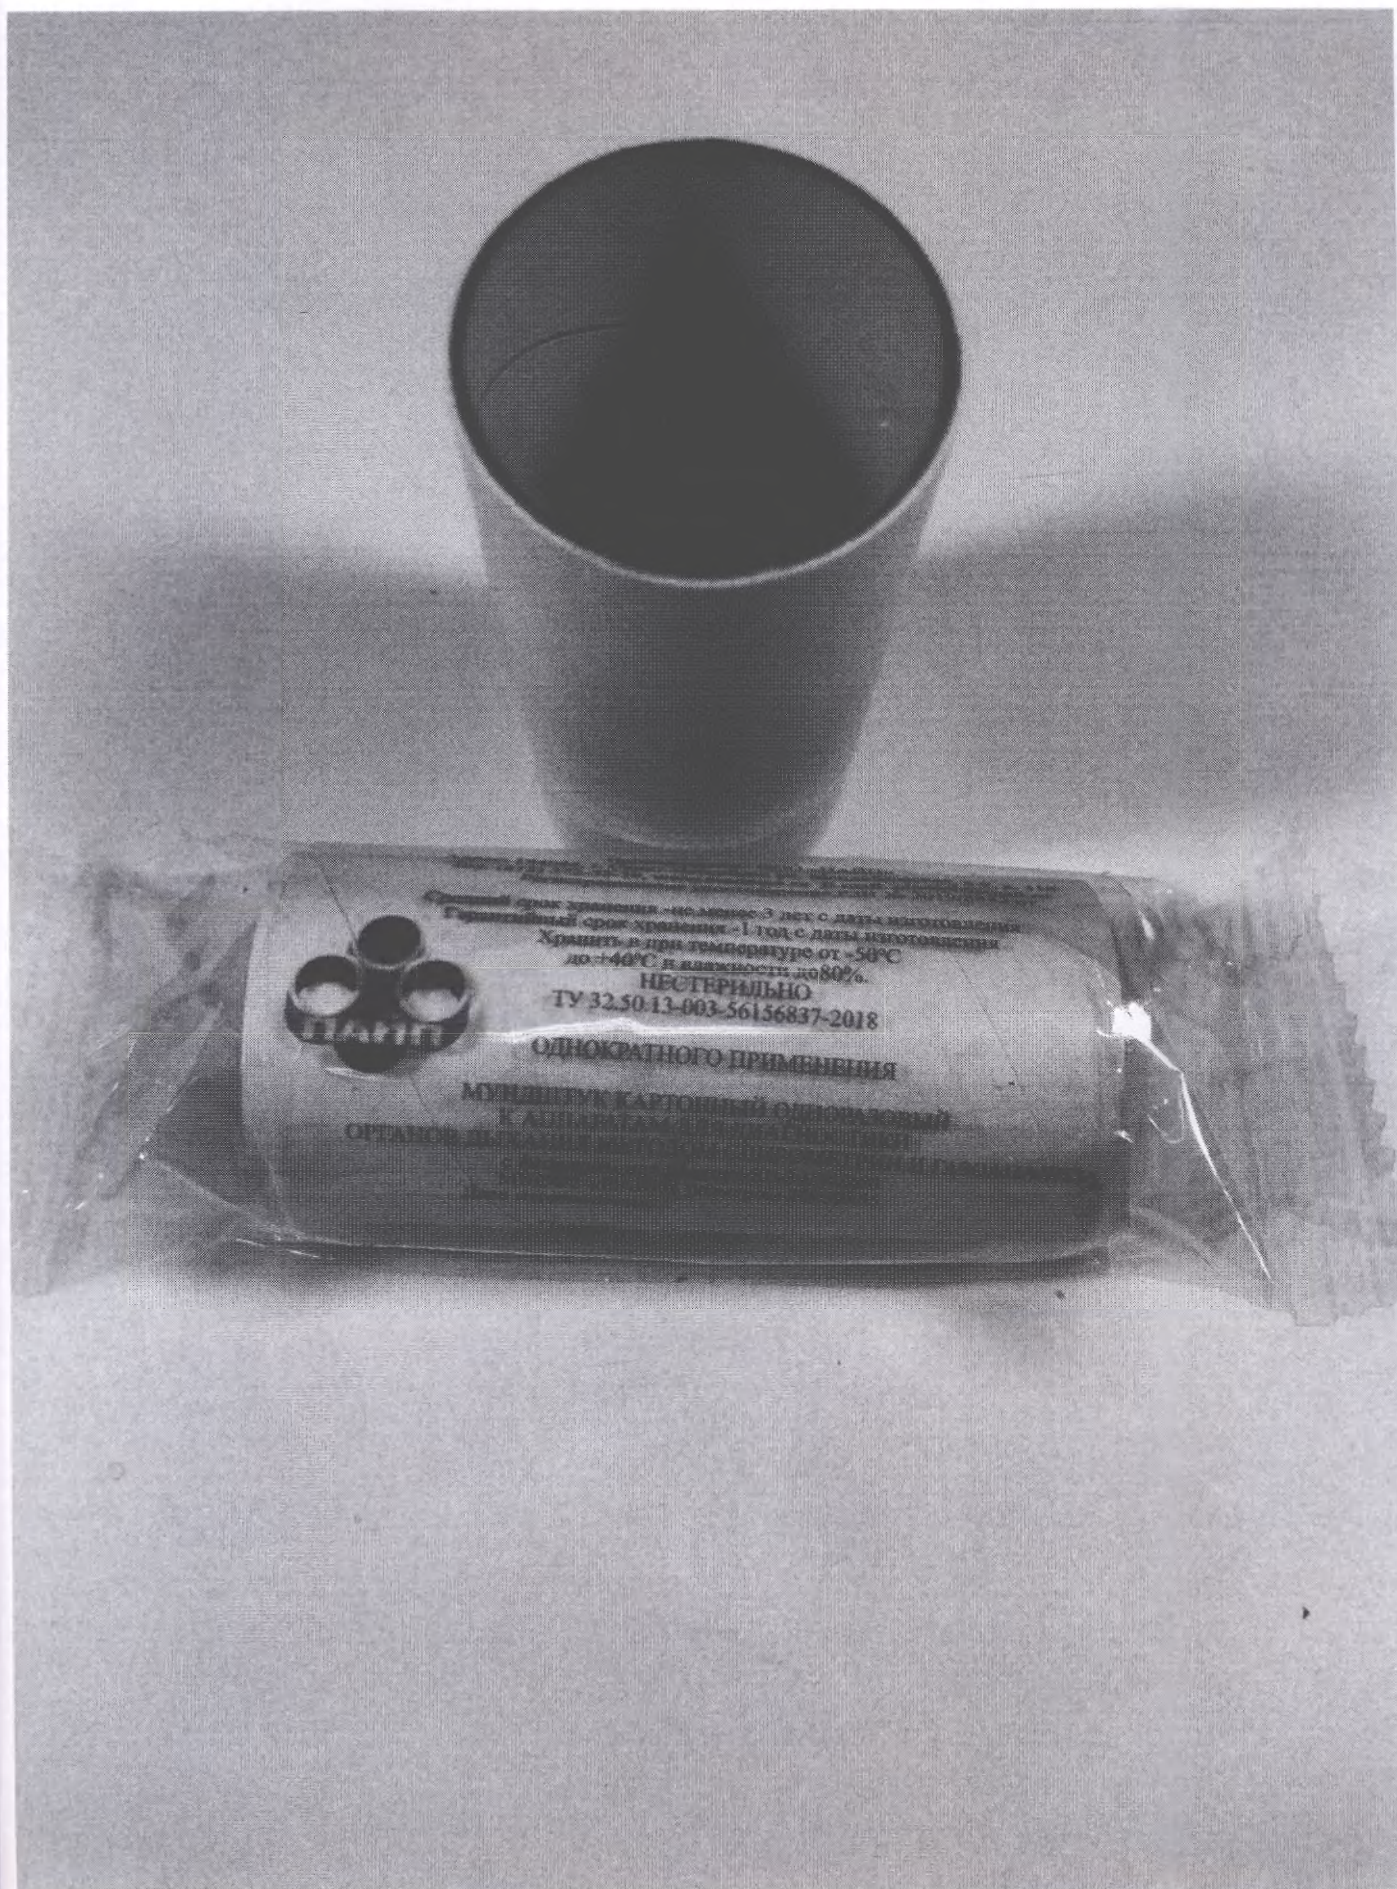

Мундштук картонный одноразовый к аппаратам для диагностики органов дыхания методом спирометрии и газоанализа, с фильтром для датчика SP-20/30/260, МКСФ2-«ПАЙП»

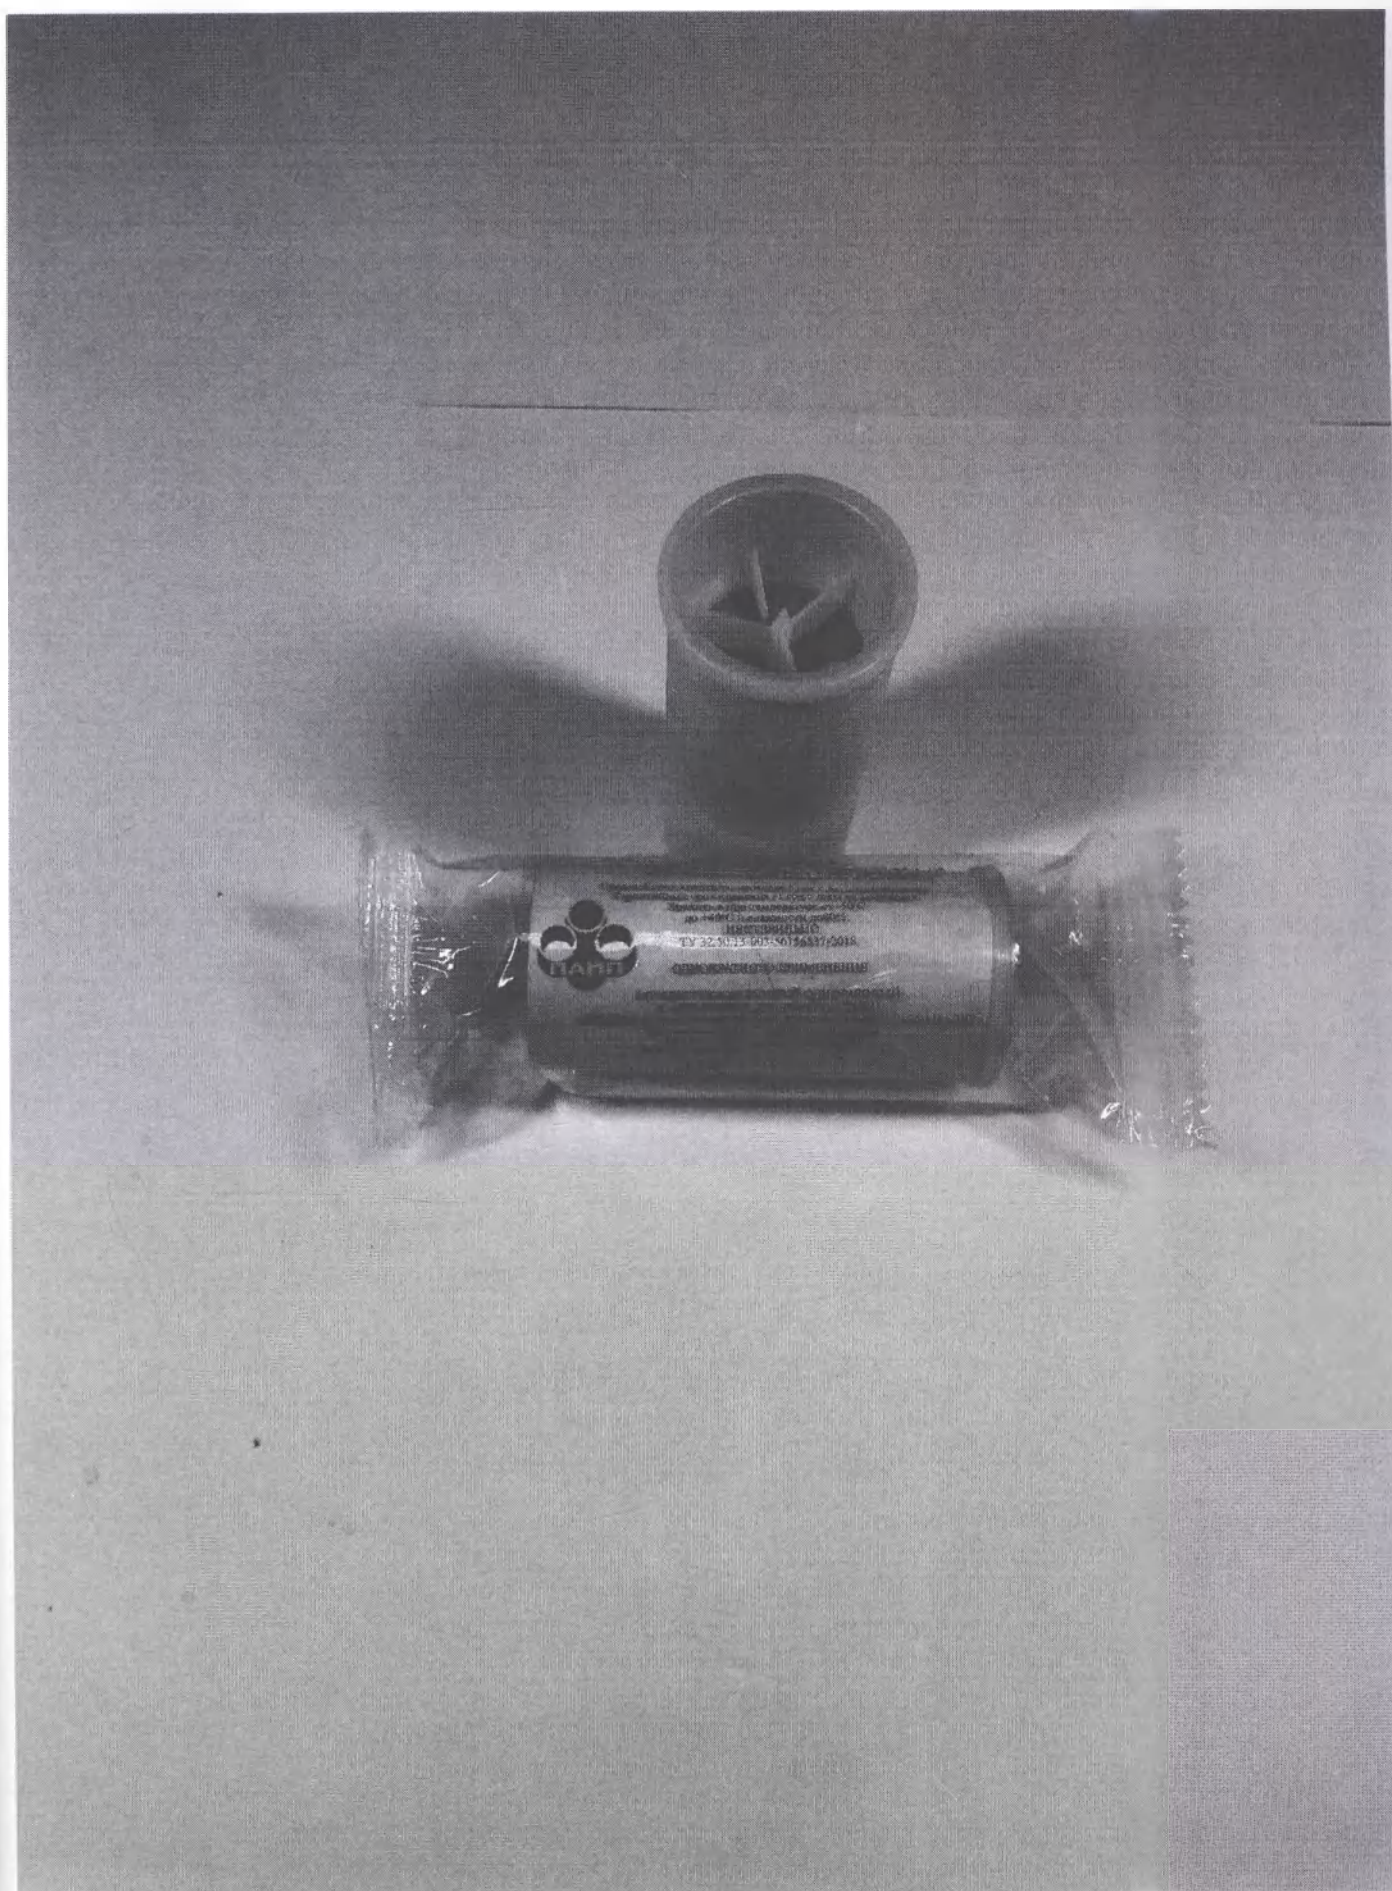

Мундштук картонный одноразовый к аппаратам для диагностики органов дыхания методом спирометрии и газоанализа, однонаправленный с обратным клапаном, МКО-«ПАЙП»

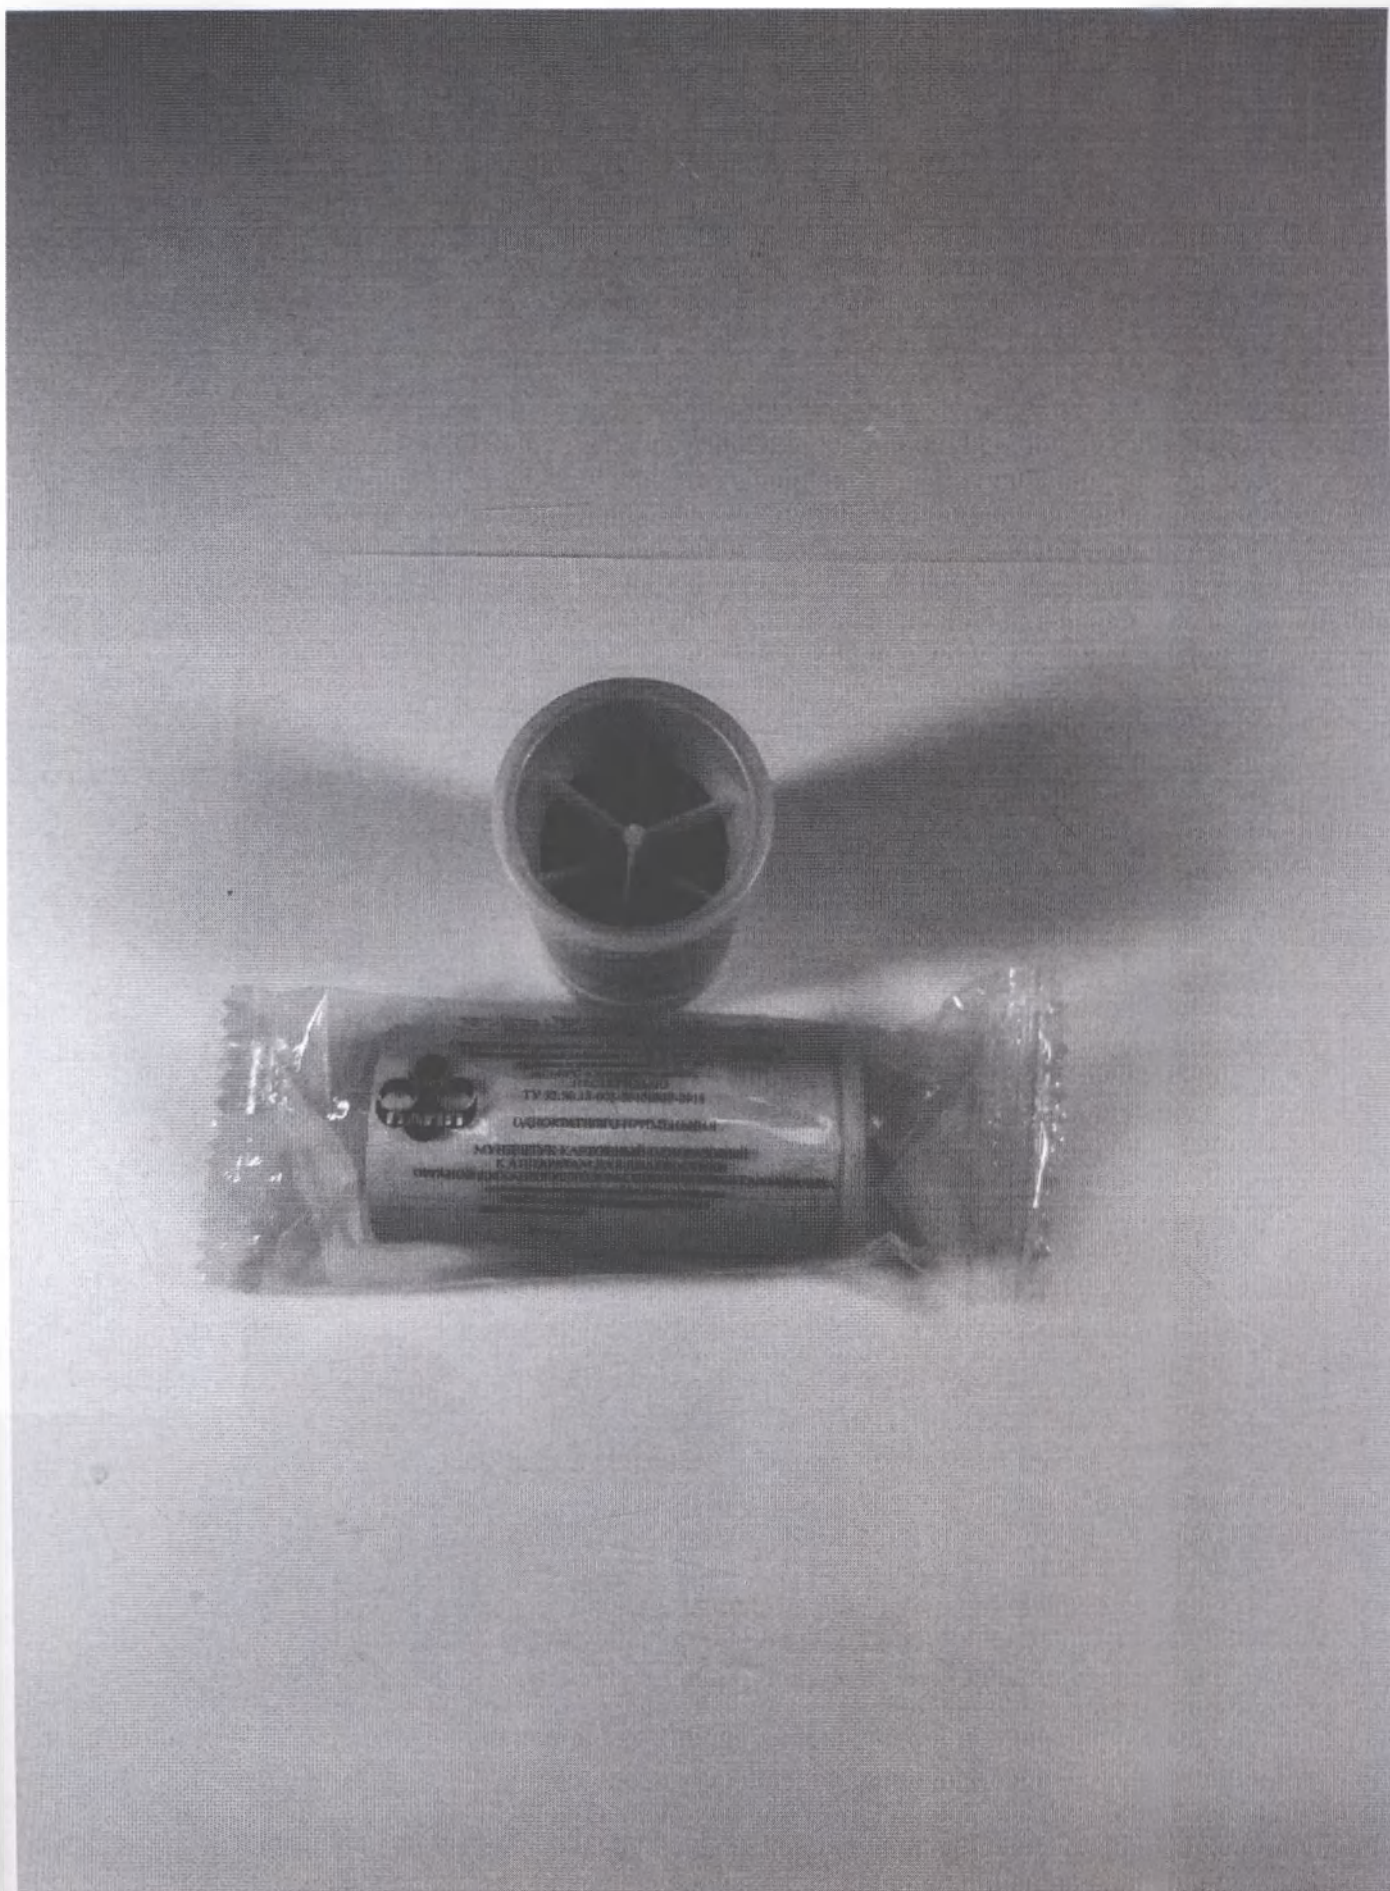

Мундштук картонный одноразовый к аппаратам для диагностики органов дыхания методом спирометрии и газоанализа, однонаправленный с обратным клапаном, МКСО-«ПАЙП»

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 8 лист(ов)

Руководитель организации



Мундштук картонный, одноразовый и аппаратам для диагностики
органов дыхания методом спирометрии и газоанализа

МК-"ПАЙП" размером **20x50x1,0**

по ТУ 32.50.13-003-50156837-2018

"НЕСТЕРИЛЬНО"

"ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ"

Производитель: ООО "ПАЙП"

194044, г. Санкт-Петербург, ул. Менделеевская, д.9, пом. 118

Телефон: 18121 372-53-38

Хранить и транспортировать при температуре от -50 °С до +40 °С и влажности до 90%.

Рег. Уд. Росздравнадзора № РЗН 2018/8442 от

Средний срок хранения - не менее 36 месяцев с даты изготовления

Партия: **ММК205010 0221**

Дата изготовления: **02.2021**

500 шт.



Фотографическое изображение маркировки транспортной упаковки изделия: Мундштук картонный одноразовый к аппаратам для диагностики органов дыхания методом спирометрии и газоанализа, без фильтра, МК-«ПАЙП» размером 20x50x1,0 .

Количество: 500 шт.

Мундштук картонный, одноразовый к аппаратам для диагностики
органов дыхания методом спирометрии и газоанализа
с встроенным защитным фильтром



МКФ1-«ПАЙП» размером **28x65x1,0**

по ТУ 32.50.13-003-56156837-2018

"НЕСТЕРИЛЬНО"

"ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ"

Производитель: **ООО «ПАЙП»**

194044, г. Санкт-Петербург, ул. Менделеевская, д.9, к.118.

Телефон: 8121 372-53-38

Хранить и транспортировать при температуре от -50°С до +40°С и влажности до 80%

Рег. Уд. Росздравнадзора № РЗН 2019/8442 от

Средний срок хранения - не менее 36 месяцев с даты изготовления

Партия: **УМНФ1286510 0221**

Дата изготовления: **02.2021**

250 шт.




Фотографическое изображения маркировки транспортной упаковки изделия: Мундштук картонный одноразовый к аппаратам для диагностики органов дыхания методом спирометрии и газоанализа, с встроенным защитным фильтром, МКФ1-«ПАЙП» размером 28x65x1,0.

Количество: 250 шт.

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 2 лист(ов)

Руководитель организации







Мундштук картонный одноразовый к аппаратам для диагностики органов дыхания методом спирометрии и газоанализа, с встроенным защитным фильтром, МКФ1-«ПАЙП», МКСФ1-«ПАЙП», МКФ2-«ПАЙП», МКСФ2-«ПАЙП»







Мундштук картонный одноразовый к аппаратам для диагностики органов дыхания методом спирометрии и газоанализа, без фильтра, МК-«ПАЙП», МКС-«ПАЙП»

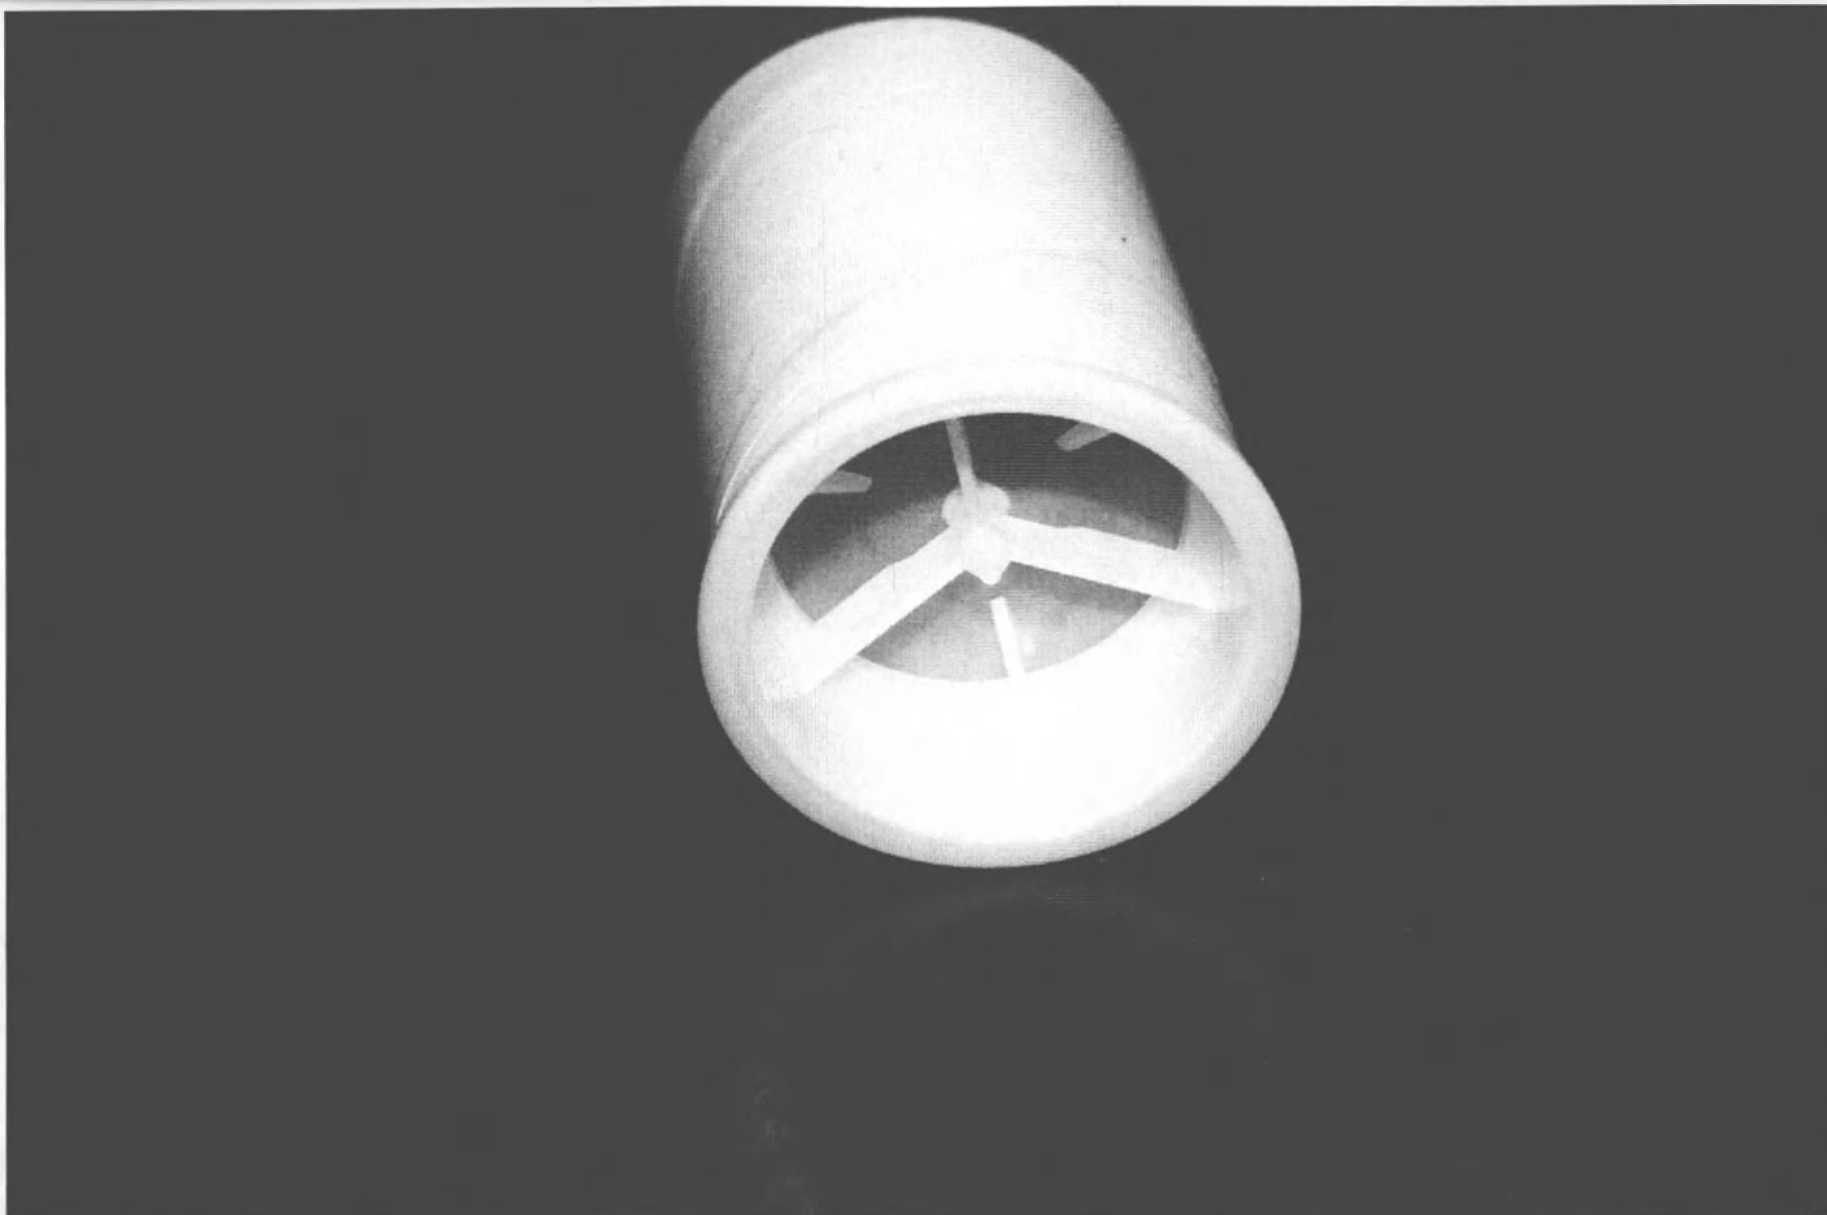

Мундштук картонный одноразовый к аппаратам для диагностики органов дыхания методом спирометрии и газоанализа, однонаправленный с обратным клапаном, МКО-«ПАЙП», МКСО-«ПАЙП»

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 3 лист(ов)

Руководитель организации




СВЕДЕНИЯ о нормативной документации на медицинское изделие

Мундштук картонный одноразовый к аппаратам для диагностики органов дыхания методом спирометрии и газоанализа: МК-«ПАЙП», МКС-«ПАЙП», МКФ1-«ПАЙП», МКСФ1-«ПАЙП», МКФ2-«ПАЙП», МКСФ2-«ПАЙП», МКО-«ПАЙП», МКСО-«ПАЙП» по ТУ 32.50.13-003-56156837-2018

Производитель: ООО "ПАЙП"

Адрес места нахождения: Россия, 194044, Санкт-Петербург, улица Менделеевская дом 9, ком. 118

Нормативный документ	Наименование
ГОСТ Р 50444	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
ГОСТ 31508-2012	Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования
ГОСТ 166-89	Штангенциркули. Технические условия
ГОСТ 7625-86	Бумага этикеточная. Технические условия
ГОСТ 12301-2006	Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов.
ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009	Изделия медицинские. Оценка биологического воздействия медицинских изделий». Часть 2 «Требования к обращению с животными
ГОСТ ISO 10993-1-2011	Изделия медицинские. Оценка биологического воздействия медицинских изделий: часть 1 «Оценка и исследование»,
ГОСТ ISO 10993-10-2011	Изделия медицинские. Оценка биологического воздействия медицинских изделий: часть 10 «Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия»,
ГОСТ ISO 10993-13-2016	Изделия медицинские. Оценка биологического воздействия медицинских изделий: часть 13 «Идентификация и количественное определение продуктов деградации полимерных медицинских изделий»
ГОСТ ISO 10993-12-2015	Изделия медицинские. Оценка биологического воздействия медицинских изделий: часть 12 «Приготовление проб и контрольные образцы»
ГОСТ 31214-2016	Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность и пирогенность
ГОСТ Р 52770-2016	Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний
ГН 2.3.3.972-00	Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Гигиенические нормативы
МУ 1.1.037-95	Биотестирование продукции из полимерных и других материалов
СанПиН 2.1.7.2790-10	Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами
СТО 00279404-015-2011	Картон для плоских слоёв гофрированного картона с белёным поверхностным слоем
ТУ 2292-002-97327280-08	Ретикулированный пенополиуретан

Генеральный директор
ООО "ПАЙП"

Гоухберг А.А.

Макет маркировки индивидуальной упаковки



Мундштук картонный одноразовый к аппаратам для диагностики органов дыхания методом
спирометрии и газоанализа. без фильтра, МК-«ПАЙП» размером ААхВВхСС
по ТУ 32.50.13-003-56156837-2018

**НЕСТЕРИЛЬНО
ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**

размер мундштука - ААхВВхСС

номер партии _____

дата производства _____

номер РУ _____

Средний срок хранения - не менее 3 лет с даты изготовления

Гарантийный срок хранения – 1 год со дня изготовления.

Условия хранения - при температуре +40°C ... -50°C

ООО "ПАЙП"

Россия, 194044, Санкт-Петербург, ул. Менделеевская, д. 9, ком. 118

+7 (812) 372-53-38

pipezak@mail.ru



Макет маркировки индивидуальной упаковки



Мундштук картонный одноразовый к аппаратам для диагностики органов дыхания методом
спирометрии и газоанализа, однонаправленный с обратным клапаном МКО-«ПАЙП»

размером ААхВВхСС

по ТУ 32.50.13-003-56156837-2018

НЕСТЕРИЛЬНО

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

размер мундштука - ААхВВхСС

номер партии _____

дата производства _____

номер РУ _____

Средний срок хранения - не менее 3 лет с даты изготовления

Гарантийный срок хранения – 1 год со дня изготовления.

Условия хранения - при температуре +40°C ... -50°C

ООО "ПАЙП"

Россия, 194044, Санкт-Петербург, ул. Менделеевская, д. 9, ком. 118

+7 (812) 372-53-38

pipezak@mail.ru

Макет маркировки индивидуальной упаковки



Мундштук картонный одноразовый к аппаратам для диагностики органов дыхания методом
спирометрии и газоанализа, без фильтра, МКС-«ПАЙП» размером ААхВВхСС
по ТУ 32.50.13-003-56156837-2018

НЕСТЕРИЛЬНО
ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

размер мундштука - ААхВВхСС

номер партии _____

дата производства _____

номер РУ _____

Средний срок хранения - не менее 3 лет с даты изготовления

Гарантийный срок хранения – 1 год со дня изготовления.

Условия хранения - при температуре +40°C ... -50°C

ООО "ПАЙП"

Россия, 194044, Санкт-Петербург, ул. Менделеевская, д. 9, ком. 118

+7 (812) 372-53-38

pipezak@mail.ru

Макет маркировки индивидуальной упаковки



Мундштук картонный одноразовый к аппаратам для диагностики органов дыхания методом
спирометрии и газоанализа, однонаправленный с обратным клапаном МКСО-«ПАЙП»

размером ААхВВхСС

по ТУ 32.50.13-003-56156837-2018

НЕСТЕРИЛЬНО

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

размер мундштука - ААхВВхСС

номер партии _____

дата производства _____

номер РУ _____

Средний срок хранения - не менее 3 лет с даты изготовления

Гарантийный срок хранения – 1 год со дня изготовления.

Условия хранения - при температуре +40°C ... -50°C

ООО "ПАЙП"

Россия, 194044, Санкт-Петербург, ул. Менделеевская, д. 9, ком. 118

+7 (812) 372-53-38

pipezak@mail.ru

Макет маркировки индивидуальной упаковки



Мундштук картонный одноразовый к аппаратам для диагностики органов дыхания методом
спирометрии и газоанализа, с встроенным защитным фильтром, МКСФ1-«ПАЙП»

размером ААхВВхСС

по ТУ 32.50.13-003-56156837-2018

НЕСТЕРИЛЬНО

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

размер мундштука - ААхВВхСС

номер партии _____

дата производства _____

номер РУ _____

Средний срок хранения - не менее 3 лет с даты изготовления

Гарантийный срок хранения – 1 год со дня изготовления.

Условия хранения - при температуре +40°C ... -50°C

ООО "ПАЙП"

Россия, 194044, Санкт-Петербург, ул. Менделеевская, д. 9, ком. 118

+7 (812) 372-53-38

pipezak@mail.ru

Макет маркировки индивидуальной упаковки



Мундштук картонный одноразовый к аппаратам для диагностики органов дыхания методом
спирометрии и газоанализа, с фильтром для датчика SP-20/30/260, МКФ2-«ПАЙП»

размером ААхВВхСС

по ТУ 32.50.13-003-56156837-2018

НЕСТЕРИЛЬНО

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

размер мундштука - ААхВВхСС

номер партии _____

дата производства _____

номер РУ _____

Средний срок хранения - не менее 3 лет с даты изготовления

Гарантийный срок хранения – 1 год со дня изготовления.

Условия хранения - при температуре +40°C ... -50°C

ООО "ПАЙП"

Россия, 194044, Санкт-Петербург, ул. Менделеевская, д. 9, ком. 118

+7 (812) 372-53-38

pipezak@mail.ru

Макет маркировки индивидуальной упаковки



Мундштук картонный одноразовый к аппаратам для диагностики органов дыхания методом спирометрии и газоанализа, с встроенным защитным фильтром, МКФ1-«ПАЙП»

размером ААхВВхСС

по ТУ 32.50.13-003-56156837-2018

НЕСТЕРИЛЬНО

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

размер мундштука - ААхВВхСС

номер партии _____

дата производства _____

номер РУ _____

Средний срок хранения - не менее 3 лет с даты изготовления

Гарантийный срок хранения – 1 год со дня изготовления.

Условия хранения - при температуре +40°C ... -50°C

ООО "ПАЙП"

Россия, 194044, Санкт-Петербург, ул. Менделеевская, д. 9, ком. 118

+7 (812) 372-53-38

pipezak@mail.ru

Макет маркировки индивидуальной упаковки



Мундштук картонный одноразовый к аппаратам для диагностики органов дыхания методом
спирометрии и газоанализа, с фильтром для датчика SP-20/30/260, МКФ2-«ПАЙП»

размером ААхВВхСС

по ТУ 32.50.13-003-56156837-2018

НЕСТЕРИЛЬНО

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

размер мундштука - ААхВВхСС

номер партии _____

дата производства _____

номер РУ _____

Средний срок хранения - не менее 3 лет с даты изготовления

Гарантийный срок хранения – 1 год со дня изготовления.

Условия хранения - при температуре +40°C ... -50°C

ООО "ПАЙП"

Россия, 194044, Санкт-Петербург, ул. Менделеевская, д. 9, ком. 118

+7 (812) 372-53-38

pipezak@mail.ru

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 8 лист(ов)

Руководитель организации

М.П. ЧАЙП



Макет маркировки групповой упаковки



Мундштук картонный одноразовый к аппаратам для диагностики органов дыхания методом
спирометрии и газоанализа, без фильтра, МК-«ПАЙП» размером ААхВВхСС
по ТУ 32.50.13-003-56156837-2018
НЕСТЕРИЛЬНО
ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

номер партии _____
количество изделий _____
размер мундштуков _____
дата производства _____
номер РУ _____
номер упаковщика _____

Средний срок хранения - не менее 3 лет с даты изготовления

Транспортирование изделий, упакованных в транспортную тару, должно осуществляться всеми видами крытых транспортных средств, с соблюдением предосторожностей, и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида.

Условия транспортирования мундштуков – по условиям хранения 2 ГОСТ 15150-69. (при температуре +40°C ... -50°C).

Хранение

Мундштуки в транспортной таре изготовителя должны храниться на складах изготовителя и потребителя в условиях хранения 2 по ГОСТ 15150-69 (при температуре +40°C ... -50°C).

ООО "ПАЙП"

Россия, 194044, Санкт-Петербург, ул. Менделеевская, д. 9, ком. 118

+7 (812) 372-53-38

pipezak@mail.ru



Макет маркировки групповой упаковки



Мундштук картонный одноразовый к аппаратам для диагностики органов дыхания методом спирометрии и газоанализа, с встроенным защитным фильтром, МКСФ1-«ПАЙП»

размером ААхВВхСС

по ТУ 32.50.13-003-56156837-2018

НЕСТЕРИЛЬНО

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

номер партии _____

количество изделий _____

размер мундштуков _____

дата производства _____

номер РУ _____

номер упаковщика _____

Средний срок хранения - не менее 3 лет с даты изготовления

Транспортирование изделий, упакованных в транспортную тару, должно осуществляться всеми видами крытых транспортных средств, с соблюдением предосторожностей, и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида.

Условия транспортирования мундштуков – по условиям хранения 2 ГОСТ 15150-69. (при температуре +40°C ... -50°C).

Хранение

Мундштуки в транспортной таре изготовителя должны храниться на складах изготовителя и потребителя в условиях хранения 2 по ГОСТ 15150-69 (при температуре +40°C ... -50°C).

ООО "ПАЙП"

Россия, 194044, Санкт-Петербург, ул. Менделеевская, д. 9, ком. 118

+7 (812) 372-53-38

pipezak@mail.ru

Макет маркировки групповой упаковки



Мундштук картонный одноразовый к аппаратам для диагностики органов дыхания методом
спирометрии и газоанализа, с фильтром для датчика SP-20/30/260, МКСФ2-«ПАЙП»

размером ААхВВхСС

по ТУ 32.50.13-003-56156837-2018

НЕСТЕРИЛЬНО

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

номер партии _____

количество изделий _____

размер мундштуков _____

дата производства _____

номер РУ _____

номер упаковщика _____

Средний срок хранения - не менее 3 лет с даты изготовления

Транспортирование изделий, упакованных в транспортную тару, должно осуществляться всеми видами крытых транспортных средств, с соблюдением предосторожностей, и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида.

Условия транспортирования мундштуков – по условиям хранения 2 ГОСТ 15150-69. (при температуре +40°C ... -50°C).

Хранение

Мундштуки в транспортной таре изготовителя должны храниться на складах изготовителя и потребителя в условиях хранения 2 по ГОСТ 15150-69 (при температуре +40°C ... -50°C).

ООО "ПАЙП"

Россия, 194044, Санкт-Петербург, ул. Менделеевская, д. 9, ком. 118

+7 (812) 372-53-38

pipezak@mail.ru

Макет маркировки групповой упаковки



Мундштук картонный одноразовый к аппаратам для диагностики органов дыхания методом
спирометрии и газоанализа, однонаправленный с обратным клапаном МКО-«ПАЙП»

размером AAxBBxCC

по ТУ 32.50.13-003-56156837-2018

НЕСТЕРИЛЬНО

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

номер партии _____

количество изделий _____

размер мундштуков _____

дата производства _____

номер РУ _____

номер упаковщика _____

Средний срок хранения - не менее 3 лет с даты изготовления

Транспортирование изделий, упакованных в транспортную тару, должно осуществляться всеми видами крытых транспортных средств, с соблюдением предосторожностей, и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида.

Условия транспортирования мундштуков – по условиям хранения 2 ГОСТ 15150-69. (при температуре +40°C ... -50°C).

Хранение

Мундштуки в транспортной таре изготовителя должны храниться на складах изготовителя и потребителя в условиях хранения 2 по ГОСТ 15150-69 (при температуре +40°C ... -50°C).

ООО "ПАЙП"

Россия, 194044, Санкт-Петербург, ул. Менделеевская, д. 9, ком. 118

+7 (812) 372-53-38

pipezak@mail.ru

Макет маркировки групповой упаковки



Мундштук картонный одноразовый к аппаратам для диагностики органов дыхания методом
спирометрии и газоанализа, без фильтра, МКС-«ПАЙП» размером ААхВВхСС
по ТУ 32.50.13-003-56156837-2018

**НЕСТЕРИЛЬНО
ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**

номер партии _____
количество изделий _____
размер мундштуков _____
дата производства _____
номер РУ _____
номер упаковщика _____

Средний срок хранения - не менее 3 лет с даты изготовления

Транспортирование изделий, упакованных в транспортную тару, должно осуществляться всеми видами крытых транспортных средств, с соблюдением предосторожностей, и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида.

Условия транспортирования мундштуков – по условиям хранения 2 ГОСТ 15150-69. (при температуре +40°C ... -50°C).

Хранение

Мундштуки в транспортной таре изготовителя должны храниться на складах изготовителя и потребителя в условиях хранения 2 по ГОСТ 15150-69 (при температуре +40°C ... -50°C).

ООО "ПАЙП"

Россия, 194044, Санкт-Петербург, ул. Менделеевская, д. 9, ком. 118

+7 (812) 372-53-38

pipezak@mail.ru

Макет маркировки групповой упаковки



Мундштук картонный одноразовый к аппаратам для диагностики органов дыхания методом
спирометрии и газоанализа, однонаправленный с обратным клапаном МКСО-«ПАЙП»

размером ААхВВхСС

по ТУ 32.50.13-003-56156837-2018

НЕСТЕРИЛЬНО

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

номер партии _____

количество изделий _____

размер мундштуков _____

дата производства _____

номер РУ _____

номер упаковщика _____

Средний срок хранения - не менее 3 лет с даты изготовления

Транспортирование изделий, упакованных в транспортную тару, должно осуществляться всеми видами крытых транспортных средств, с соблюдением предосторожностей, и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида.

Условия транспортирования мундштуков – по условиям хранения 2 ГОСТ 15150-69. (при температуре +40°C ... -50°C).

Хранение

Мундштуки в транспортной таре изготовителя должны храниться на складах изготовителя и потребителя в условиях хранения 2 по ГОСТ 15150-69 (при температуре +40°C ... -50°C).

ООО "ПАЙП"

Россия, 194044, Санкт-Петербург, ул. Менделеевская, д. 9, ком. 118

+7 (812) 372-53-38

pipezak@mail.ru

Макет маркировки групповой упаковки



Мундштук картонный одноразовый к аппаратам для диагностики органов дыхания методом
спирометрии и газоанализа, с встроенным защитным фильтром, МКФ1-«ПАЙП»

размером ААхВВхСС

по ТУ 32.50.13-003-56156837-2018

НЕСТЕРИЛЬНО

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

номер партии _____
количество изделий _____
размер мундштуков _____
дата производства _____
номер РУ _____
номер упаковщика _____

Средний срок хранения - не менее 3 лет с даты изготовления

Транспортирование изделий, упакованных в транспортную тару, должно осуществляться всеми видами крытых транспортных средств, с соблюдением предосторожностей, и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида.

Условия транспортирования мундштуков – по условиям хранения 2 ГОСТ 15150-69. (при температуре +40°C ... -50°C).

Хранение

Мундштуки в транспортной таре изготовителя должны храниться на складах изготовителя и потребителя в условиях хранения 2 по ГОСТ 15150-69 (при температуре +40°C ... -50°C).

ООО "ПАЙП"

Россия, 194044, Санкт-Петербург, ул. Менделеевская, д. 9, ком. 118

+7 (812) 372-53-38

pipezak@mail.ru

Макет маркировки групповой упаковки



Мундштук картонный одноразовый к аппаратам для диагностики органов дыхания методом
спирометрии и газоанализа, с фильтром для датчика SP-20/30/260, МКФ2-«ПАЙП»

размером ААхВВхСС

по ТУ 32.50.13-003-56156837-2018

НЕСТЕРИЛЬНО

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

номер партии _____

количество изделий _____

размер мундштуков _____

дата производства _____

номер РУ _____

номер упаковщика _____

Средний срок хранения - не менее 3 лет с даты изготовления

Транспортирование изделий, упакованных в транспортную тару, должно осуществляться всеми видами крытых транспортных средств, с соблюдением предосторожностей, и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида.

Условия транспортирования мундштуков — по условиям хранения 2 ГОСТ 15150-69. (при температуре +40°C ... -50°C).

Хранение

Мундштуки в транспортной таре изготовителя должны храниться на складах изготовителя и потребителя в условиях хранения 2 по ГОСТ 15150-69 (при температуре +40°C ... -50°C).

ООО "ПАЙП"

Россия, 194044, Санкт-Петербург, ул. Менделеевская, д. 9, ком. 118

+7 (812) 372-53-38

pipezak@mail.ru

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 8 лист(ов)

Руководитель организации



