


Фотографические изображения
медицинского изделия

***Аппарат ультразвуковой диагностический с
принадлежностями***



1. Аппарат ультразвуковой диагностический, варианты исполнения: S11

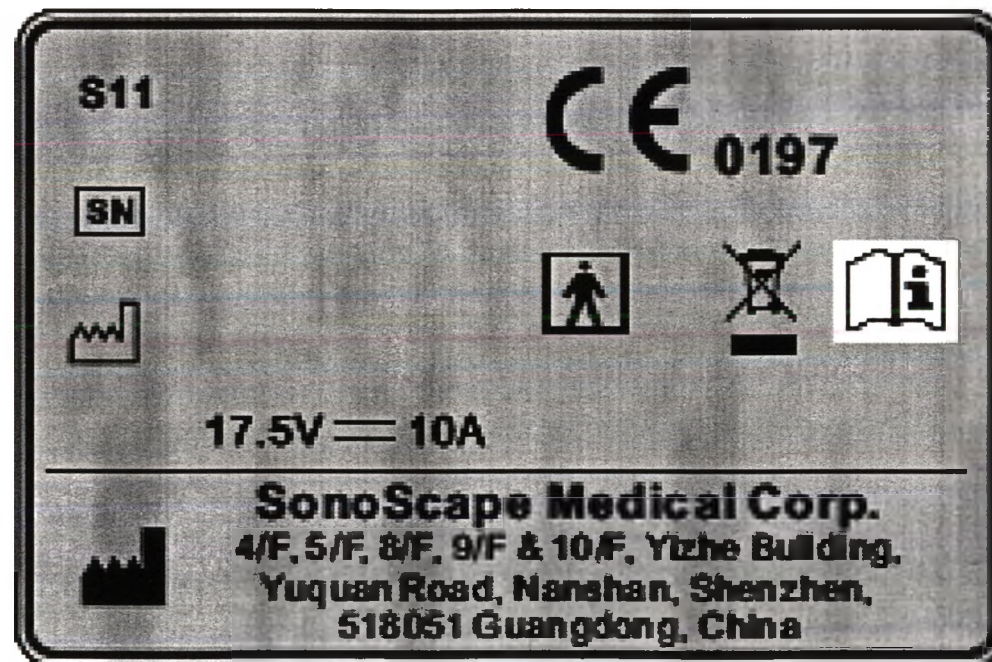


Макет маркировки. Модель S11

I. Аппарат ультразвуковой диагностический, вариант исполнения: S11. Макет маркировки



I. Аппарат ультразвуковой диагностический, вариант исполнения: S35

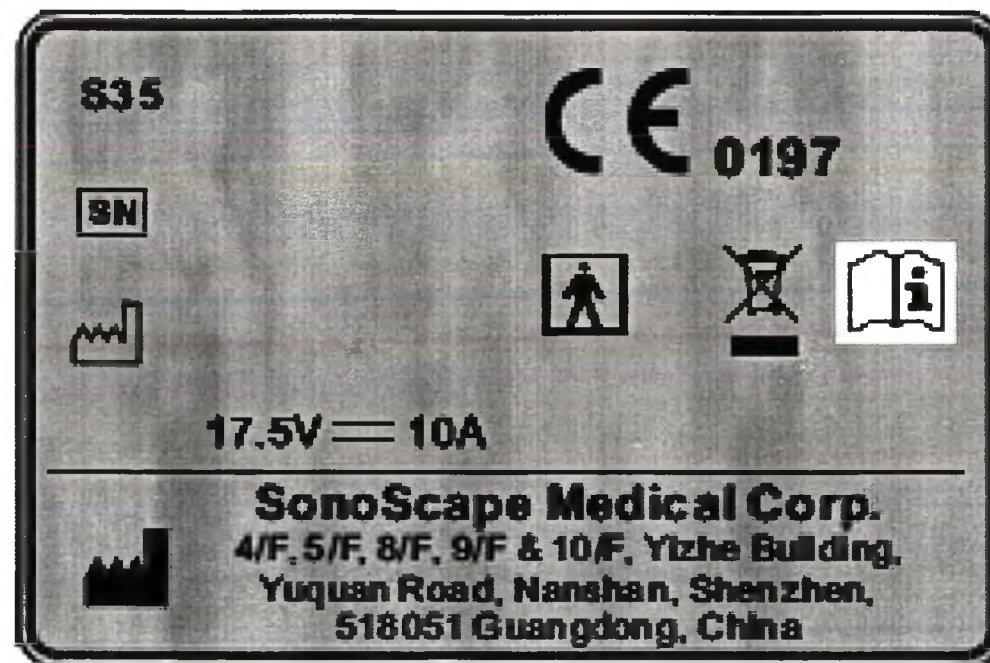


Макет маркировки. Модель S35

I. Аппарат ультразвуковой диагностический, вариант исполнения: S35. Макет маркировки



I. Аппарат ультразвуковой диагностический, вариант исполнения: S40

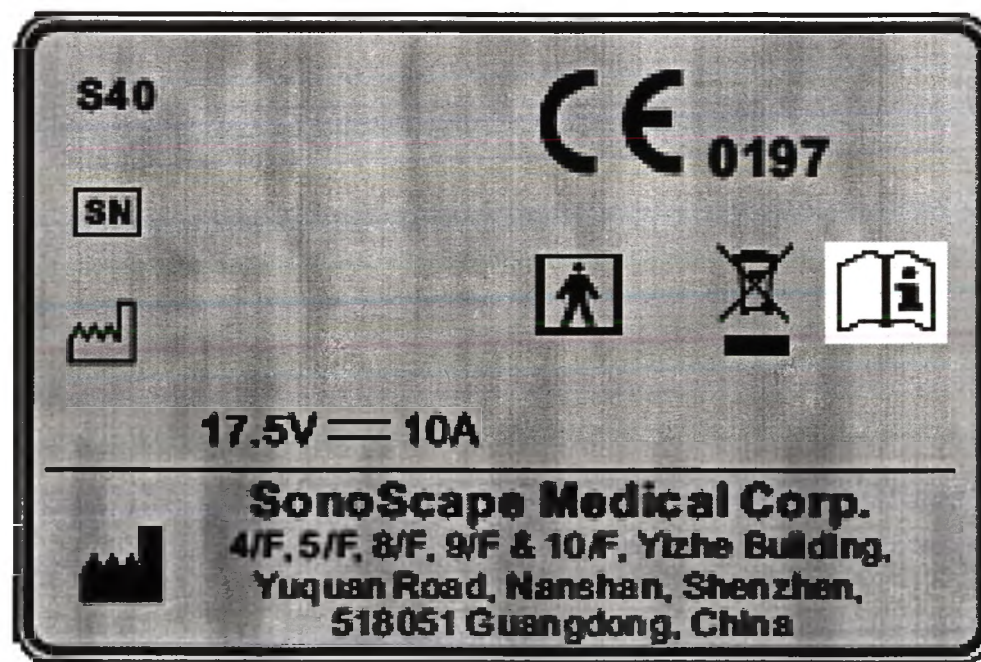


Макет маркировки. Модель S40

I. Аппарат ультразвуковой диагностический, вариант исполнения: S40. Макет маркировки




I. Аппарат ультразвуковой диагностический, вариант исполнения: S40 Exp

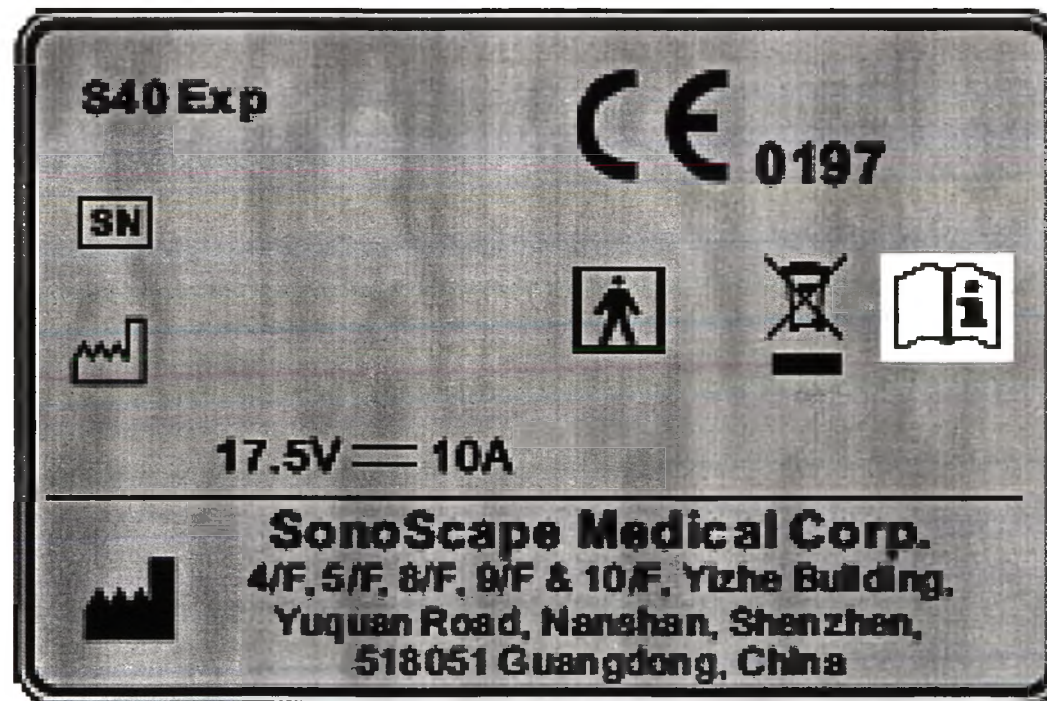

Макет маркировки. Модель S40 Exp

I. Аппарат ультразвуковой диагностический, вариант исполнения: S40 Exp. Макет маркировки

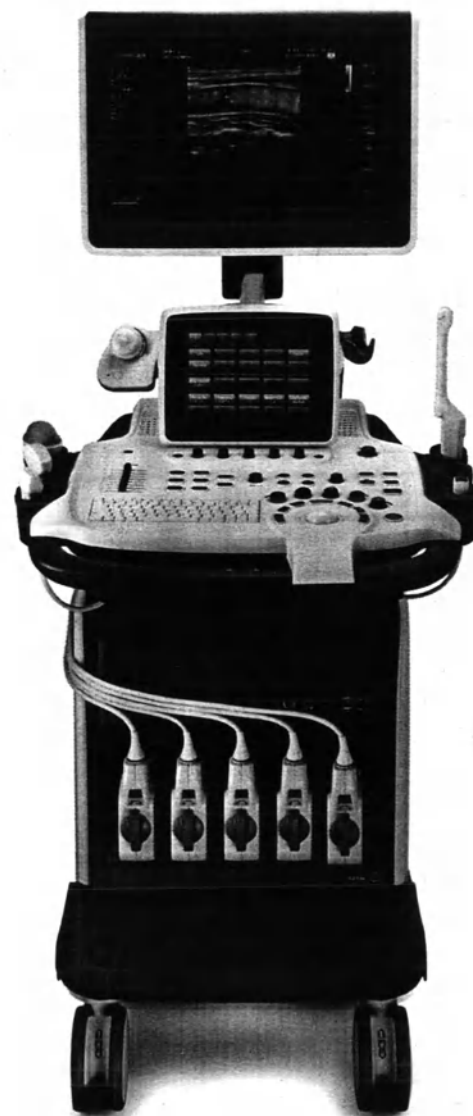

I. Аппарат ультразвуковой диагностический, вариант исполнения: S40 Pro



Макет маркировки. Модель S40 Pro

I. Аппарат ультразвуковой диагностический, вариант исполнения: S40 Pro. Макет маркировки



II. Принадлежности: 1. Датчик микроконвексный ректовагинальный, высокой плотности, ультразвуковой – не более 2 шт.




2. Датчик микроконвексный ректовагинальный ультразвуковой – не более 2 шт.



3. Датчик микроконвексный внутриполостной трансректальный ультразвуковой – не более 2 шт.



4. Датчик микроконвексный внутриполостной ультразвуковой – не более 2 шт.

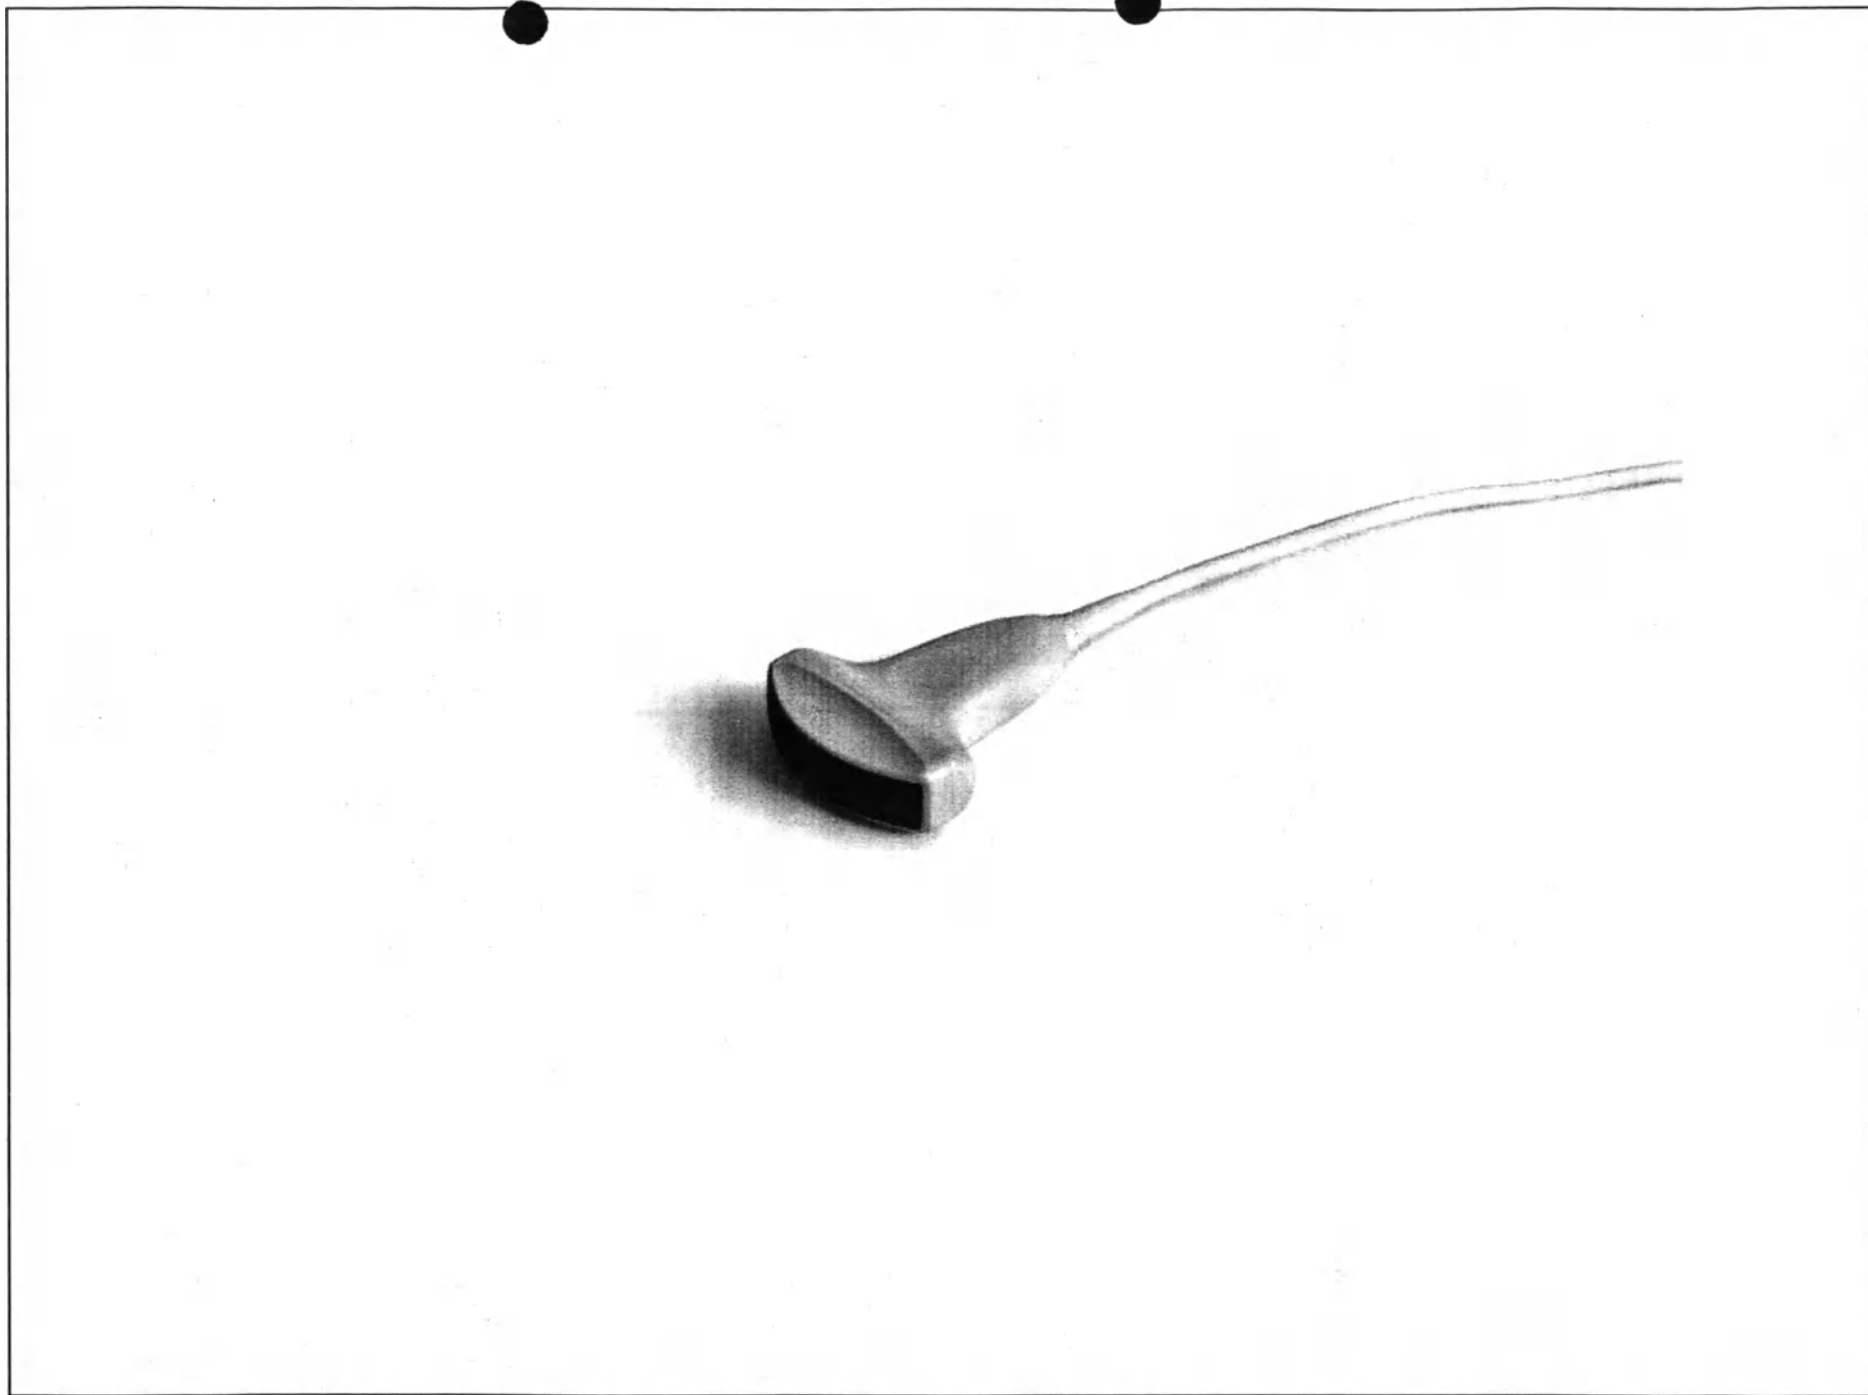


5. Датчик конвексный низкочастотный, высокой плотности, ультразвуковой – не более 2 шт.



6. Датчик конвексный высокочастотный ультразвуковой – не более 2 шт.



7. Датчик конвексный низкочастотный ультразвуковой – не более 2 шт.

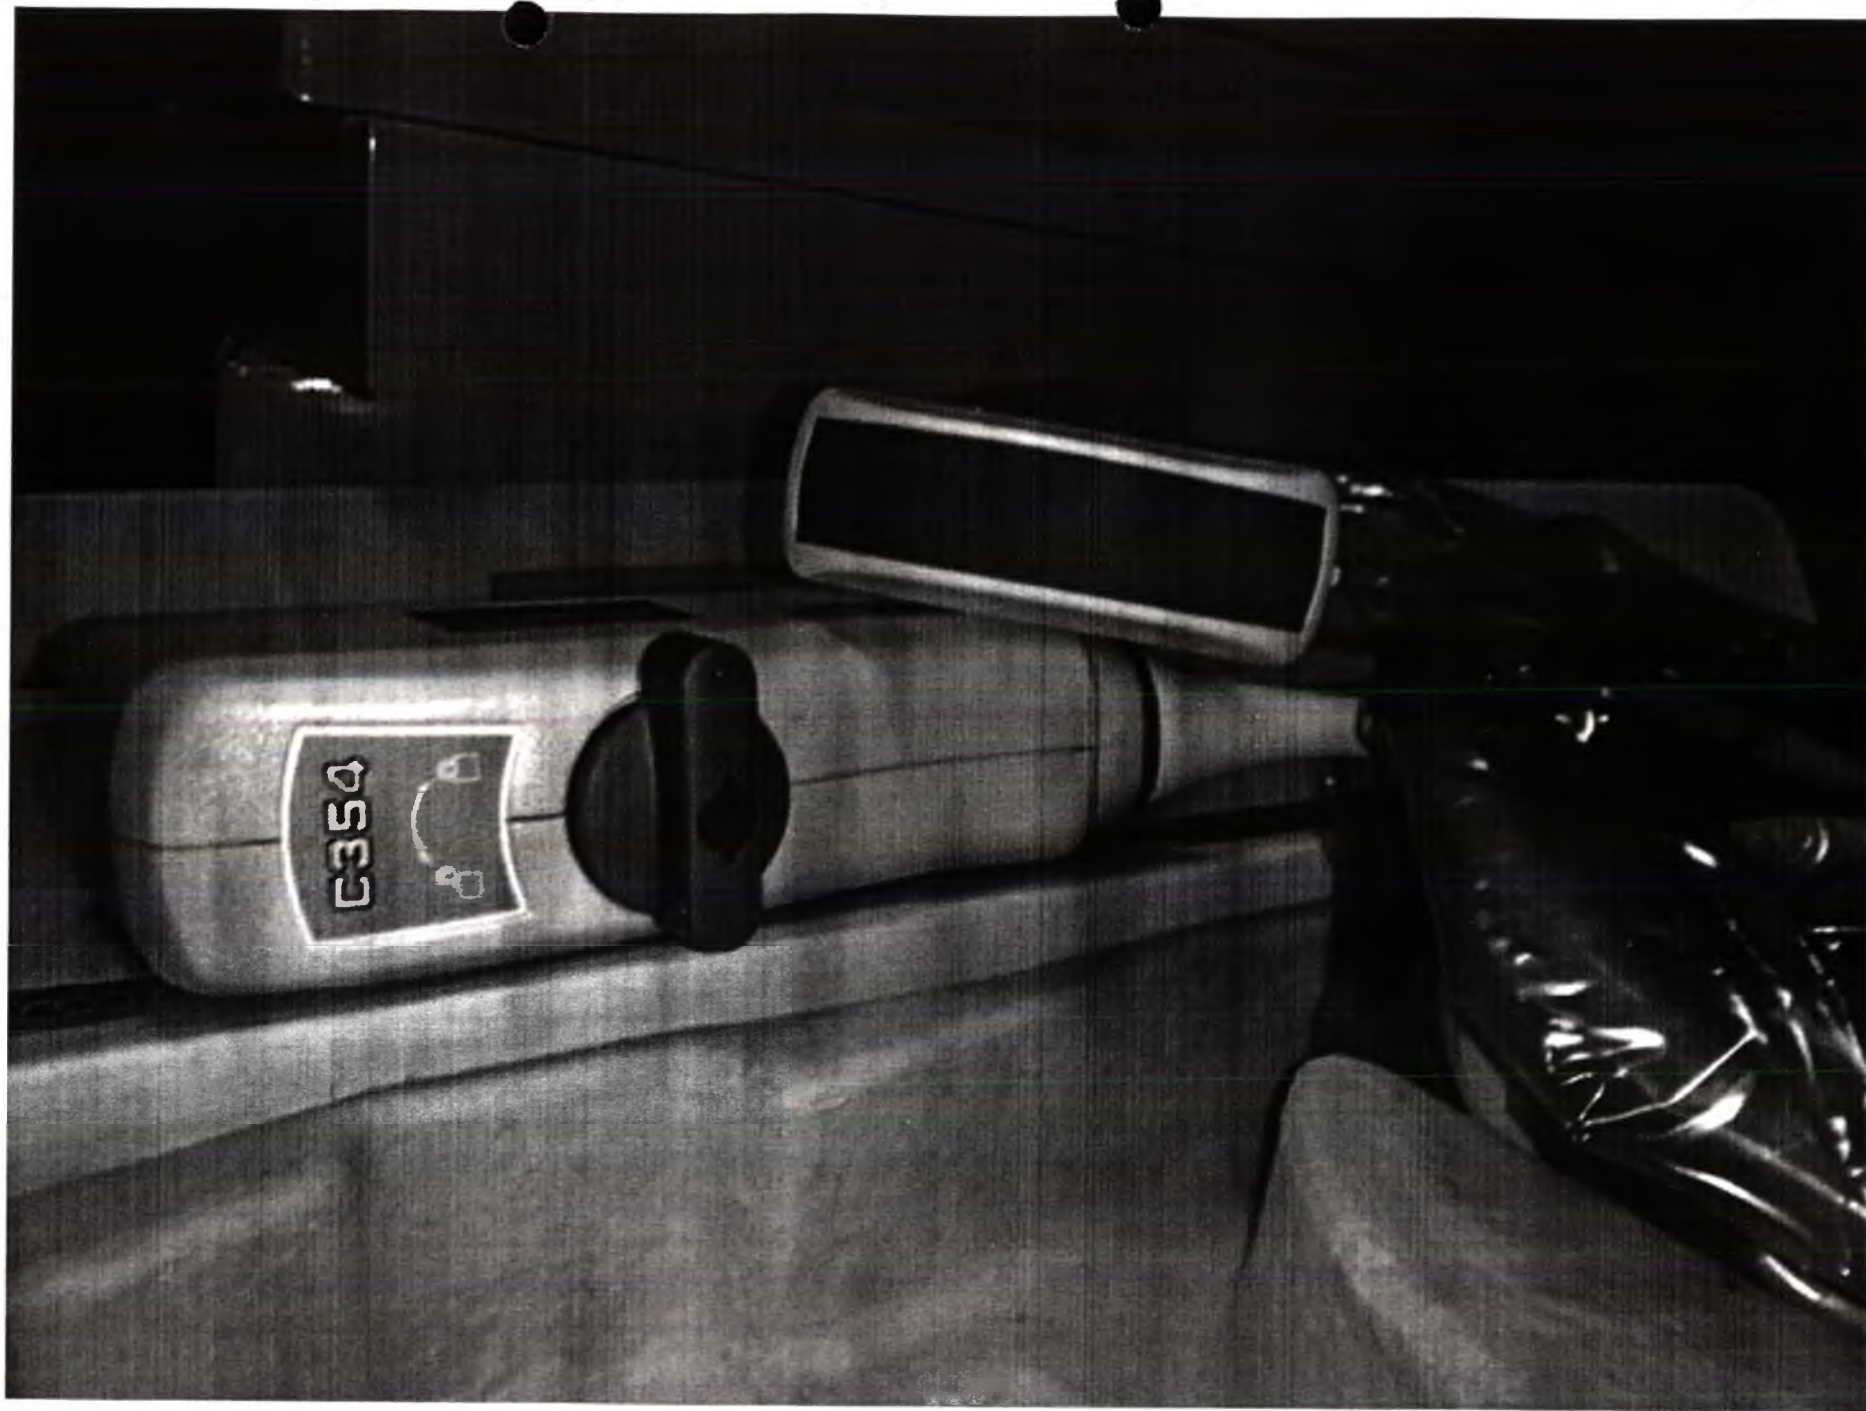

8. Датчик конвексный низкочастотный абдоминальный ультразвуковой – не более 2 шт.



9. Датчик линейный высокочастотный, высокой плотности, ультразвуковой – не более 2 шт.




10. Датчик линейный высокочастотный ультразвуковой – не более 2 шт.



11. Датчик линейный высокочастотный для обследований сосудов, высокой плотности, ультразвуковой – не более 2 шт.




12. Датчик линейный высокочастотный для обследований сосудов ультразвуковой – не более 2 шт.

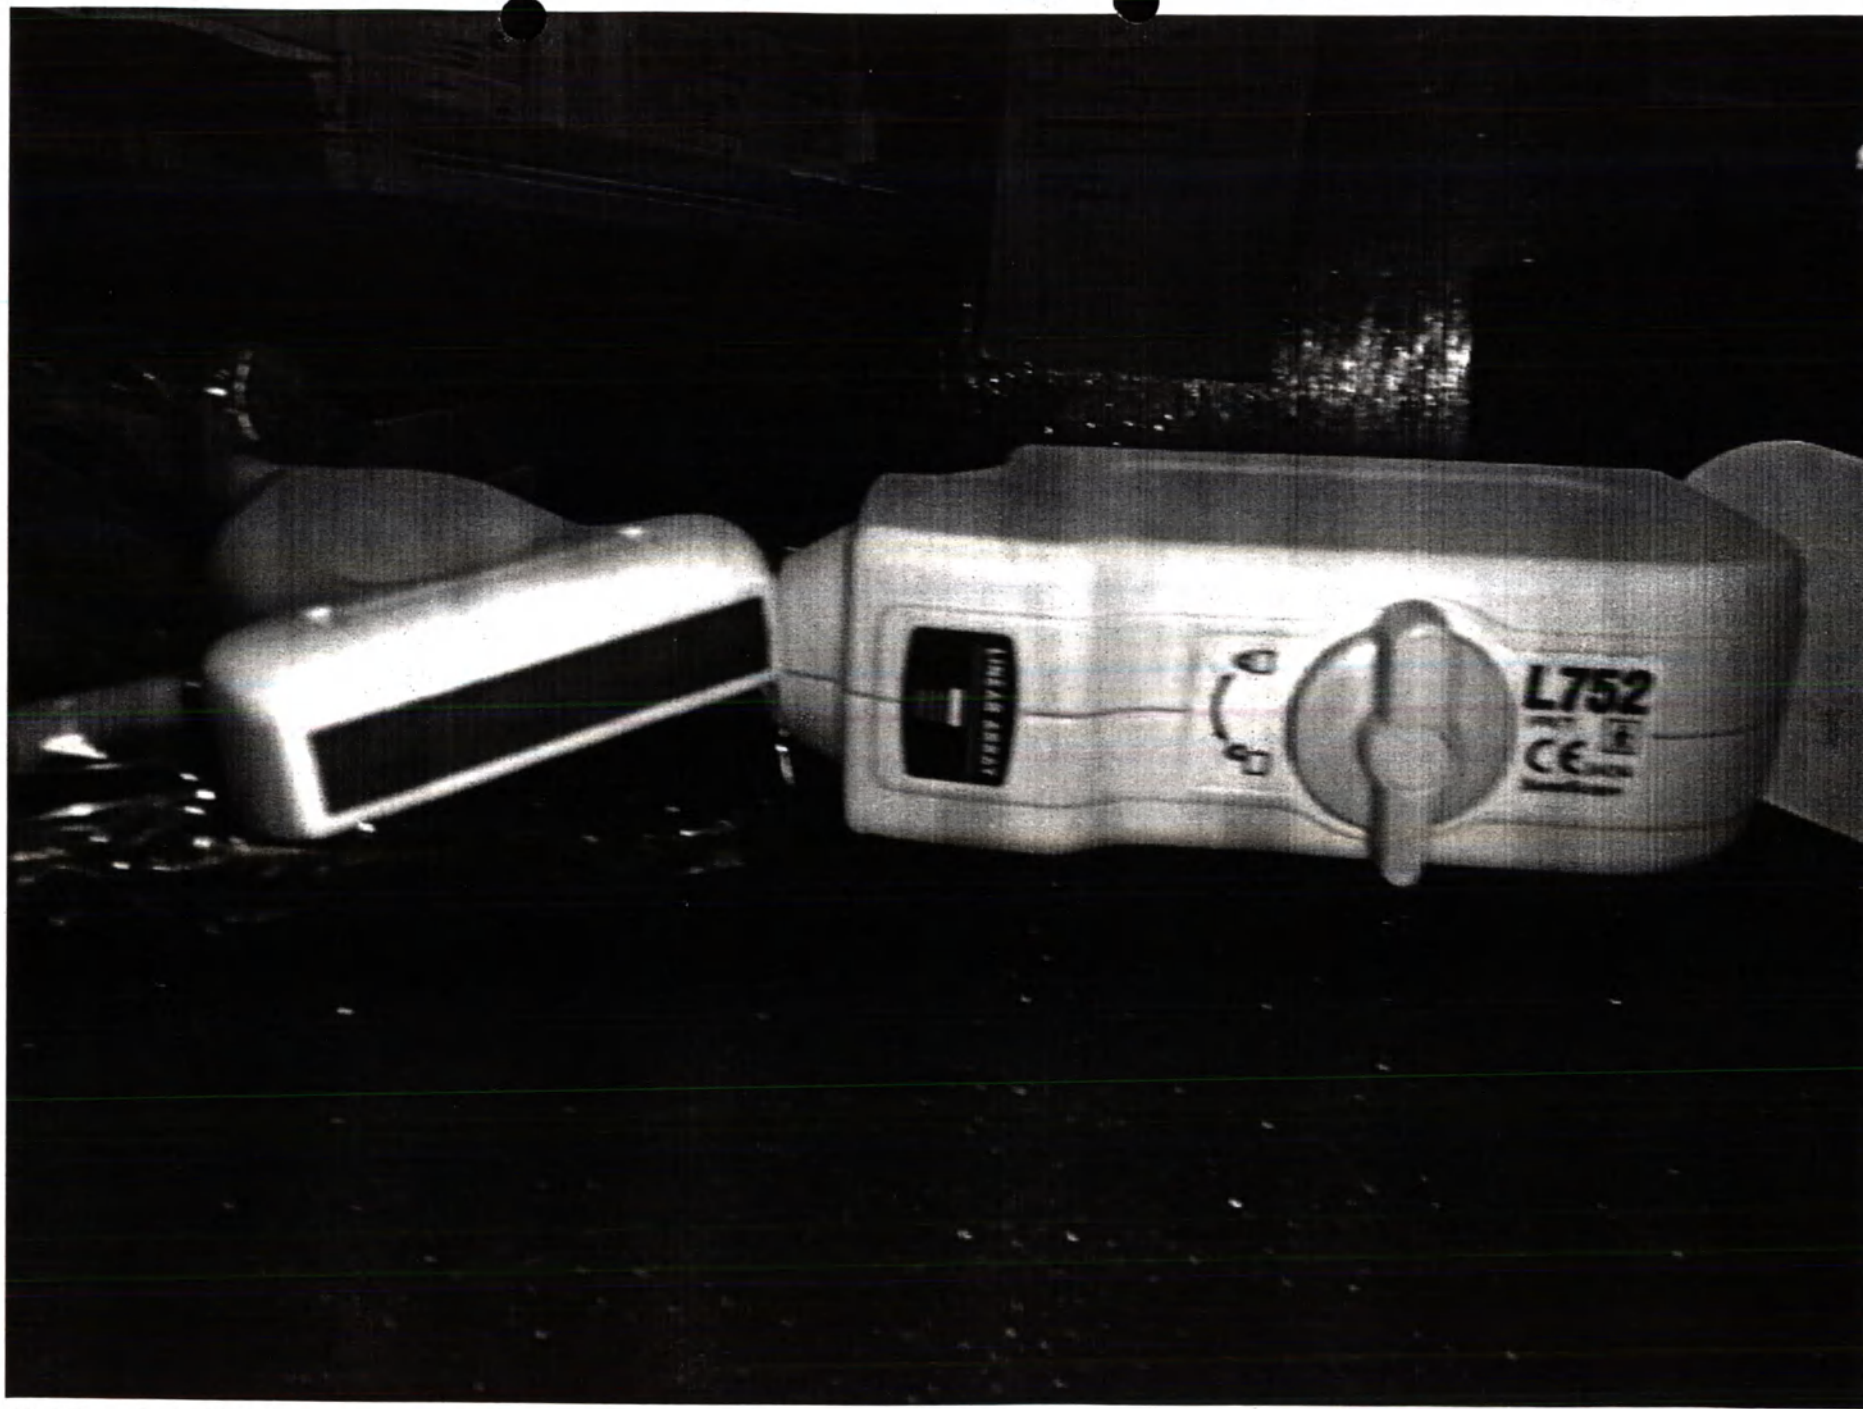


13. Датчик линейный высокочастотный для обследований поверхностных органов, сверхвысокой плотности, ультразвуковой – не более 2 шт.



14. Датчик линейный внутриполостной ультразвуковой – не более 2 шт.

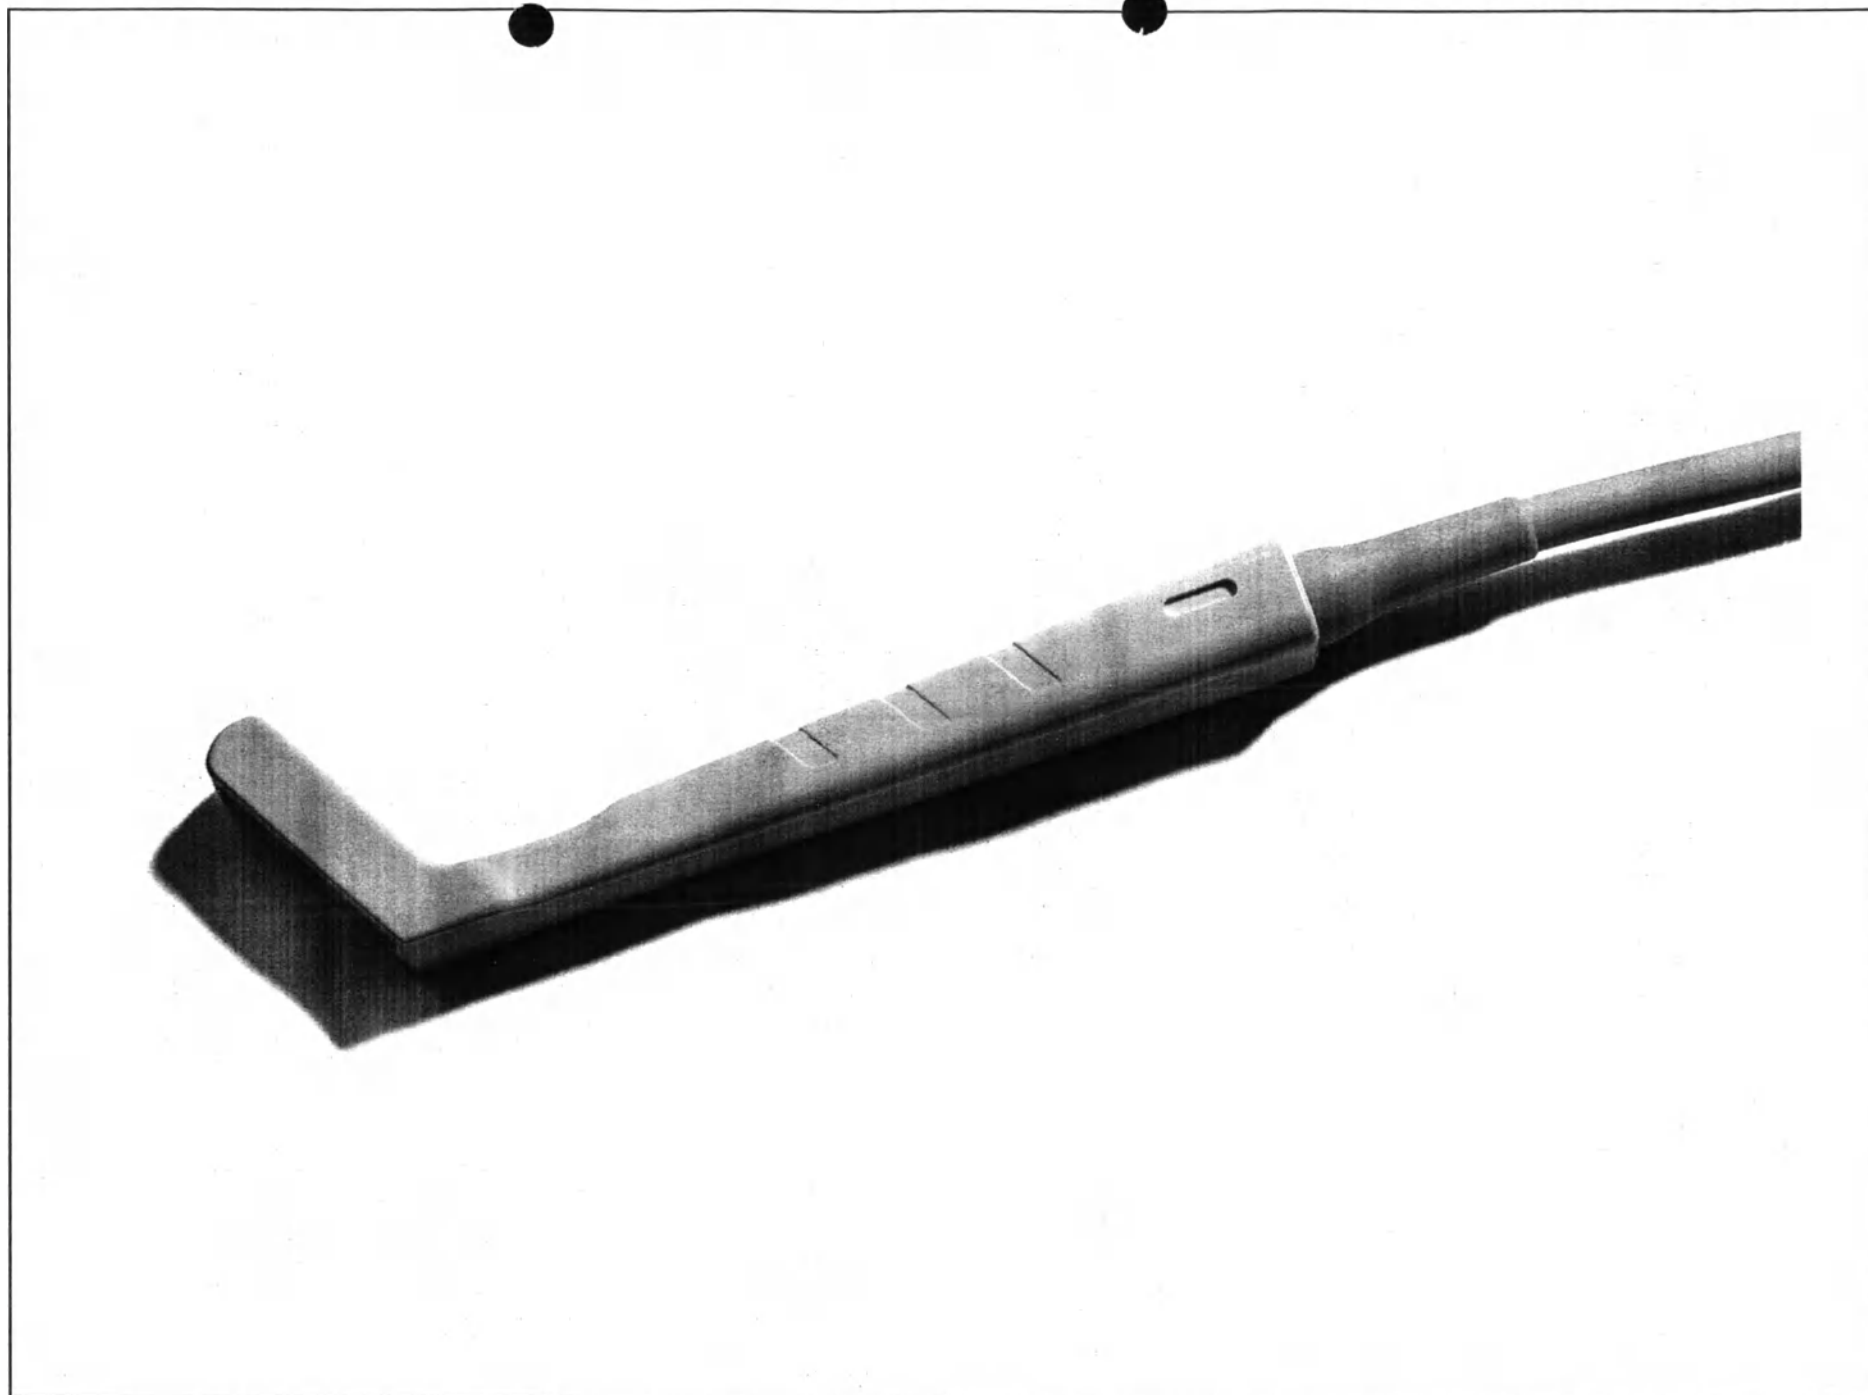


15. Датчик линейный интраоперационный ультразвуковой – не более 2 шт.

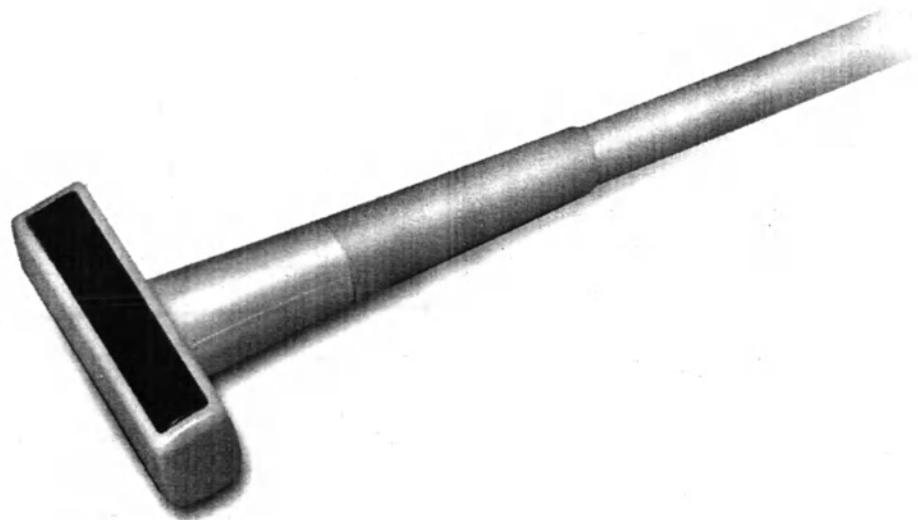


16. Датчик линейный интраоперационный Т-образный ультразвуковой – не более 2 шт.


21

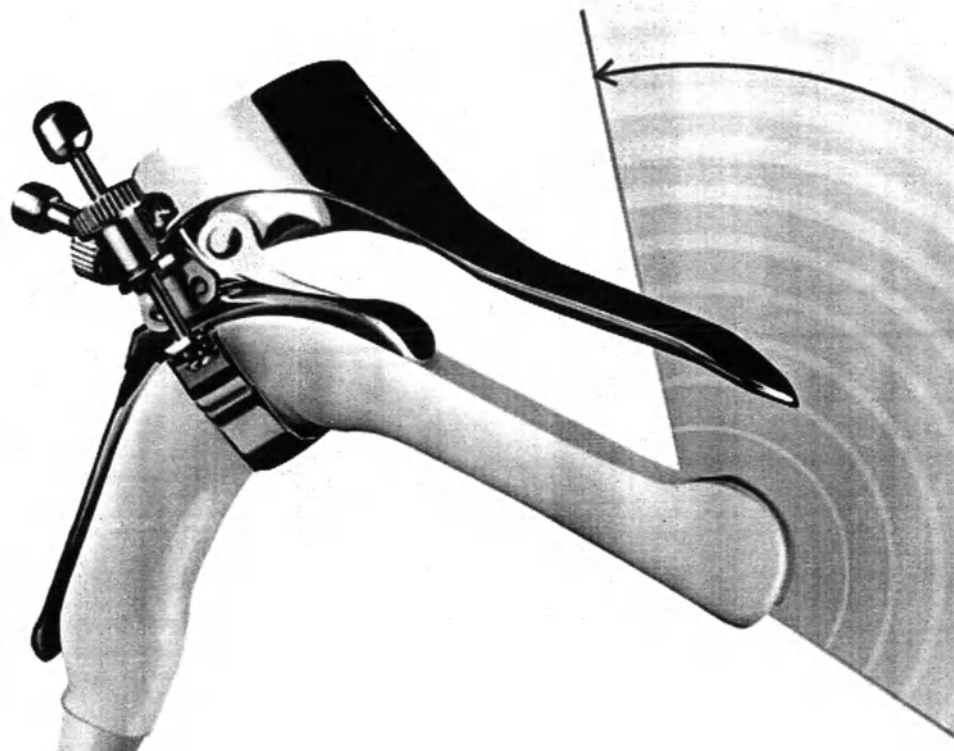


17. Датчик микроконвексный, встраиваемый в гинекологическое зеркало, ультразвуковой – не более 2 шт.

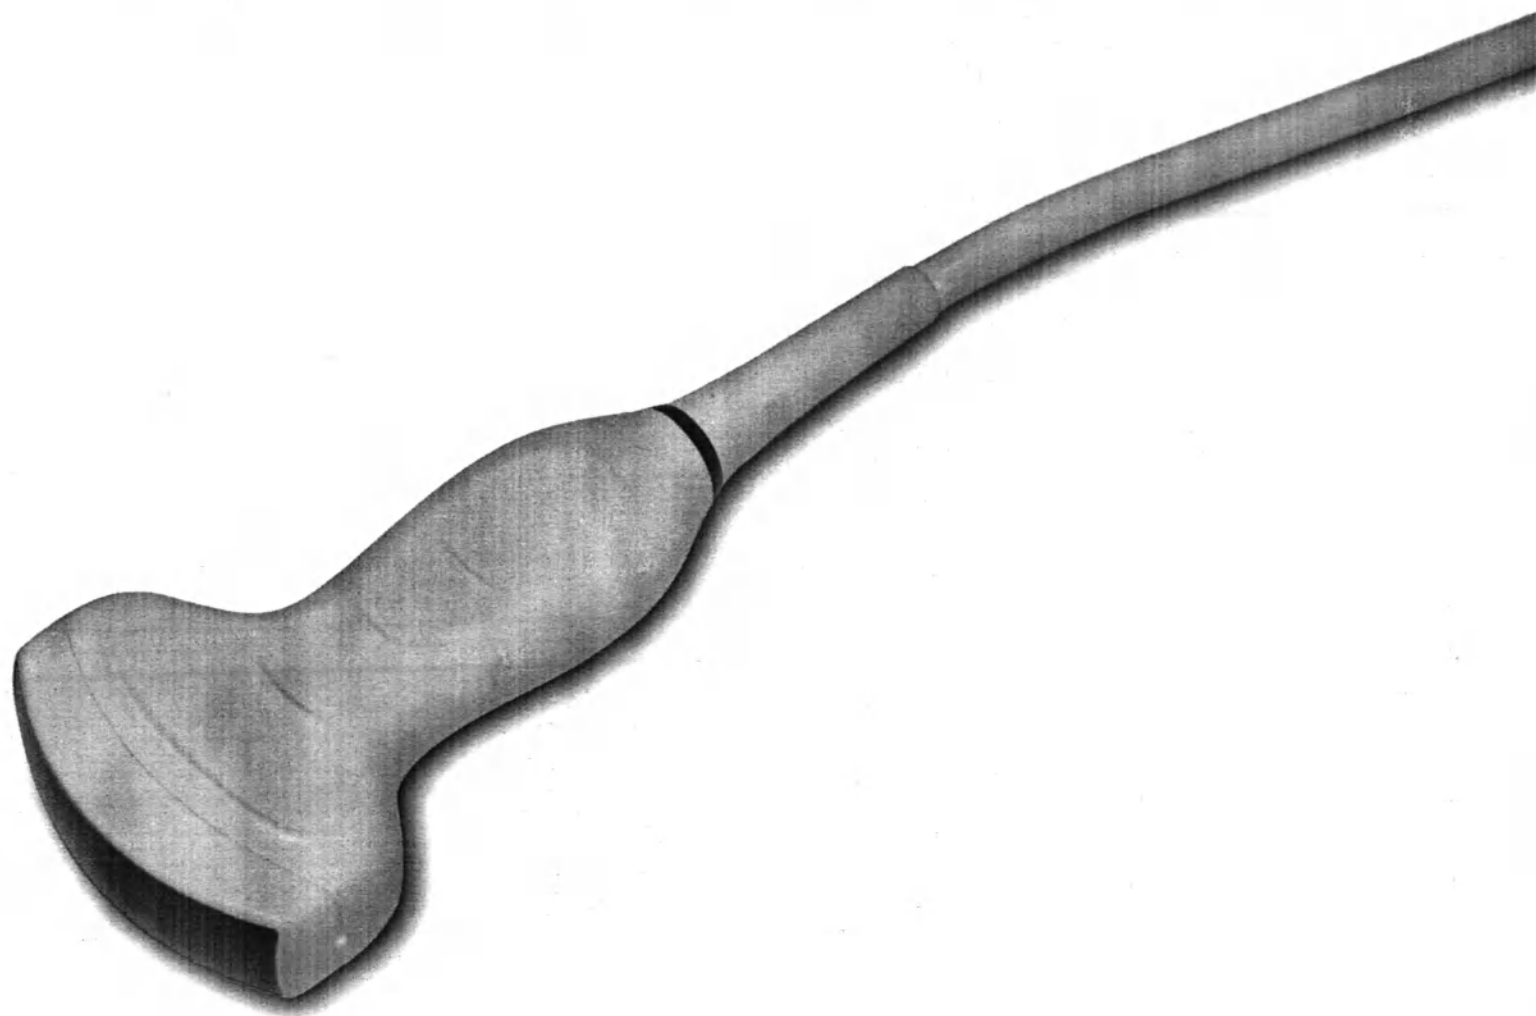


18. Датчик конвексный широкополосный ультразвуковой – не более 2 шт.

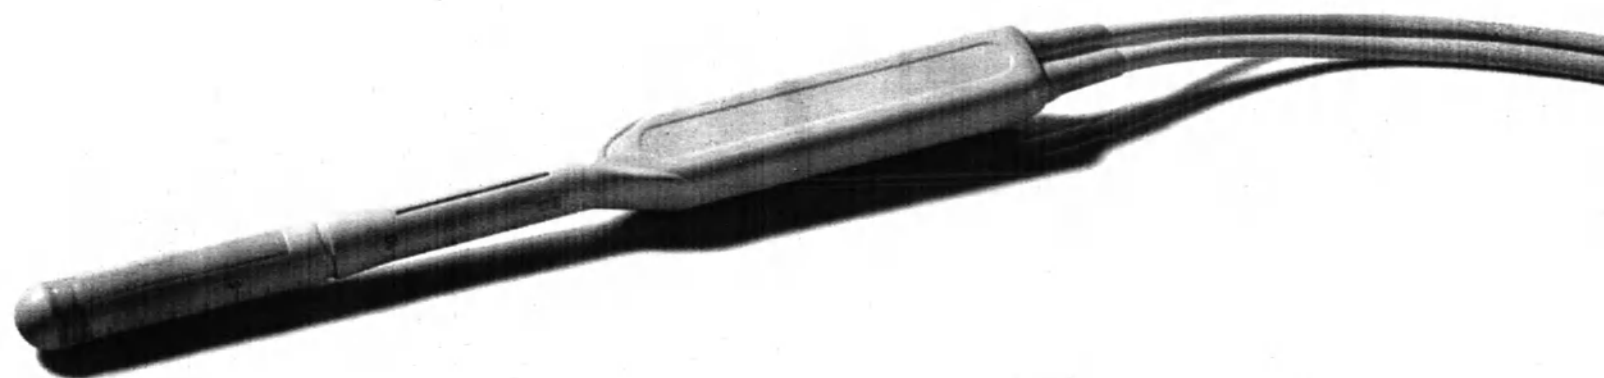

19. Датчик биплановый внутриволокнистый линейно-микроволновый – не более 2 шт.

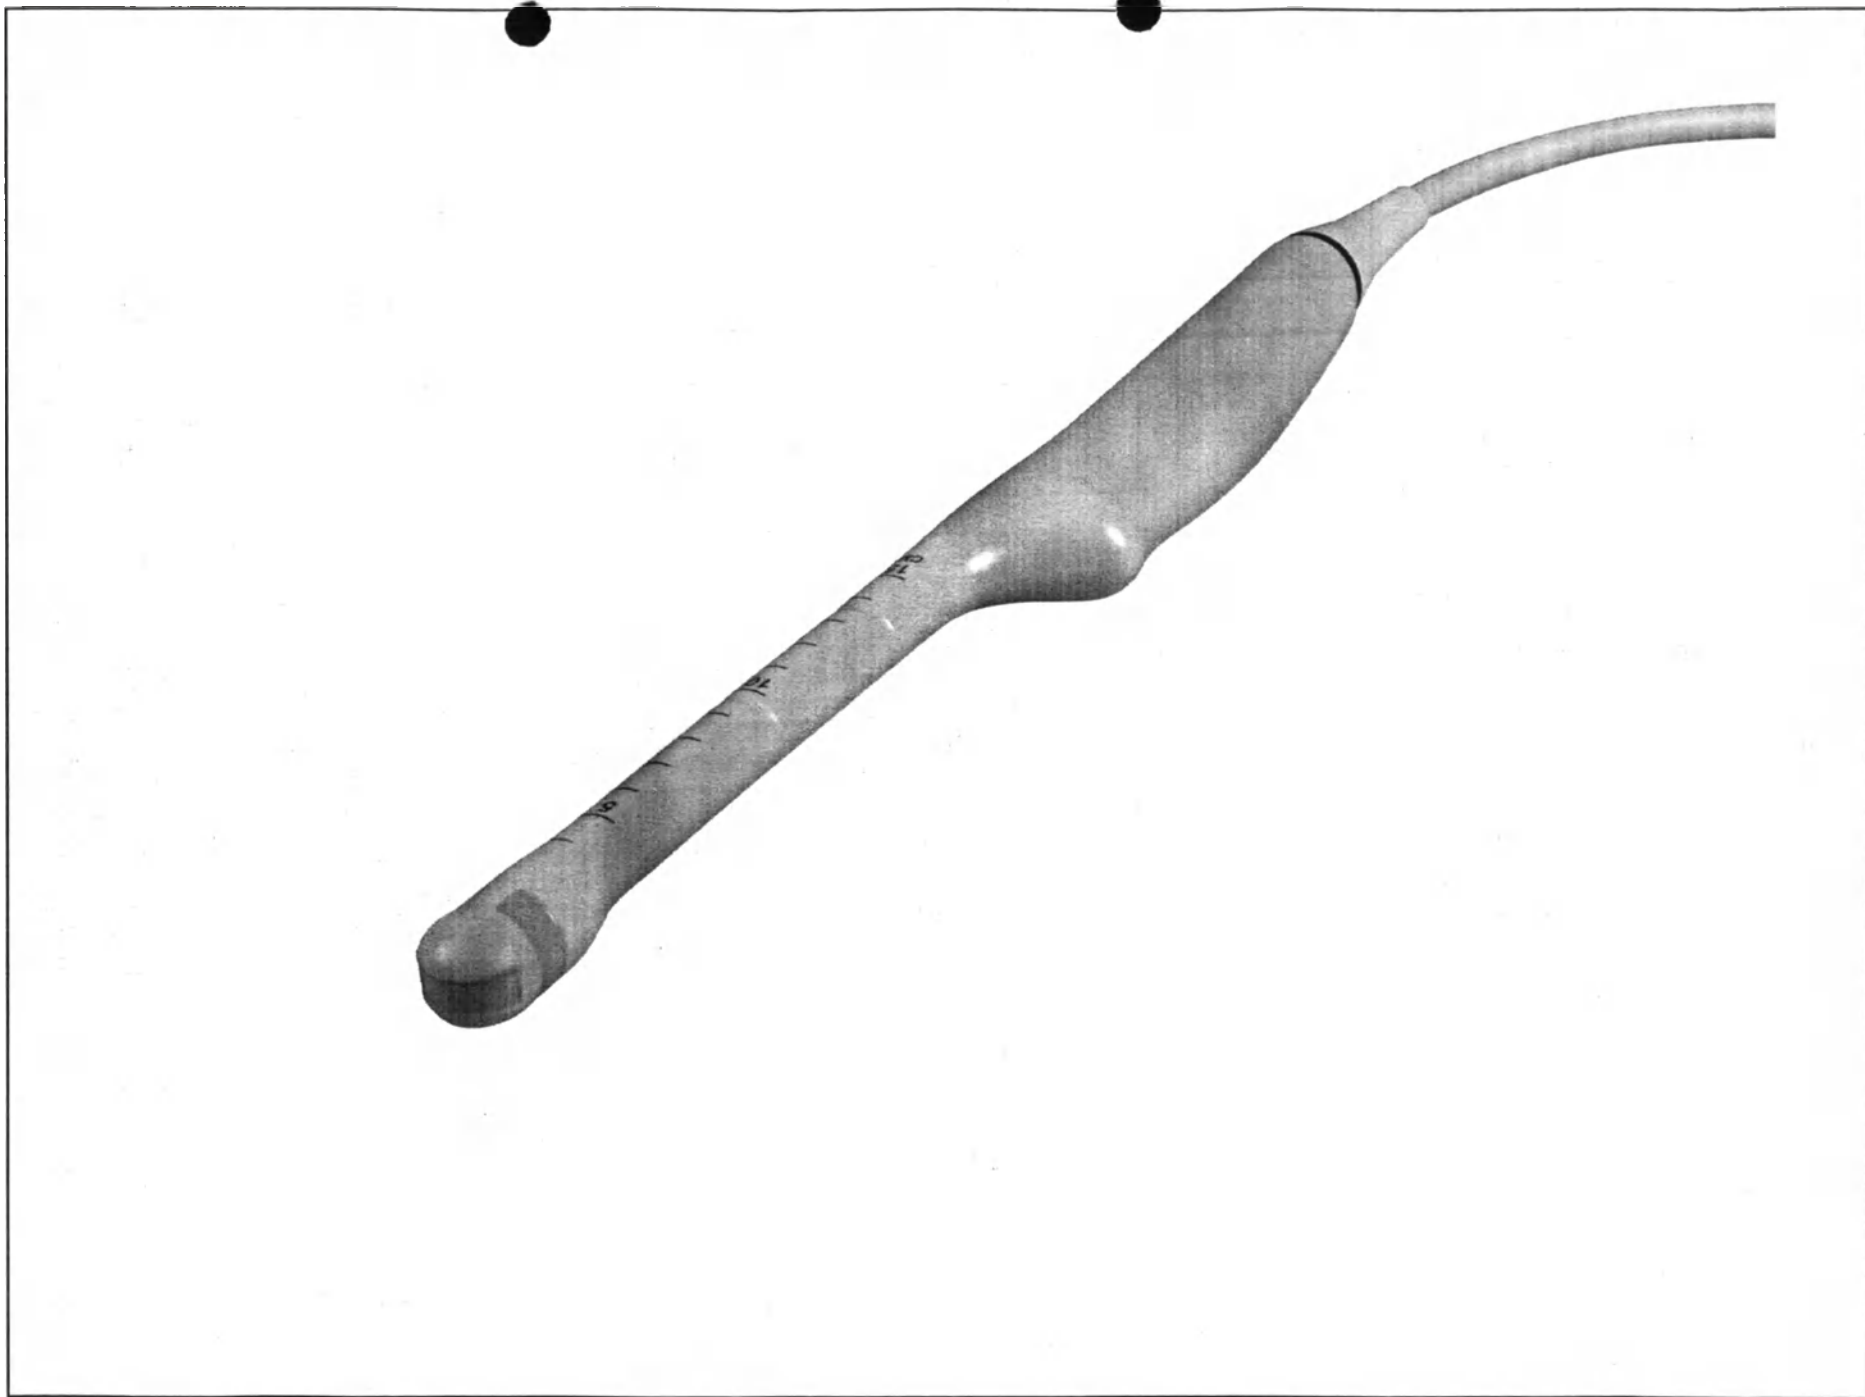


20. Датчик биплановый внутриволокнистый микроконвексно-микроконвексный ультразвуковой – не более 2 шт.

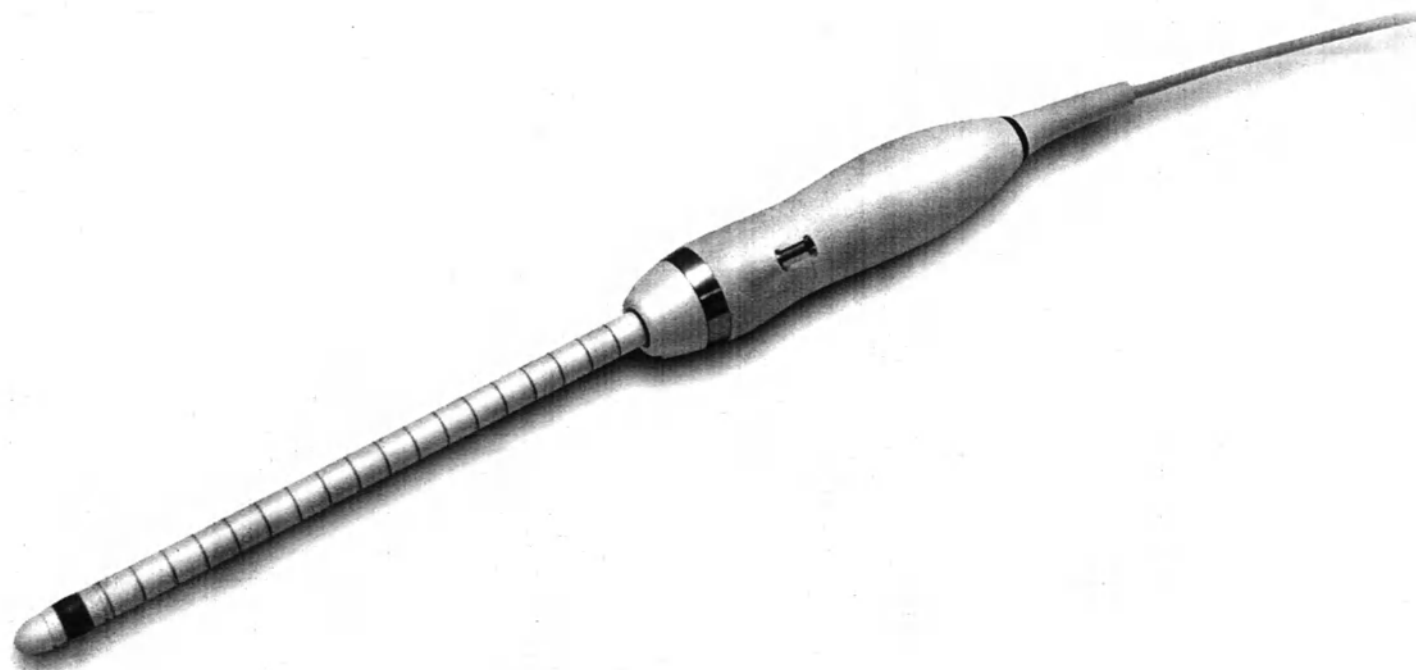


21. Датчик трансректальный радиального сканирования ультразвуковой – не более 2 шт.




22. Датчик секторный фазированный низкочастотный ультразвуковой – не более 2 шт.

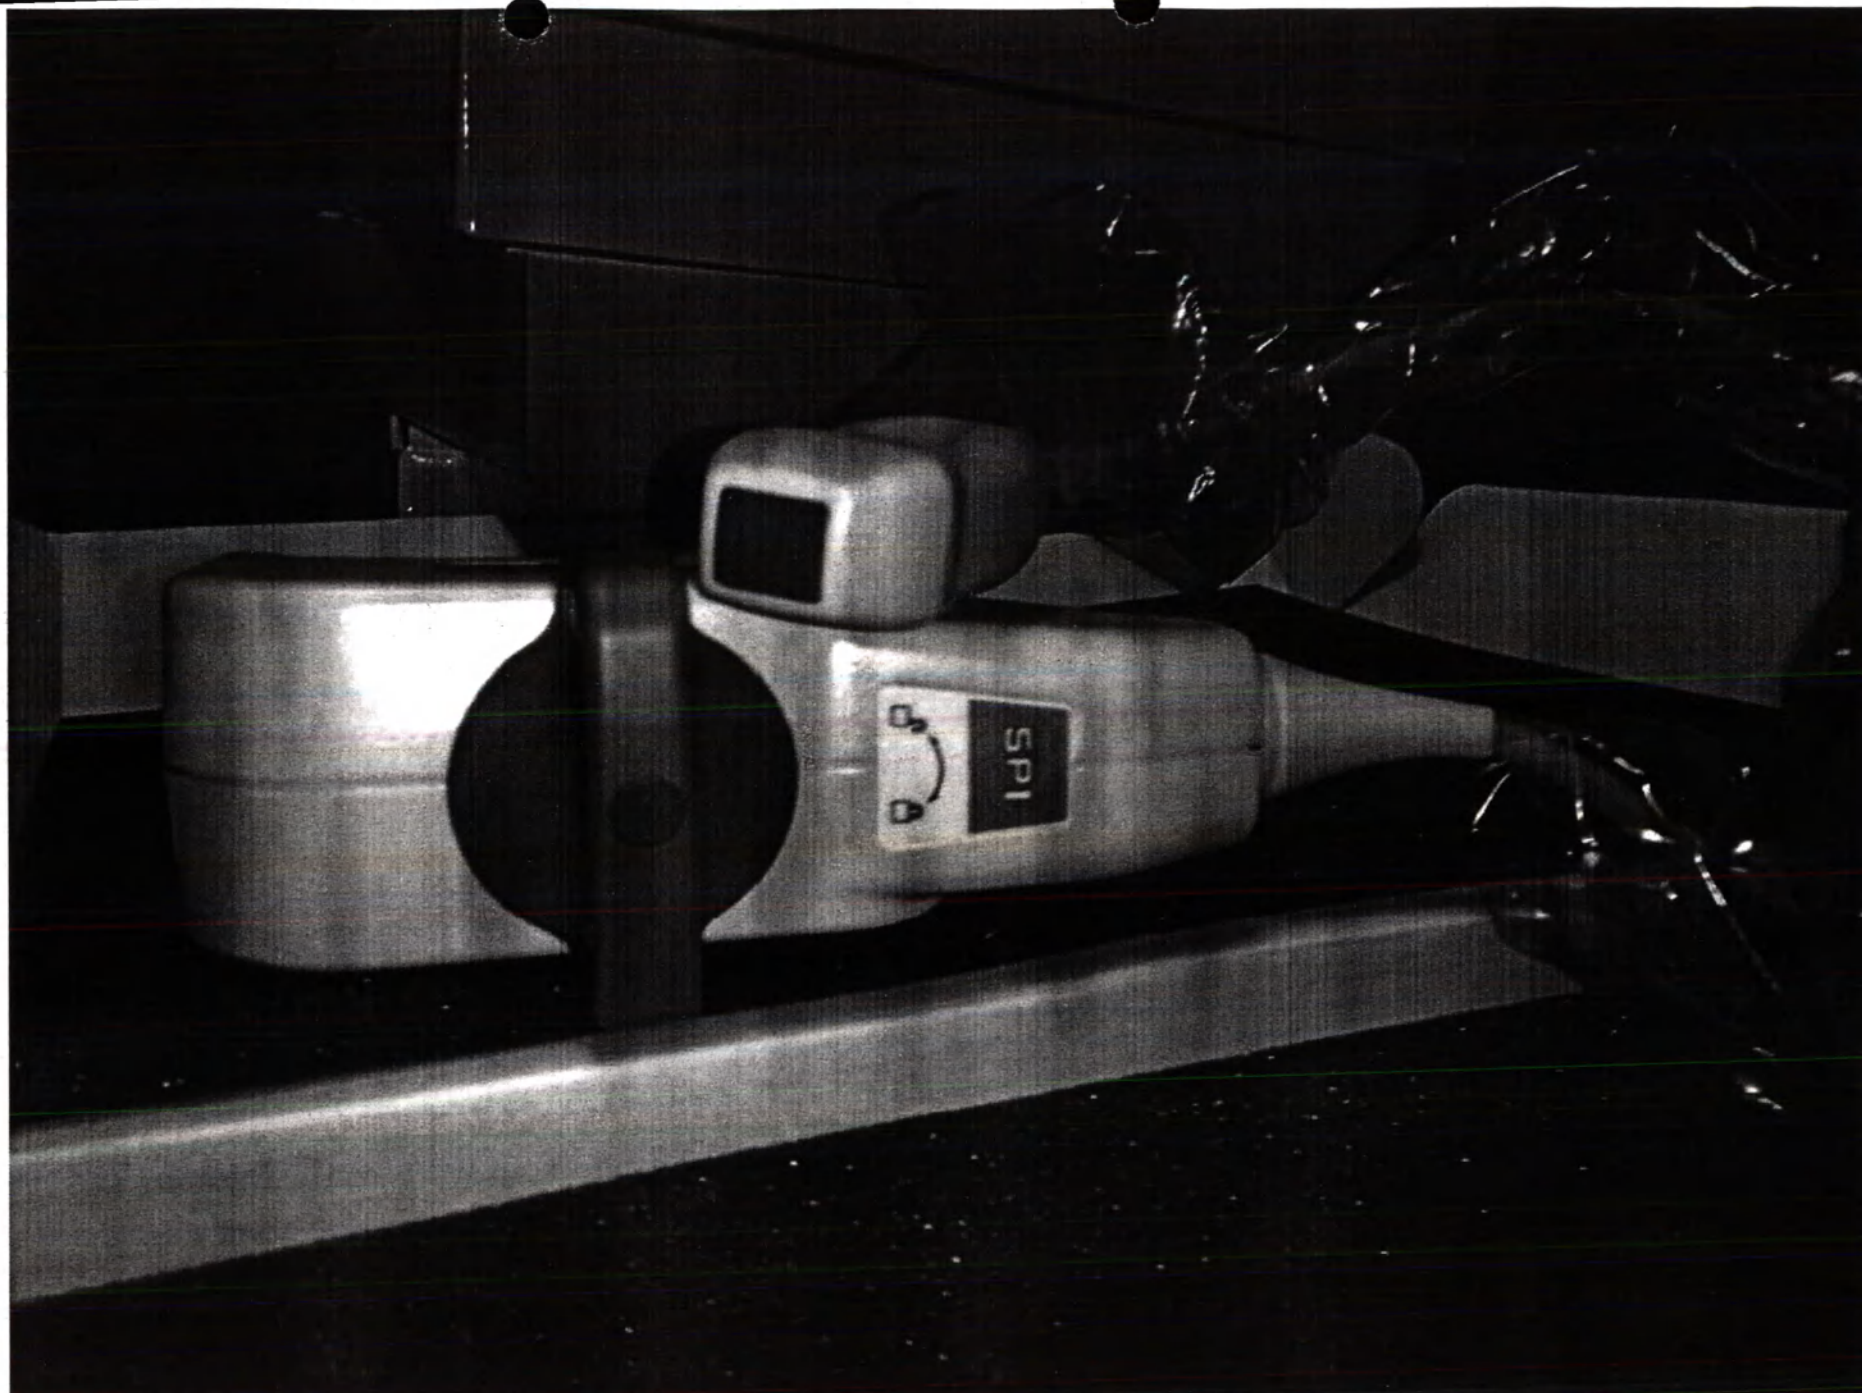

23. Датчик секторный фазированный высокочастотный ультразвуковой – не более 2 шт.

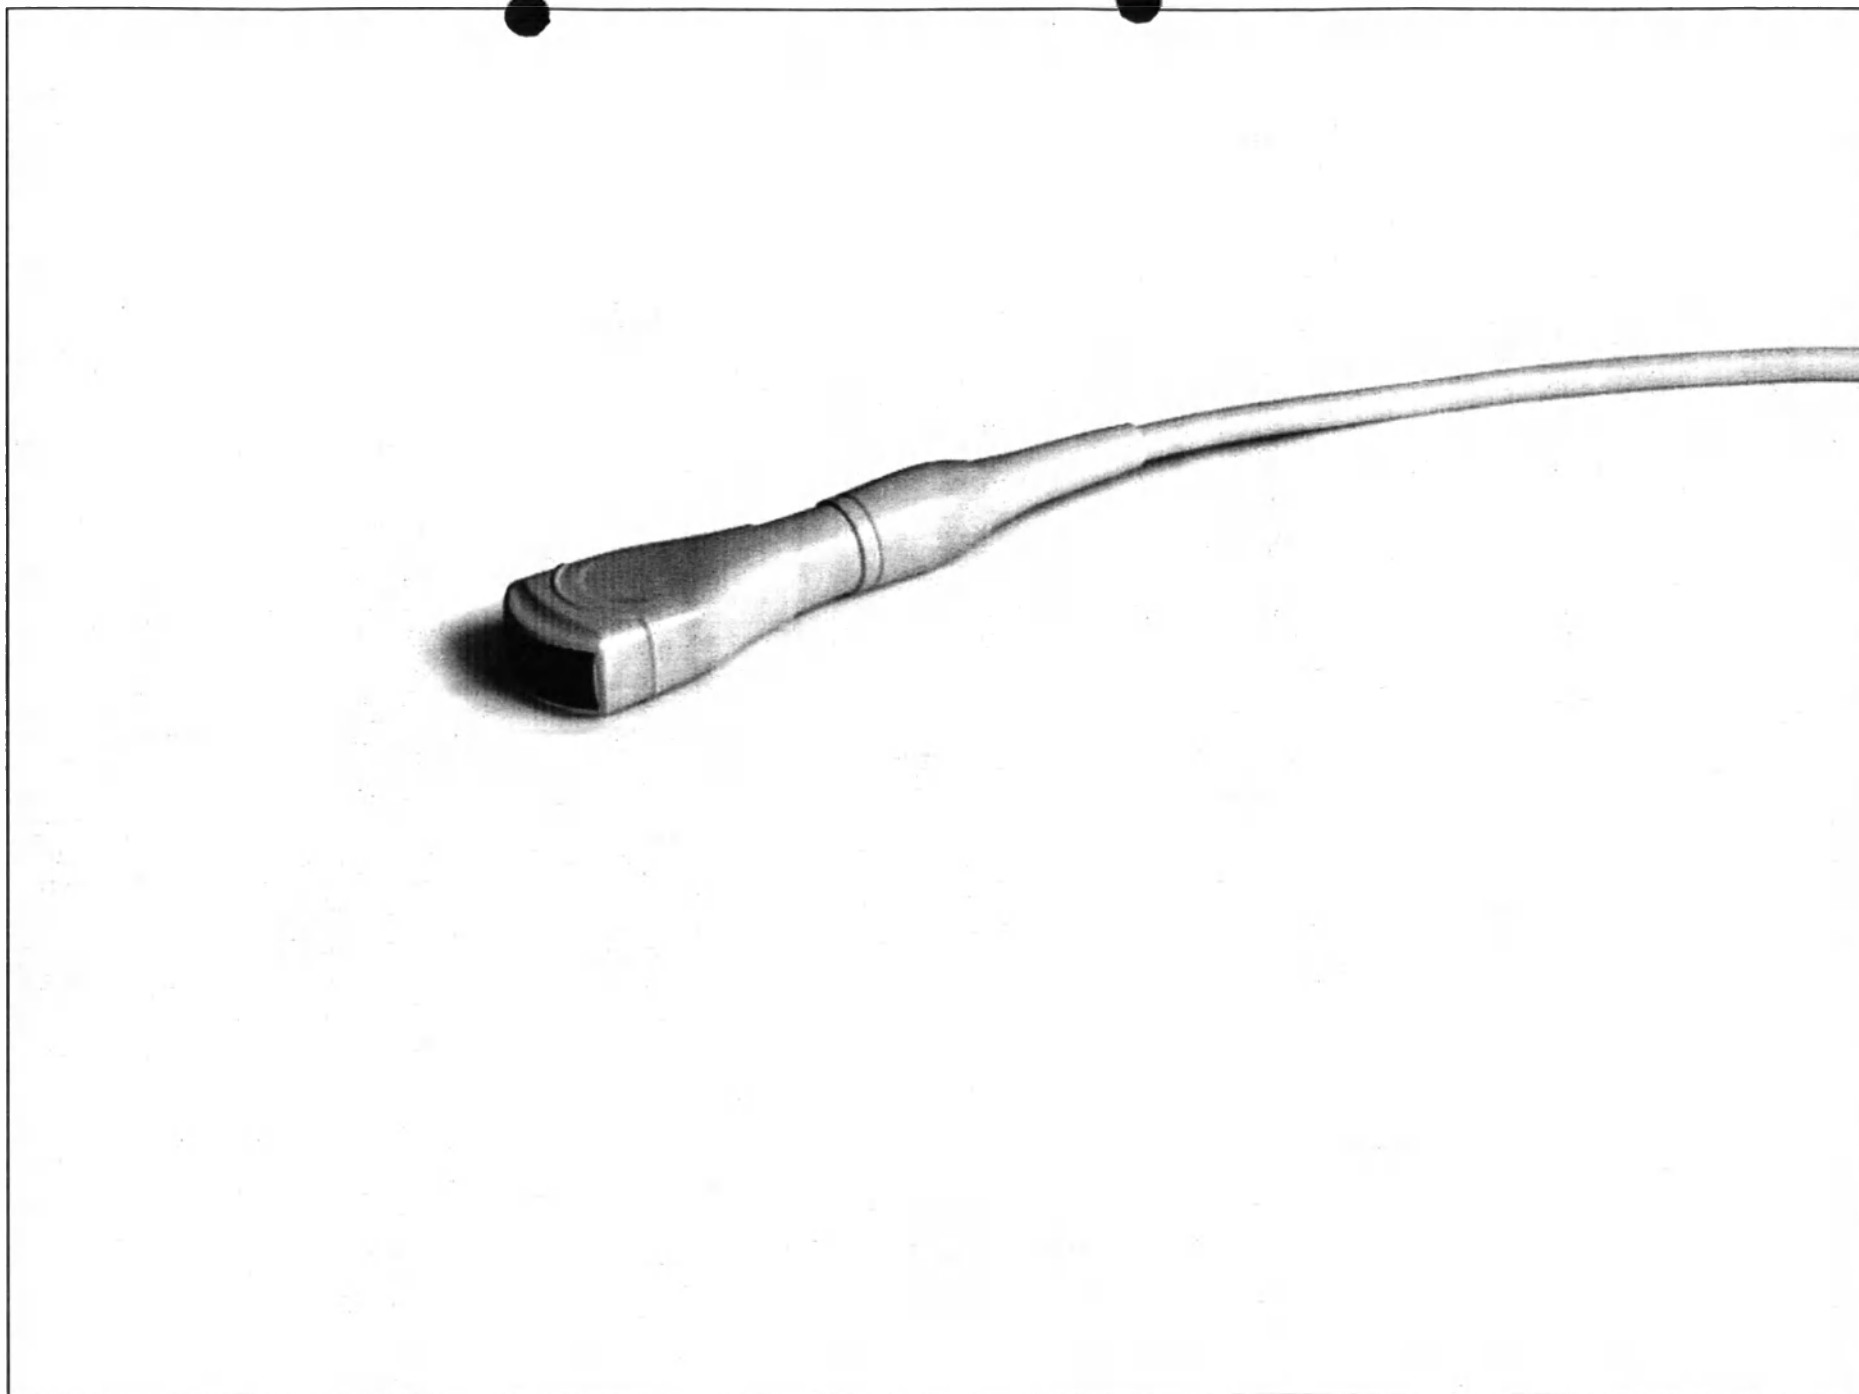

24. Датчик микроконвексный низкочастотный ультразвуковой – не более 2 шт.

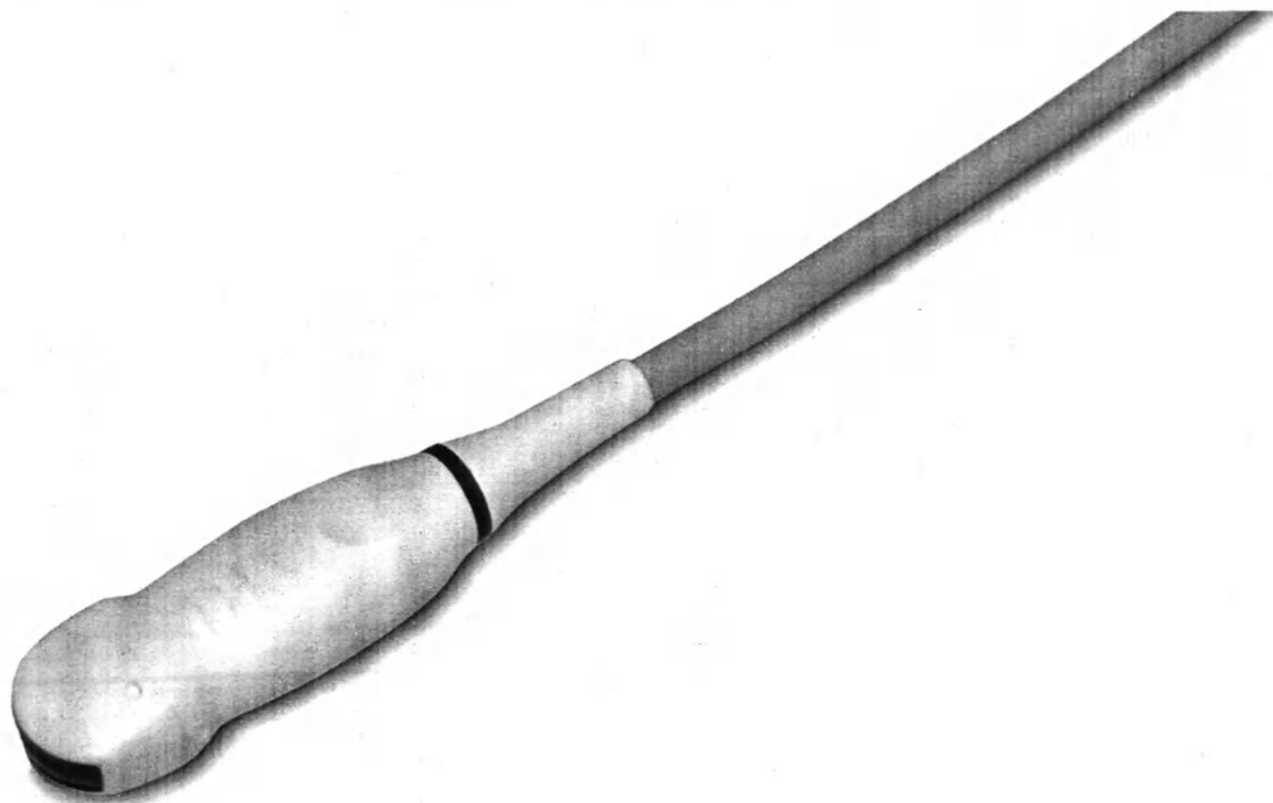


25. Датчик микроконвексный высокочастотный ультразвуковой – не более 2 шт.




26. Датчик монокристалльный конвексный ультразвуковой – не более 2 шт.



27. Датчик широкополосный линейный ультразвуковой – не более 2 шт.

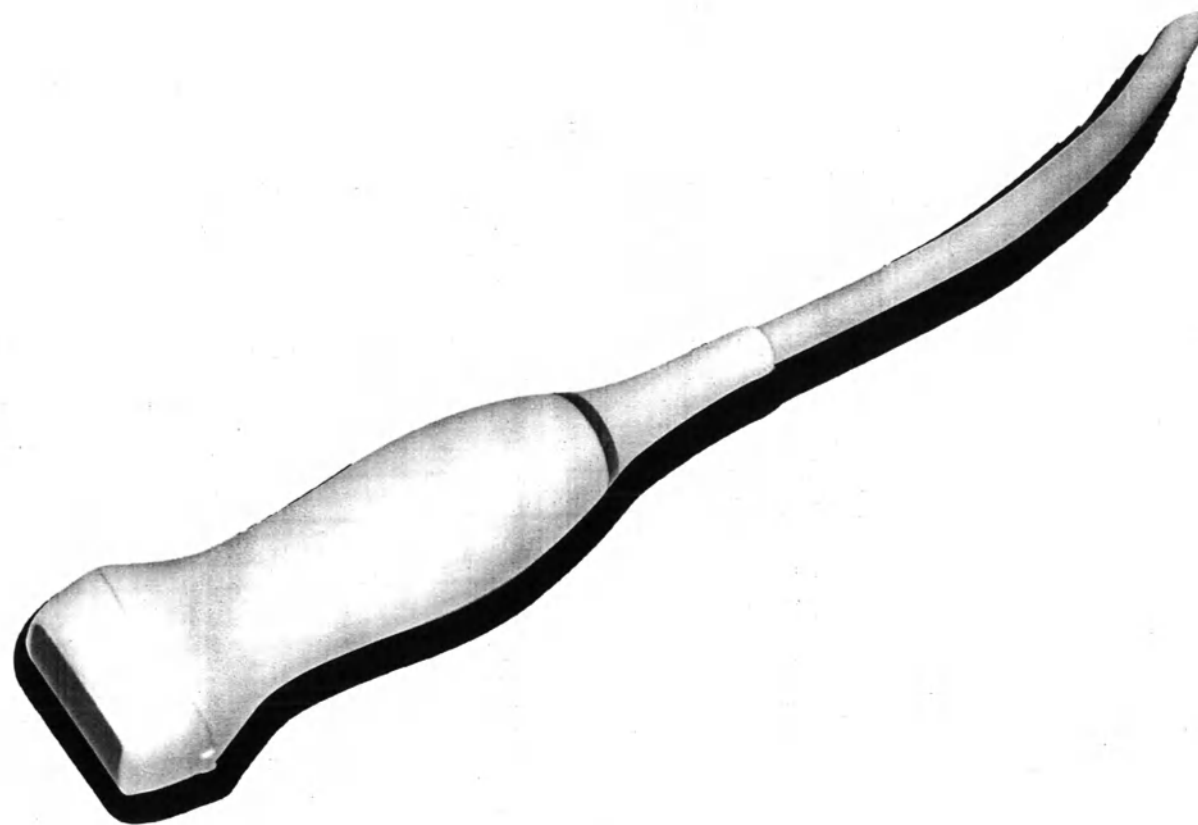


28. Датчик монокристалльный секторный фазированный ультразвуковой – не более 2 шт.

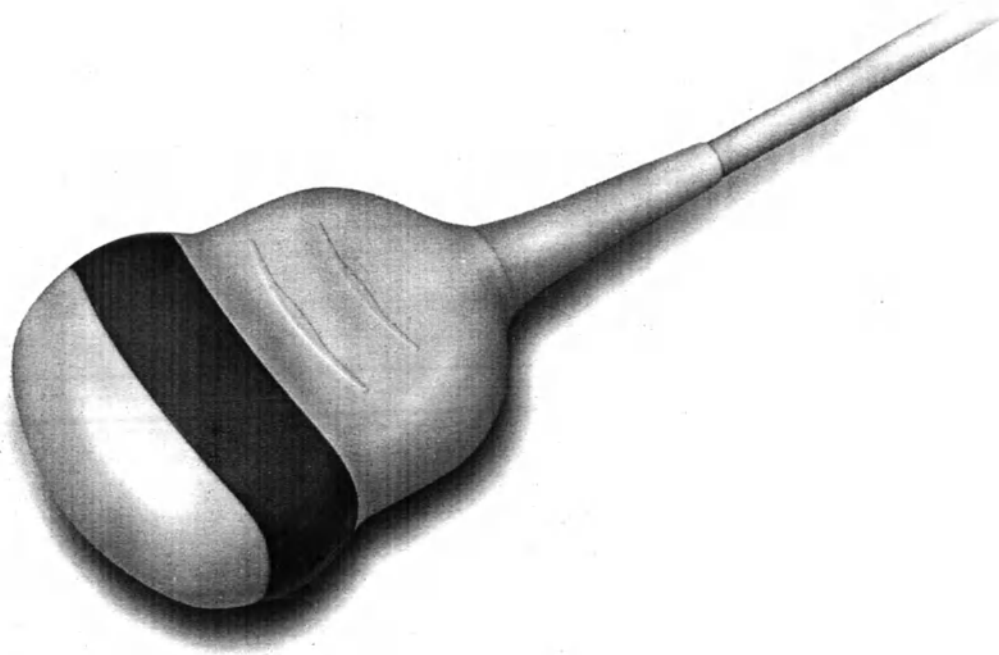


29. Датчик монокристалльный объемный ультразвуковой – не более 2 шт.




30. Датчик лапароскопический ультразвуковой – не более 2 шт.

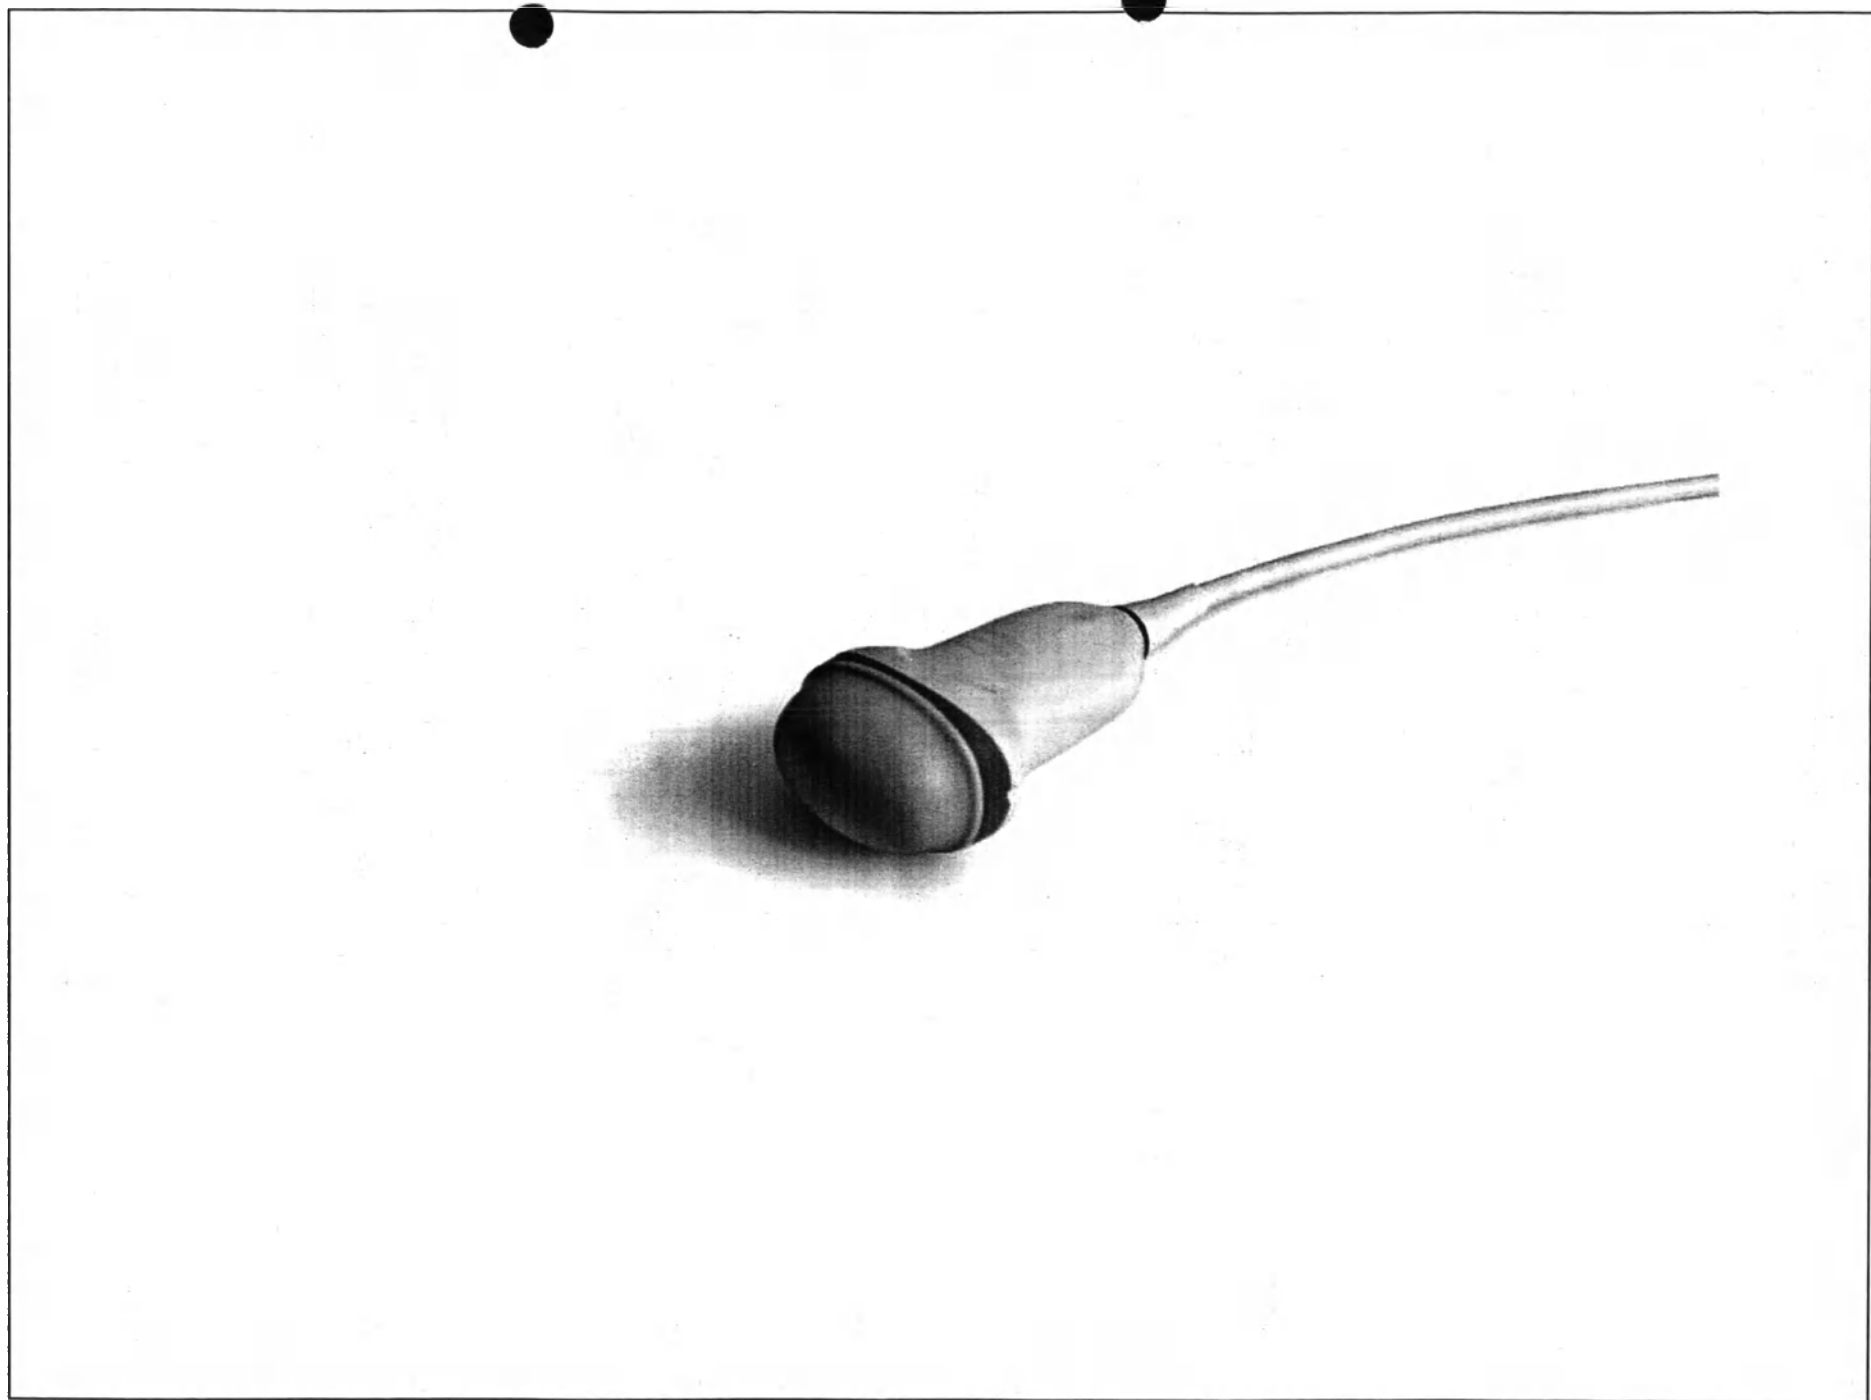


31. Датчик объемный конвексный ультразвуковой – не более 2 шт.

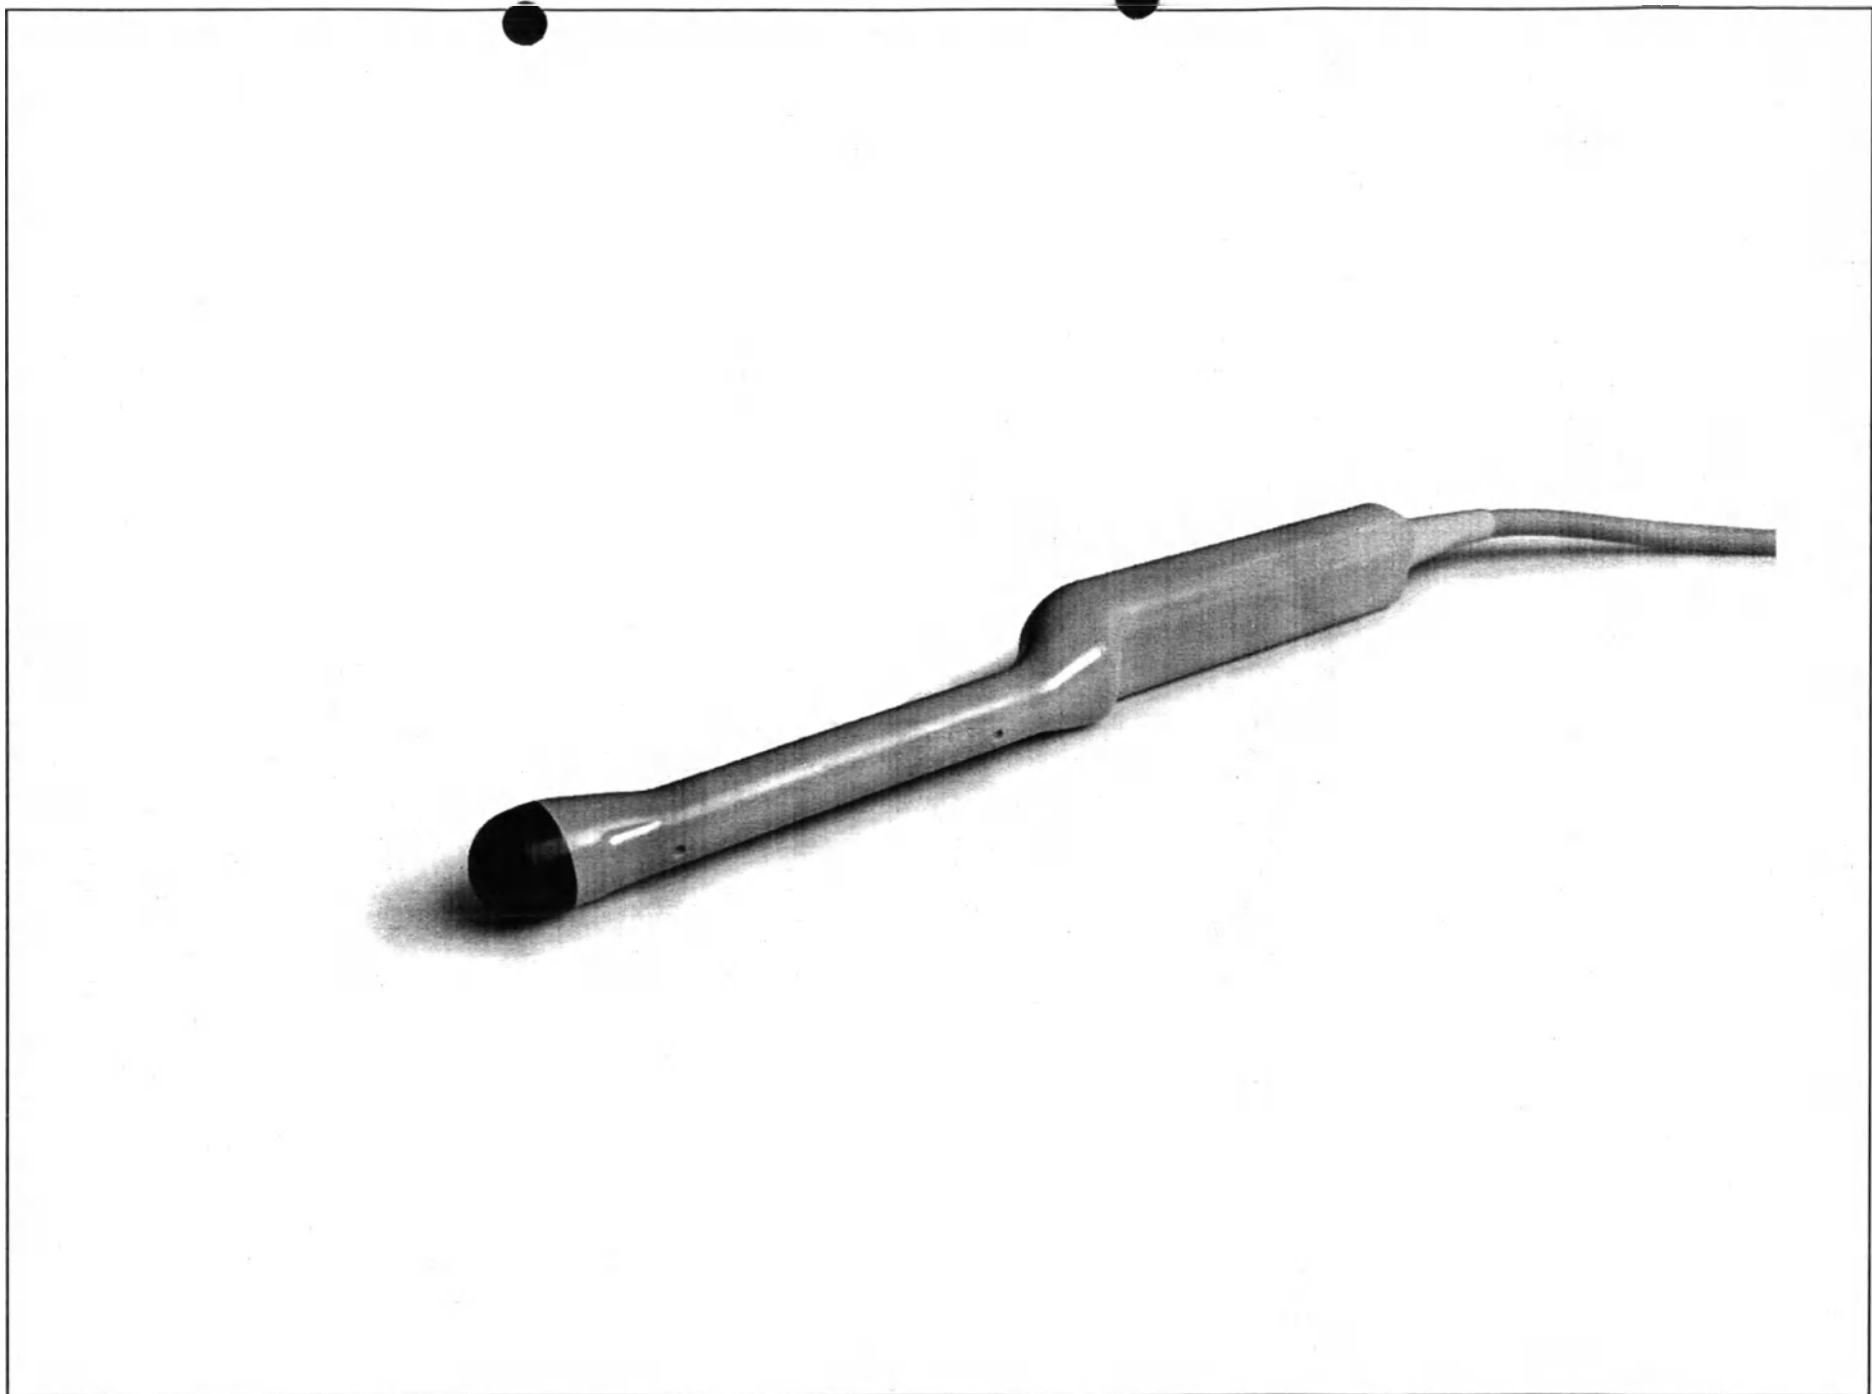


32. Датчик объемный внутриполостной ультразвуковой – не более 2 шт.

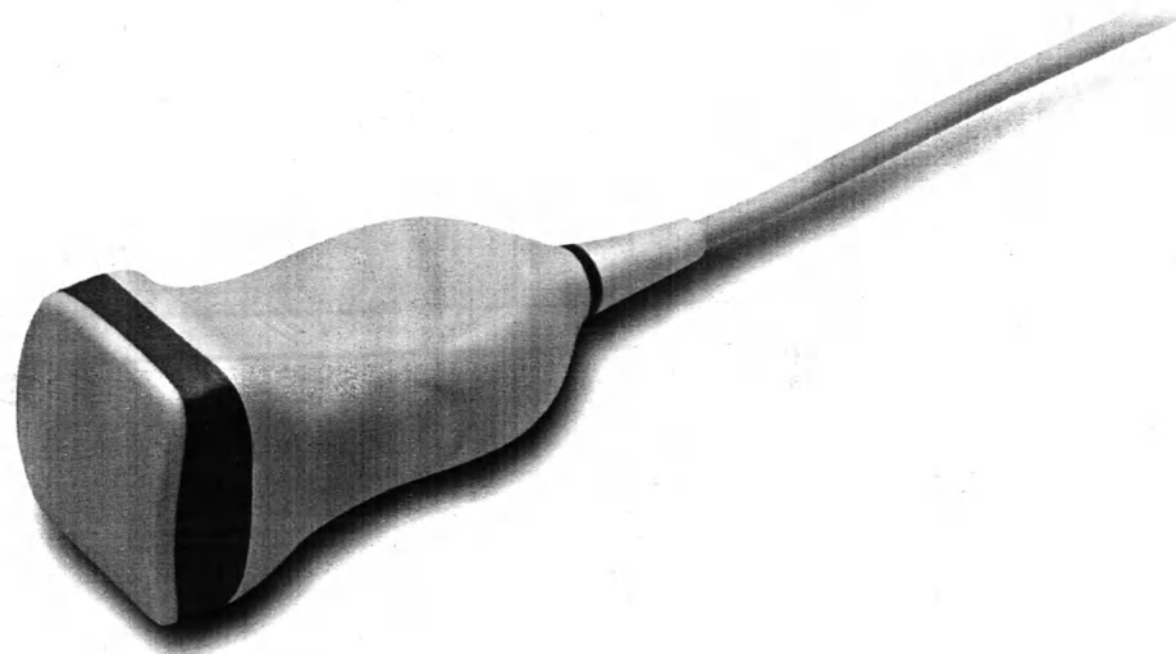

33. Датчик объемный линейный ультразвуковой – не более 2 шт.

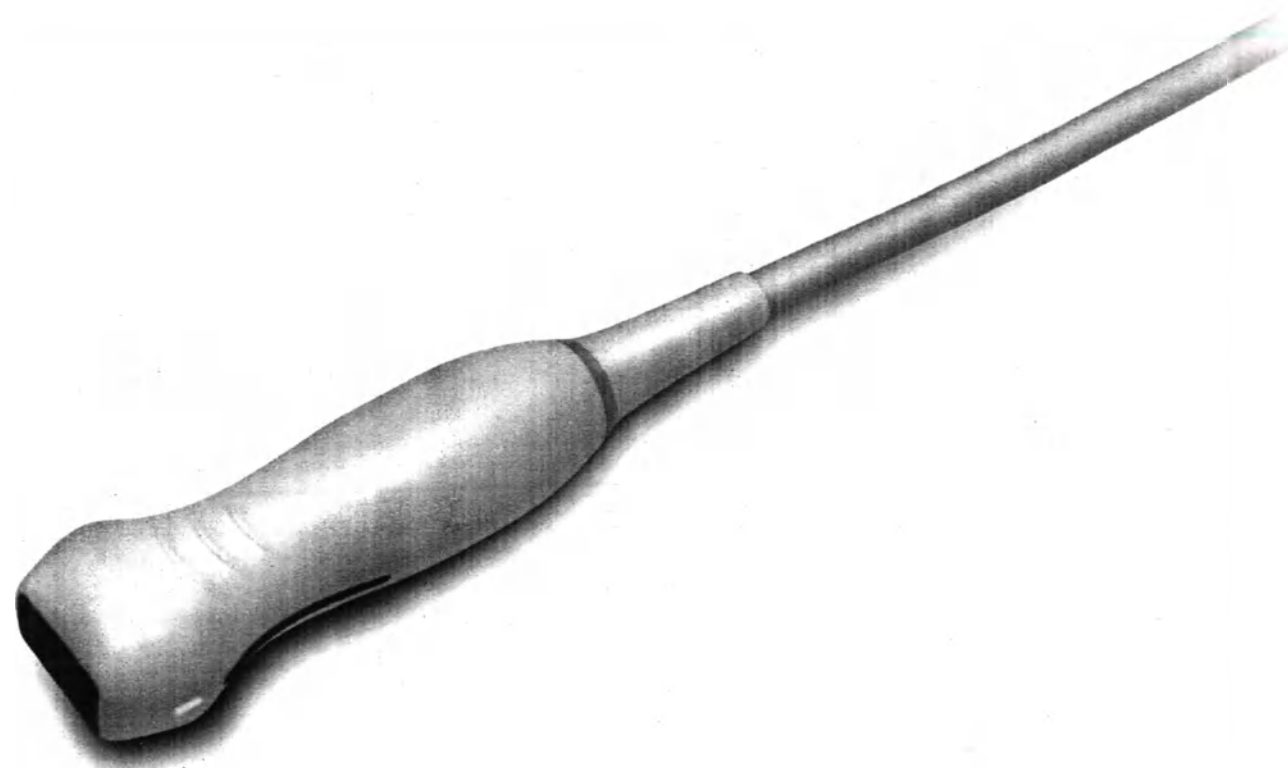

34. Датчик секторный фазированный широкополосный высокочастотный ультразвуковой – не более 2 шт.

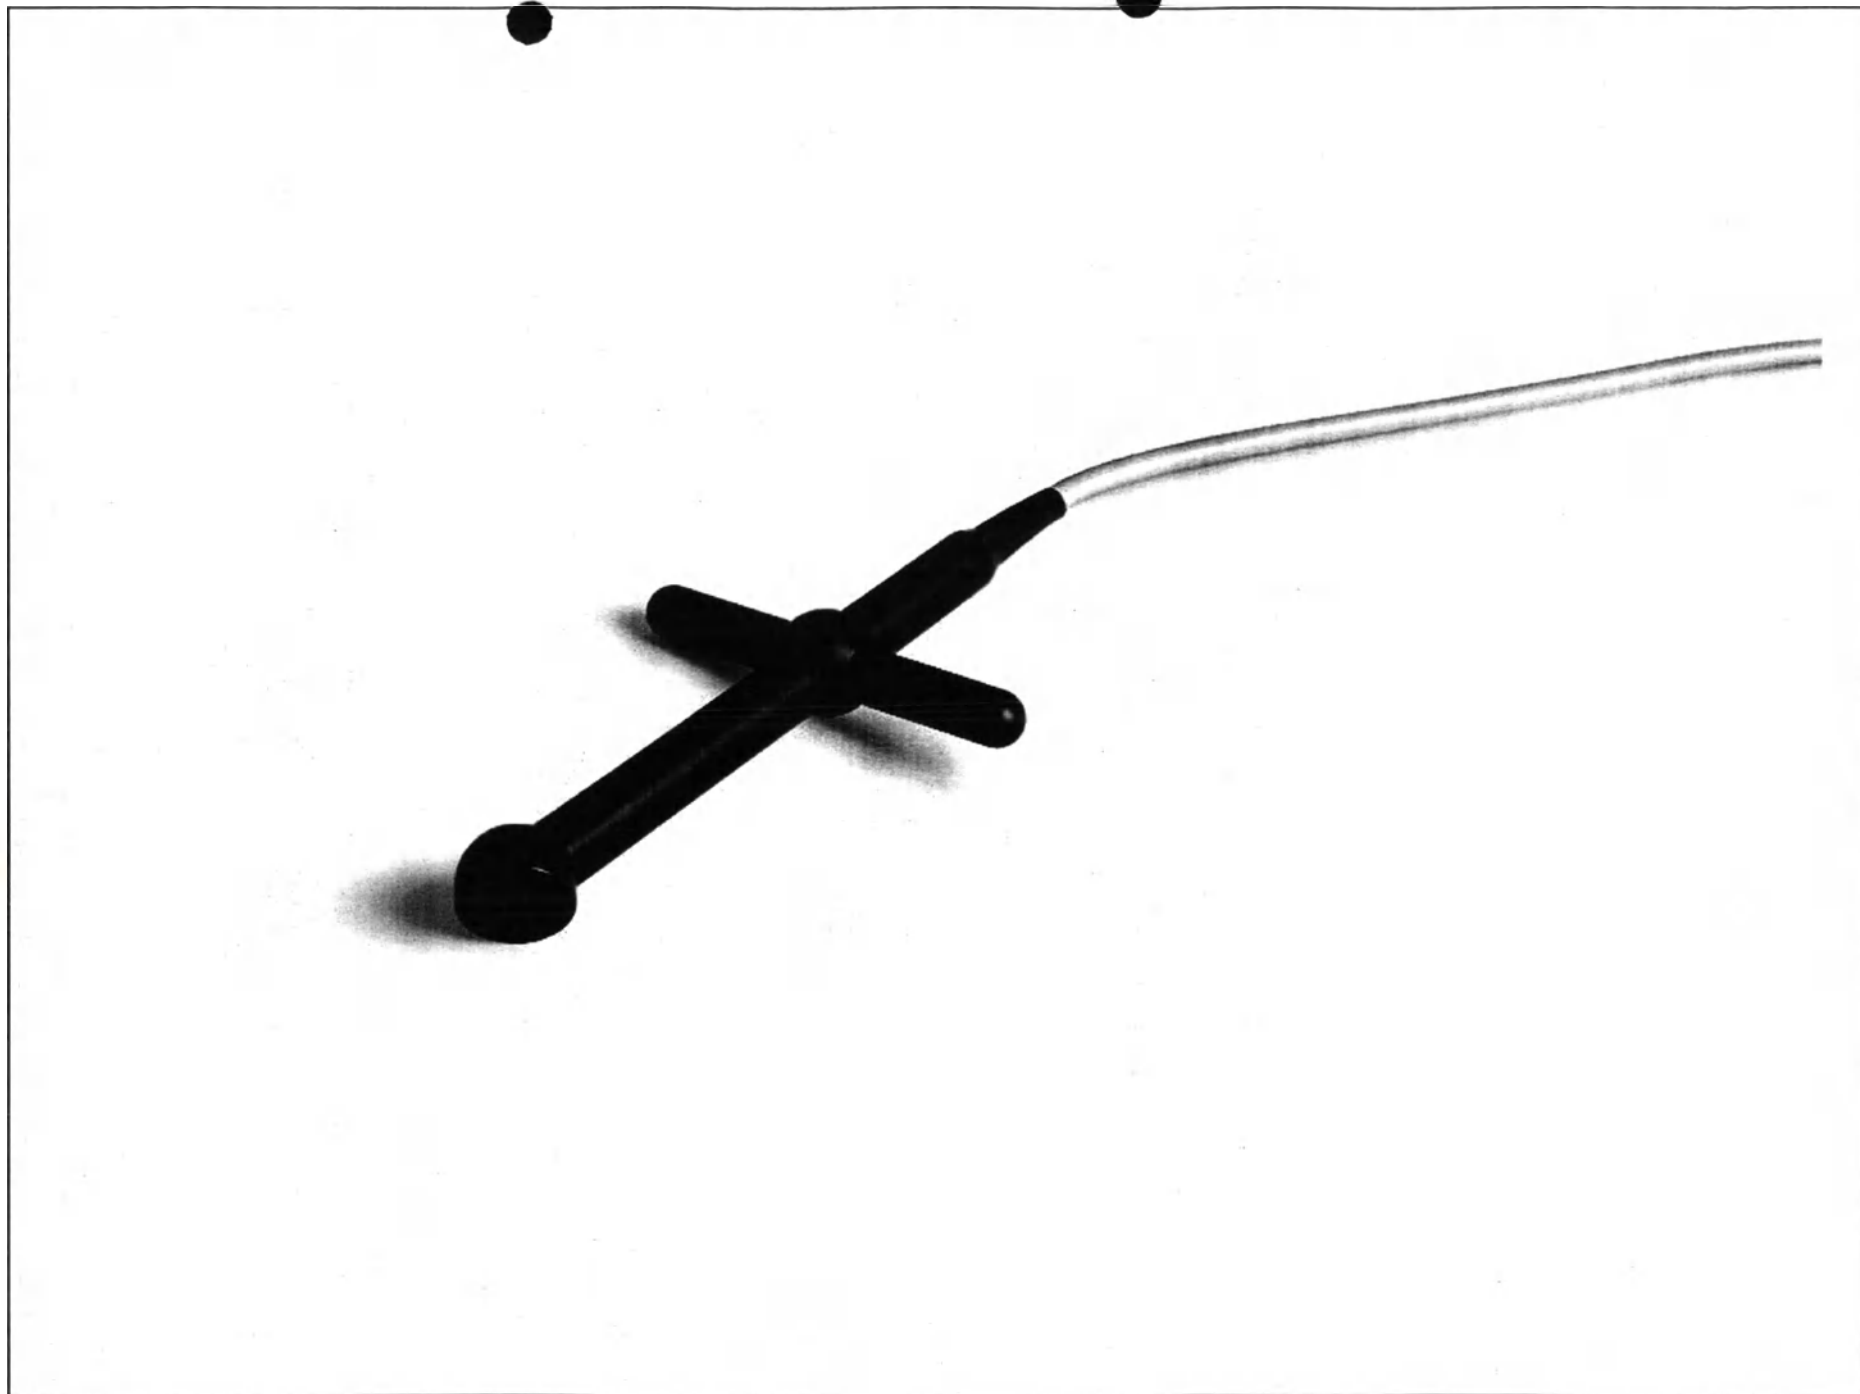


35. Датчик доплеровский карандашный ультразвуковой – не более 2 шт.




36. Датчик транспищеводный ультразвуковой – не более 2 шт.




37. Датчик транспицеводный детский ультразвуковой – не более 2 шт.

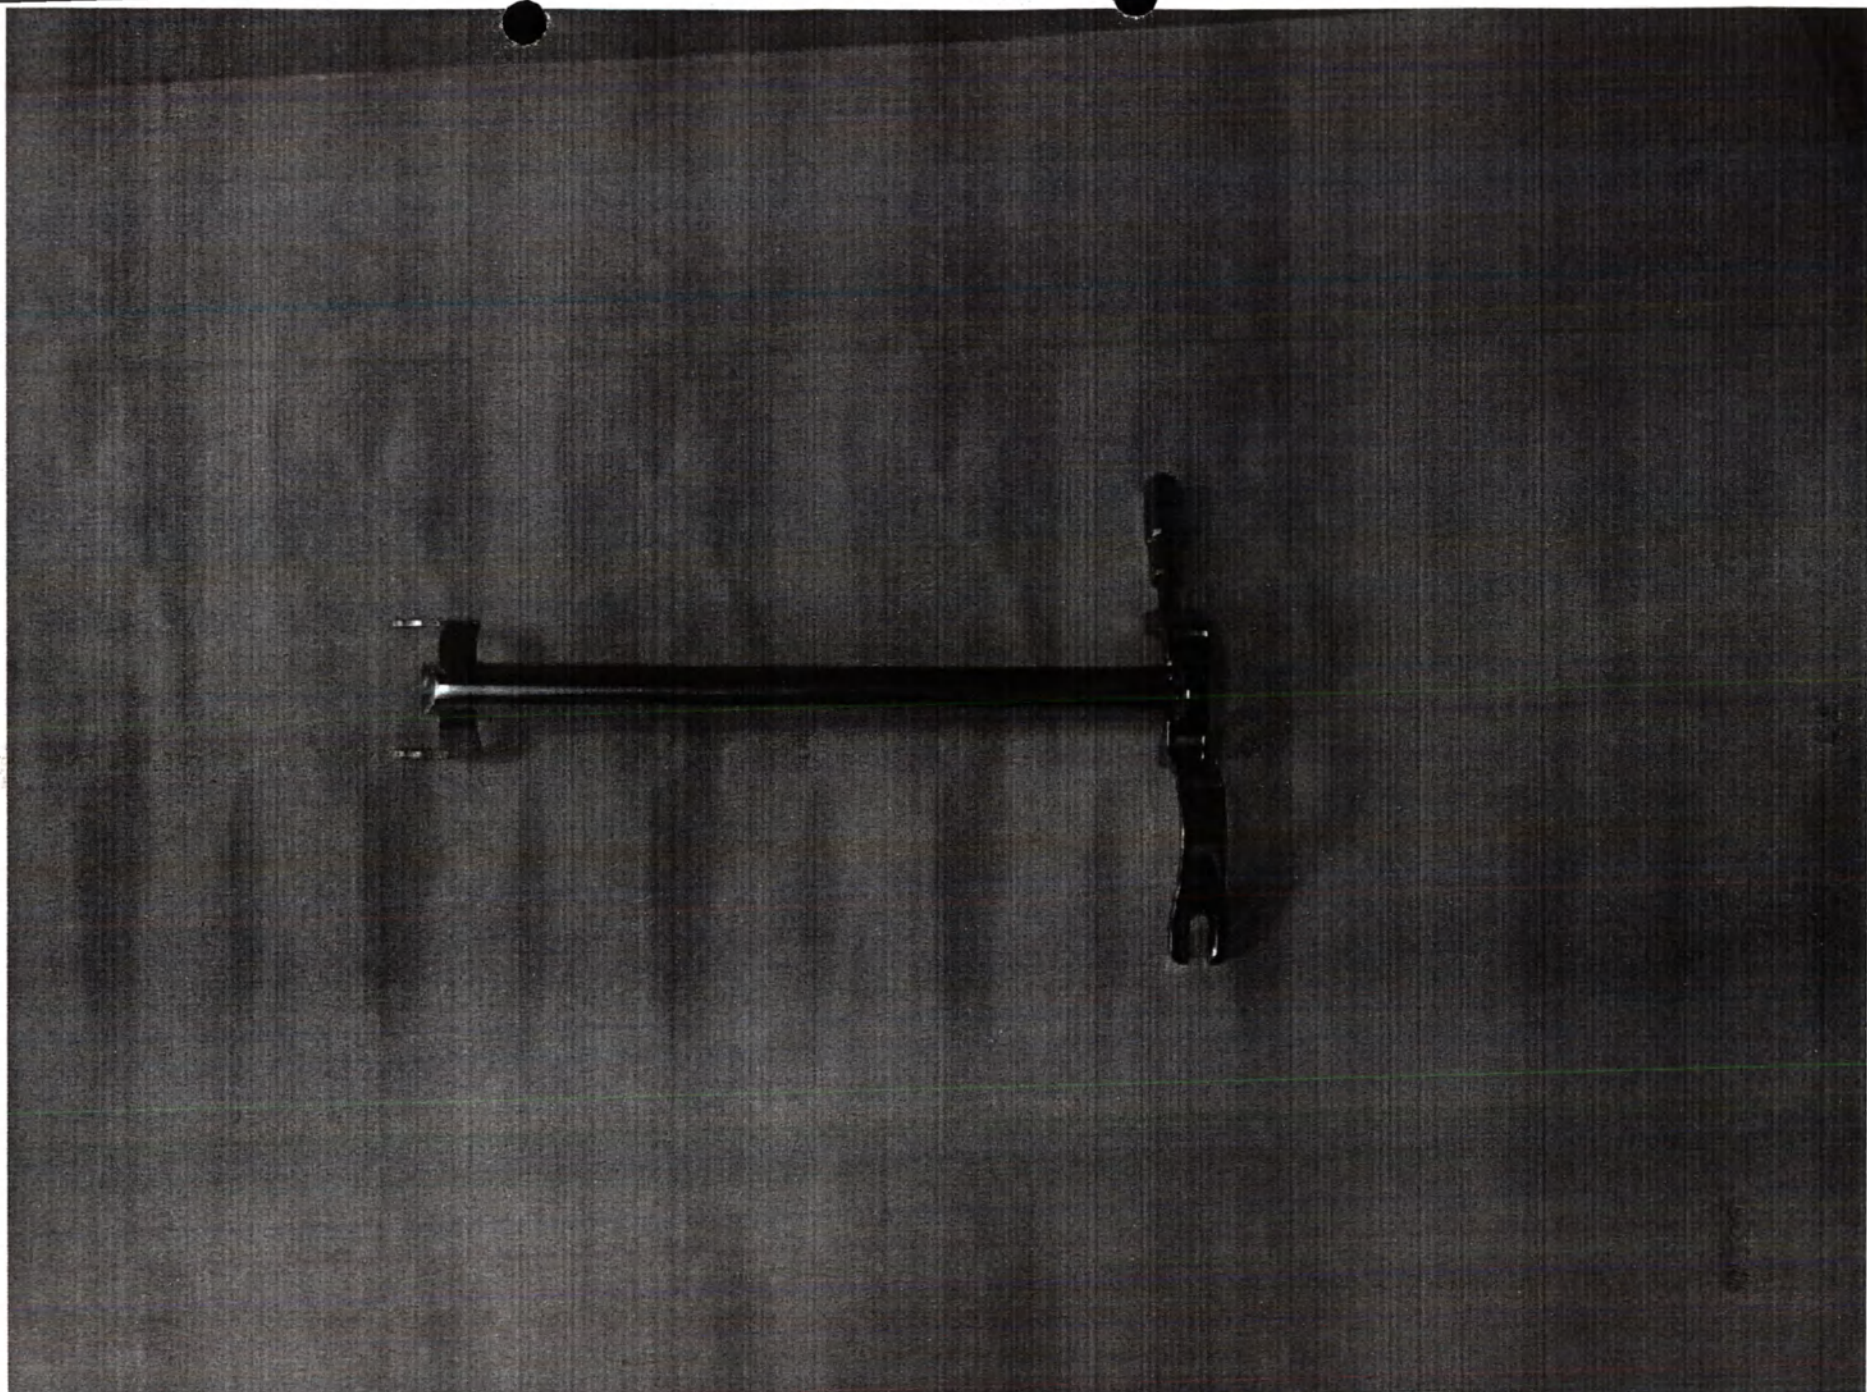


38. Адаптер пункционный для датчика микроконвексного ректовагинального высокой плотности ультразвукового.

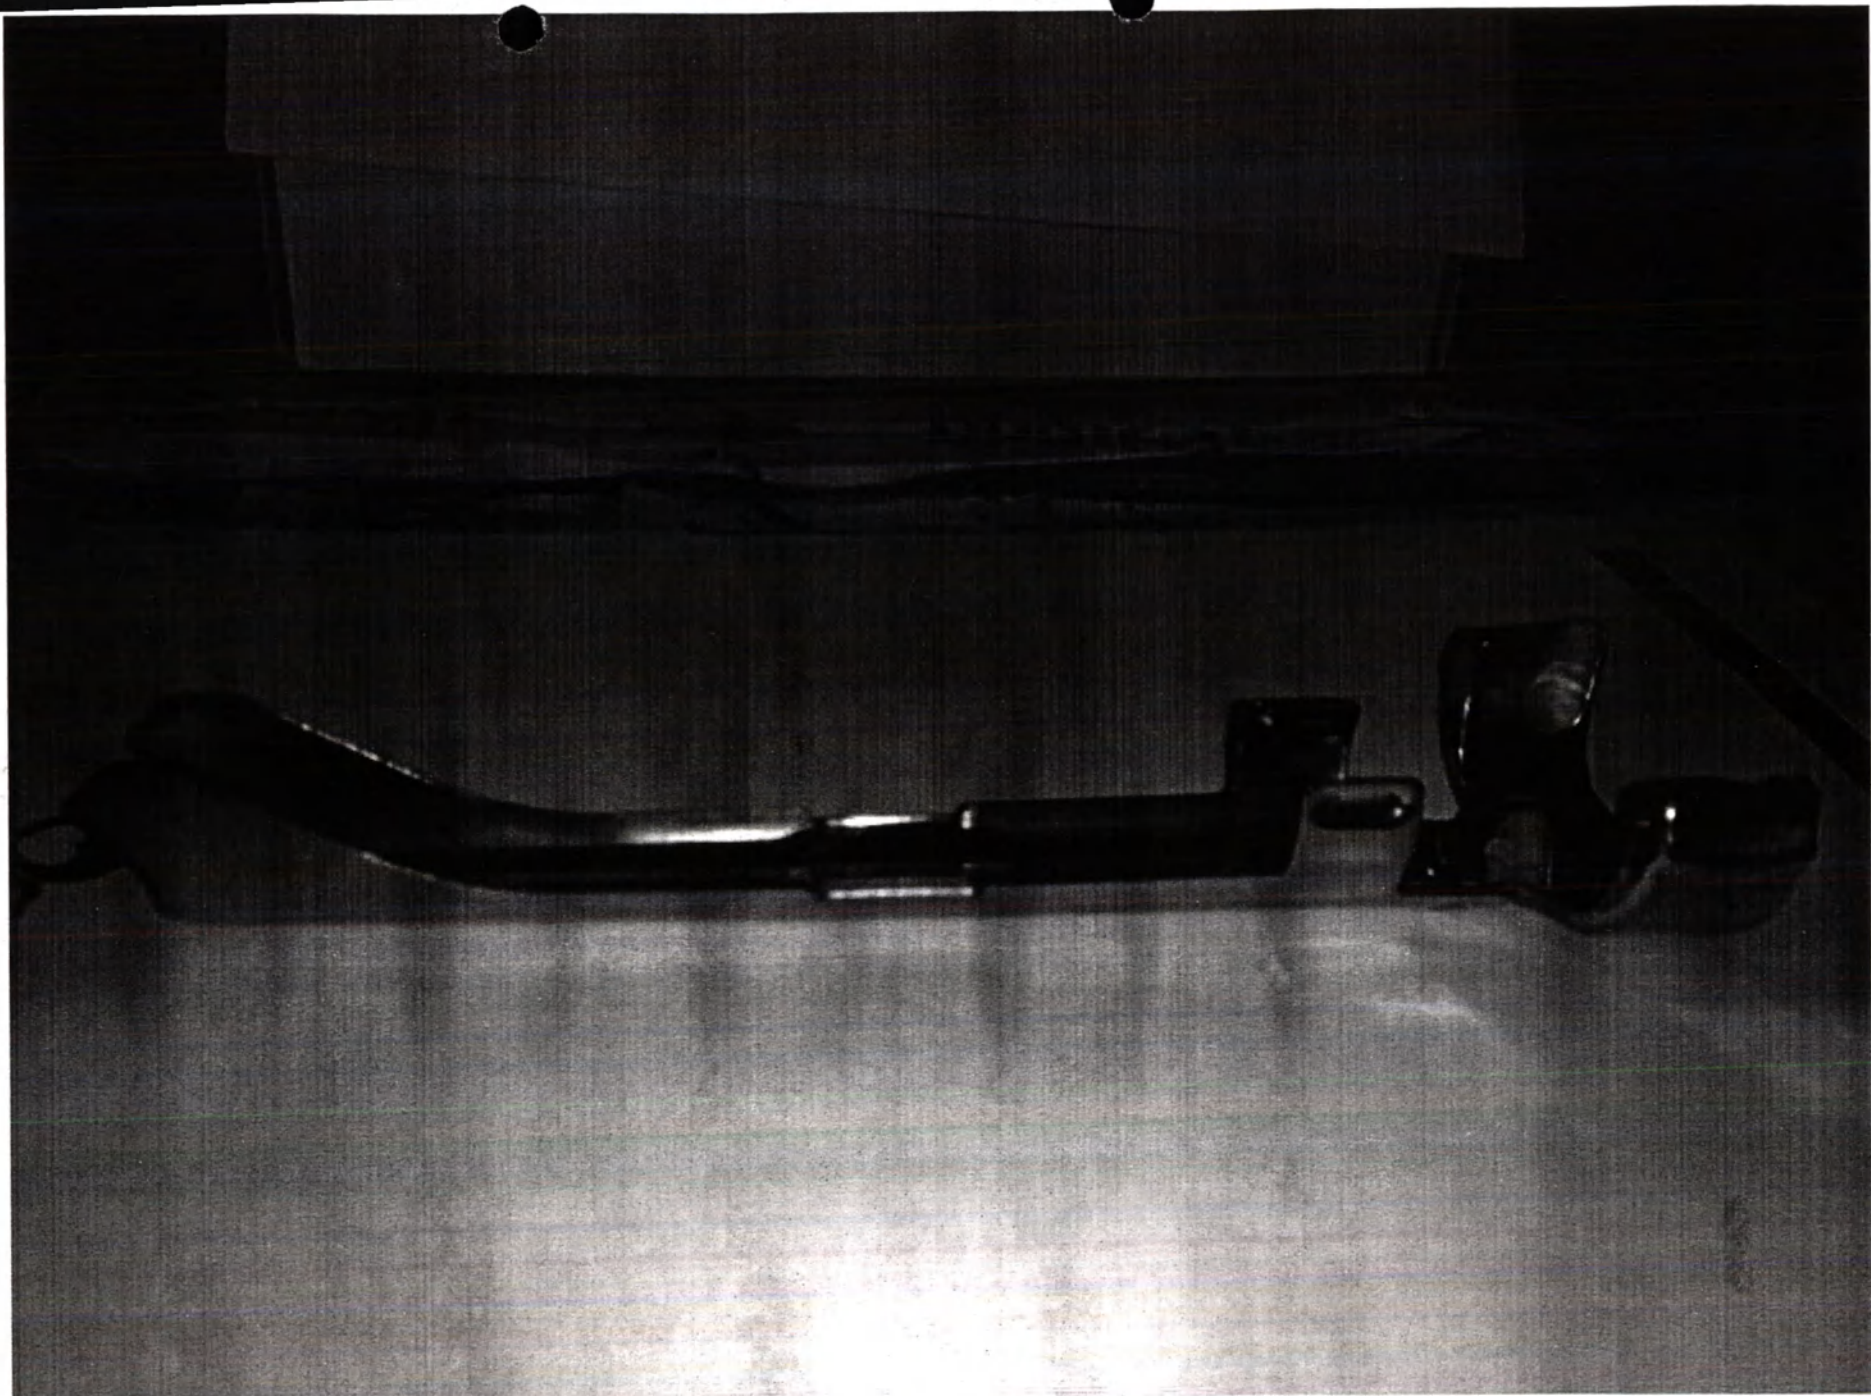


39. Адаптер пункционный для датчика микроконвексного ректовагинального ультразвукового.

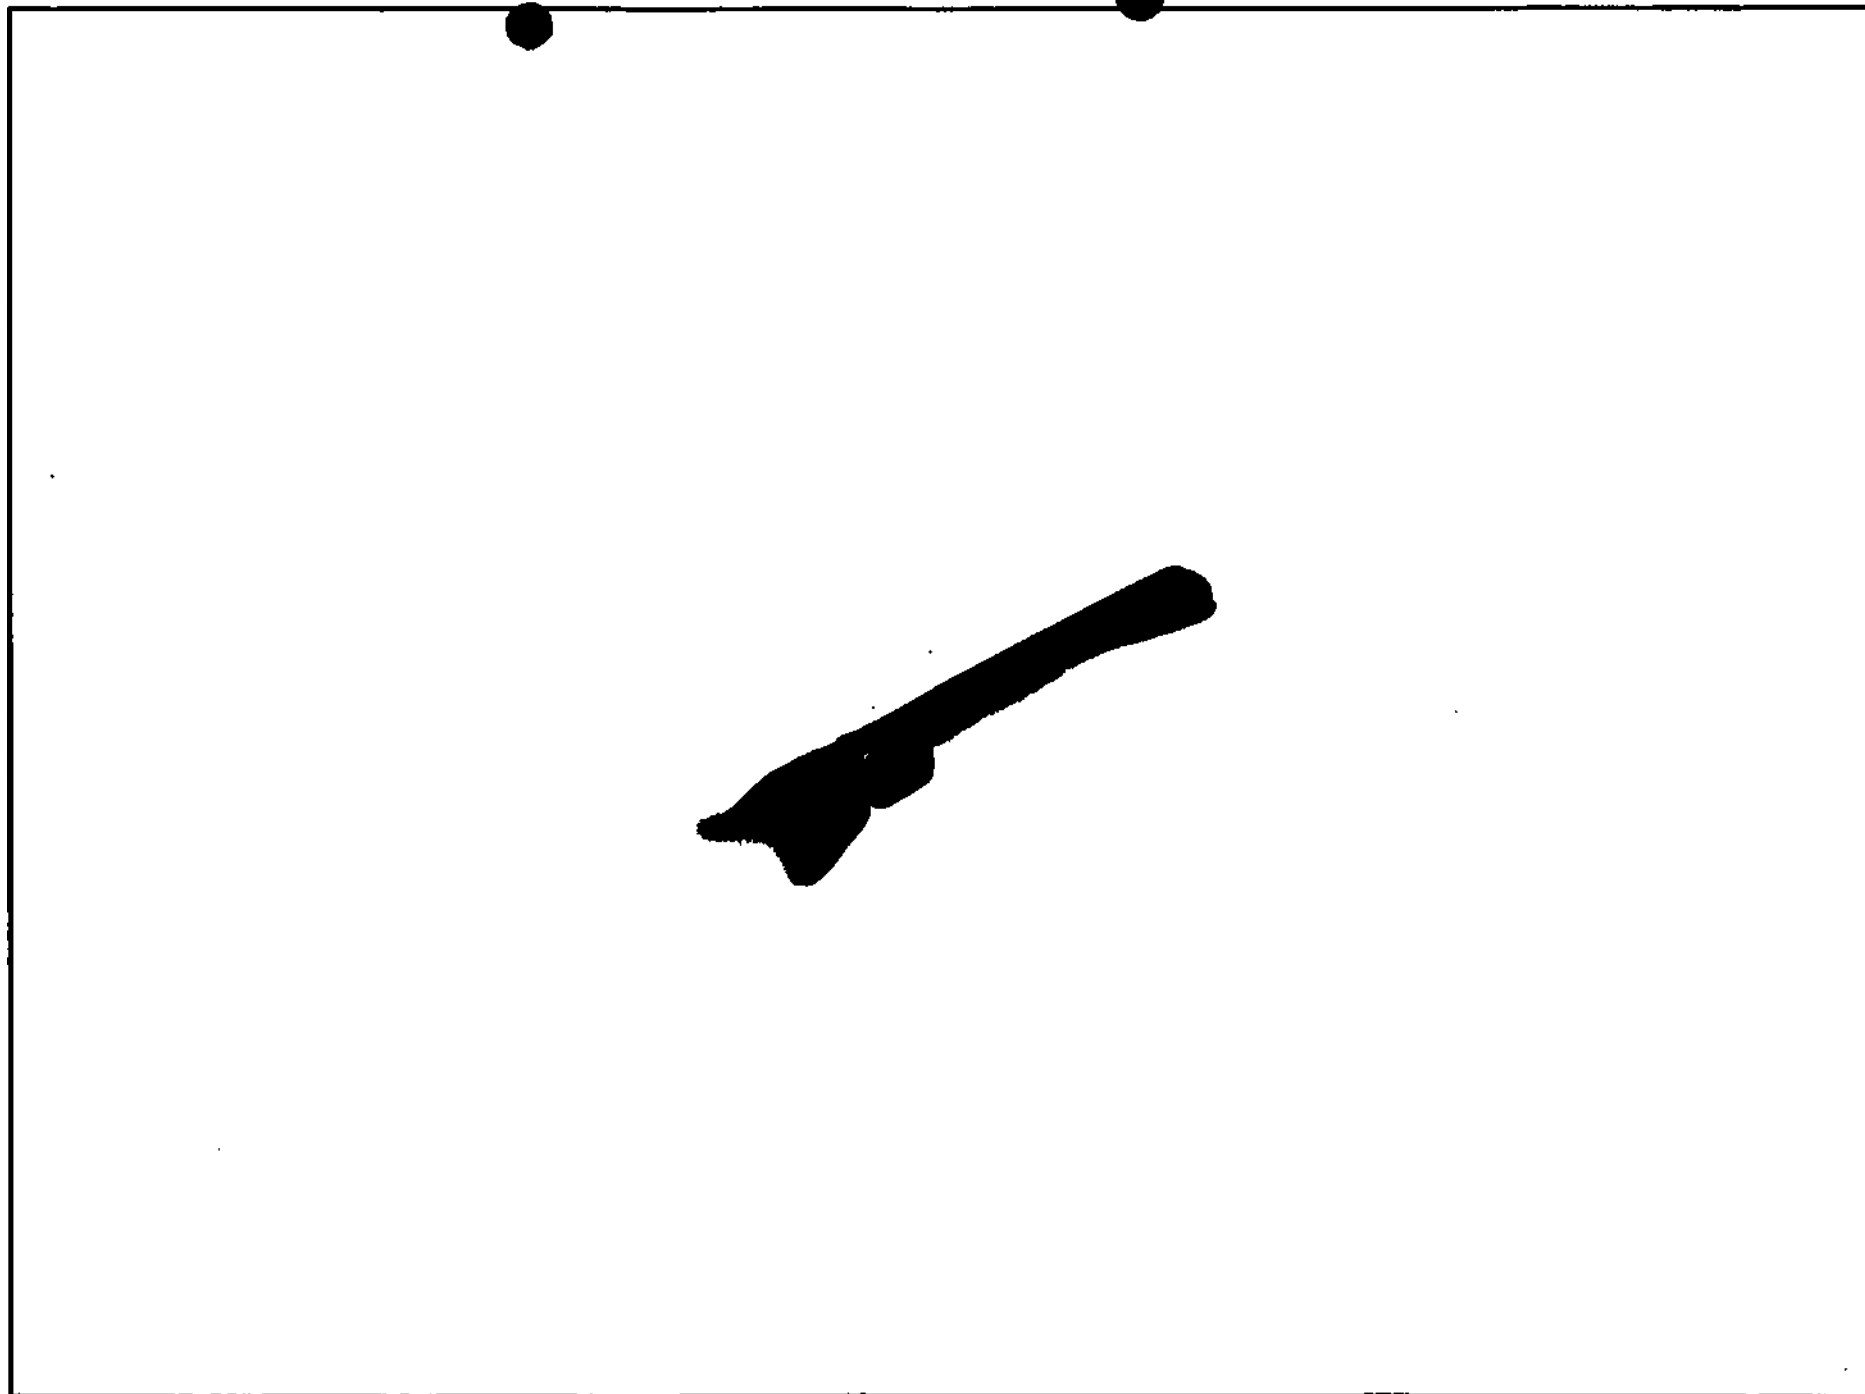


40. Адаптер пункционный для датчика микроконвексного внутриволостного трансректального ультразвукового

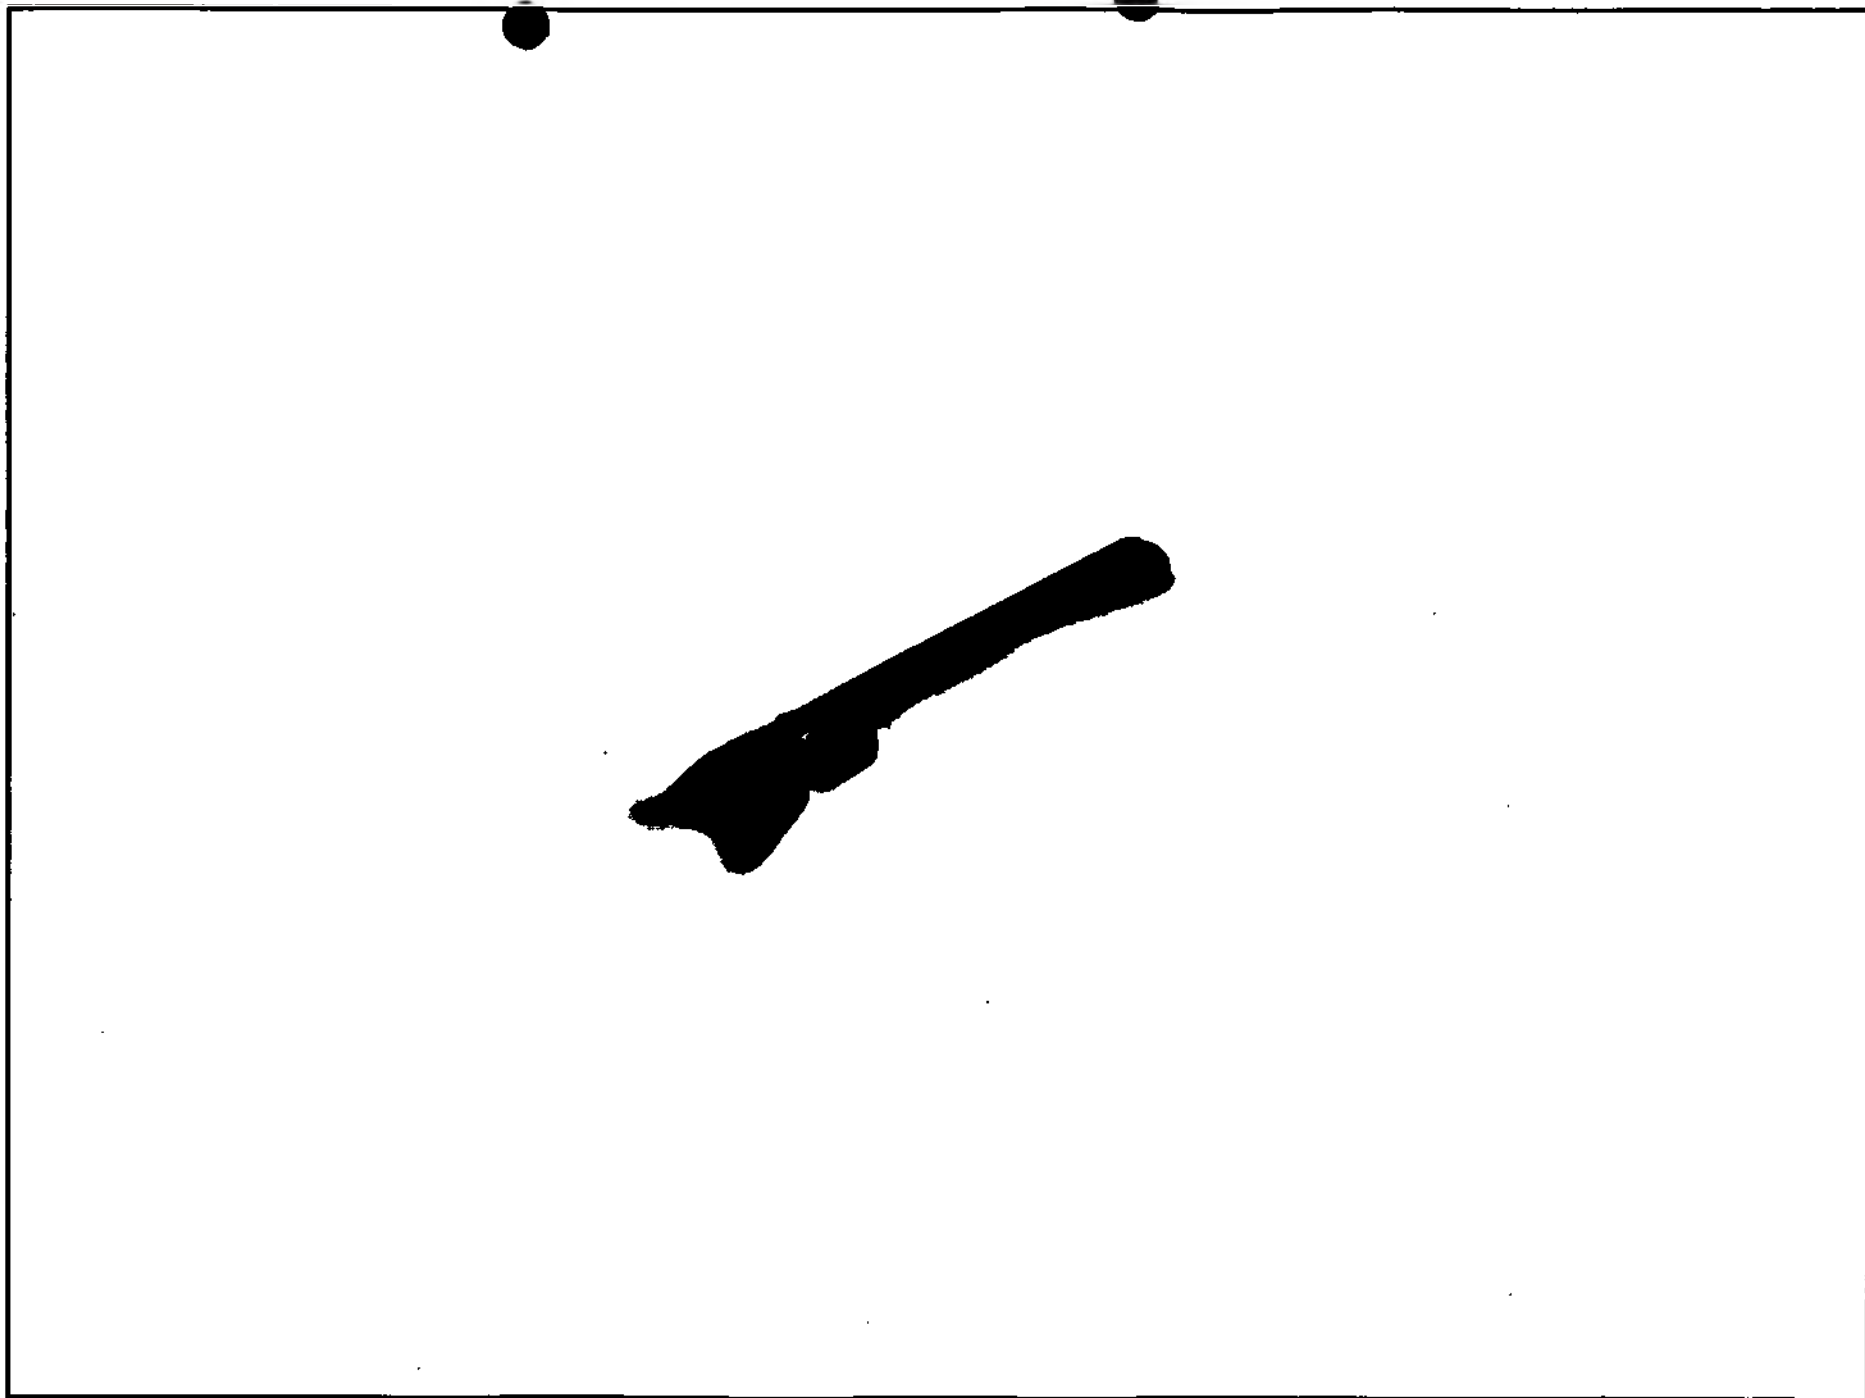

41. Адаптер пункционный для датчика микроконвексного внутриполостного ультразвукового.

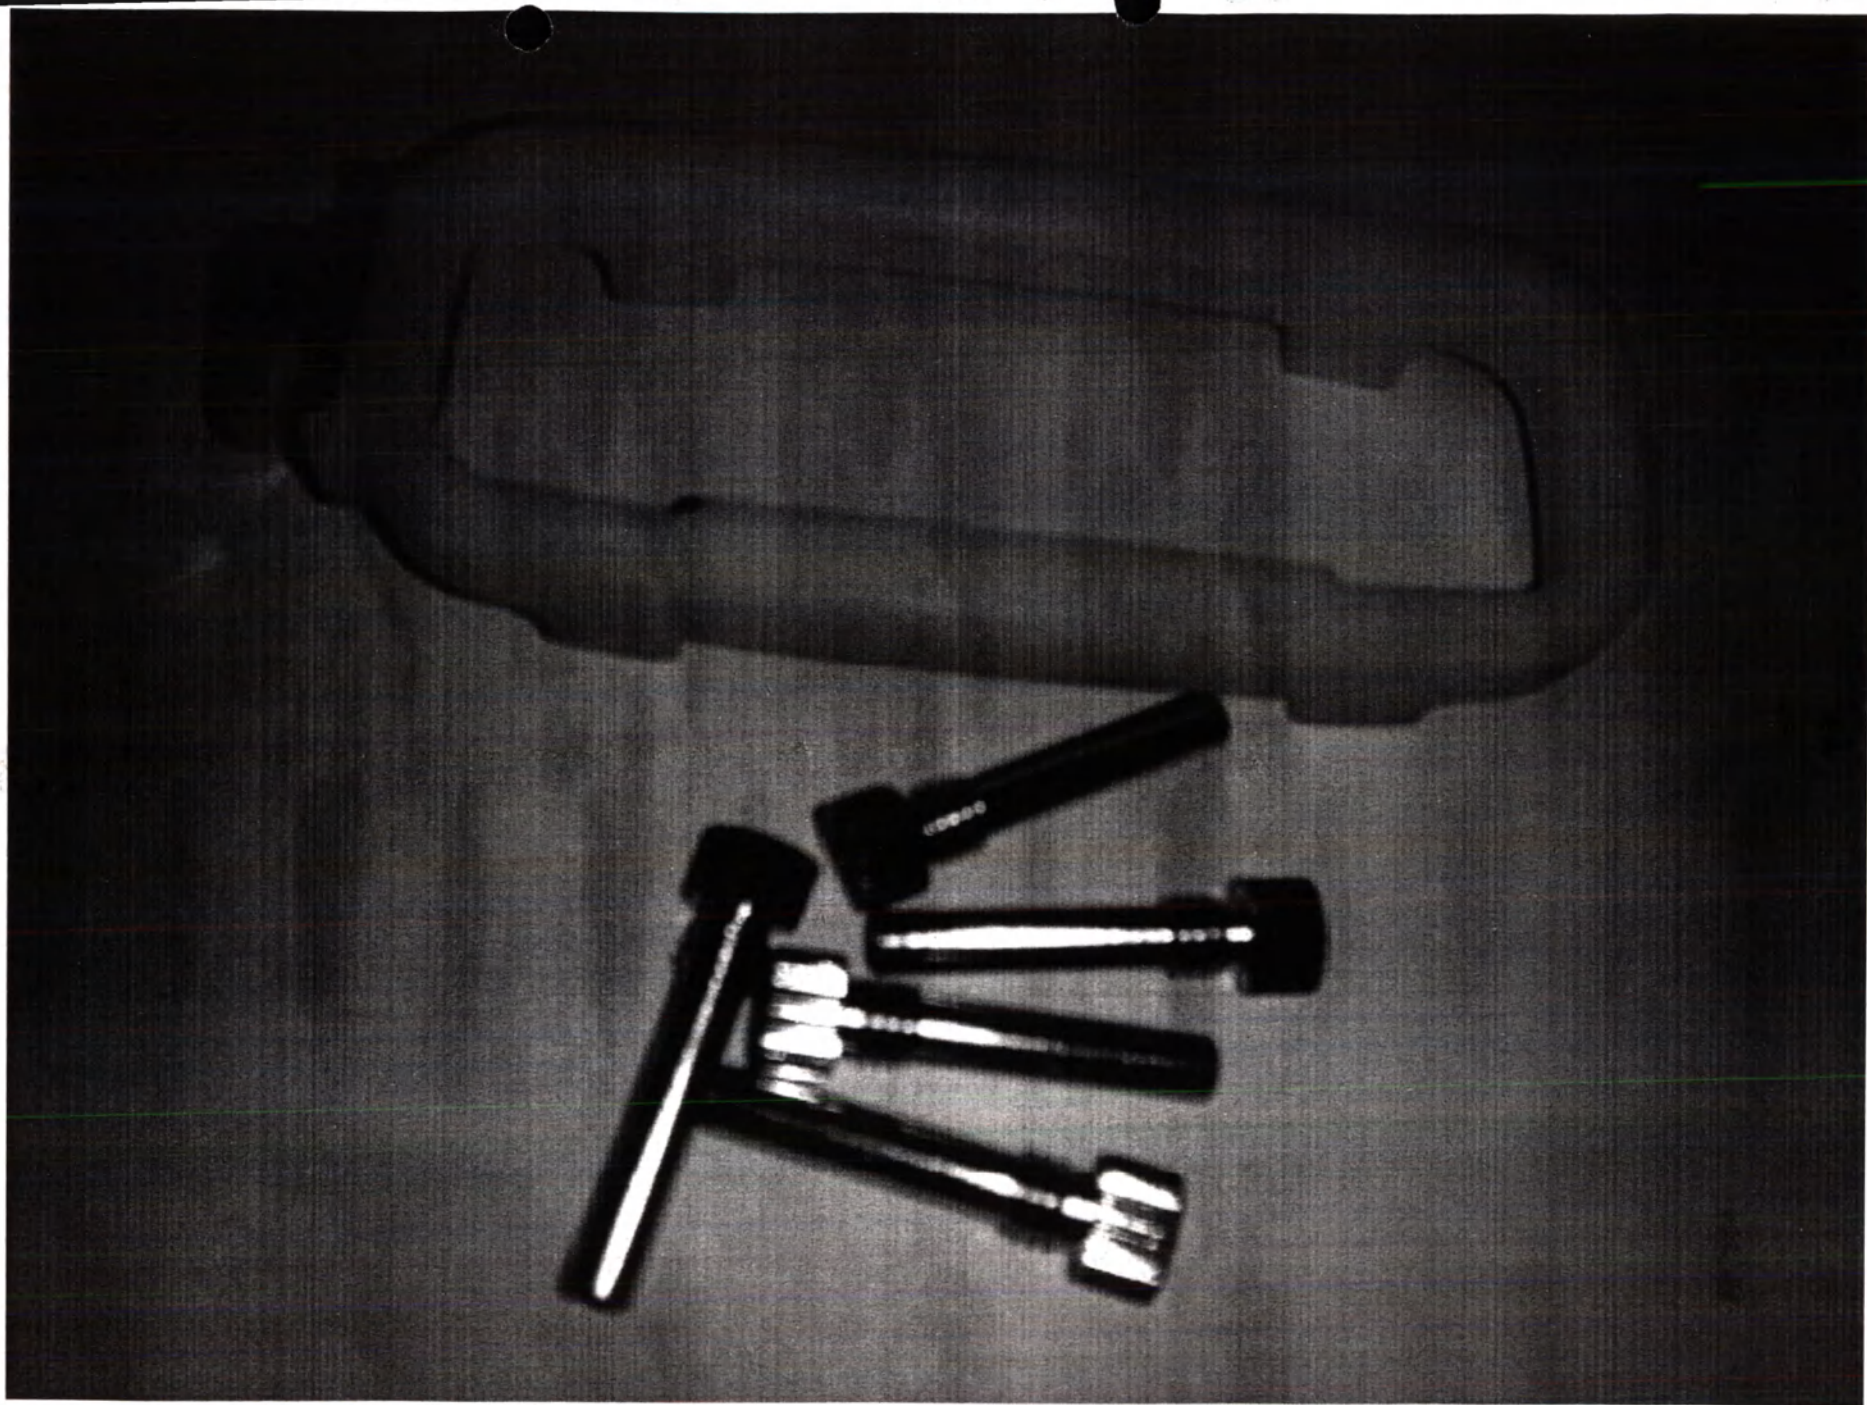

42. Адаптер функциональный для датчика конвексного низкочастотного высокой плотности ультразвукового.

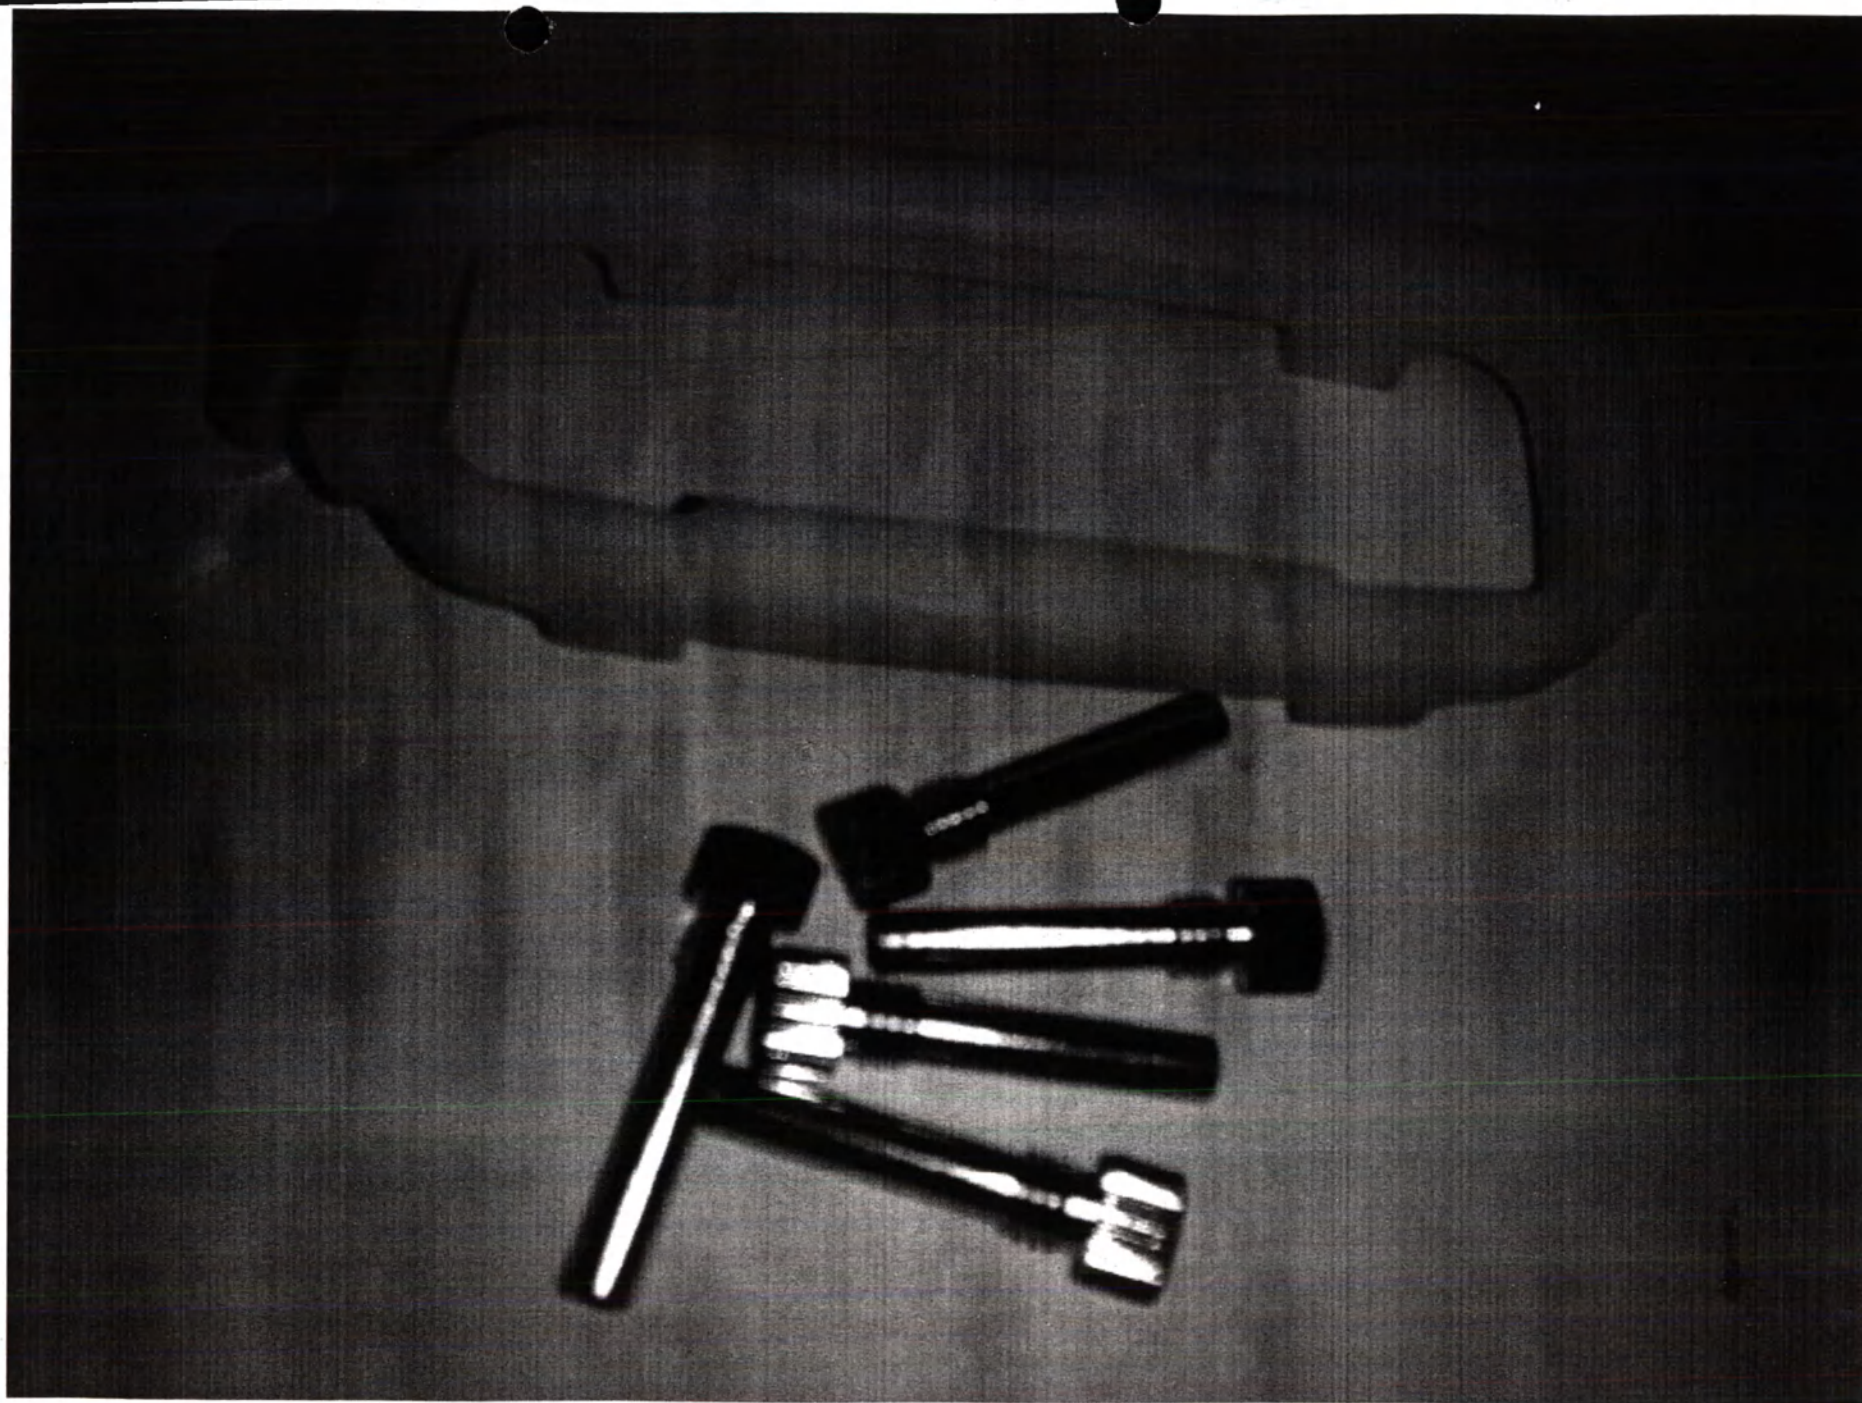


13. Адаптер пункционный для датчика конвексного высокочастотного ультразвукового.




44. Адаптер пункционный для датчика конвексного низкочастотного ультразвукового.




45. Адаптер пункционный для датчика конвексного низкочастотного абдоминального ультразвукового.

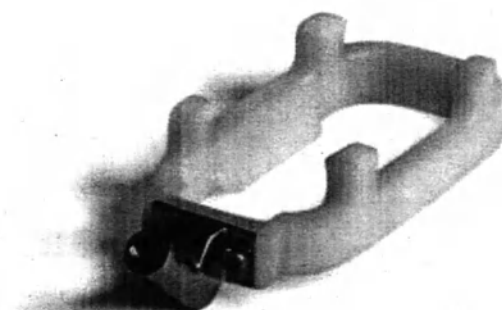


46. Адаптер пункционный для датчика линейного высокочастотного высокой плотности ультразвукового.

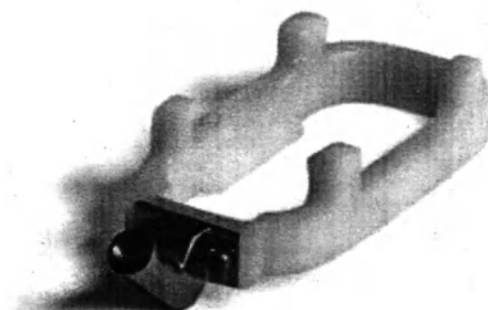


47. Адаптер пункционный для датчика линейного высокочастотного ультразвукового.

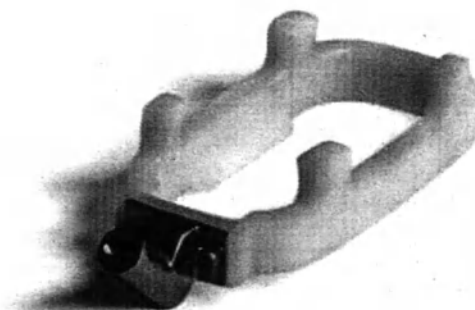


48. Адаптер пункционный для датчика линейного высокочастотного, для обследований сосудов, высокой плотности, ультразвукового.

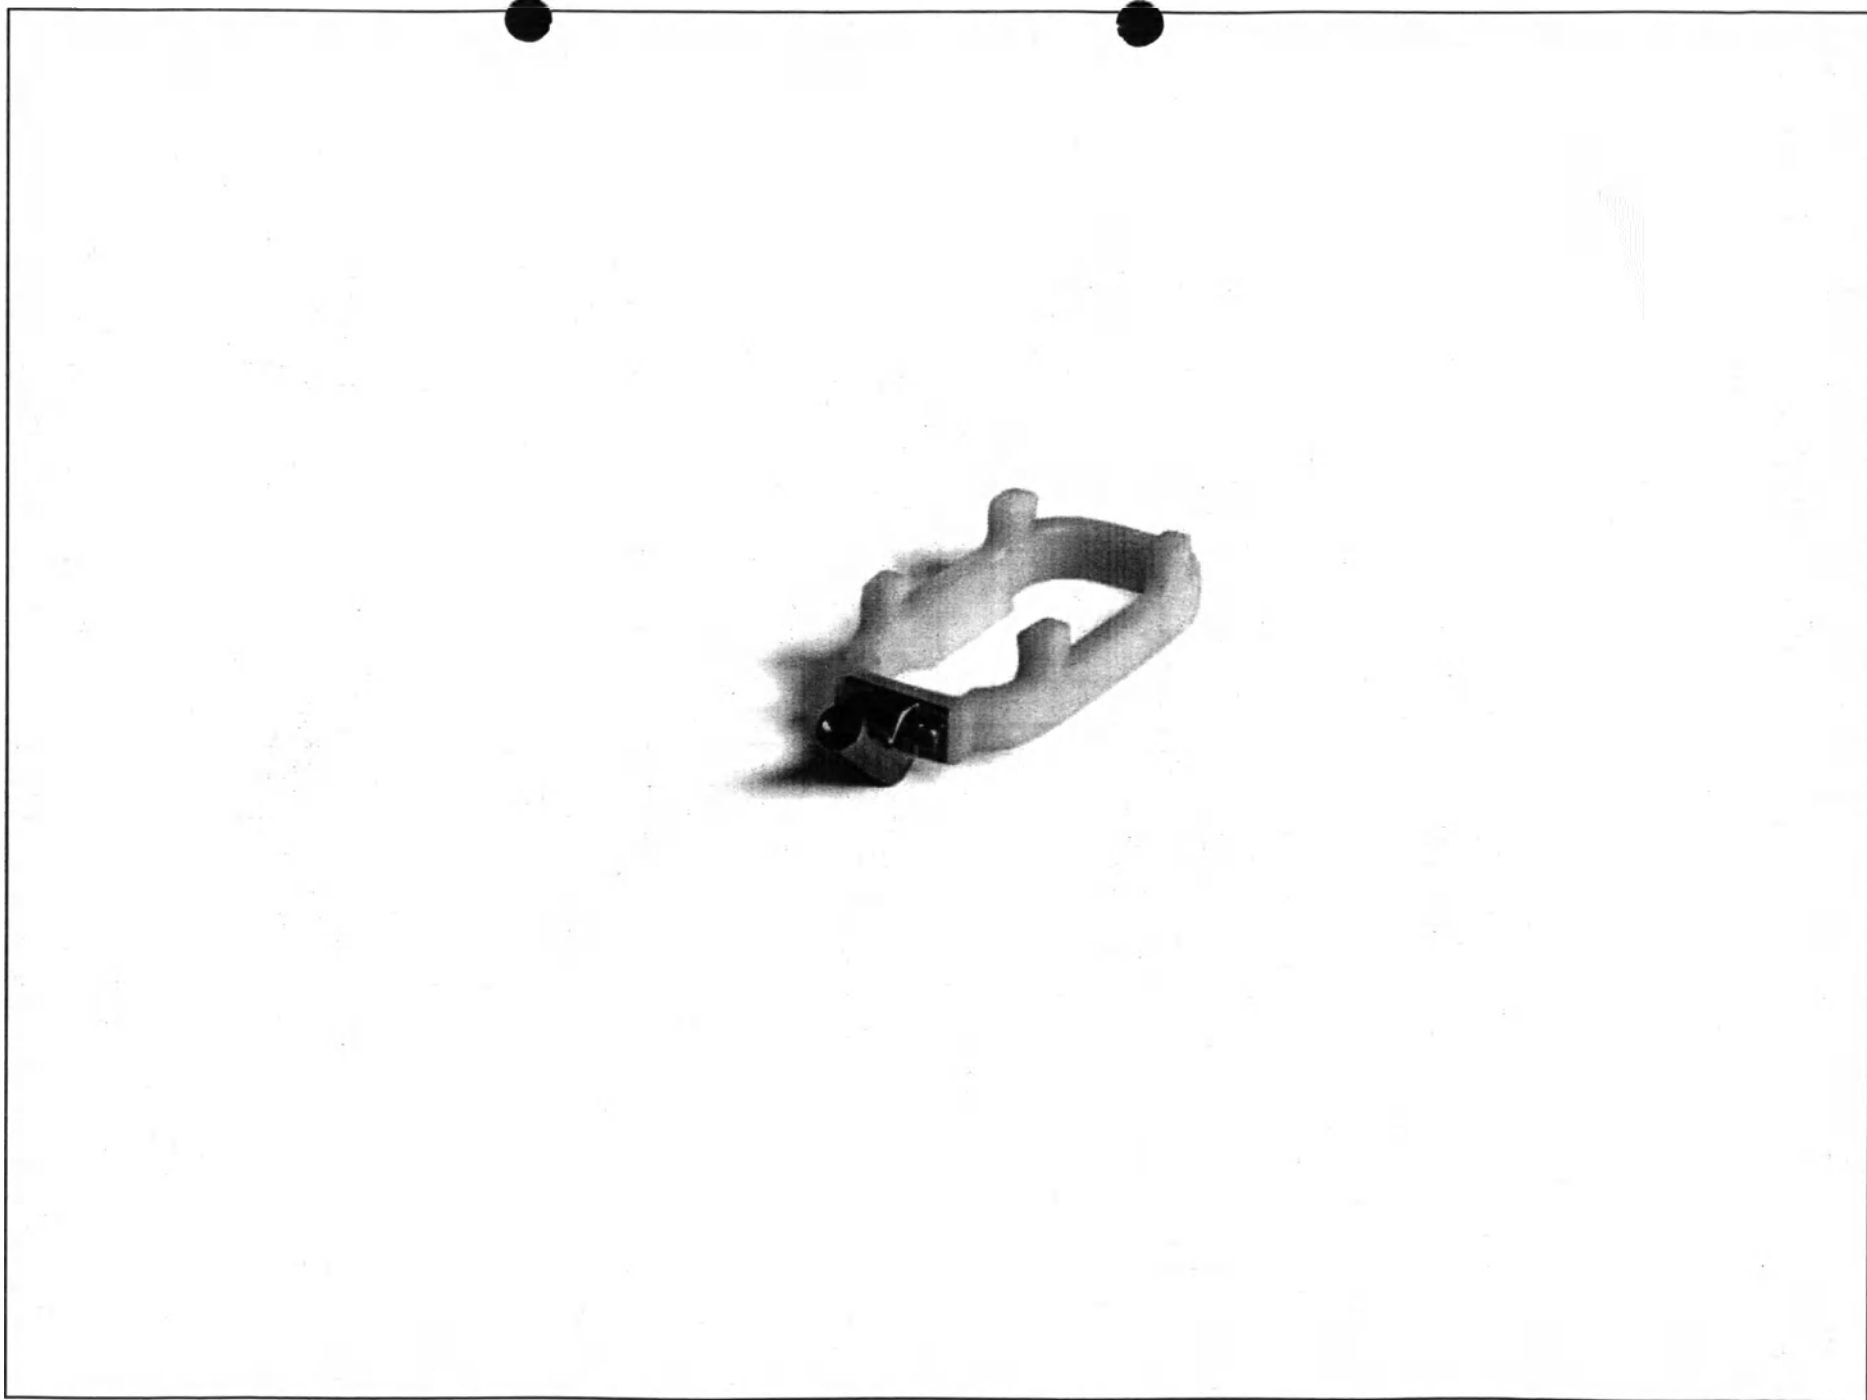

49. Адаптер пункционный для датчика линейного высокочастотного, для обследований сосудов, ультразвукового.

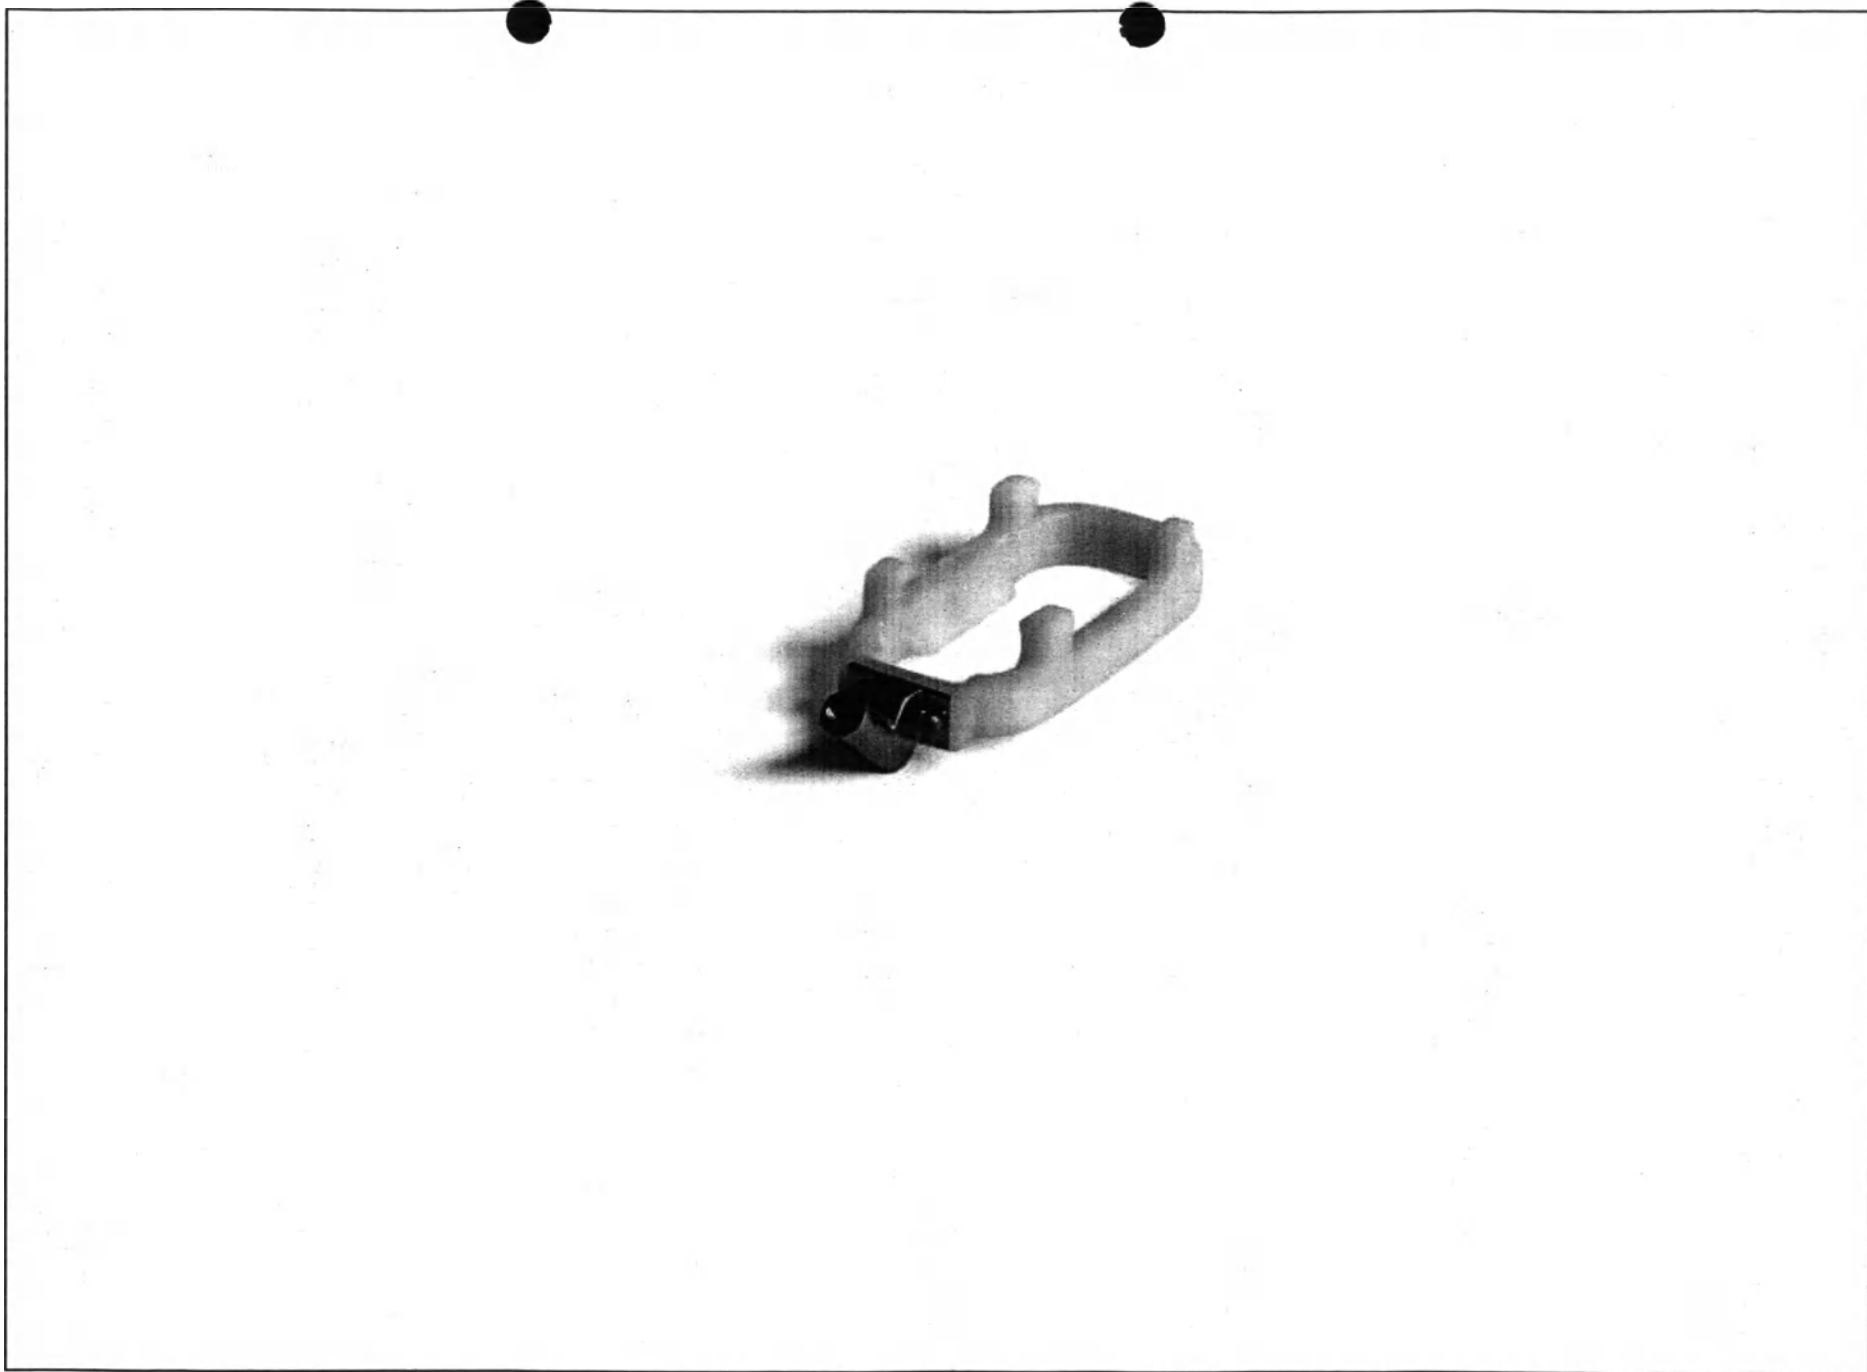


50. Адаптер пункционный для датчика линейного высокочастотного, для обследований поверхностных органов сверхвысокой плот-

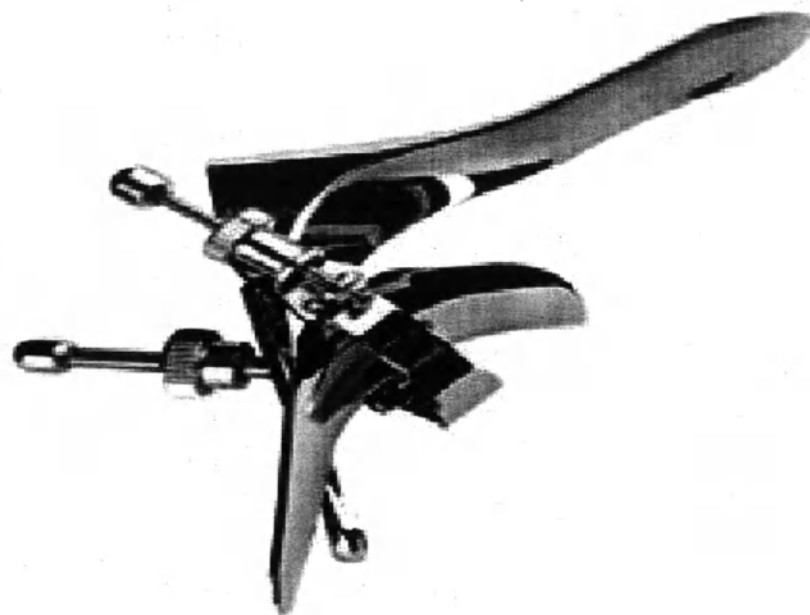


51. Металлическое гинекологическое зеркало для датчика микроконвексного , встраиваемого в гинекологическое зеркало, ультразвукового.




52. Адаптер функциональный для датчика конвексного широкополосного ультразвукового.

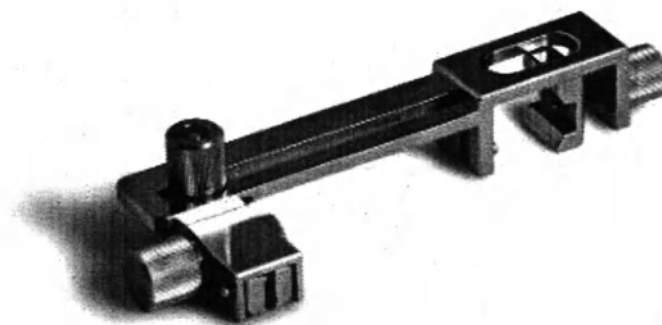

53. Адаптер пункционный для датчика бипланового внутриполостного линейно-микроконвексного ультразвукового.

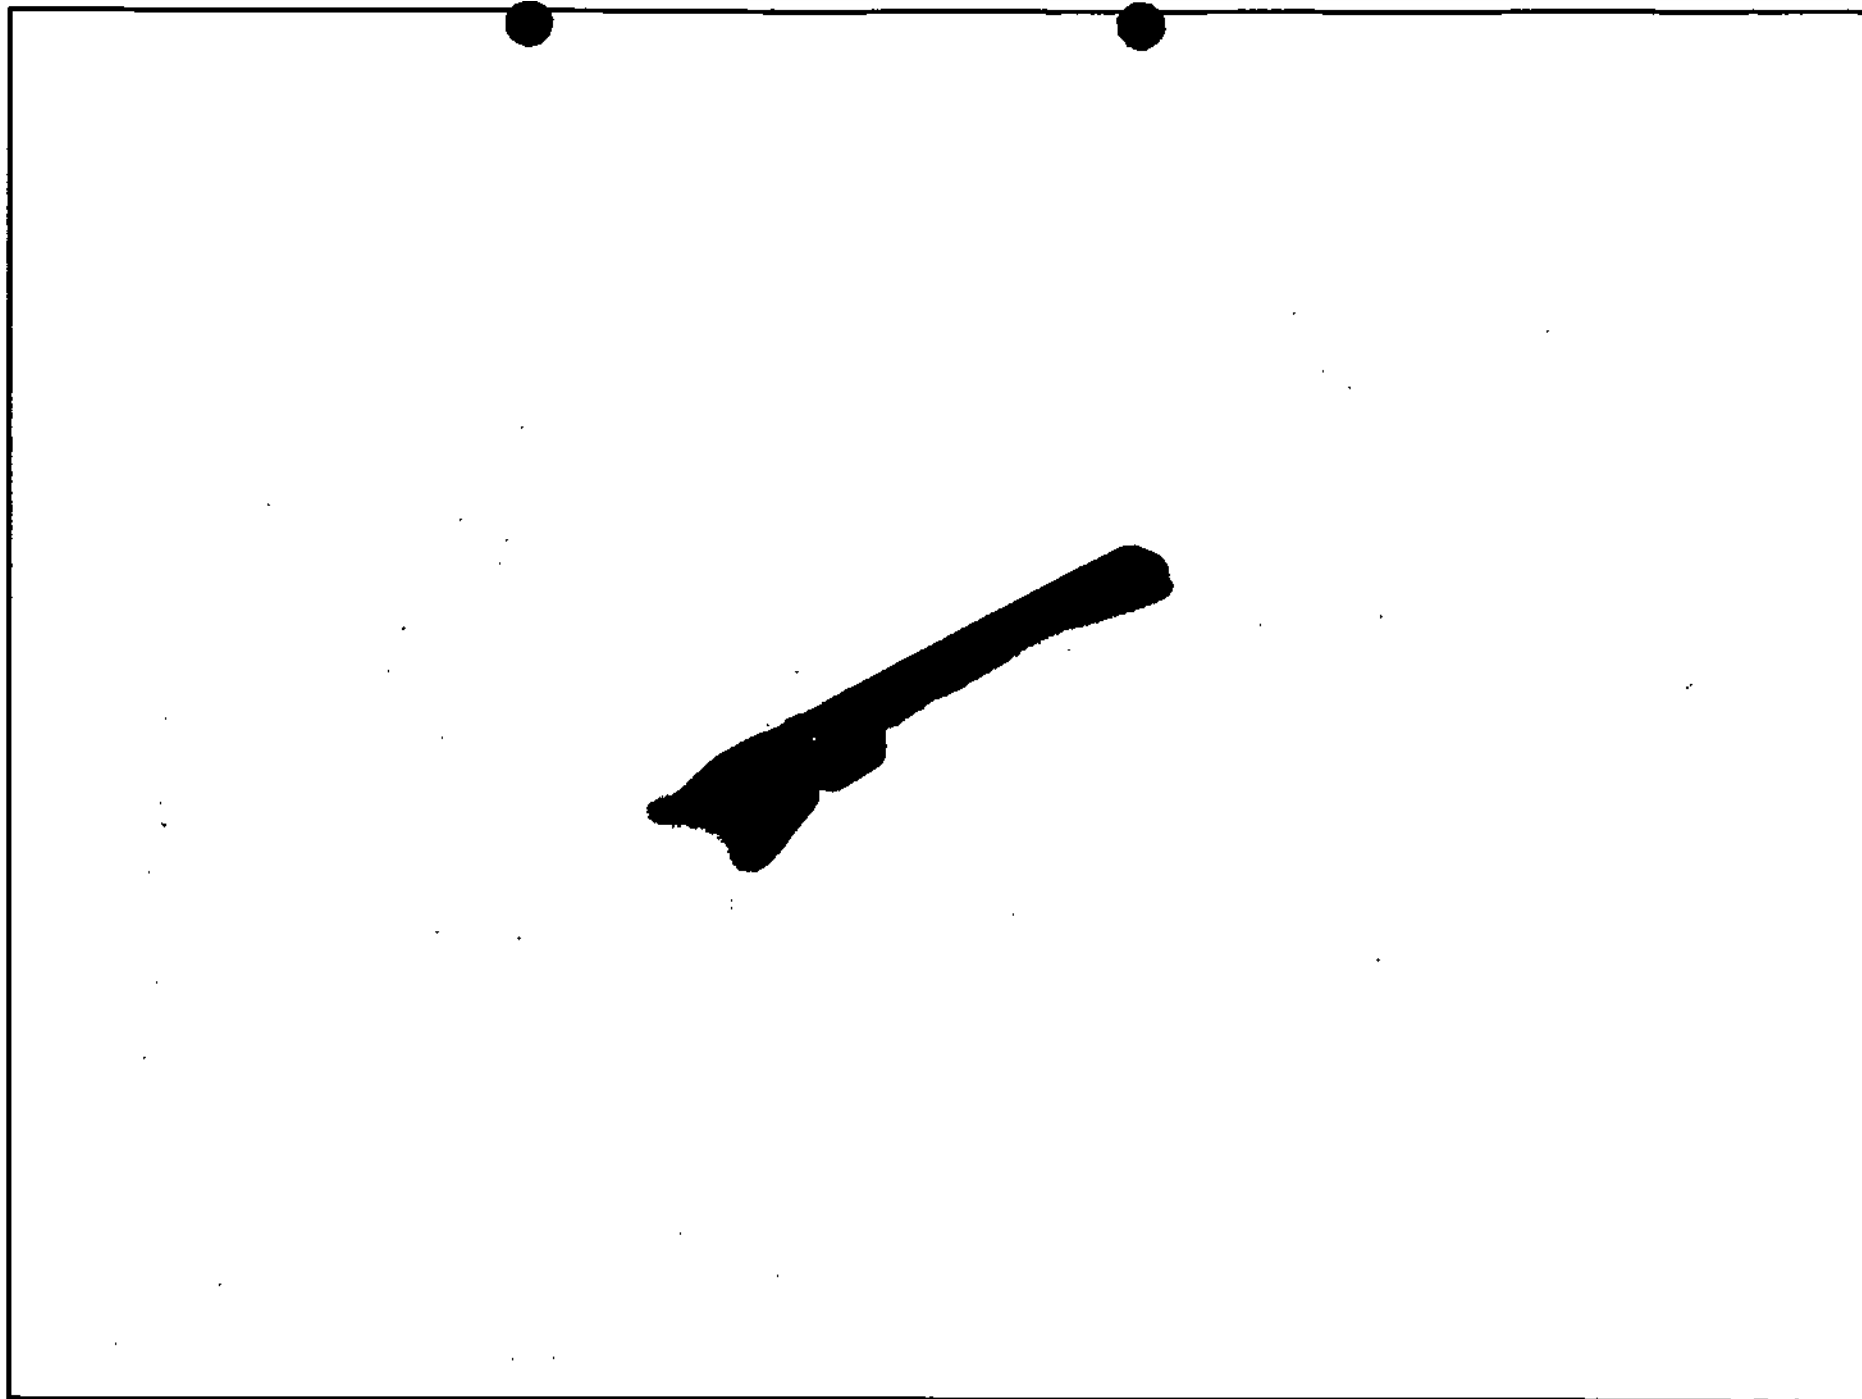


54. Адаптер пункционный для датчика бипланового внутриполостного микроконвексно-микроконвексного ультразвукового.

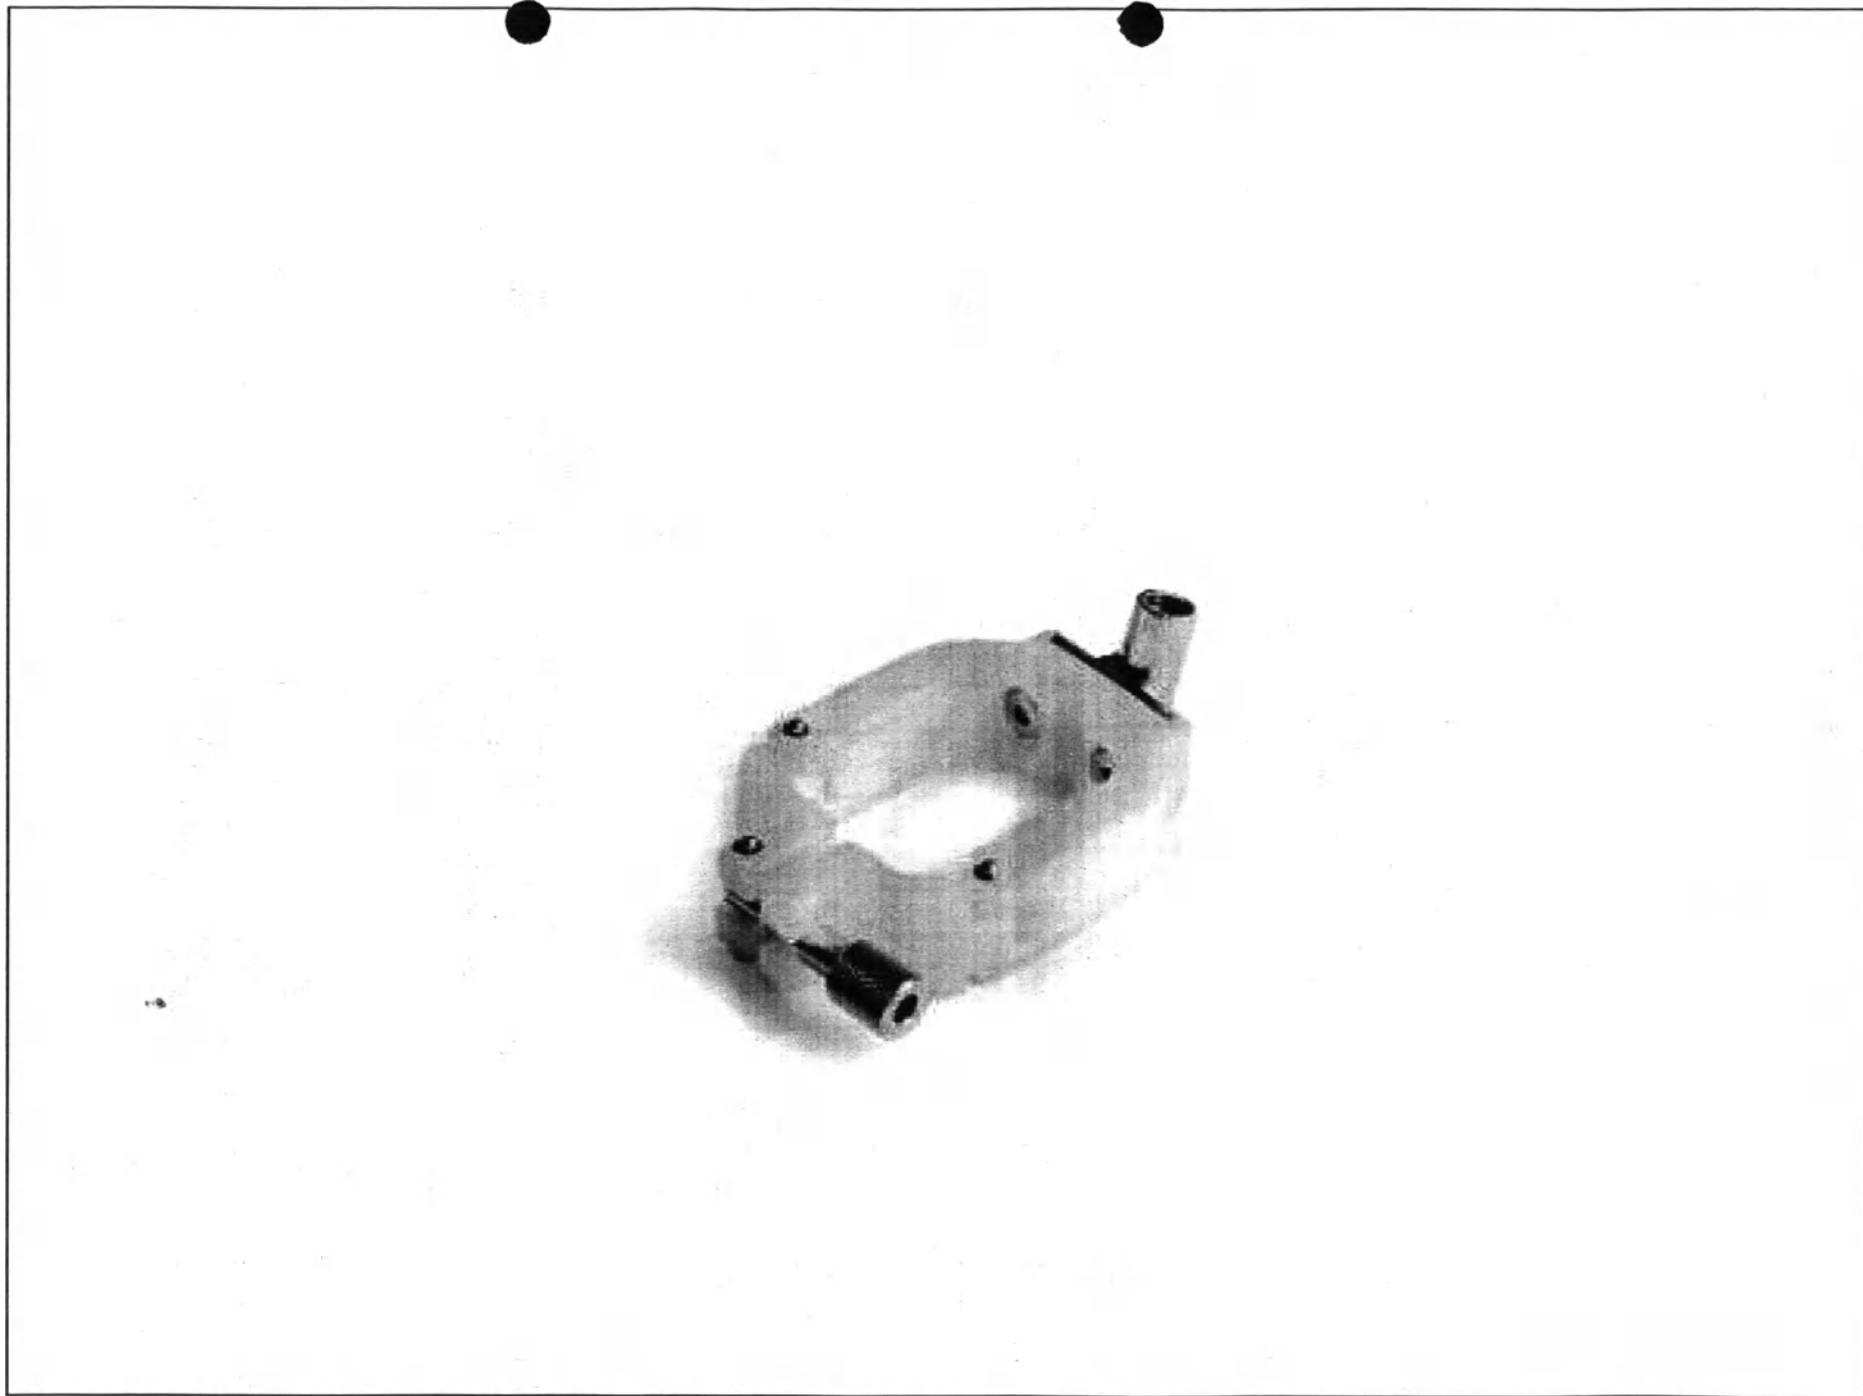


55. Адаптер пункционный для датчика секторного фазированного низкочастотного ультразвукового.




56. Адаптер пункционный для датчика микроконвексного высокочастотного ультразвукового.

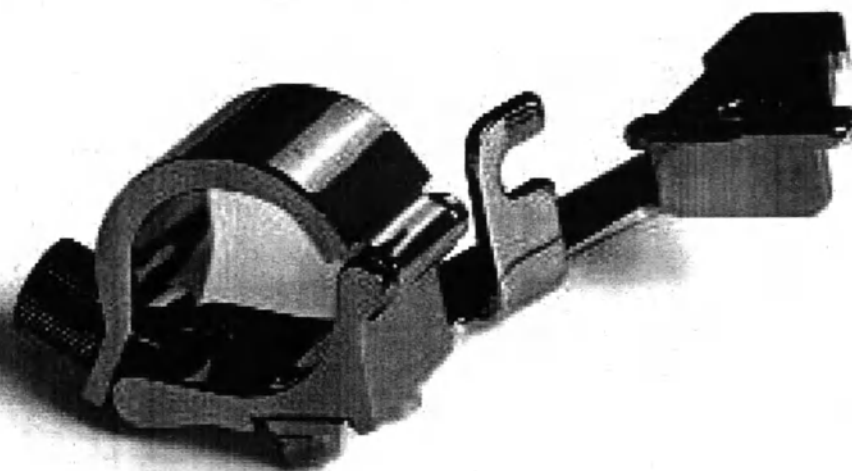


57. Адаптер пункционный для датчика микроконвексного низкочастотного ультразвукового.

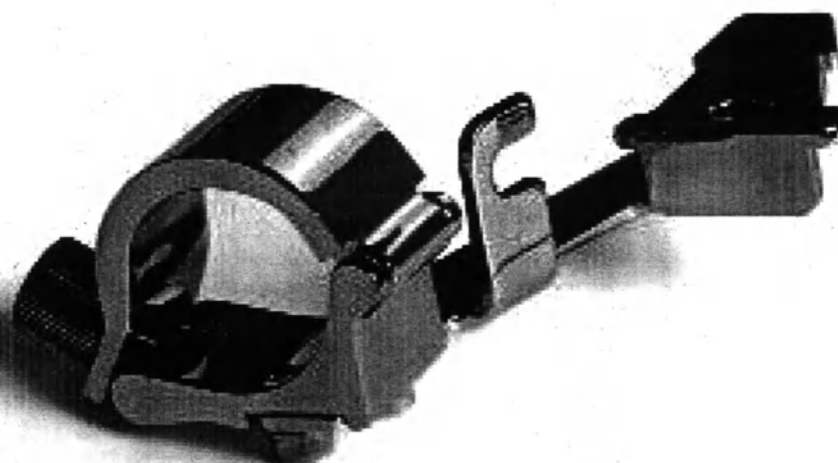

58. Адаптер пункционный для датчика монокристалльного конвексного ультразвукового.

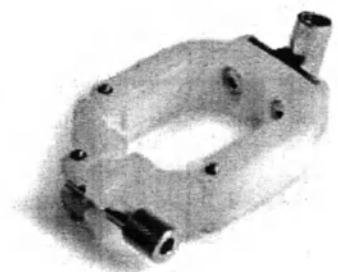


59. Адаптер пункционный для датчика широкополосного линейного ультразвукового.

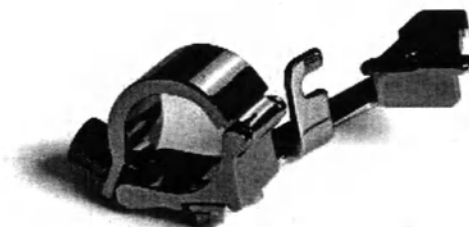


60. Адаптер пункционный для датчика монокристалльного секторного фазированного ультразвукового.



61. Ножной переключатель режимов работы сканера

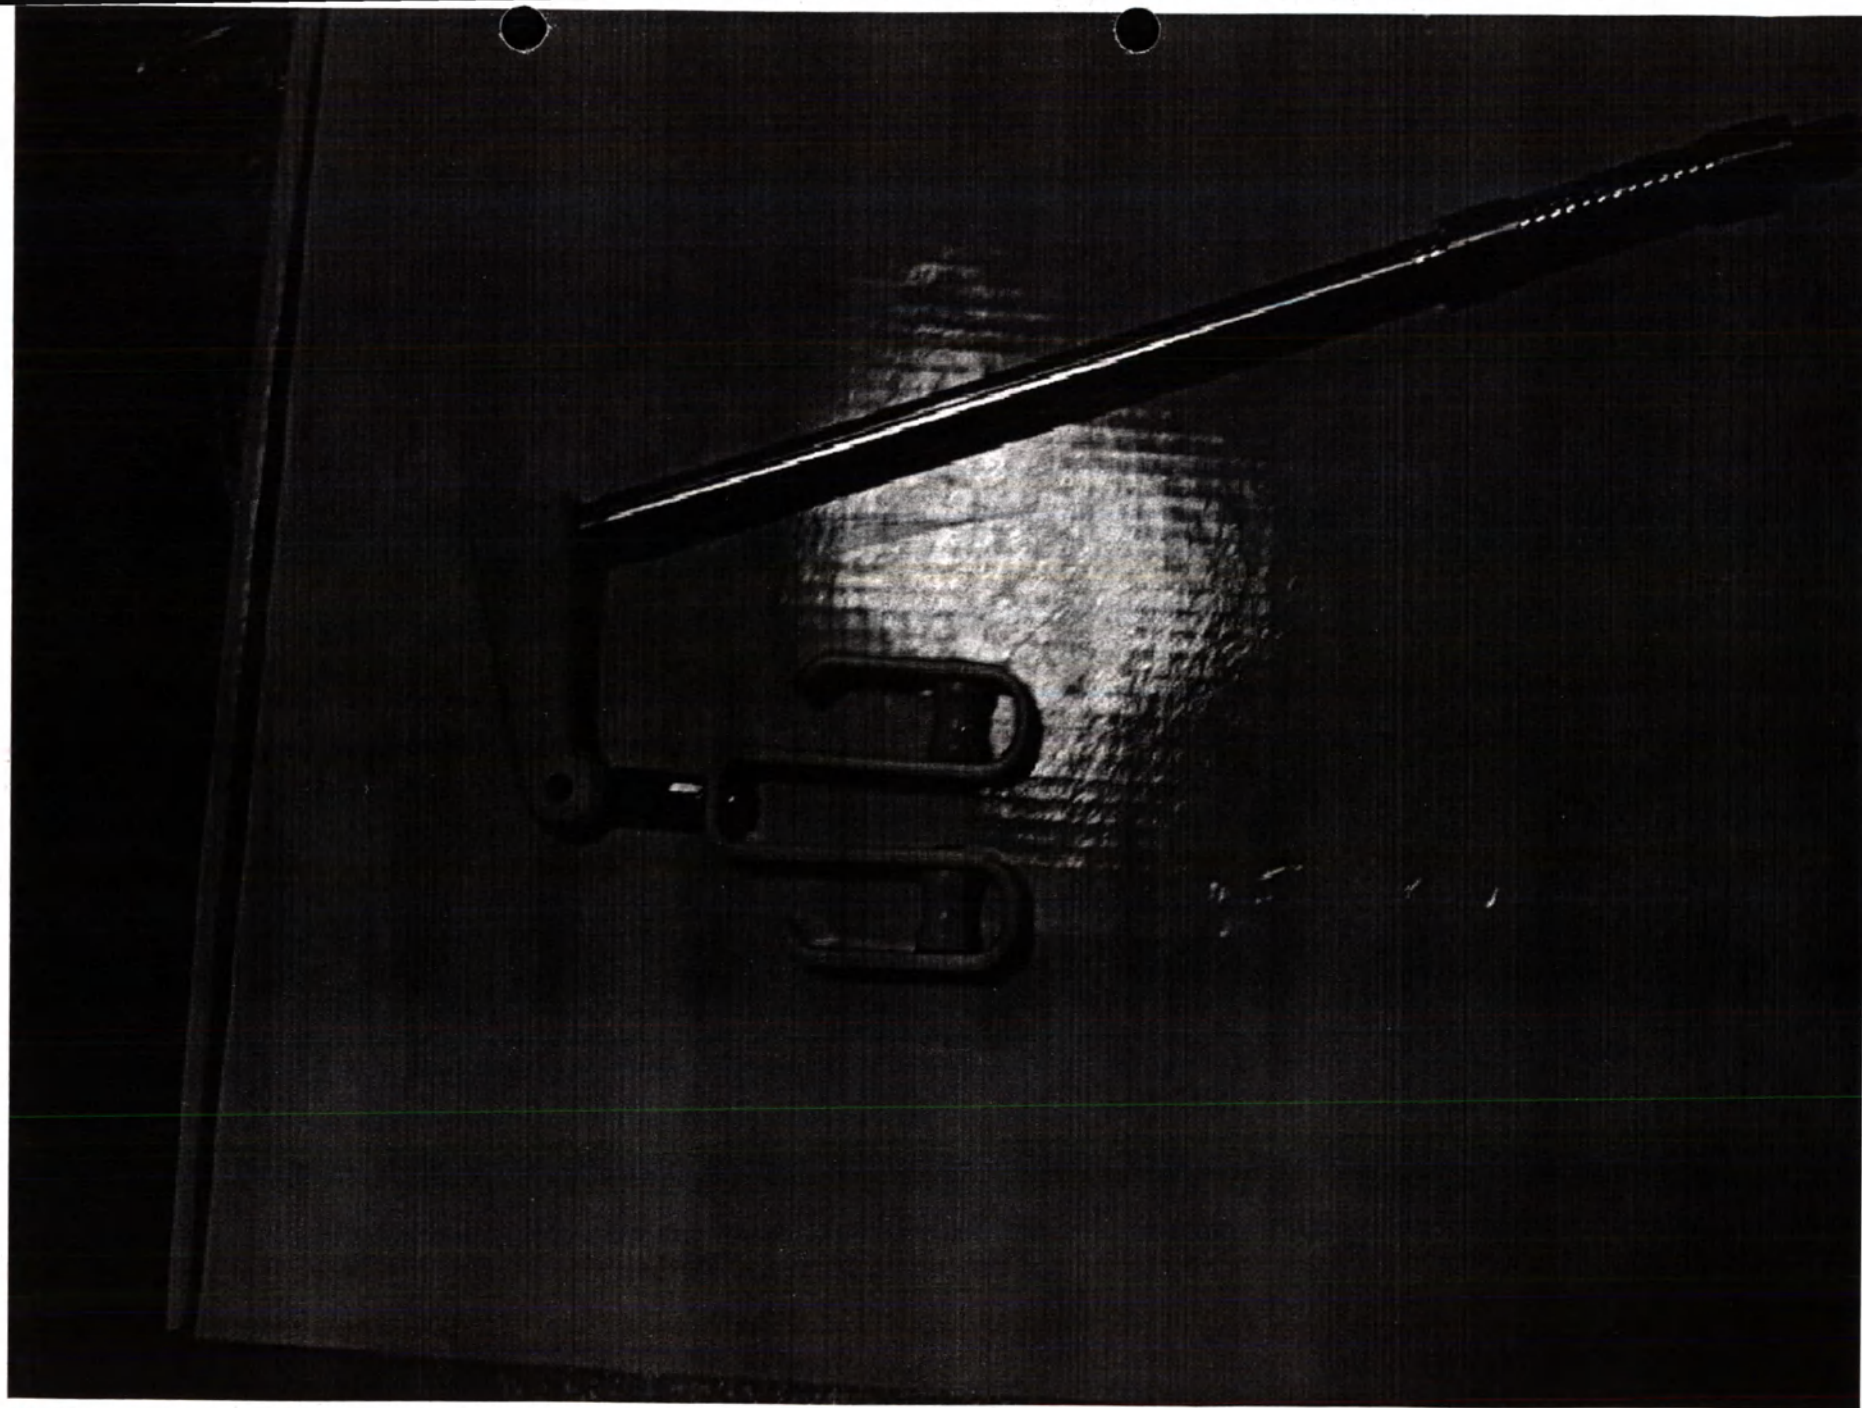

62. Держатель для кабелей датчиков – не более 2 шт

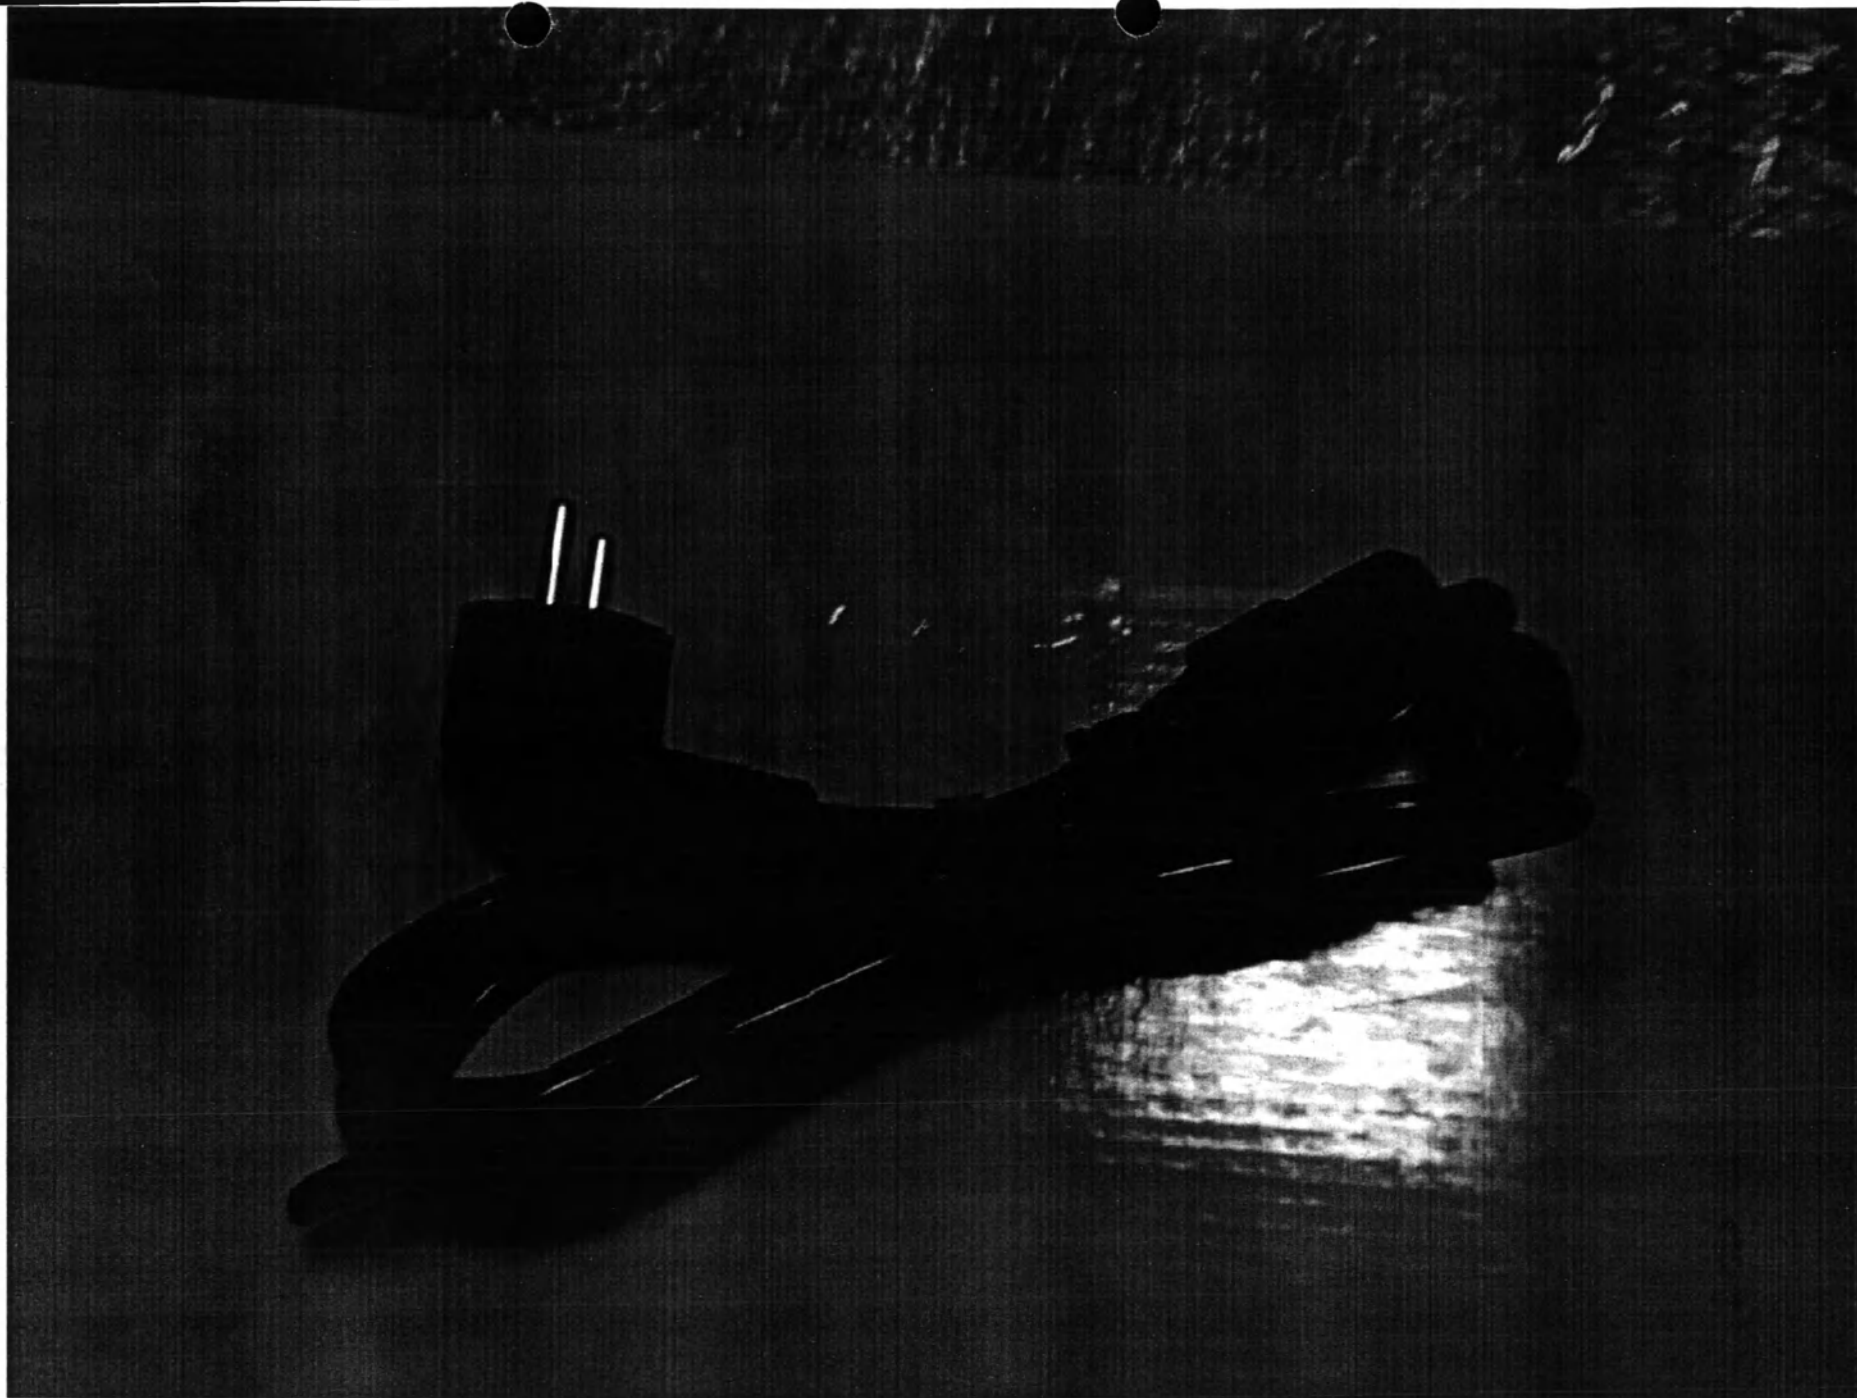


63. Сетевой кабель — не более 2 шт.




64. Набор интерфейсных кабелей – не более 2 шт.




65. Руководство пользователя – не более 3 шт.

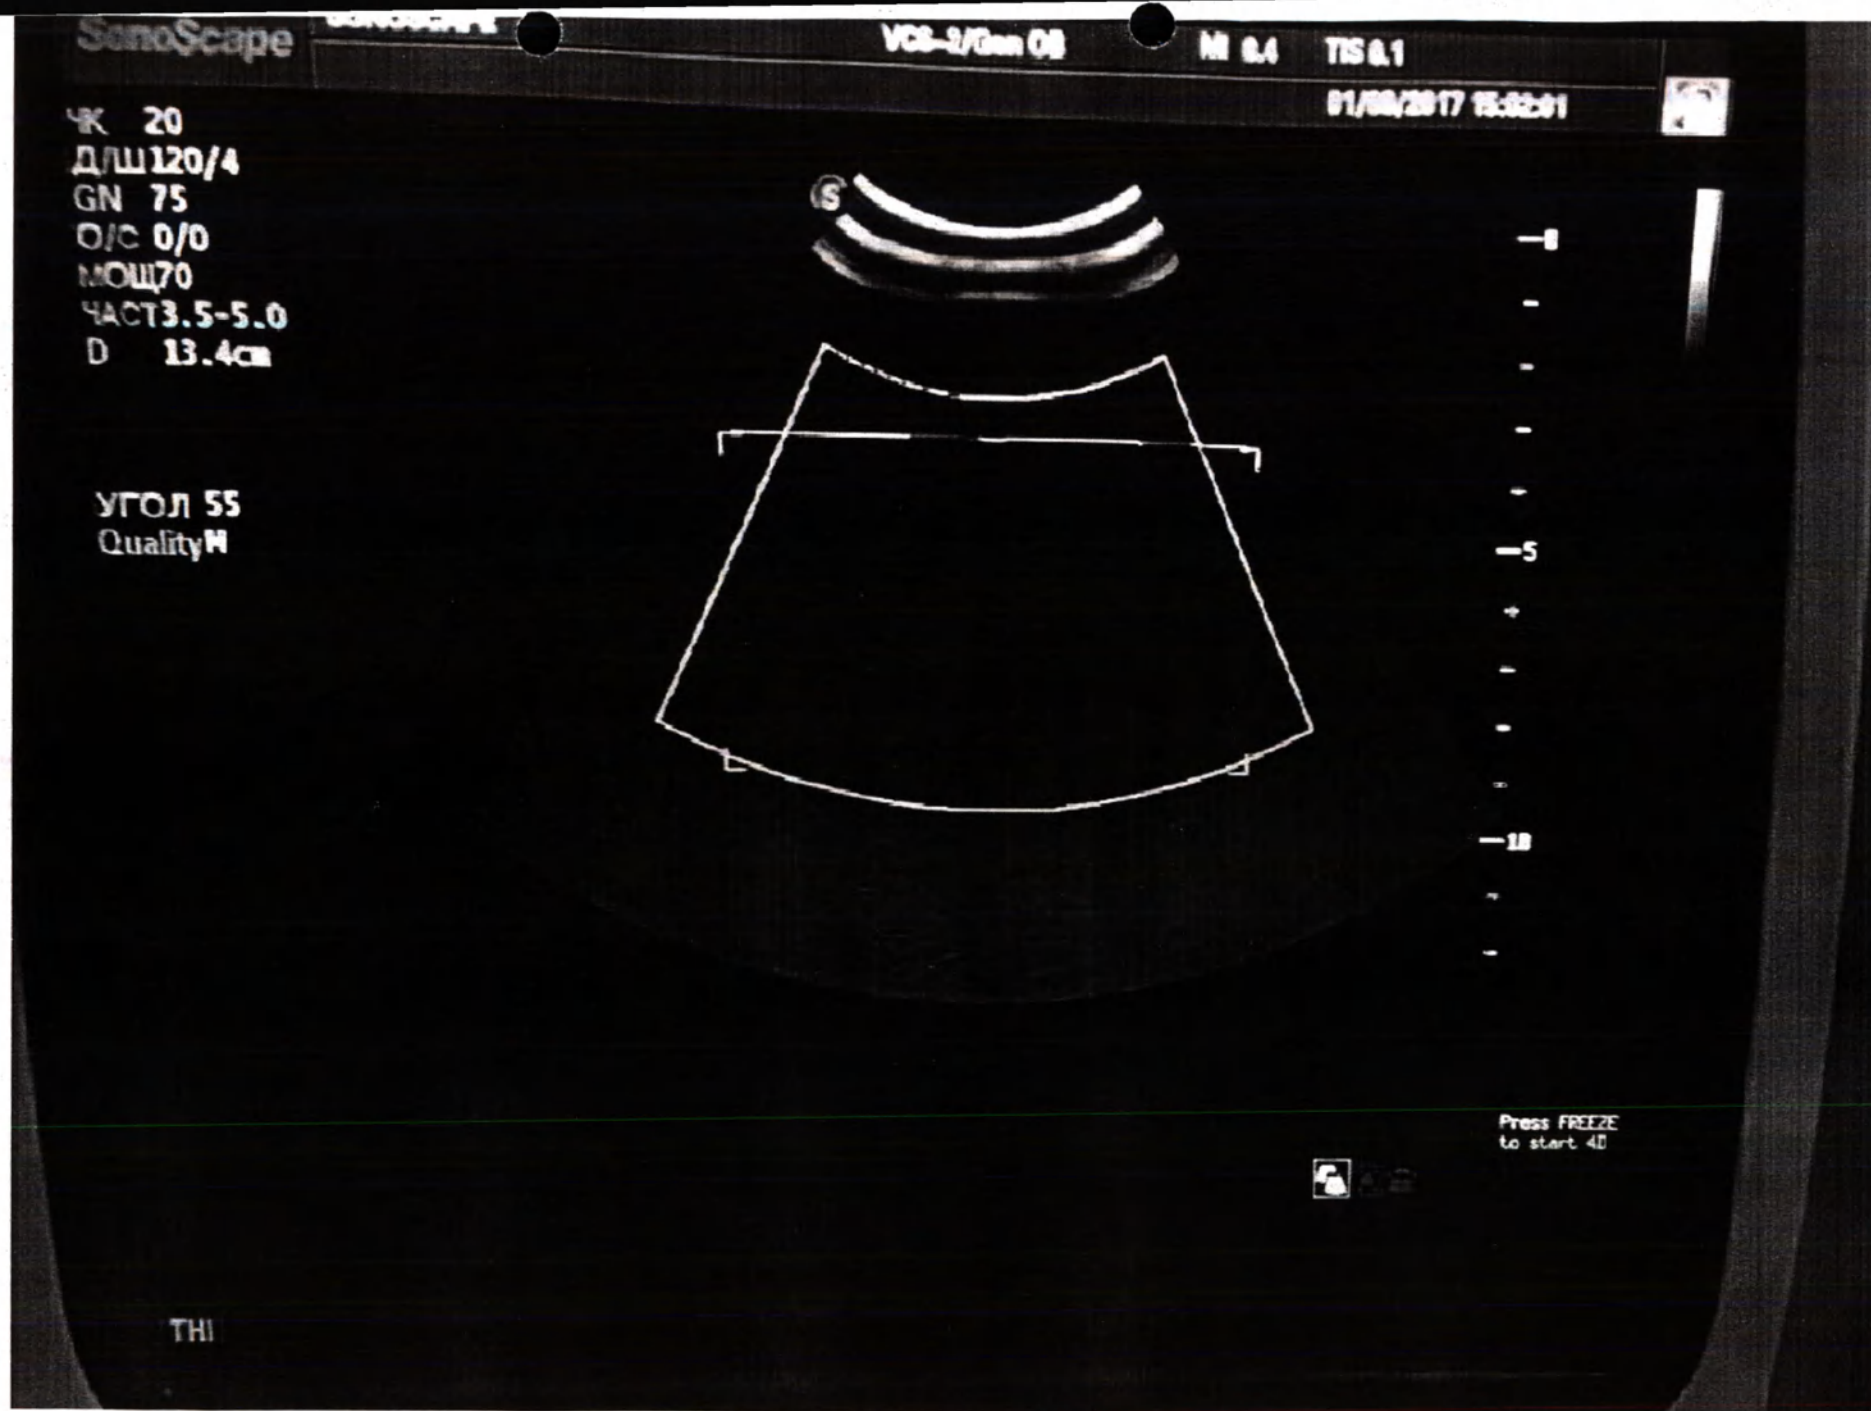


66. Модуль трехмерной реконструкции в реальном режиме времени.

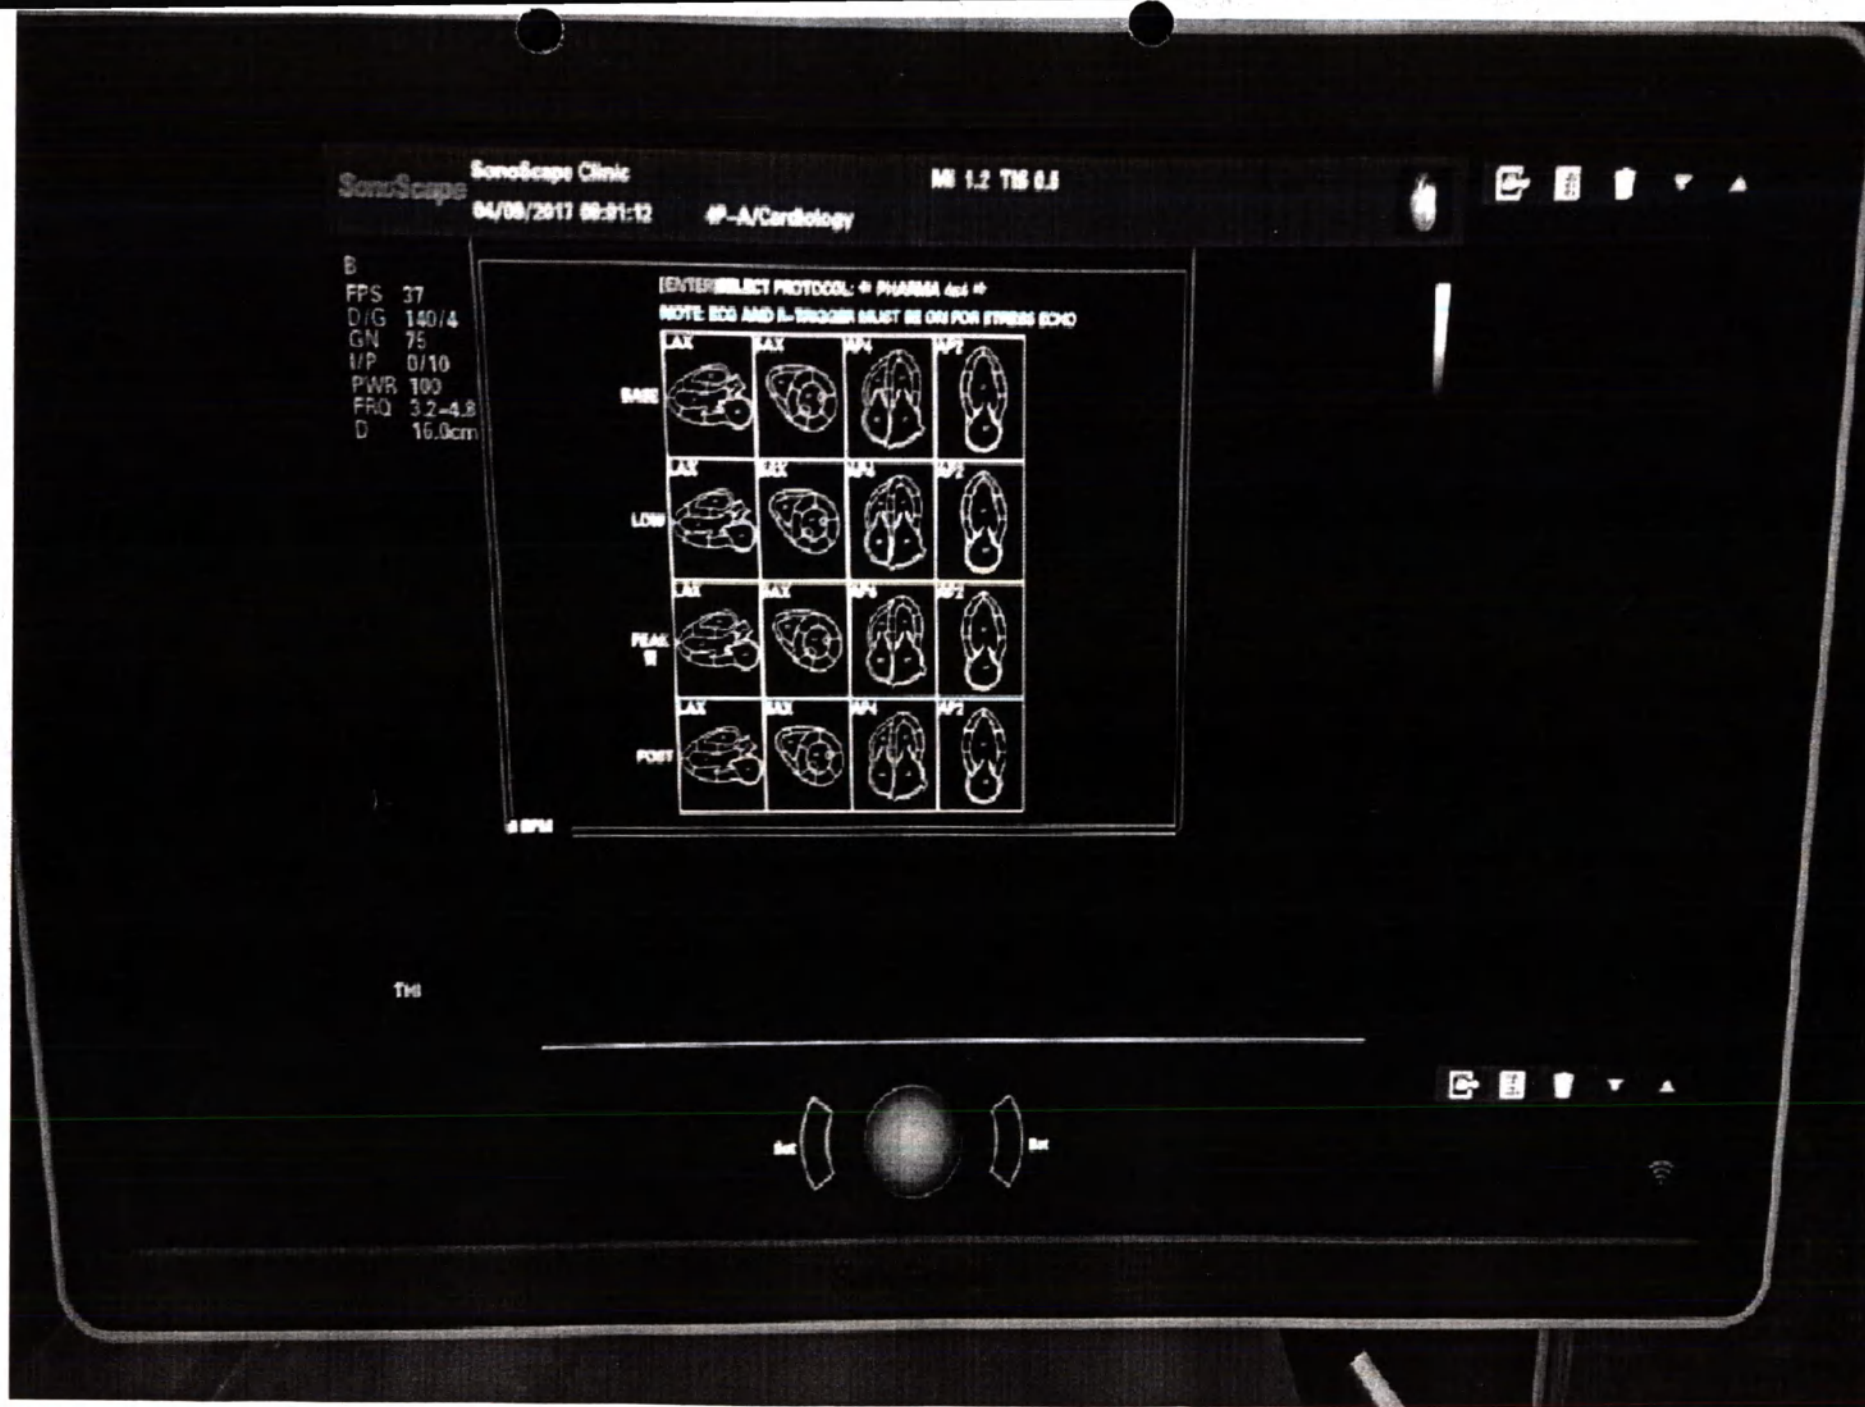


67. Модуль стресс-эхо.

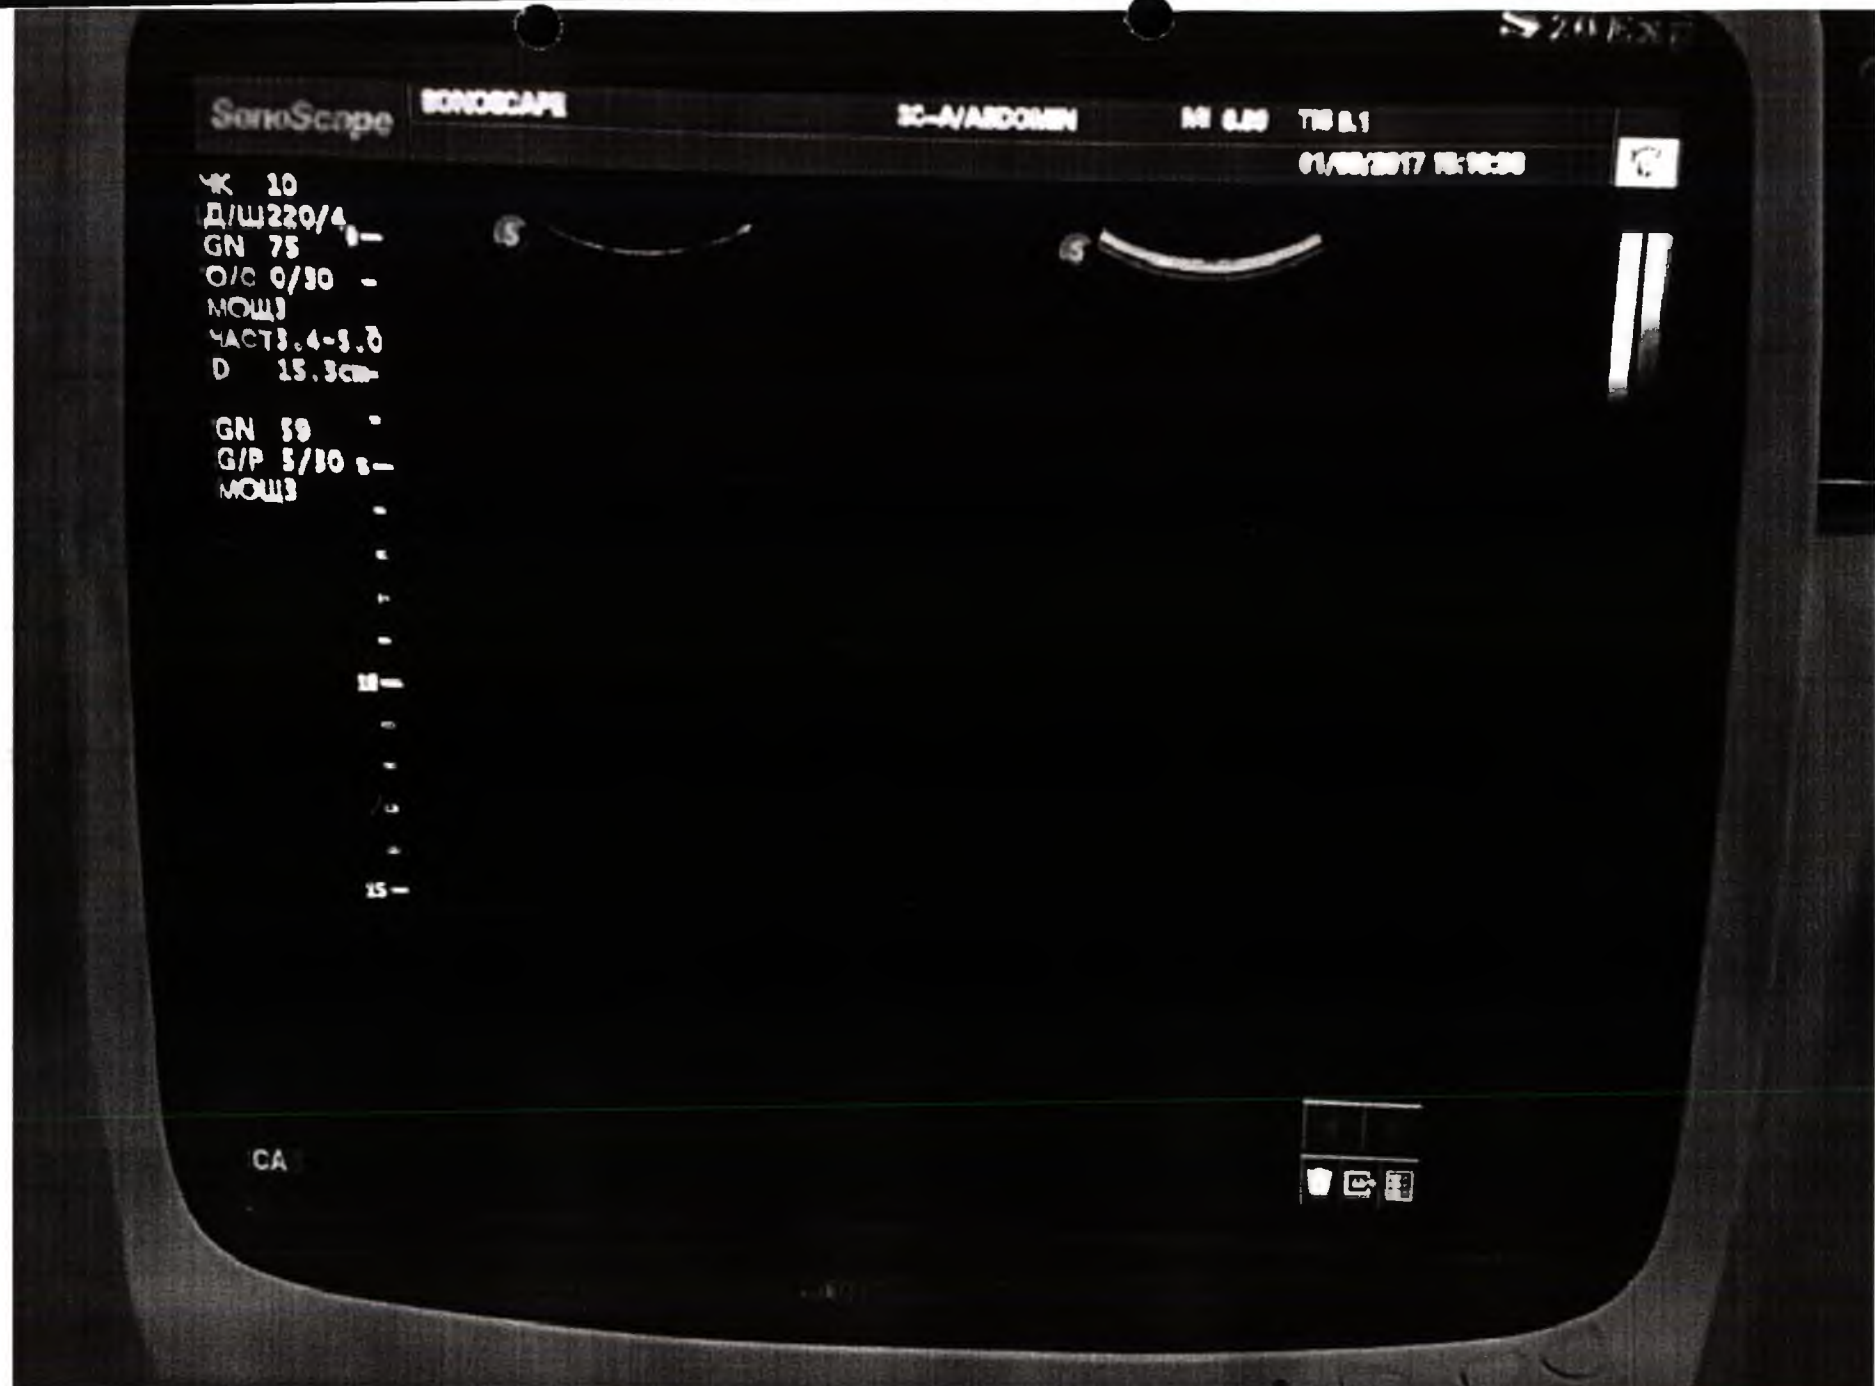


68. Модуль контрастных веществ.

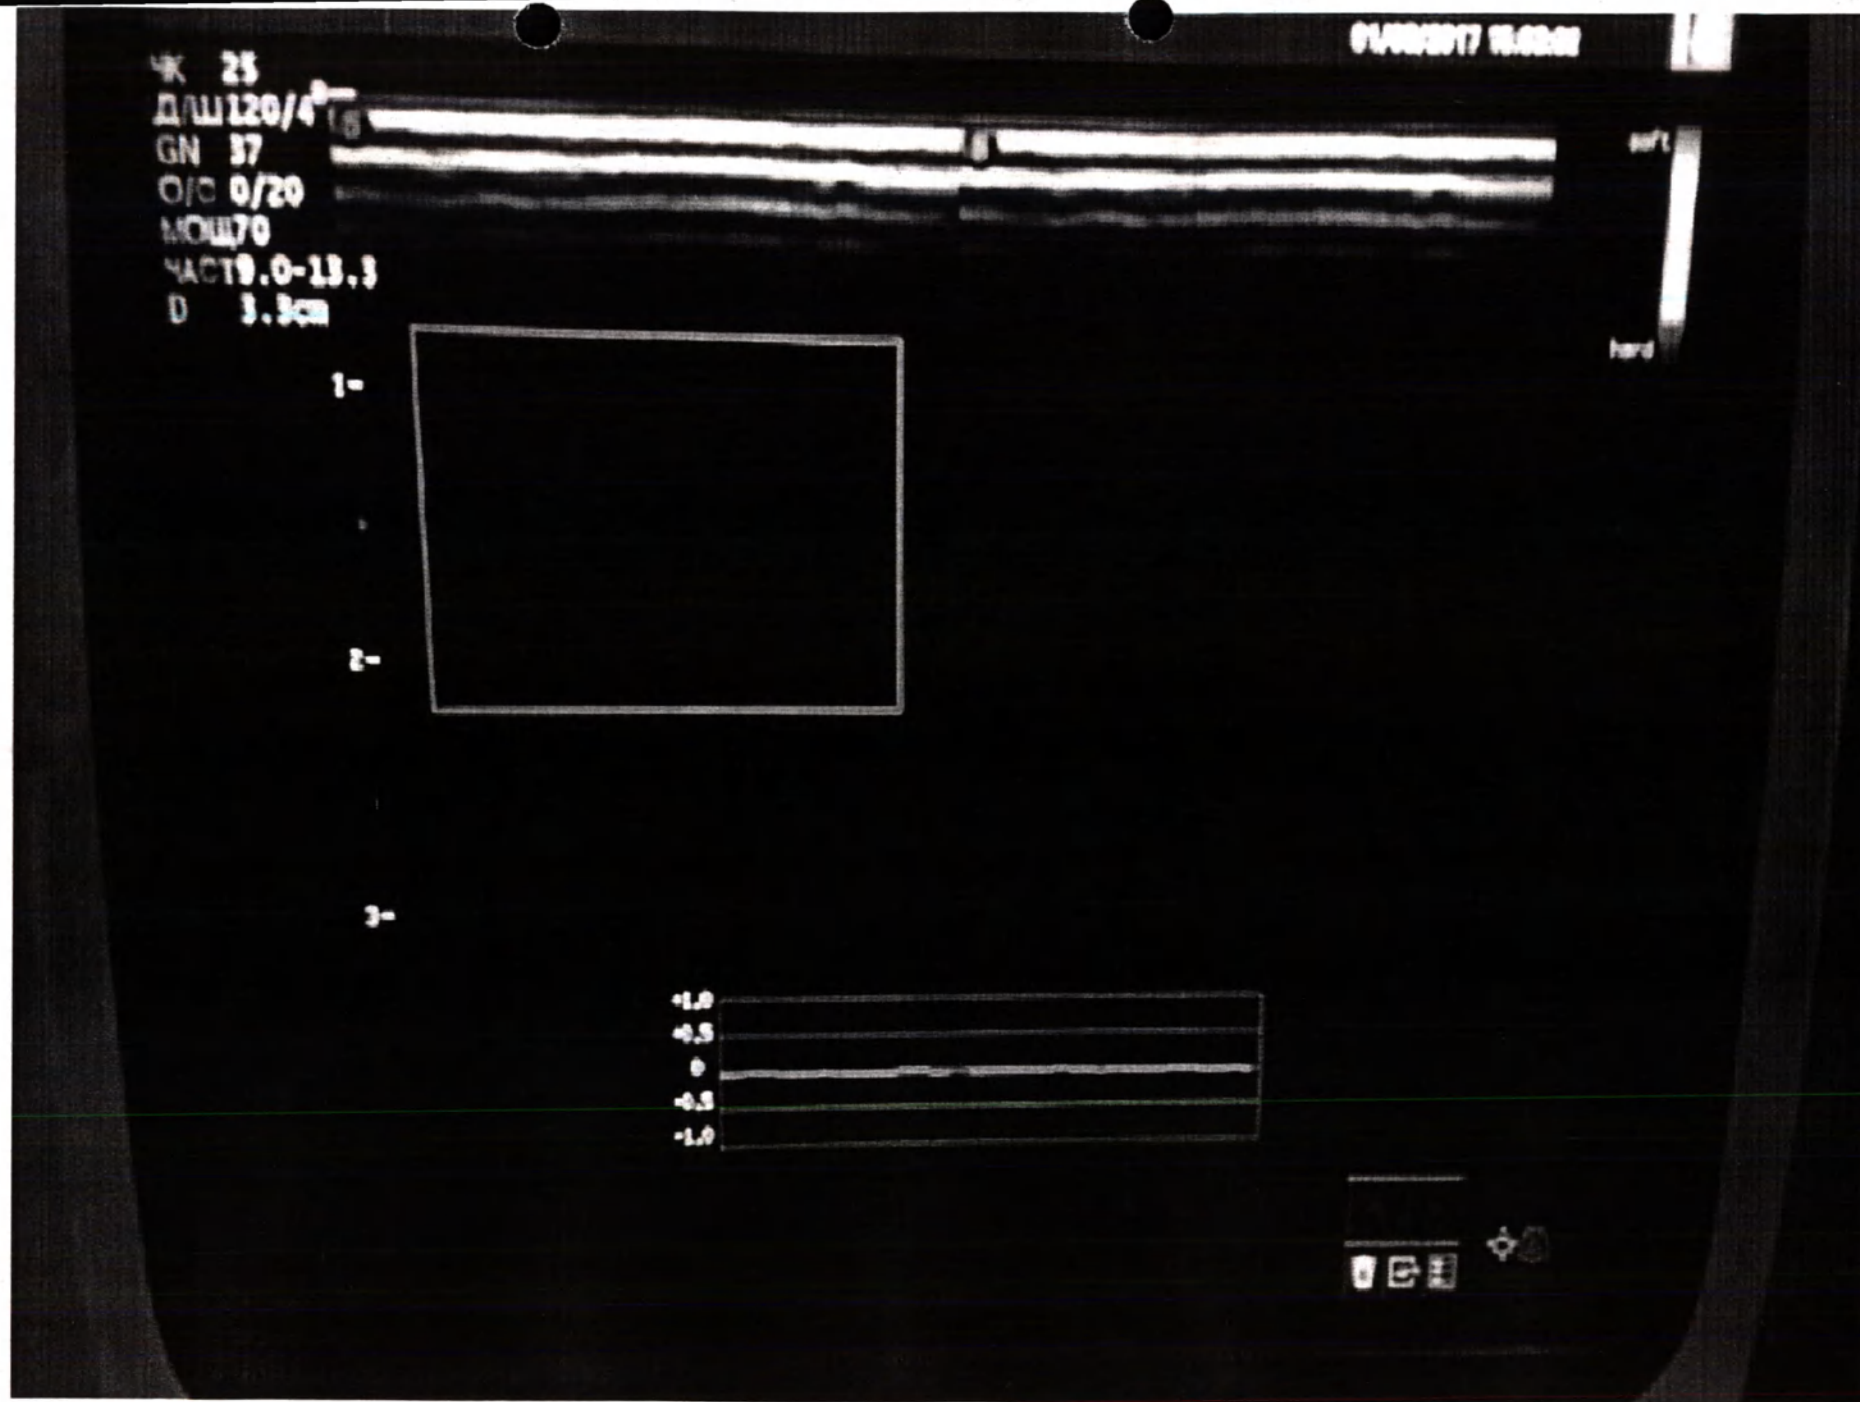


69. Модуль эластографии.

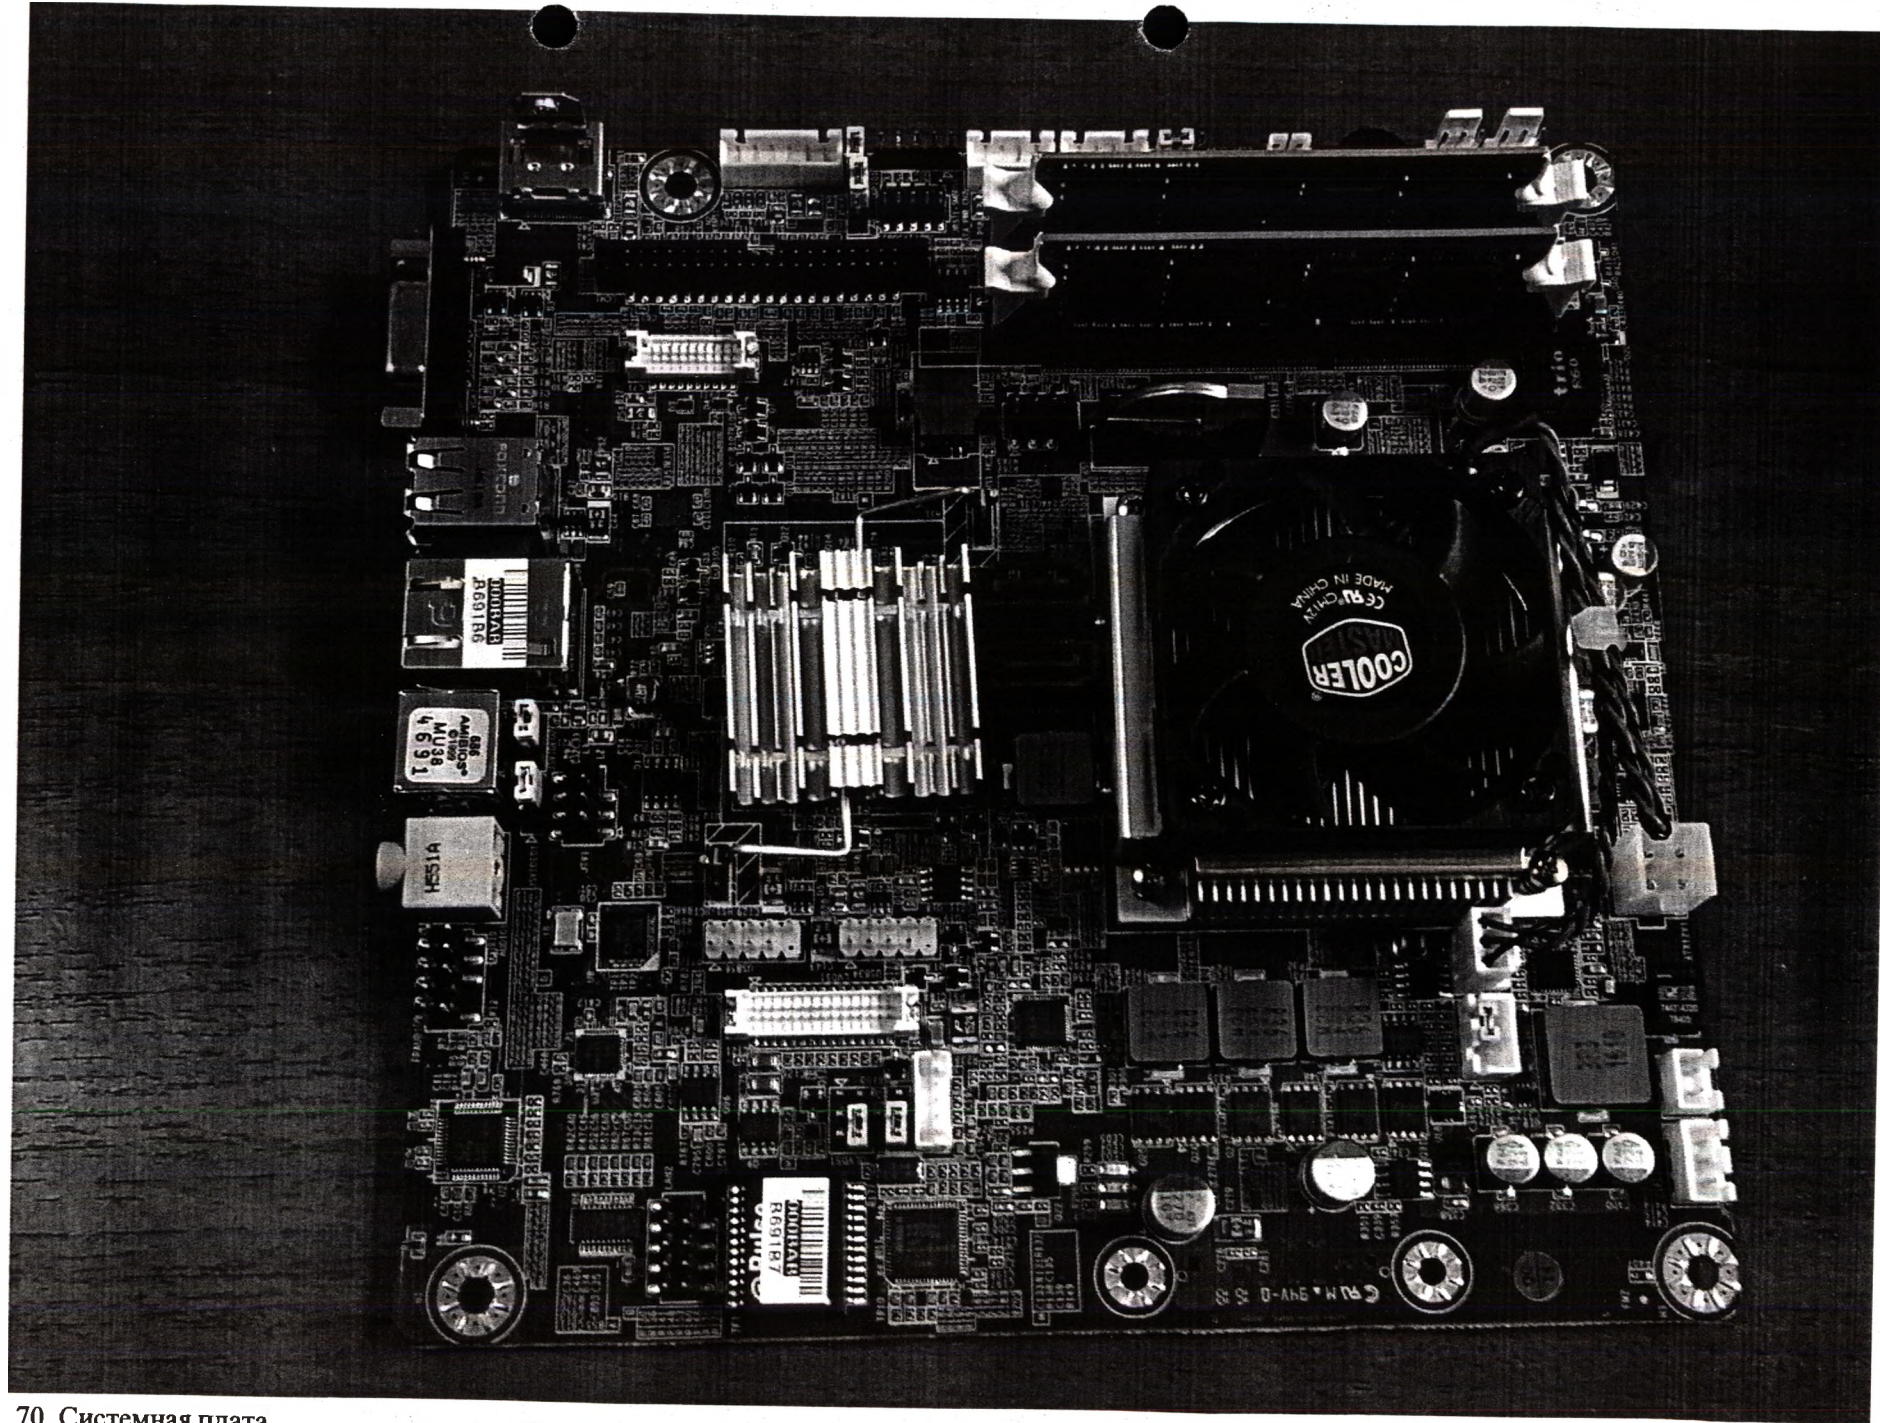


70. Системная плата.

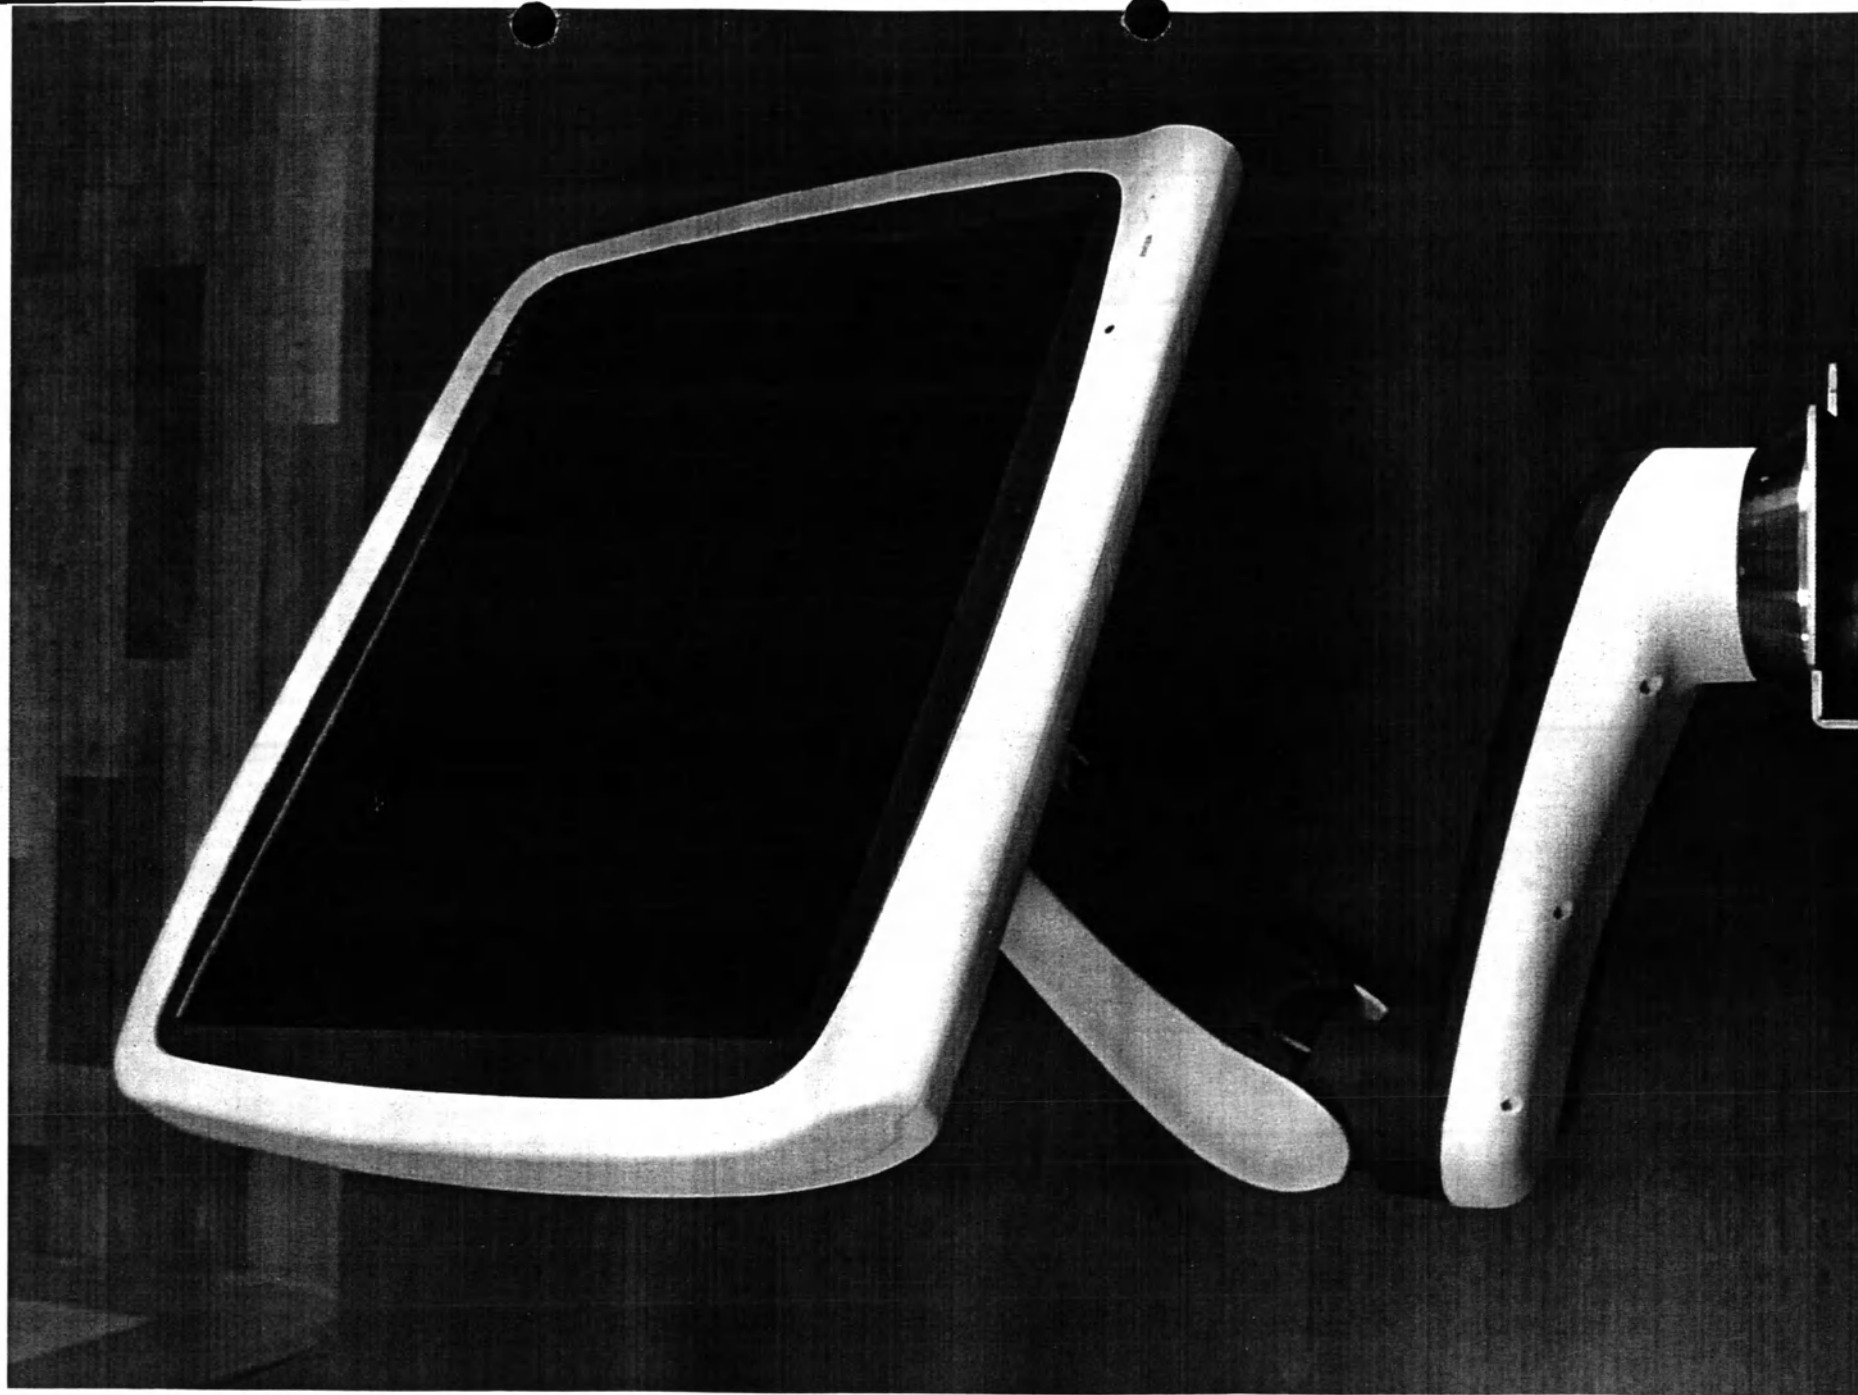


71. Жидкокристаллический монитор.

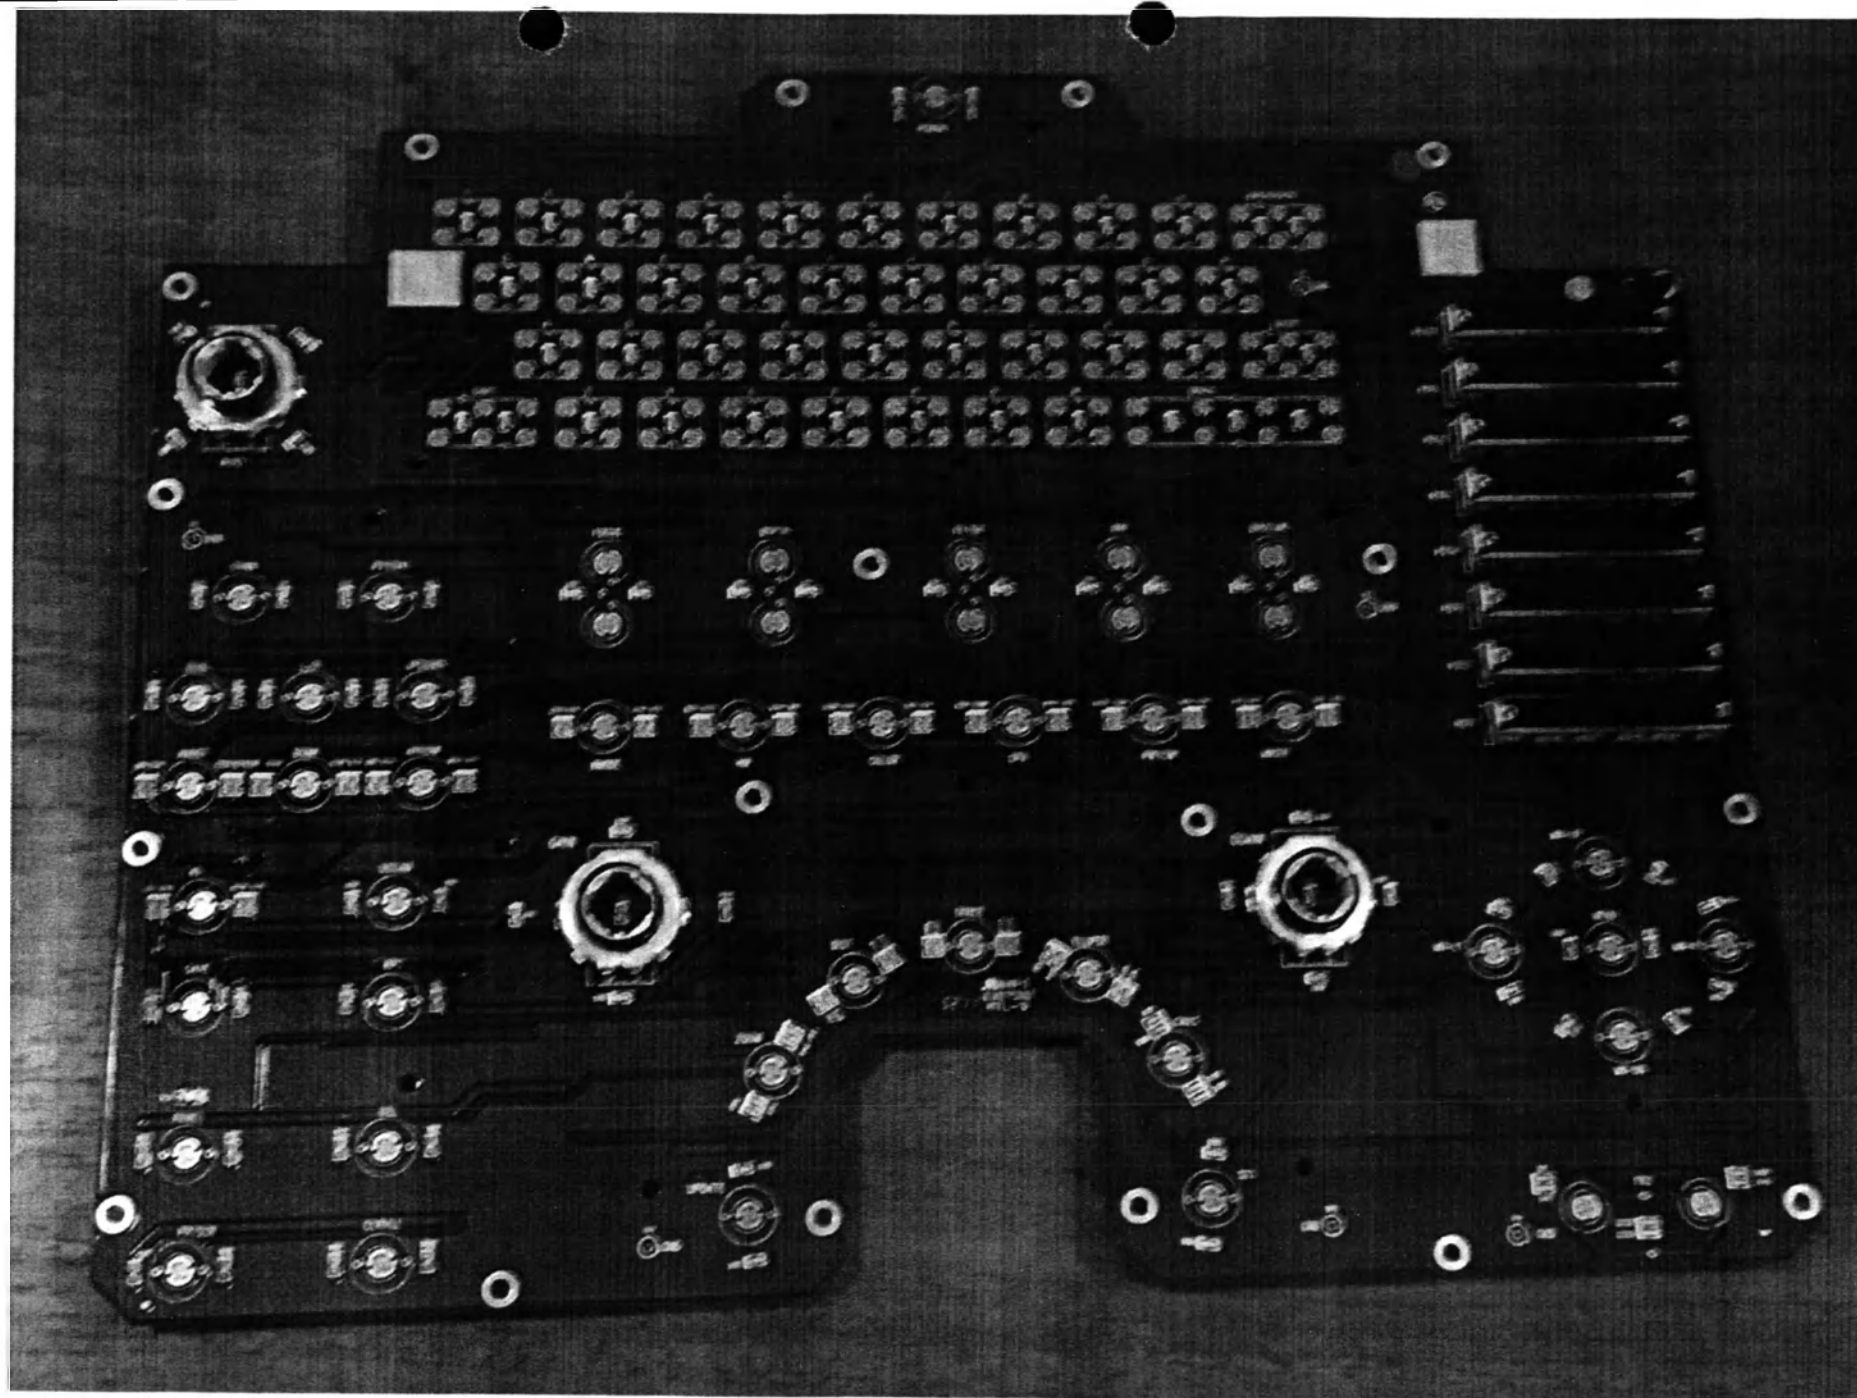


72. Панель управления.

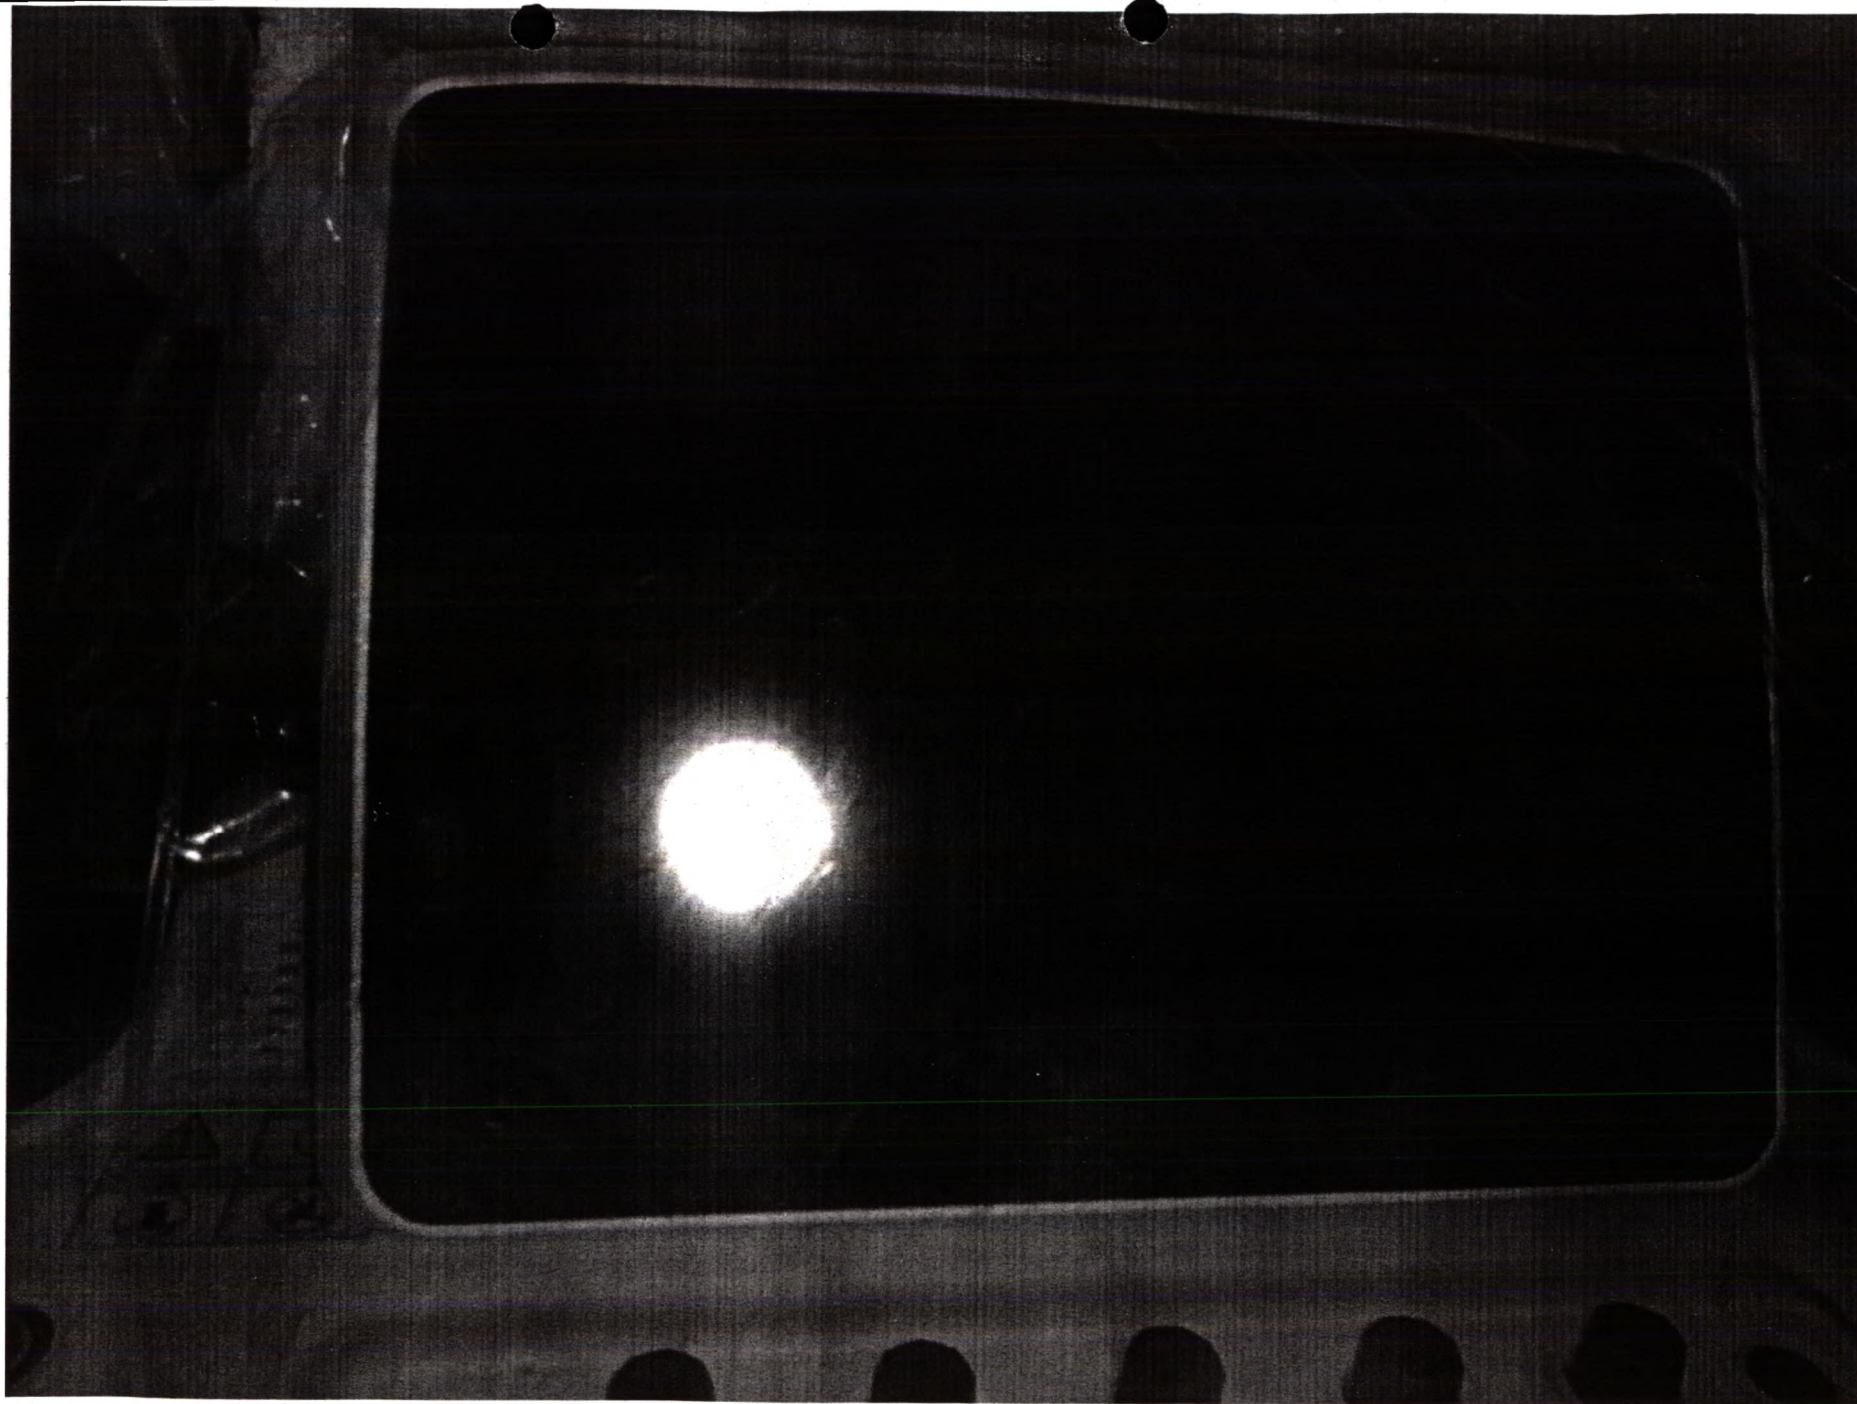


73. Сенсорная панель управления.

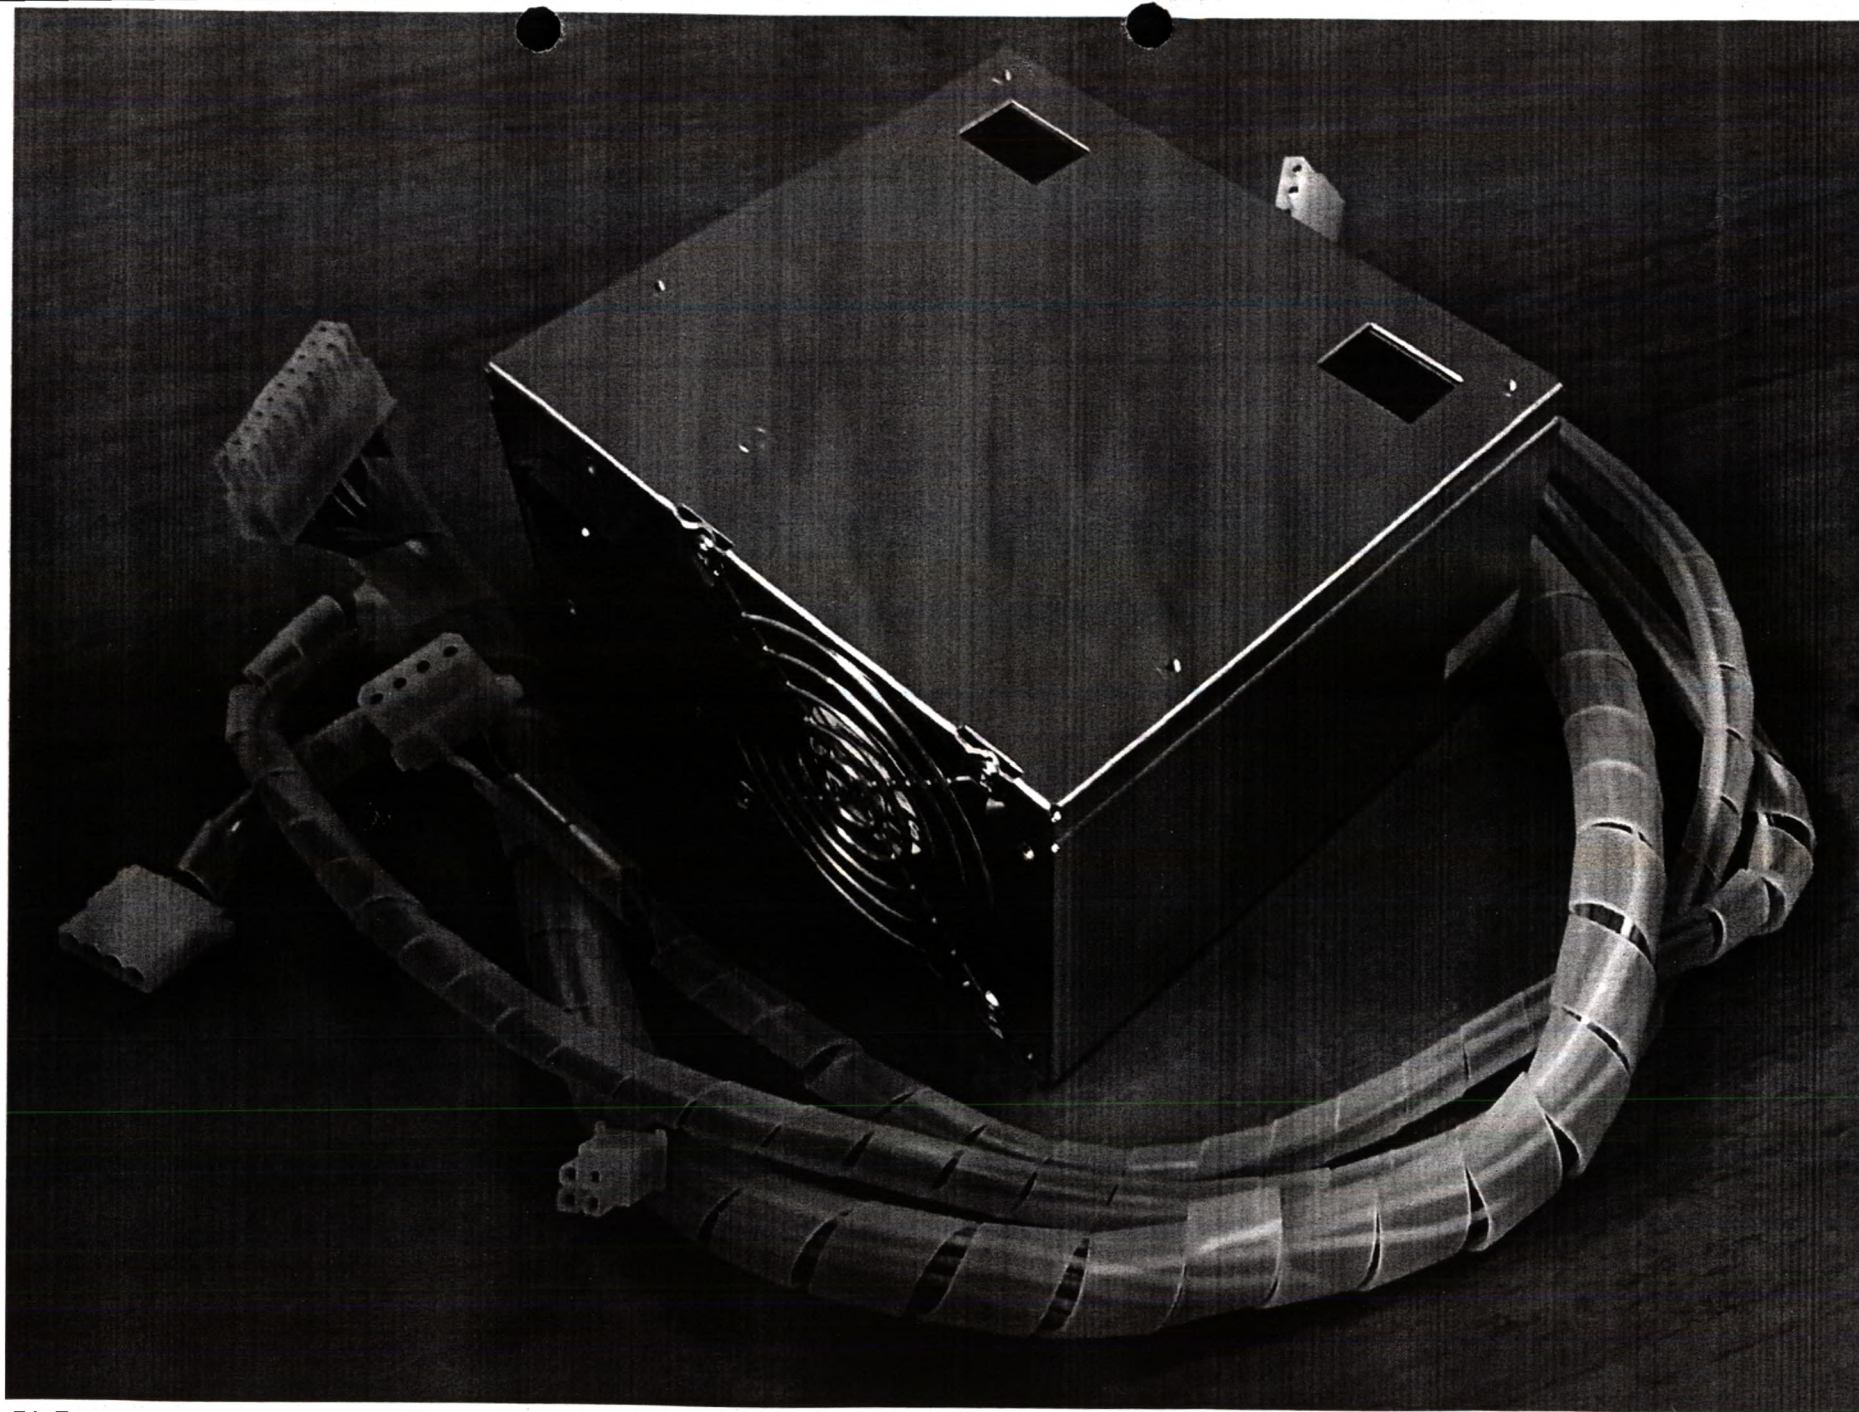


74. Блок питания— не более 2 шт.

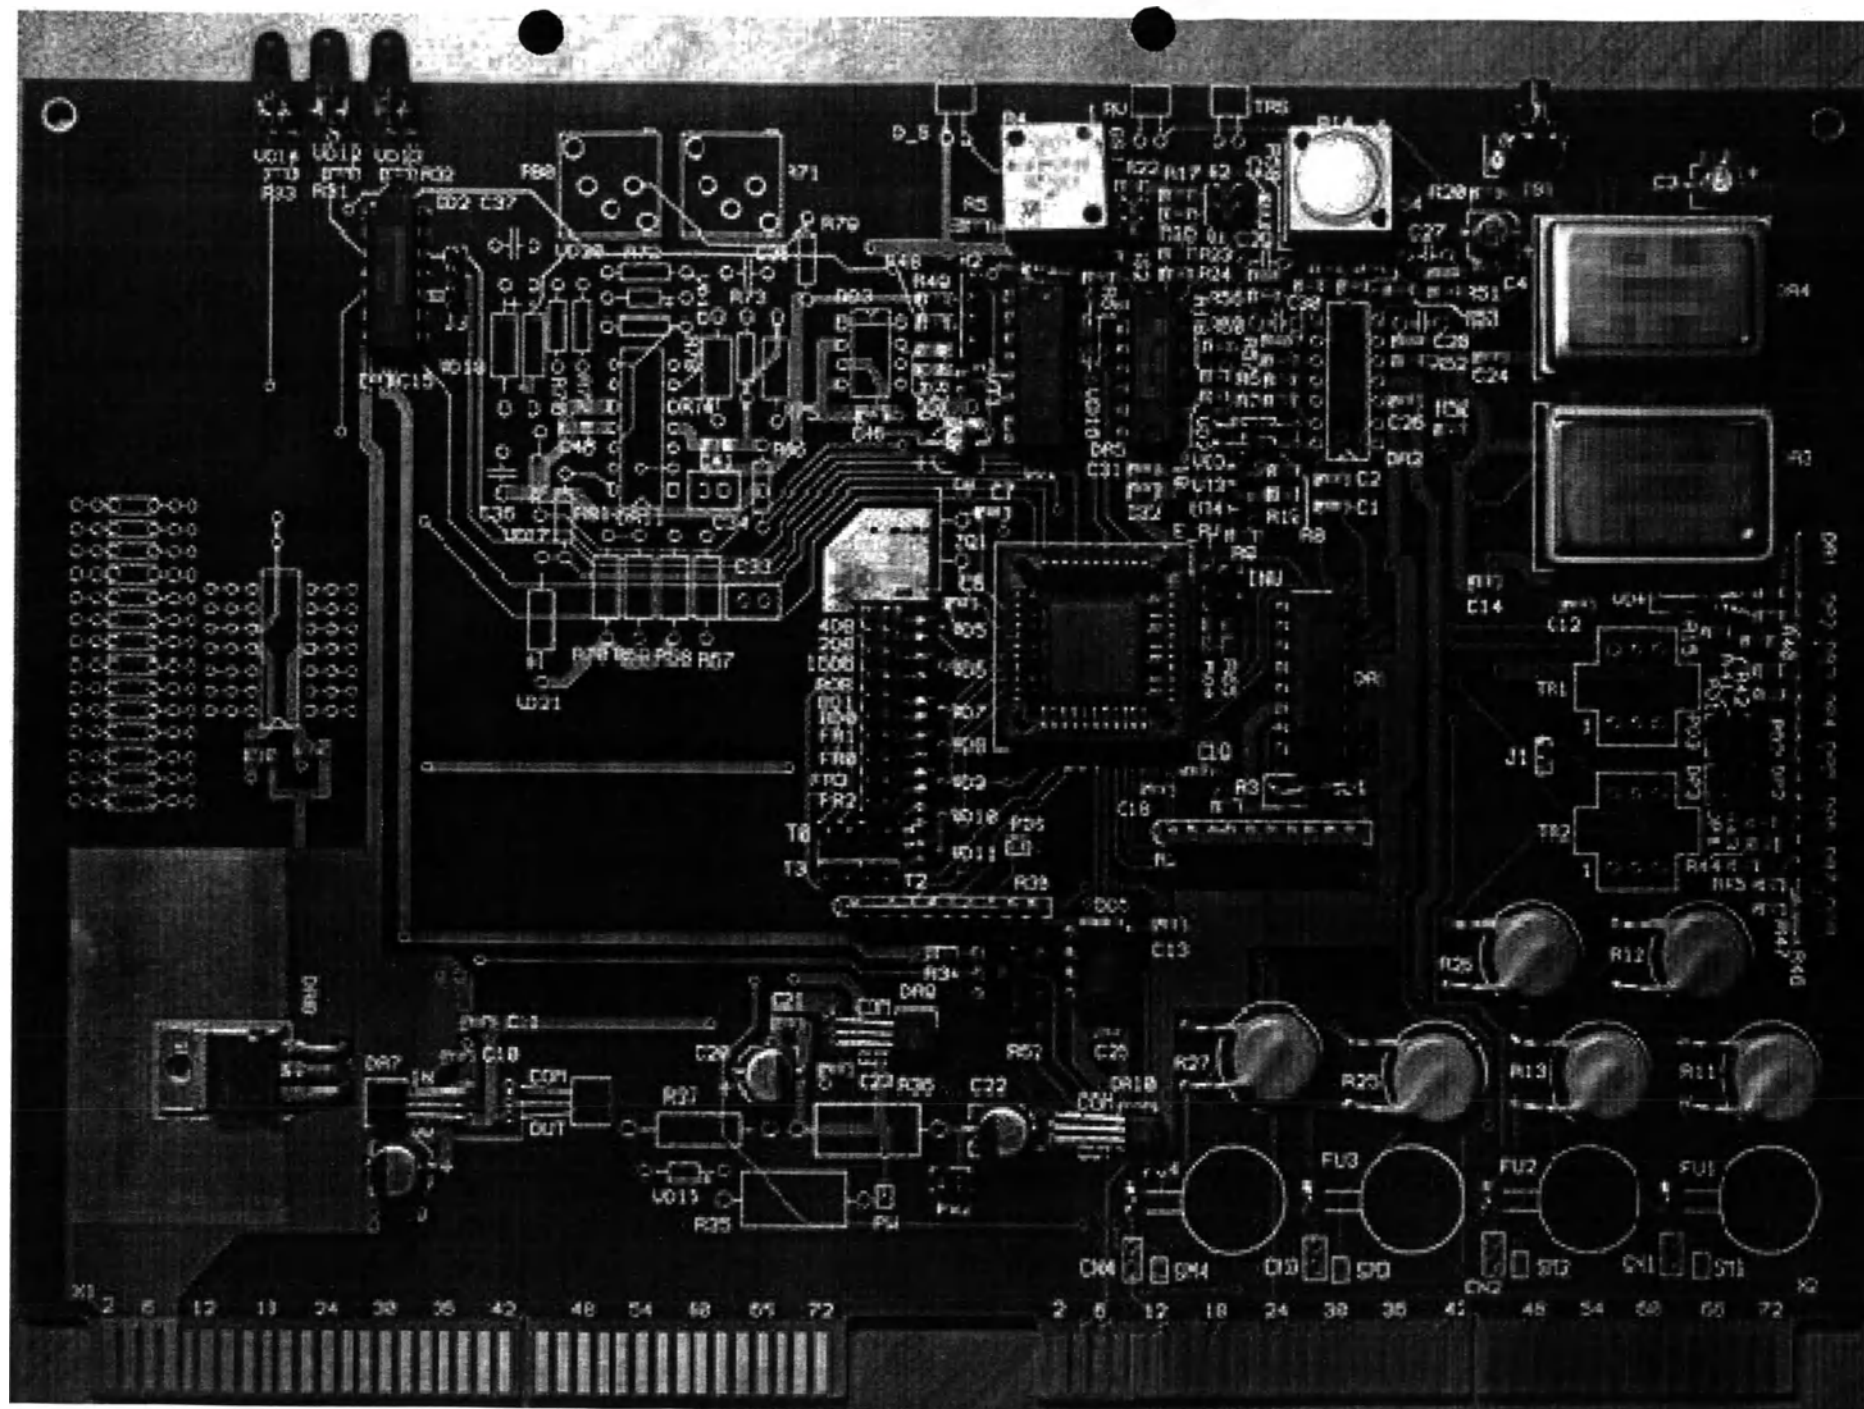


75. Блок формирователя луча.

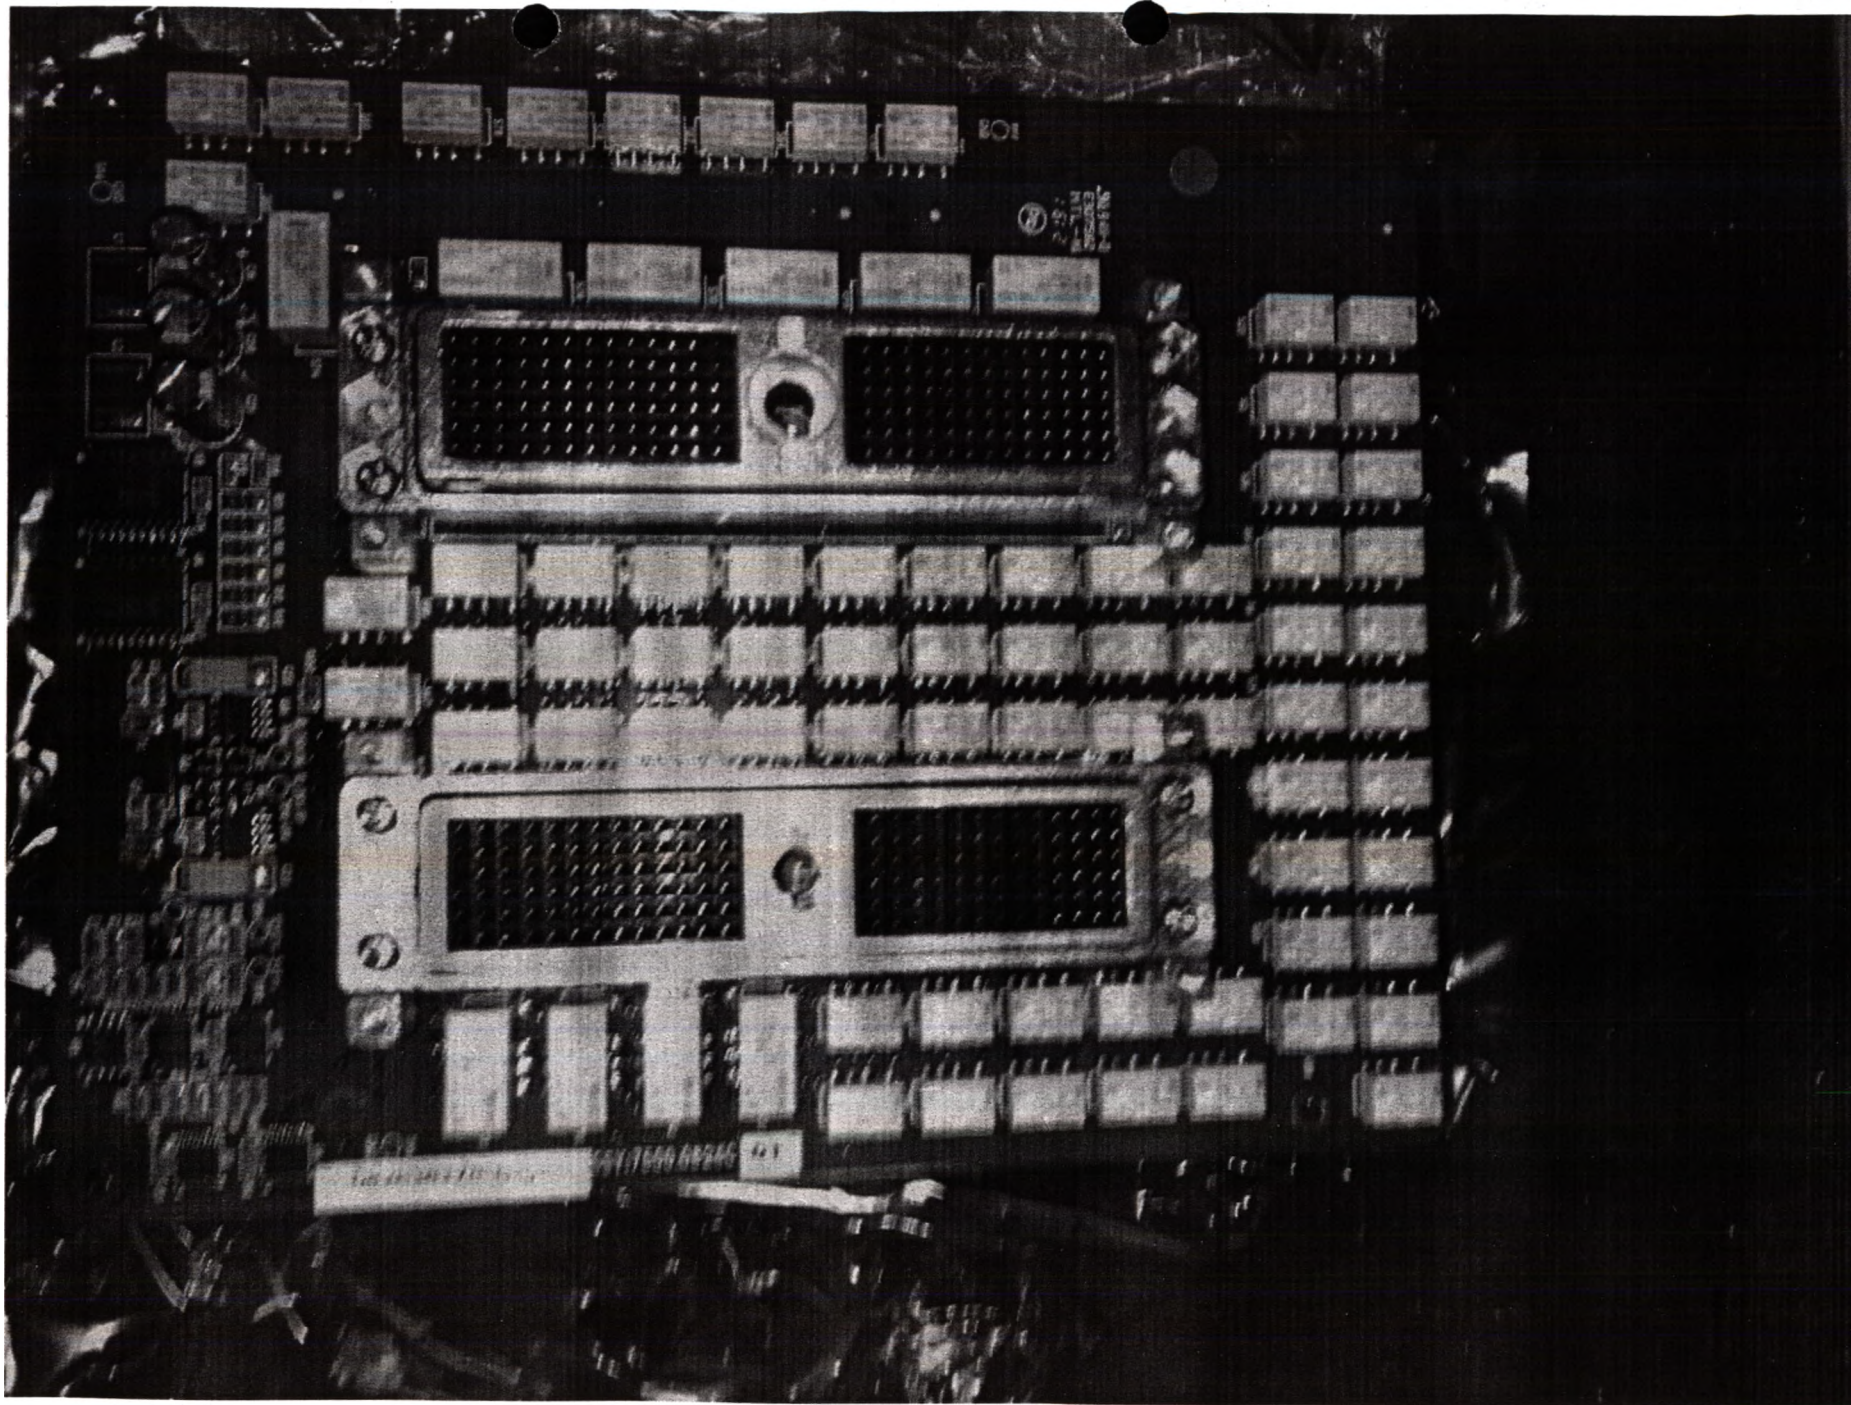

76. Блок коннекторов.

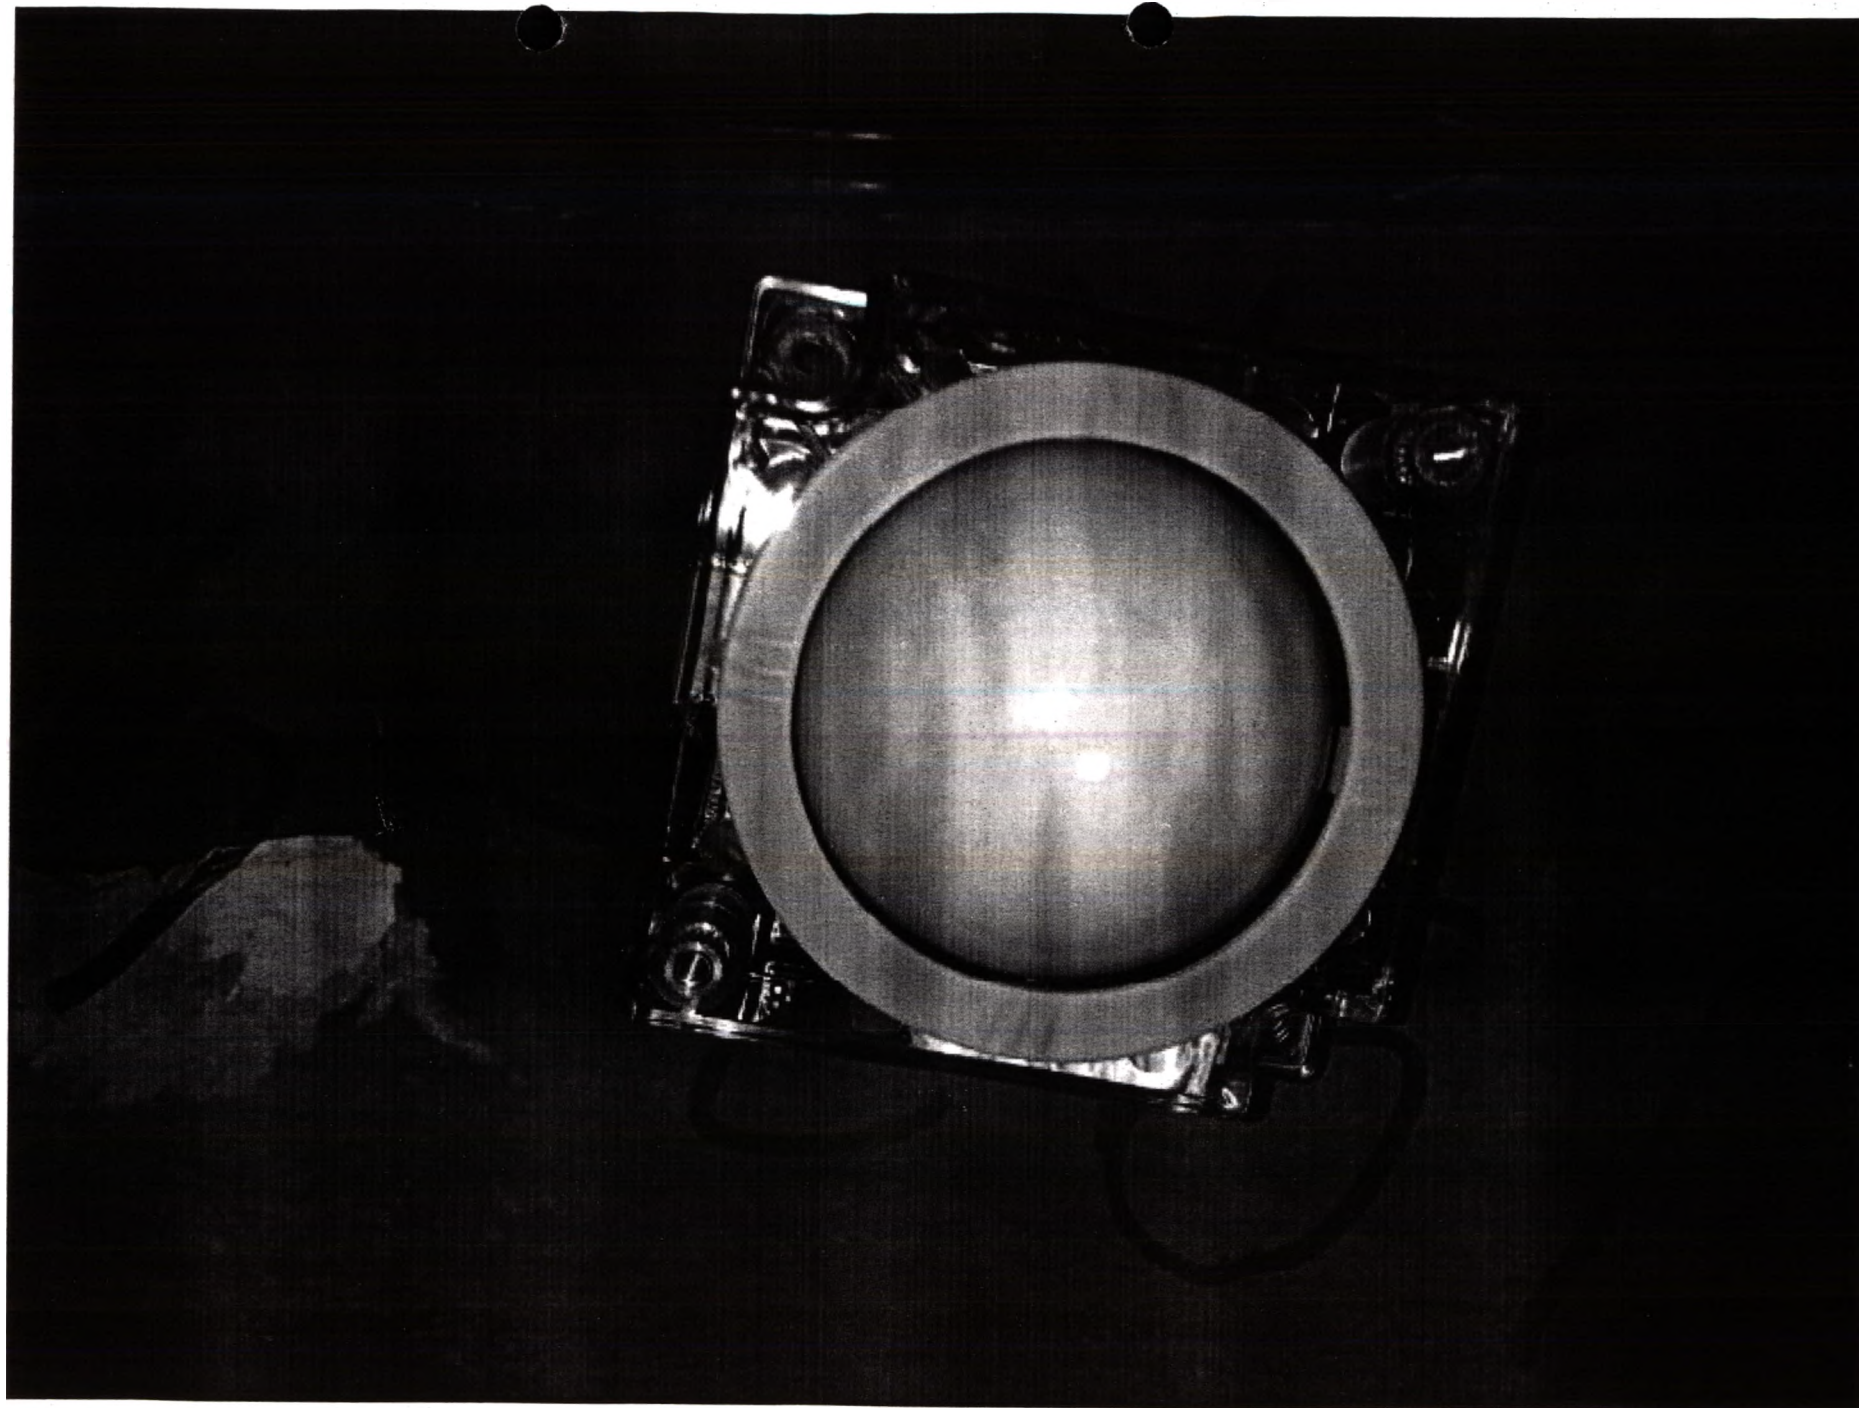

77. Манипулятор шаровой.

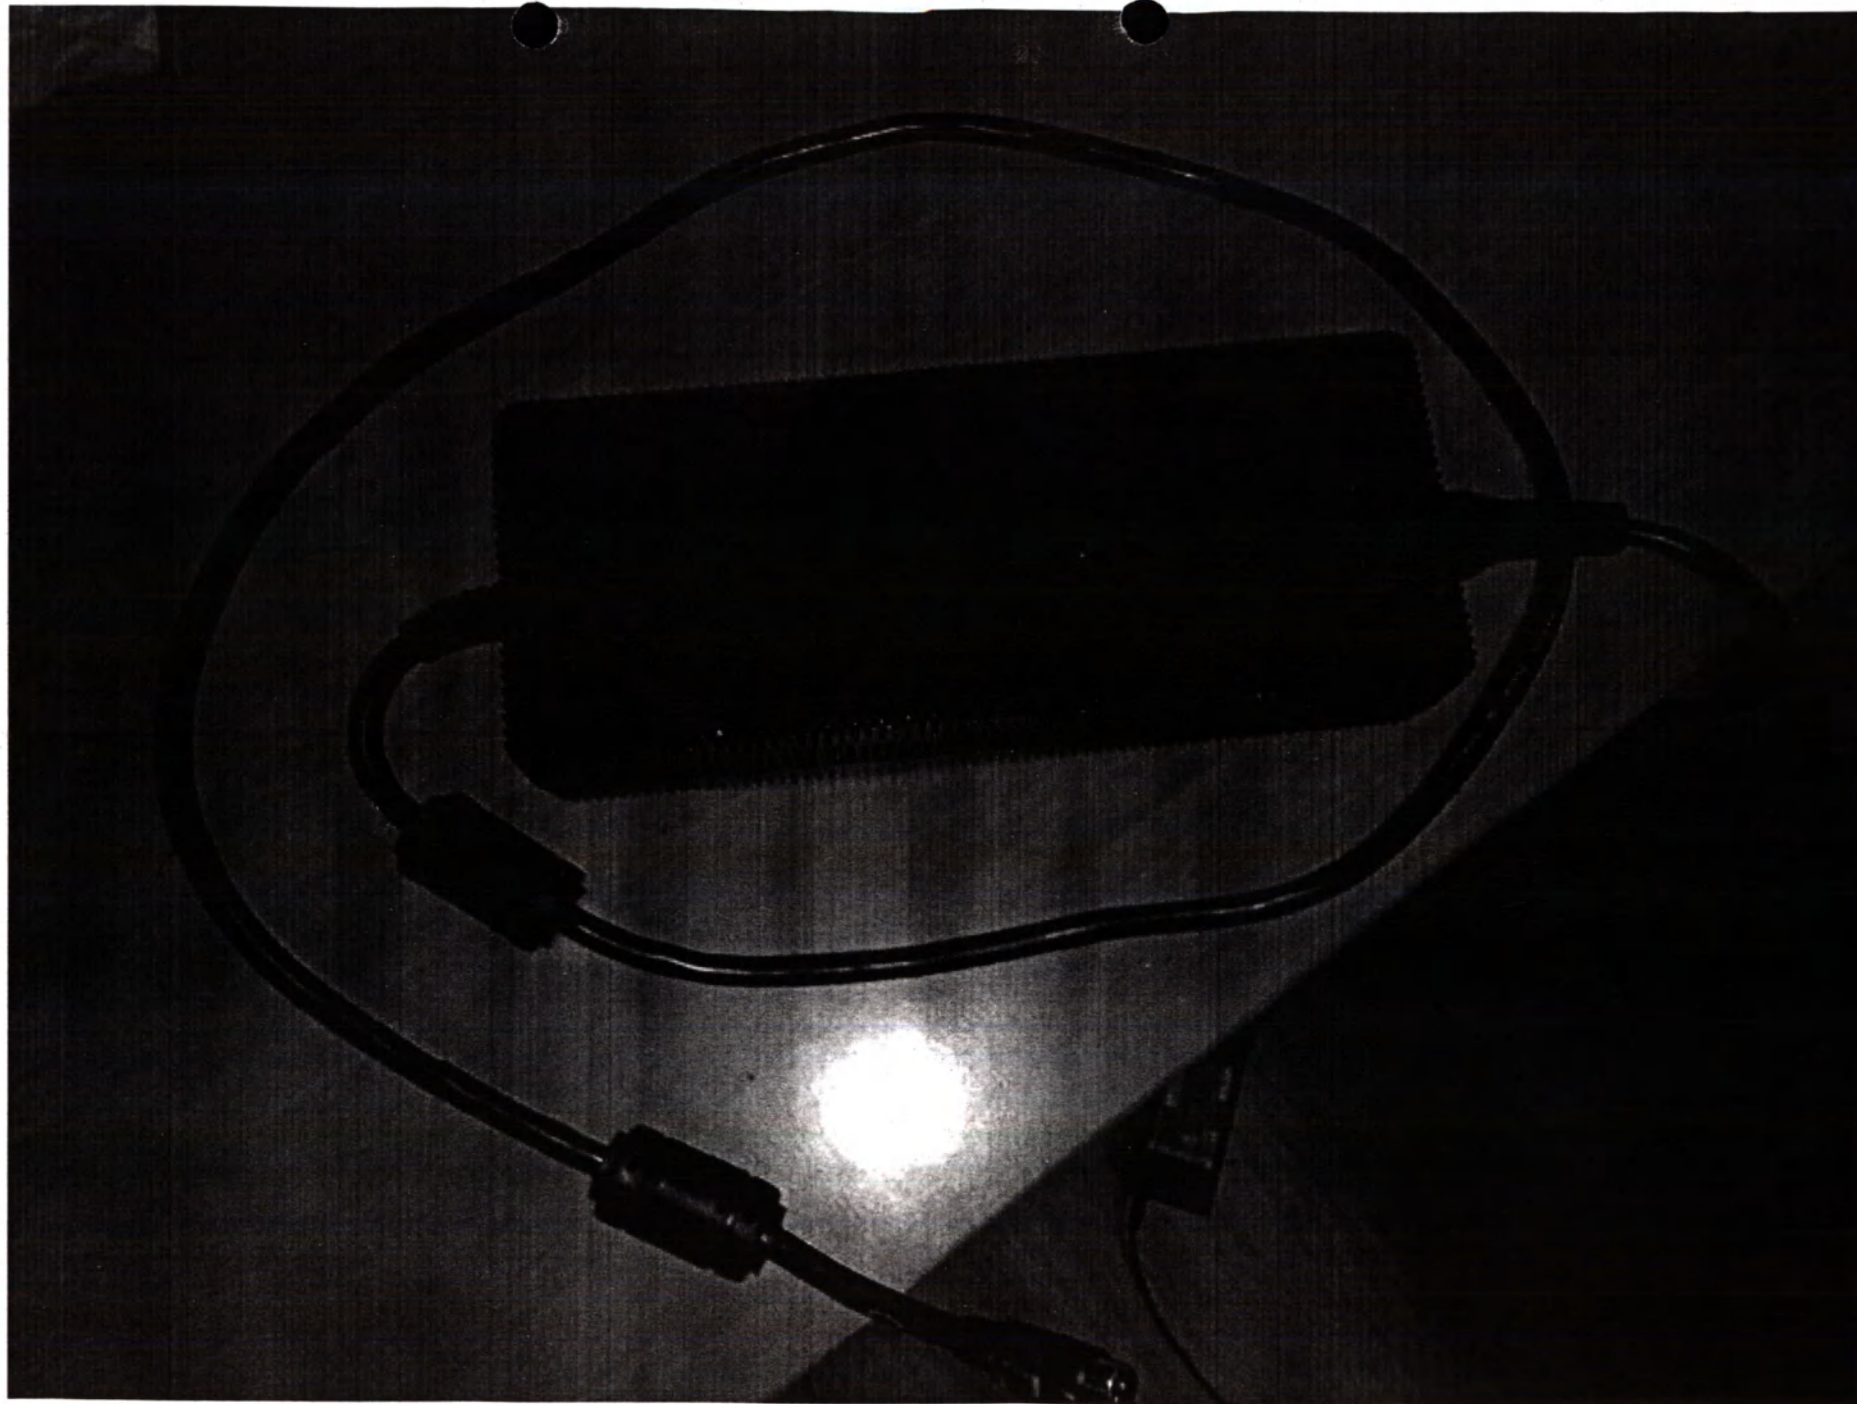

78. Адаптер питания – не более 2 шт.



Прошито, пронумеровано
На 90 (разноста)
листах
Верно: Генеральный
директор ООО "Соколовы"
Самар
Головнин И.И.

