

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ДжиИ Хэлскеа»

О.А. Лукша

«04» декабря 2020 г.

М.П.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

Аппарат искусственной вентиляции легких CARESCAPE R860 с принадлежностями
(производство Datex-Ohmeda, Inc., "Датекс-Охмеда, Инк.", США)

Фото 1. Аппарат искусственной вентиляции легких CARESCAPE R860 / Основной блок аппарата.



Фото 2. Кабель для подсоединения к сети


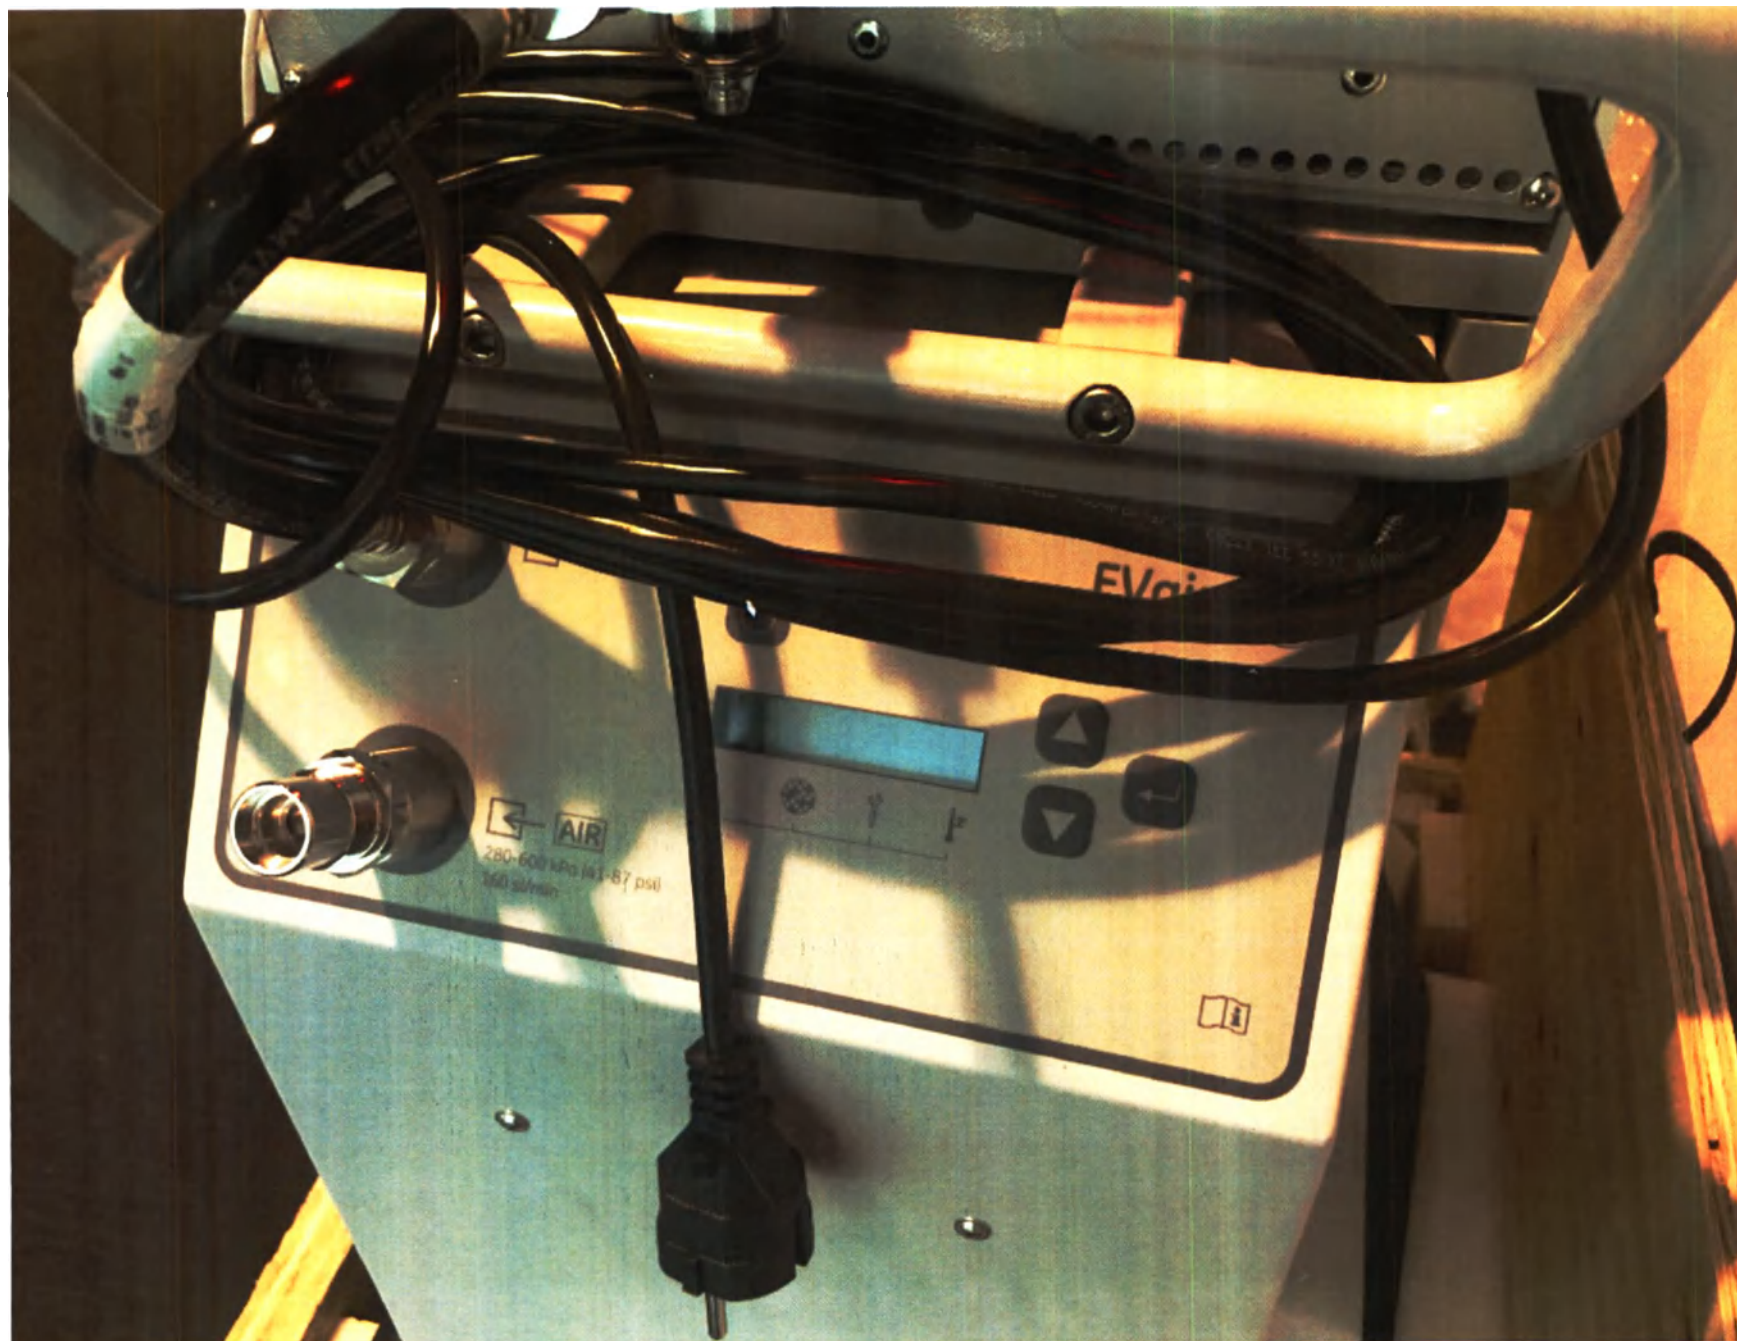


Фото 3. Руководство по эксплуатации

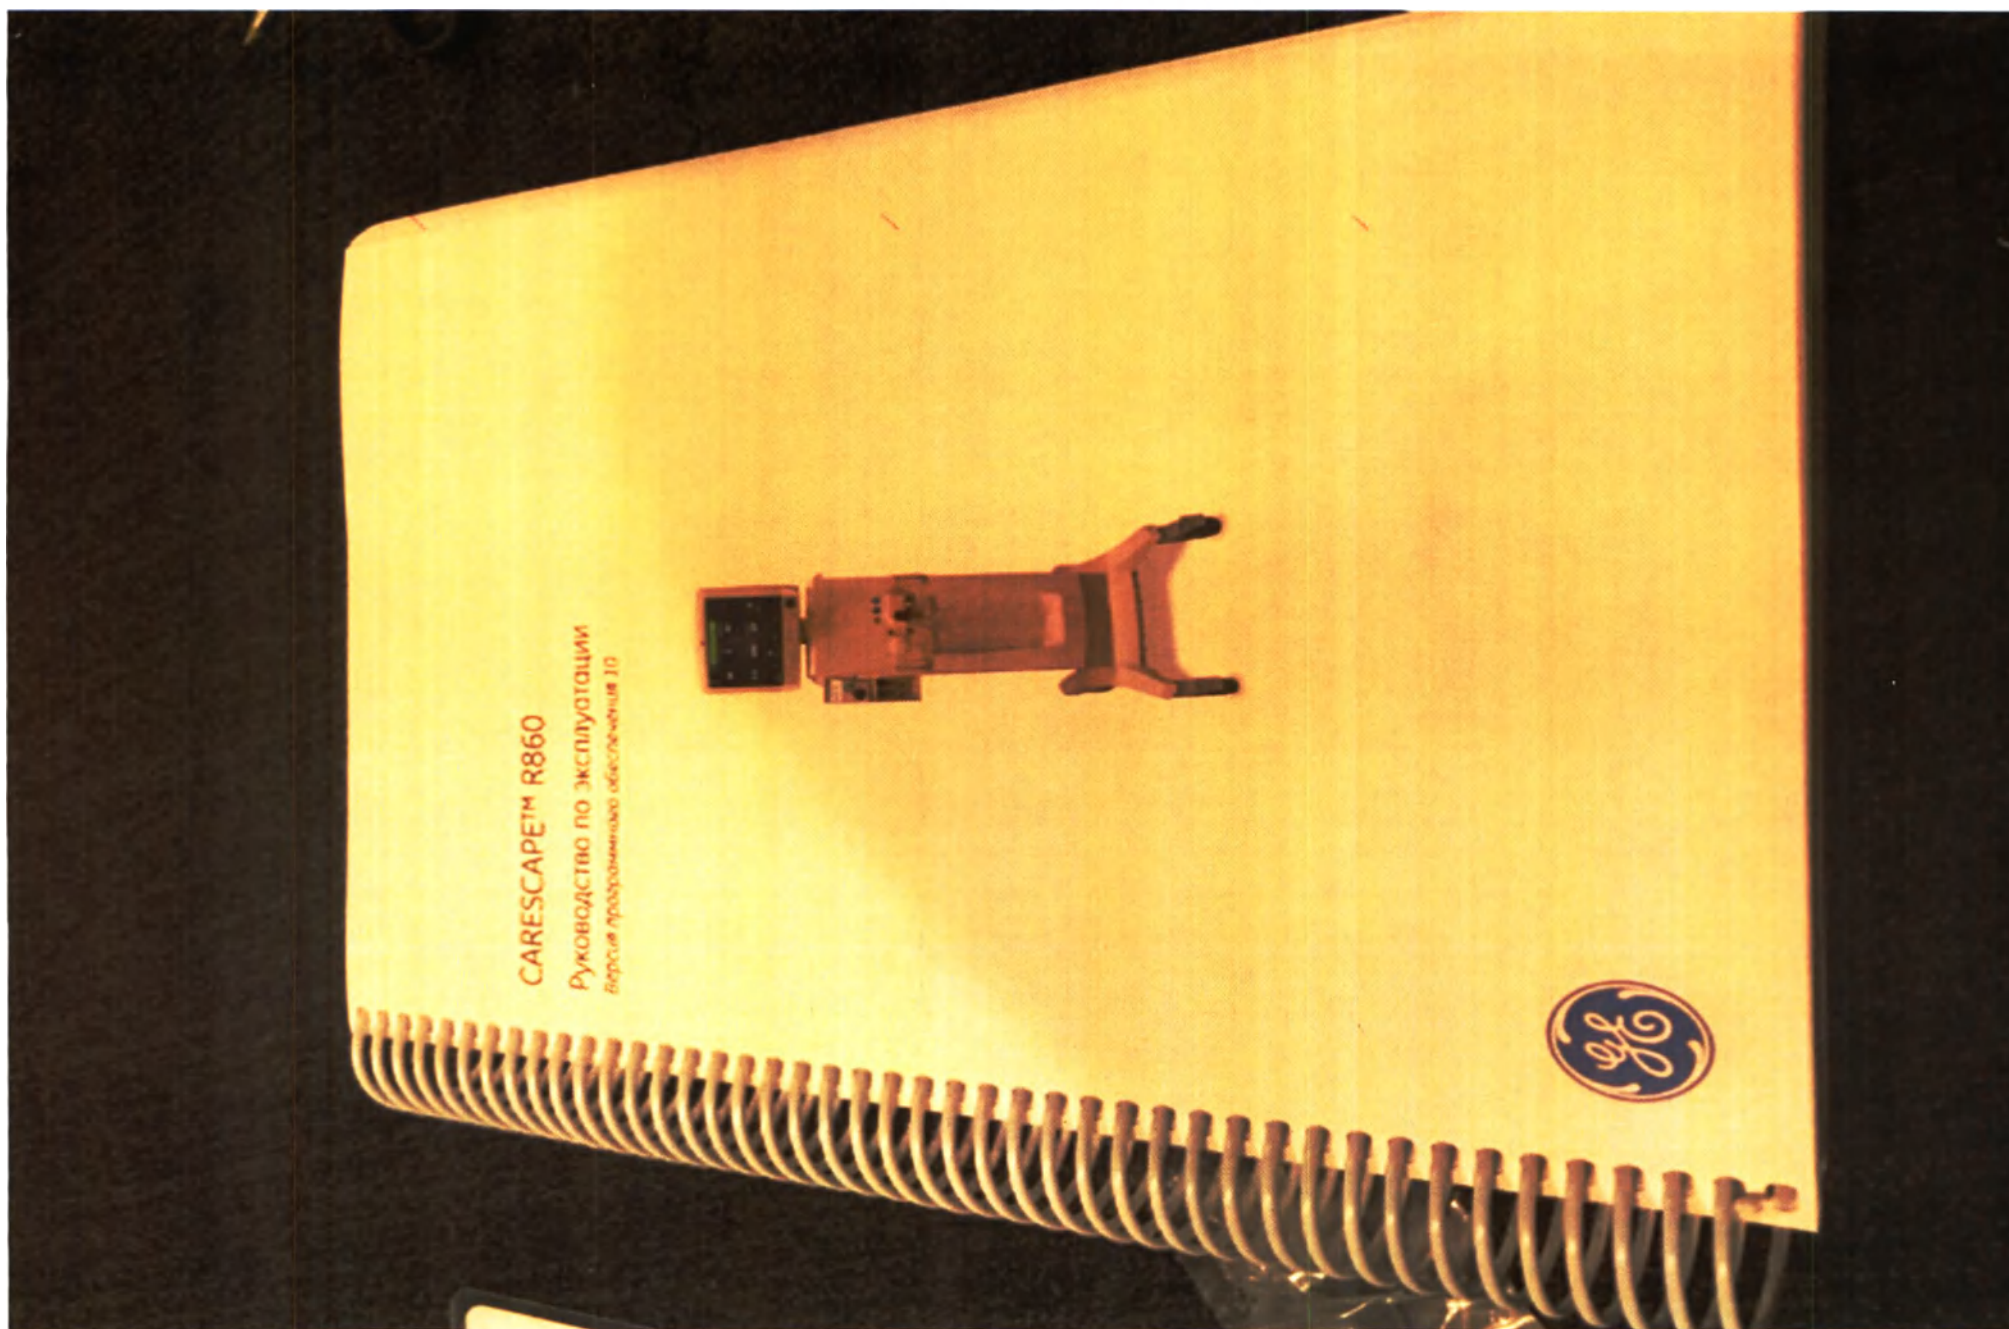

CARESCAPE R860

Предоперационное тестирование

Подробные инструкции по использованию системы приведены в руководстве по эксплуатации

Краткое руководство

- ☐ Удостоверьтесь в том, что все необходимое оборудование для экстренных ситуаций имеется в наличии и находится в исправном состоянии
- ☐ Убедитесь в том, что оборудование не повреждено и что все компоненты подсоединены правильно
- ☐ Проверьте узлы подключения магистрали подачи воздуха и кислорода
- ☐ Убедитесь, что контур дыхания правильно собран и не поврежден
- ☐ Переведите выключатель системы в положение ON («Вкл»)
- ☐ Выберите тип пациента (взрослый, ребенок или новорожденный)
- ☐ Выполните или пропустите проверку системы
- ☐ Выберите режим вентиляции и настройки
- ☐ Начните вентиляцию
- ☐ Убедитесь визуально в начале процесса вентиляции
- ☐ Проверьте пределы сигналов тревоги



Фото 4. Краткое руководство: предоперационное тестирование

Фото 5. Программное обеспечение Adult/Red



Фото 6. Программное обеспечение Adult/Ped



Фото 7. Программное обеспечение Adult/Ped/Neo



Фото 8. Программное обеспечение Neo



Фото 9. Программное обеспечение на русском языке.

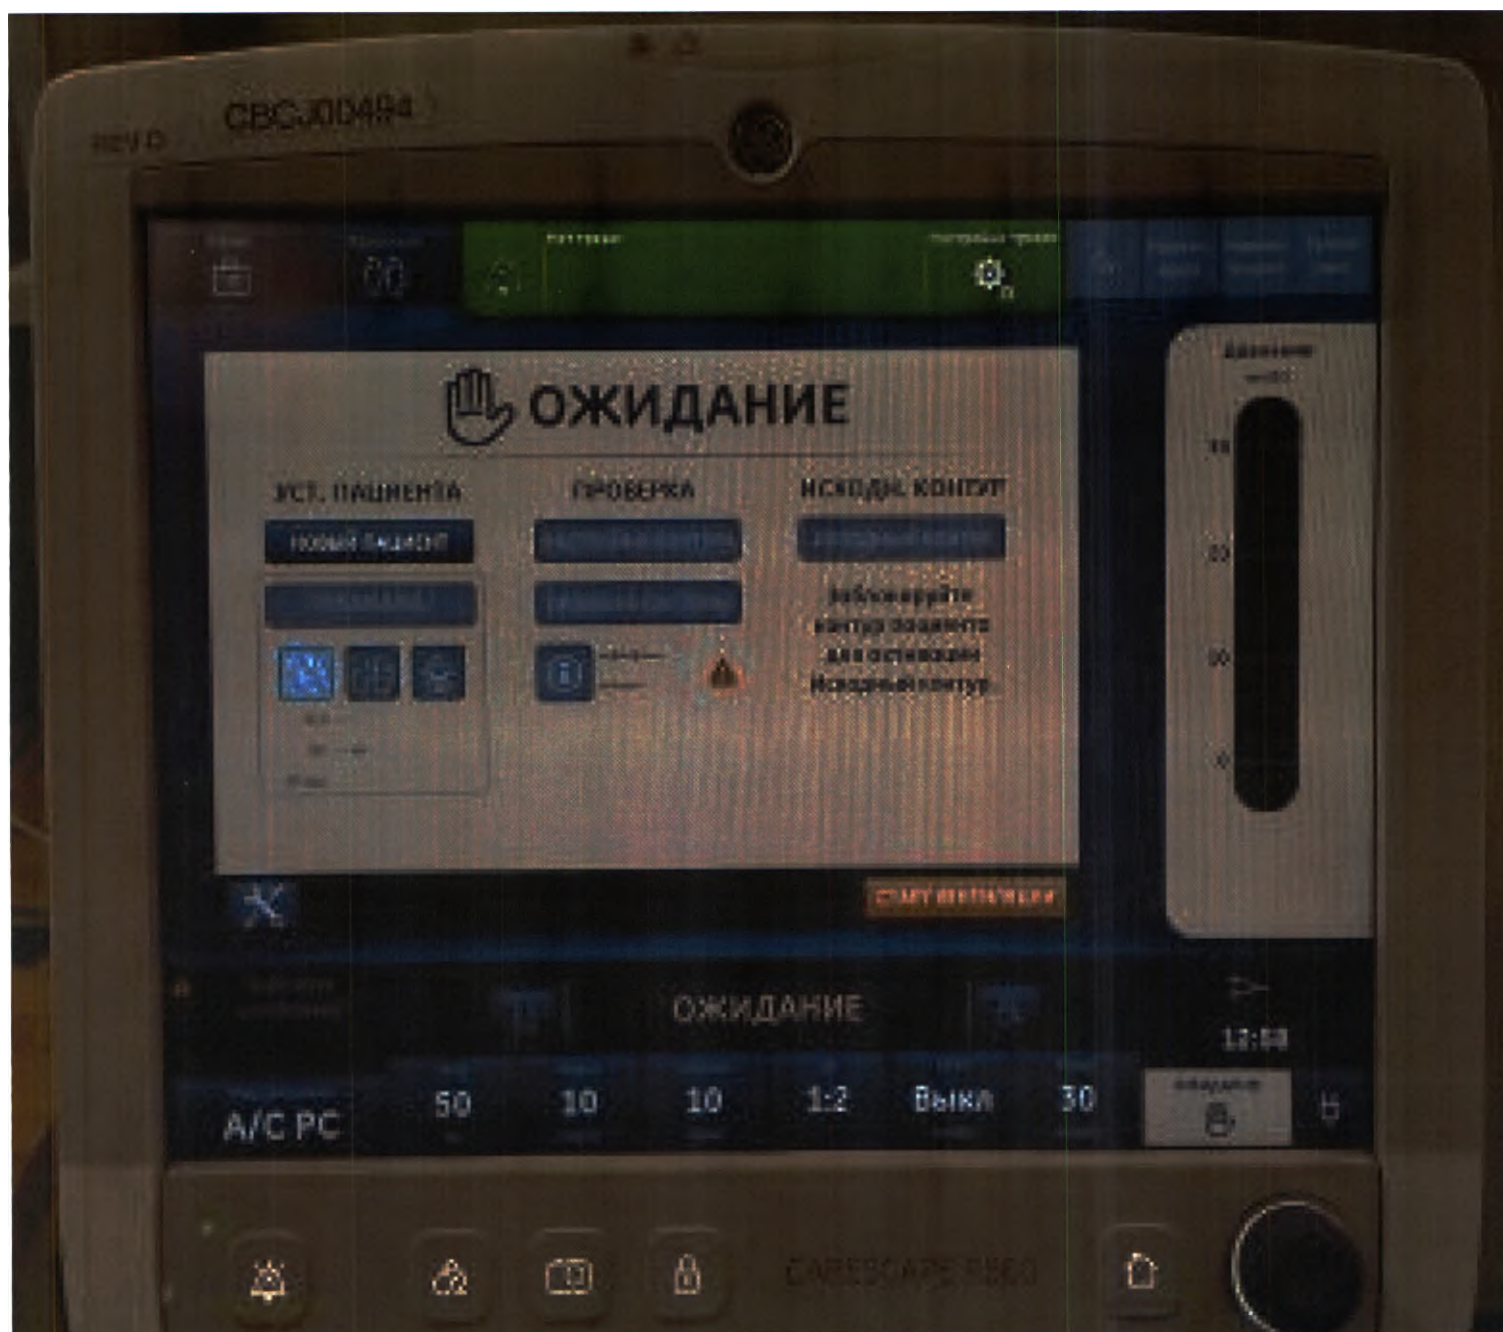


Фото 10. Программное обеспечение APRV.



Фото 11. Программное обеспечение Bilevel-Vent.



Фото 12. Программное обеспечение BiLevel-VG.



Фото 13. Программное обеспечение SIMV-PRVC.



Фото 14. Программное обеспечение VS.



Фото 15. Программное обеспечение NIV.



Фото 16. Программное обеспечение NCPAP.



Фото 17. Программное обеспечение FRC.



Фото 18. Программное обеспечение Spirodynamics.



Фото 19. Кронштейны для поддержки дыхательного контура

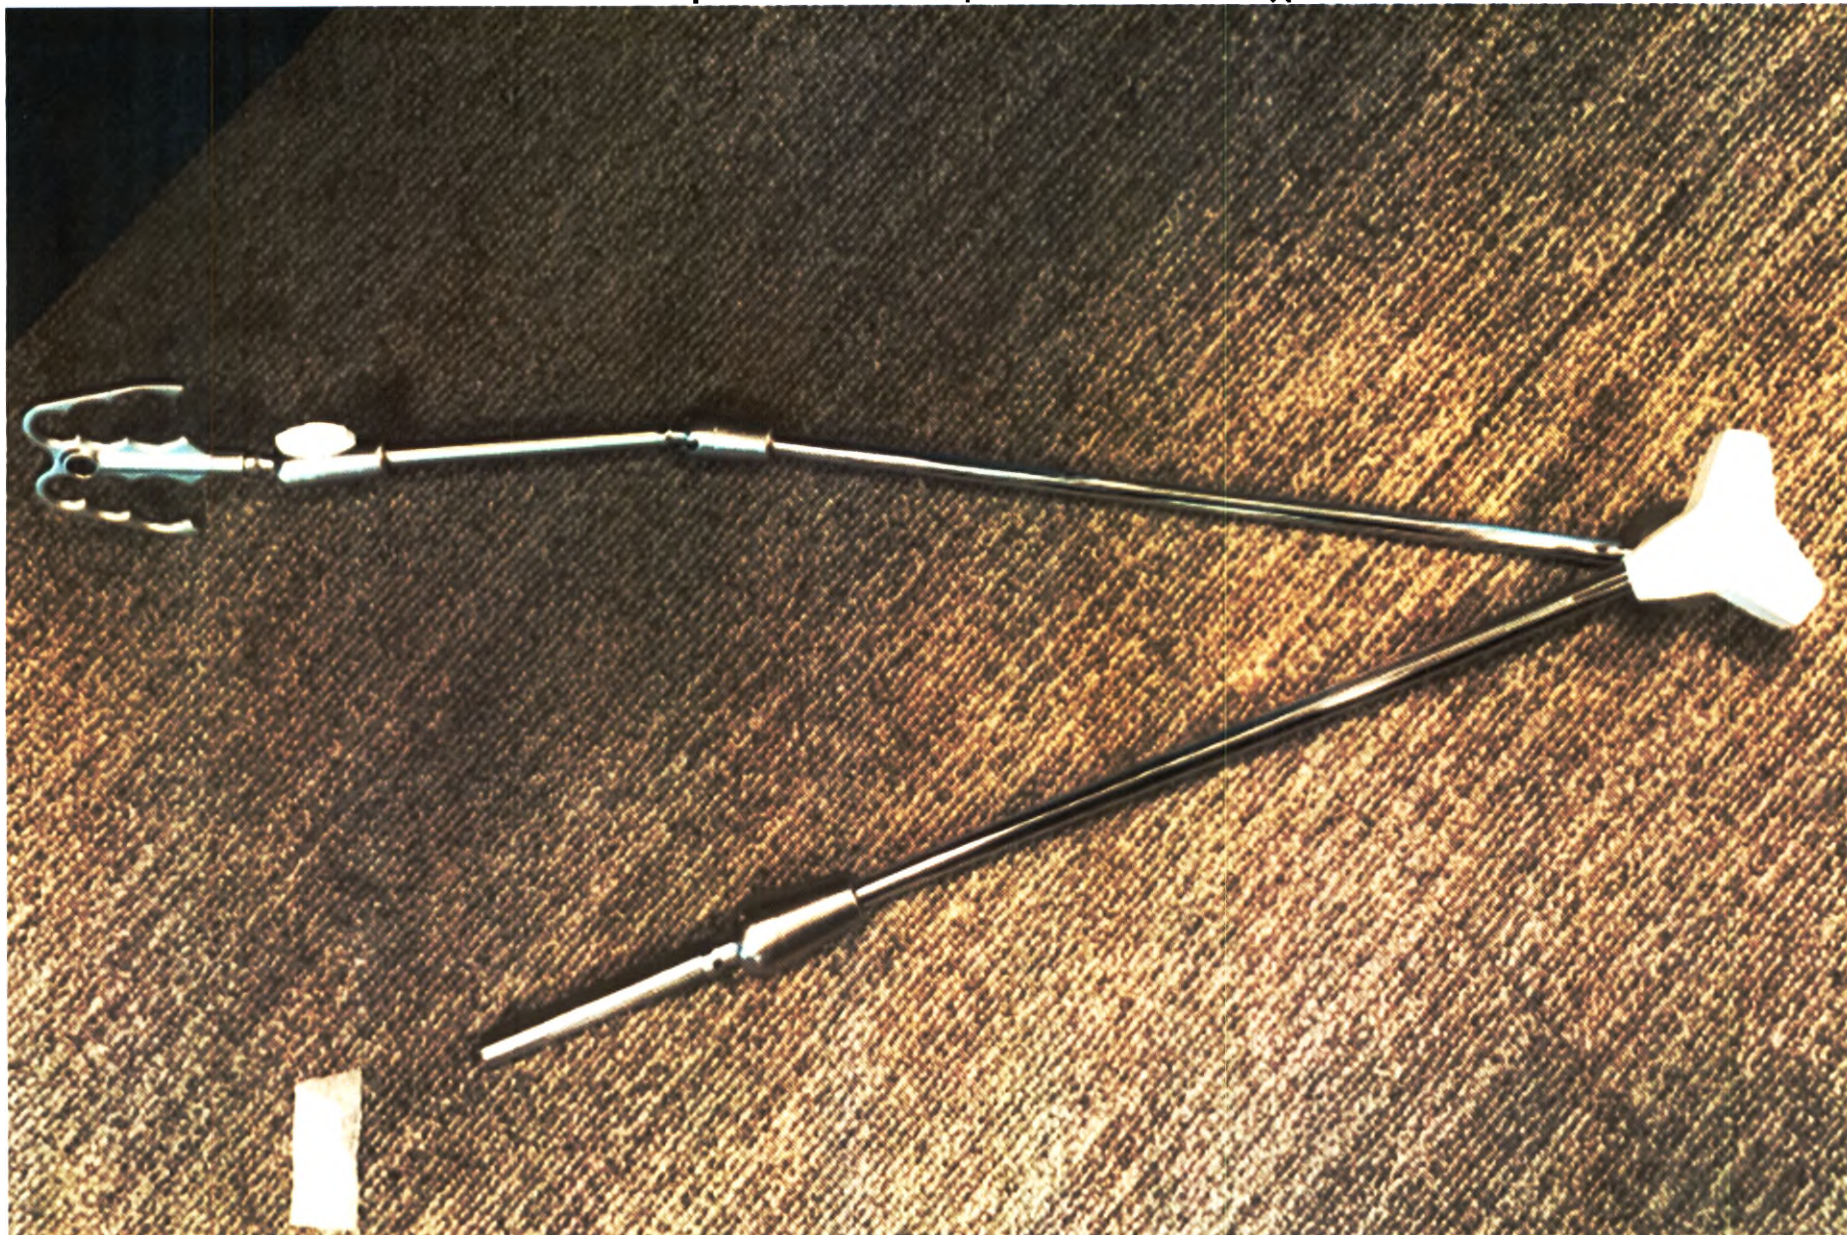


Фото 20. Одноразовый дыхательный контур для взрослых пациентов

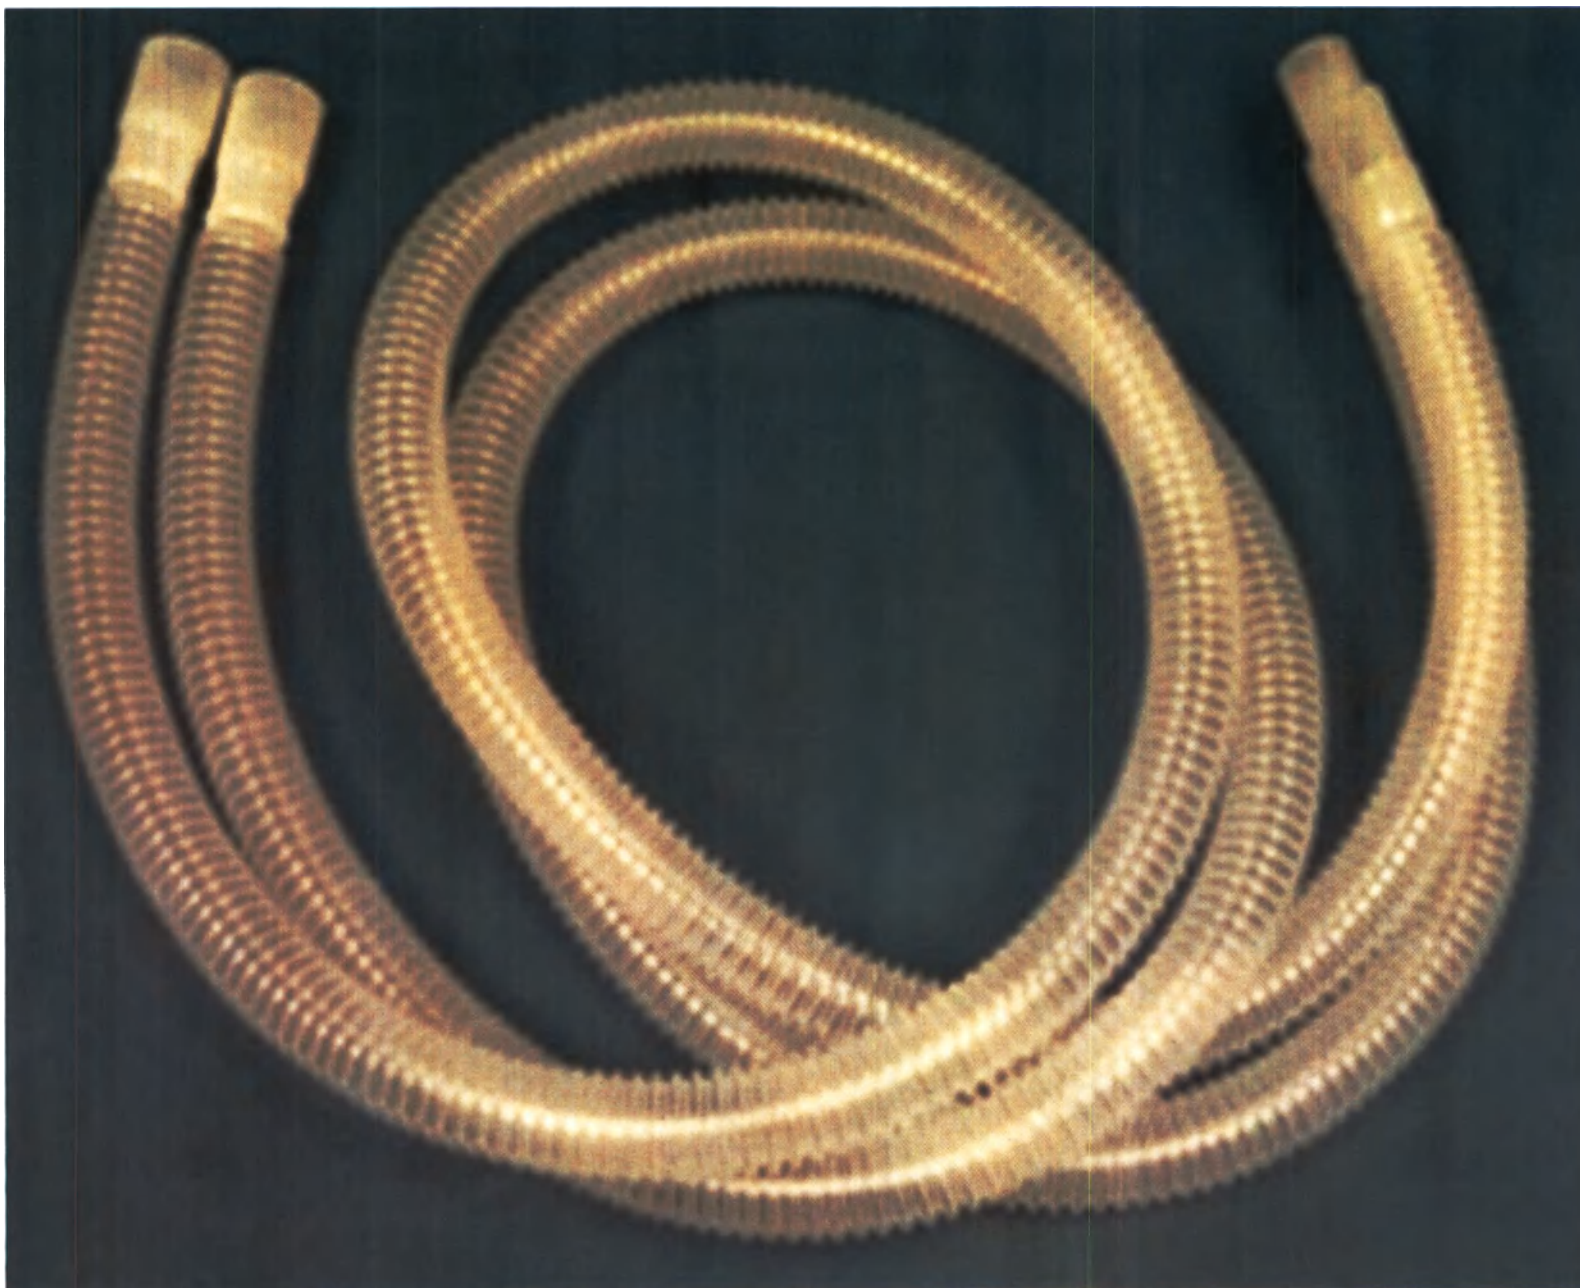


Фото 21. Одноразовый дыхательный контур для взрослых пациентов

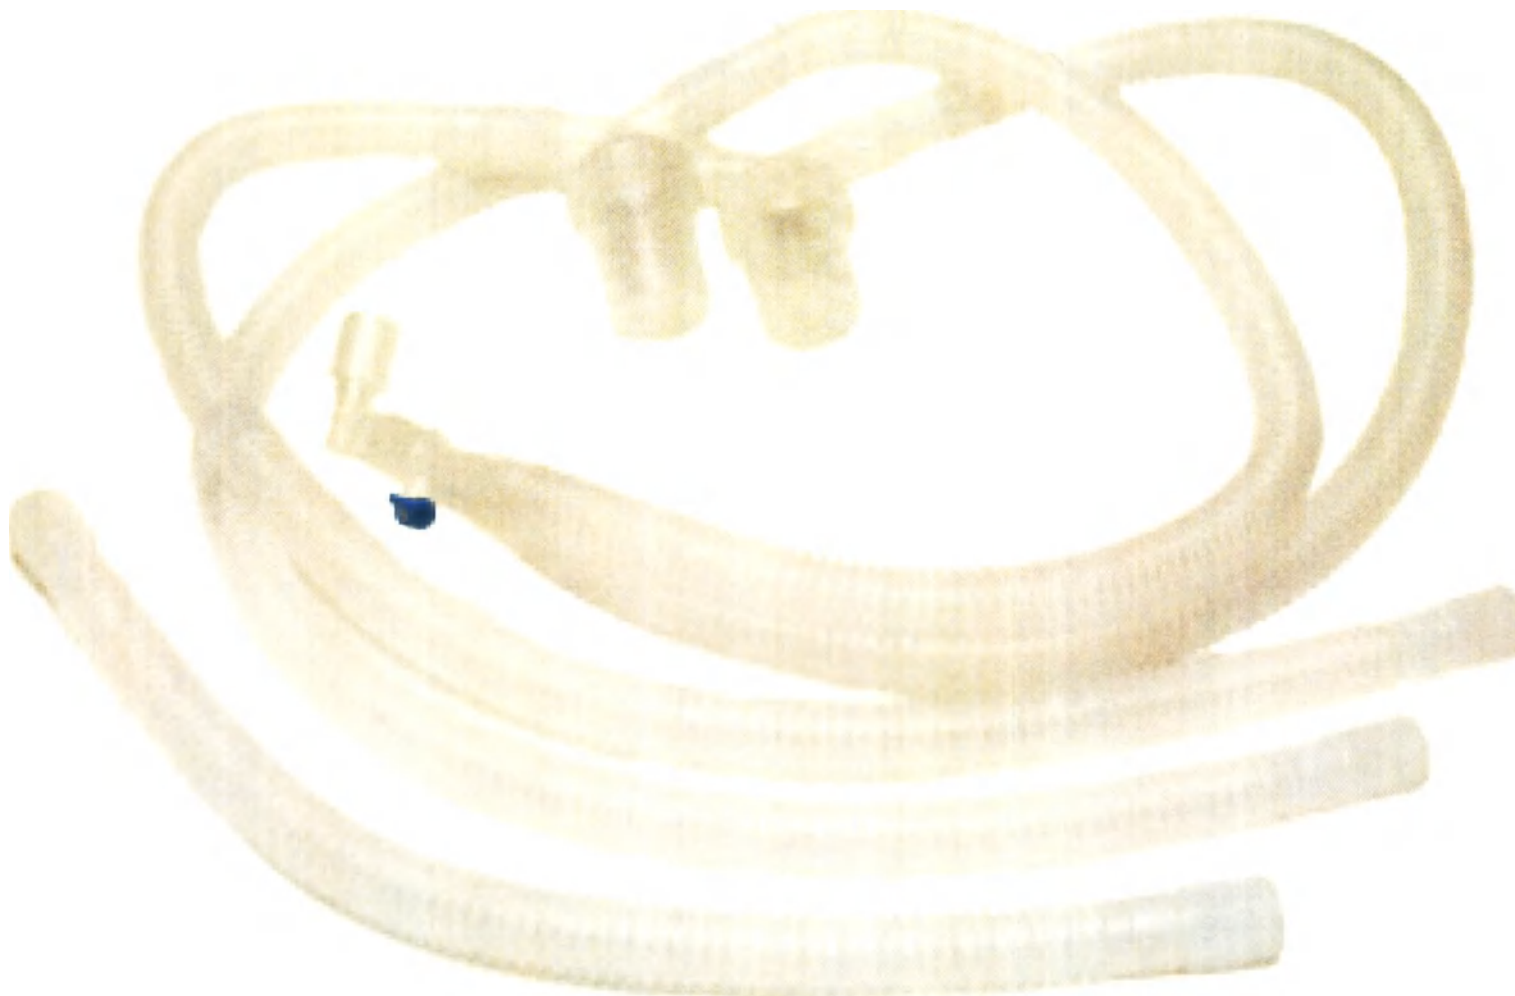


Фото 22. Одноразовый дыхательный контур для педиатрических пациентов



Фото 23. Одноразовый дыхательный контур для педиатрических пациентов

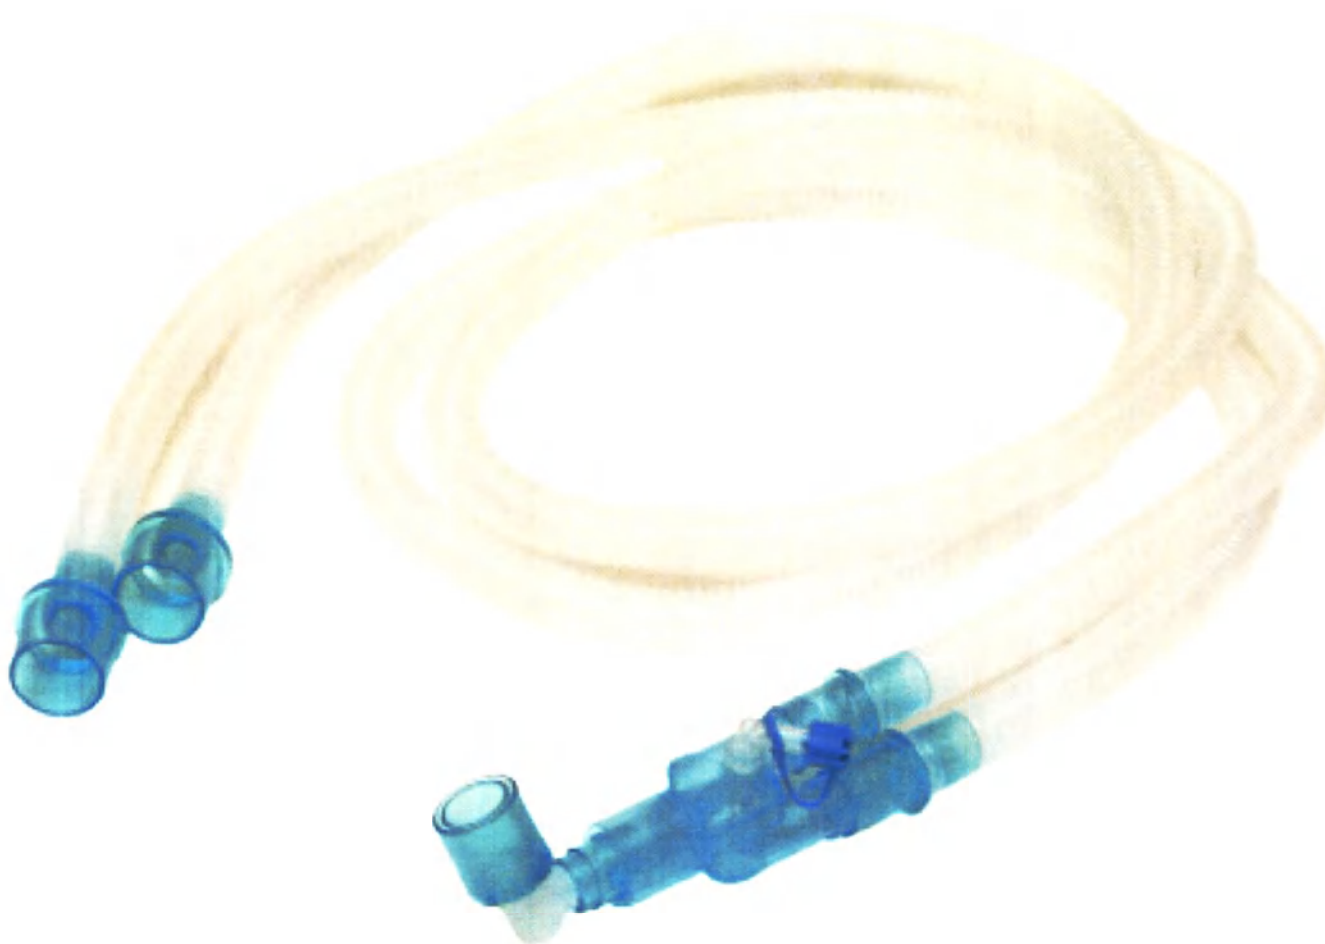


Фото 24. Контур для новорожденных пациентов

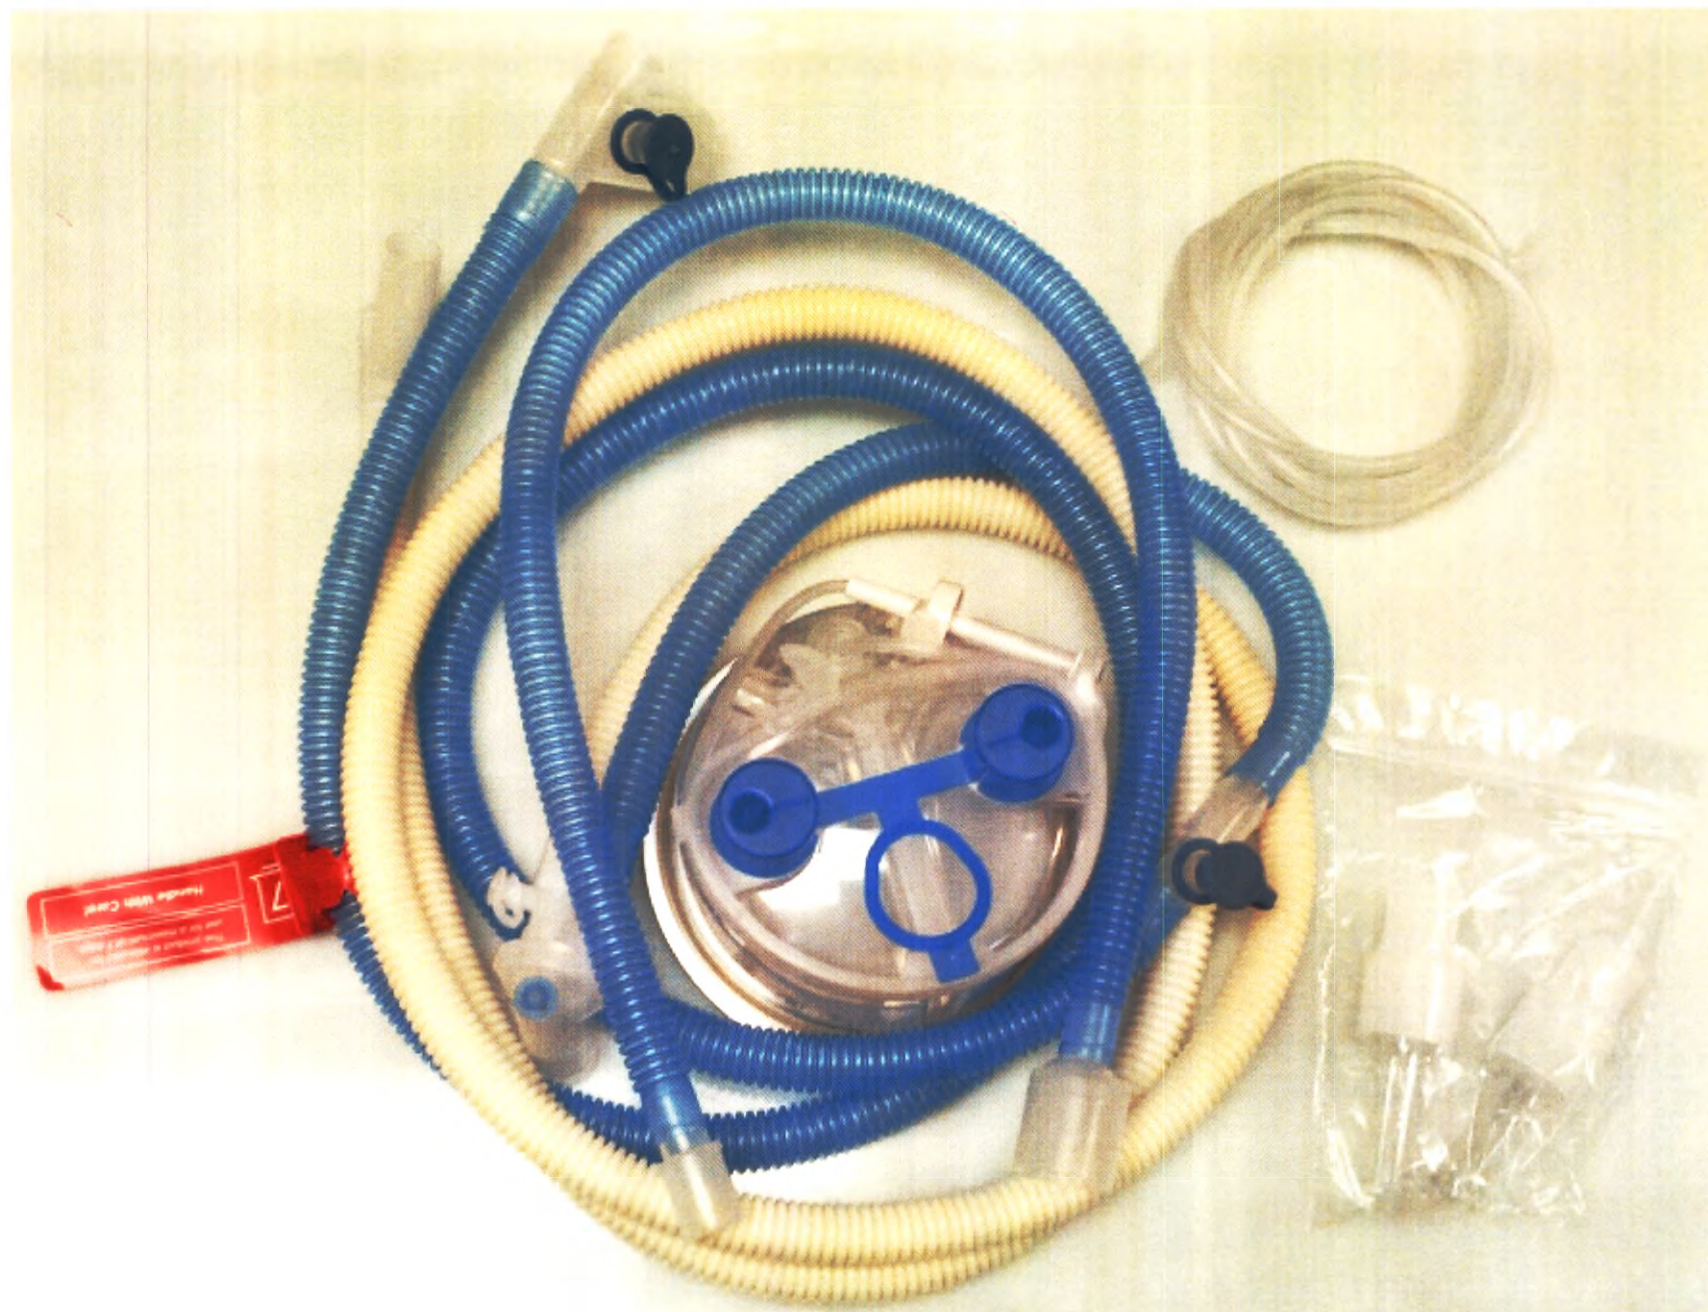


Фото 25. Дыхательный контур для взрослых, многоразовый

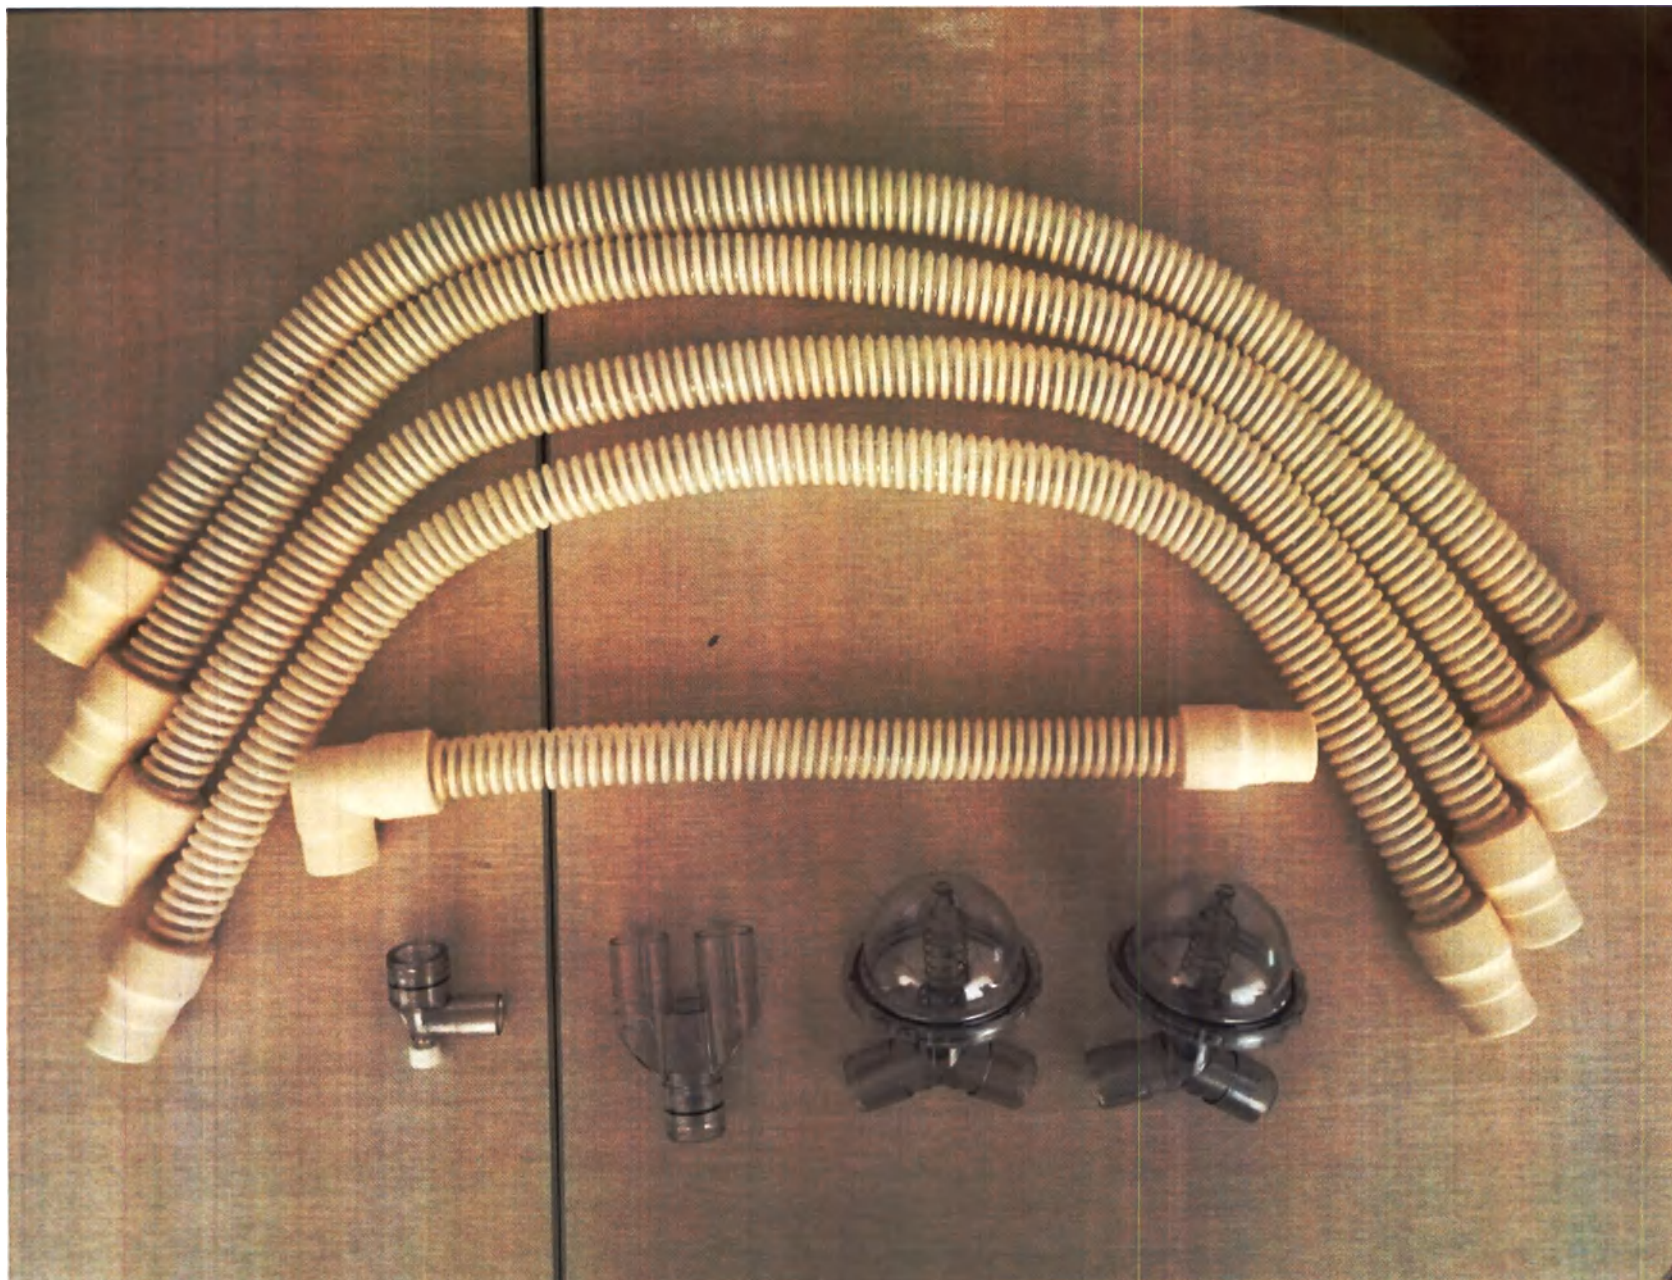


Фото 26. Дыхательный контур детский, многоразовый

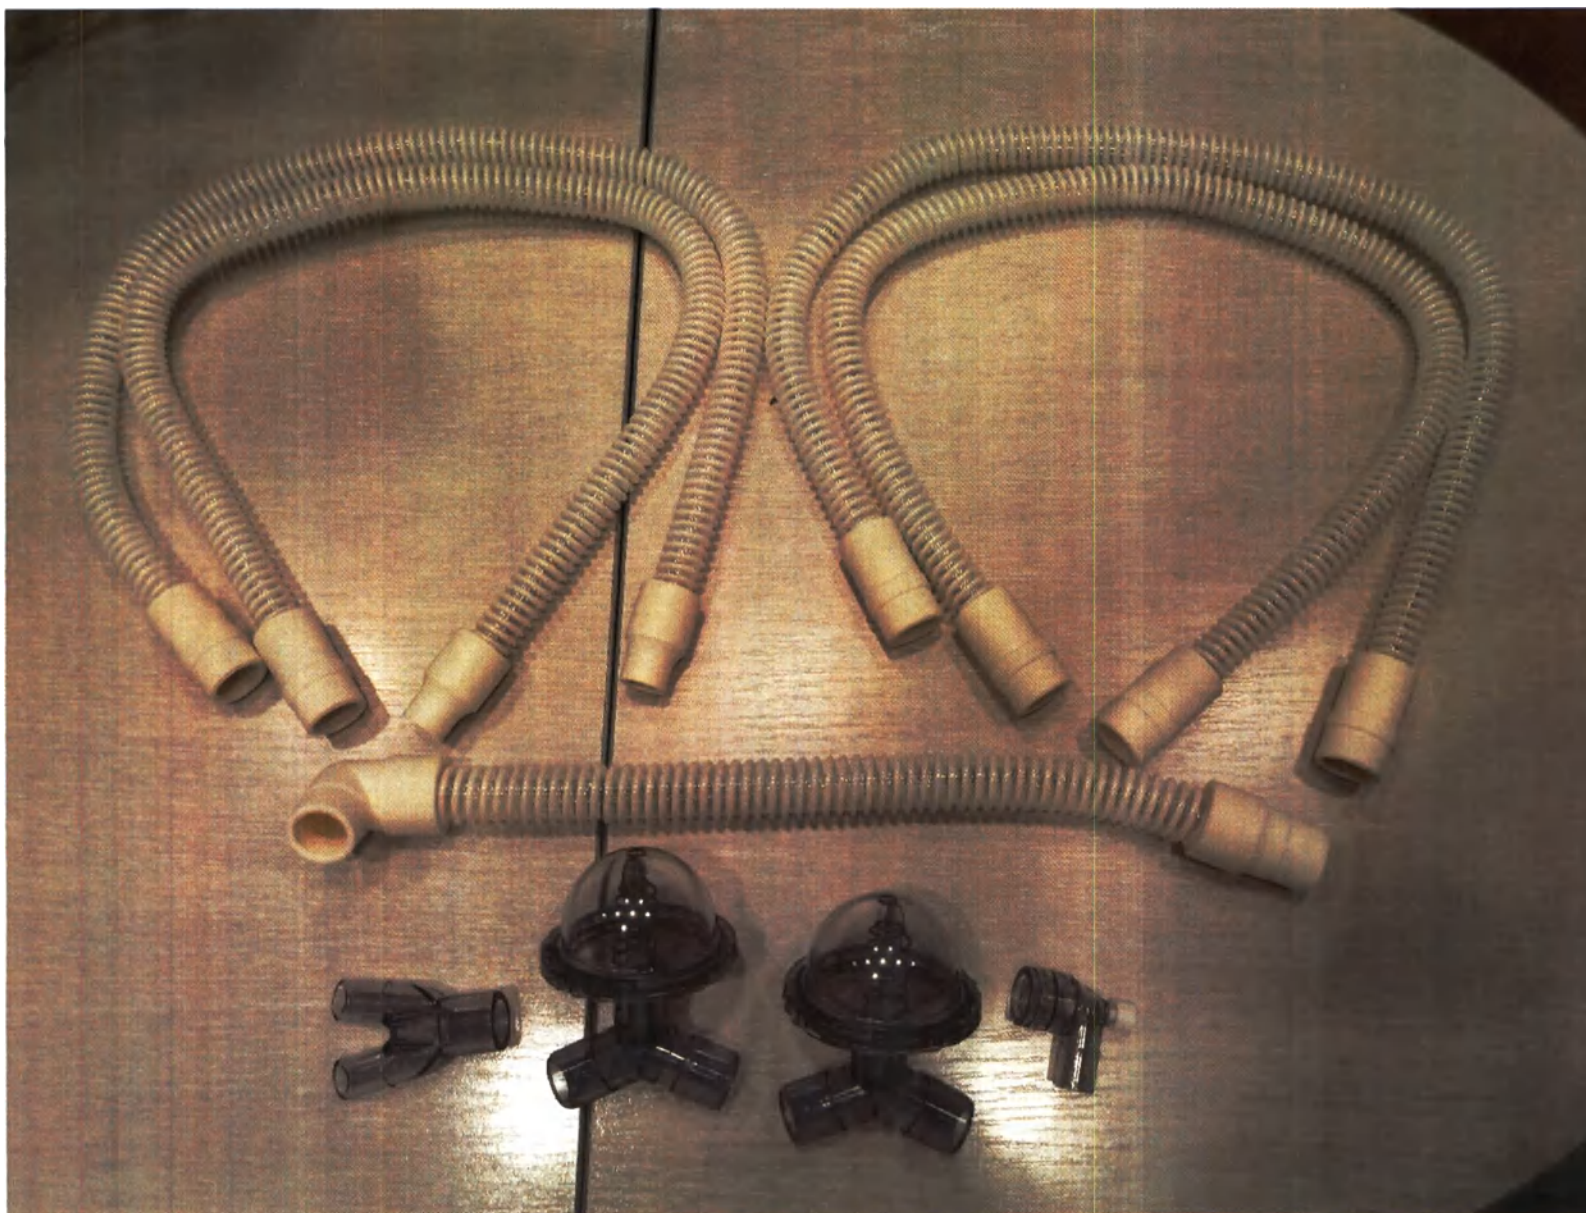


Фото 27. Комплект небулайзера

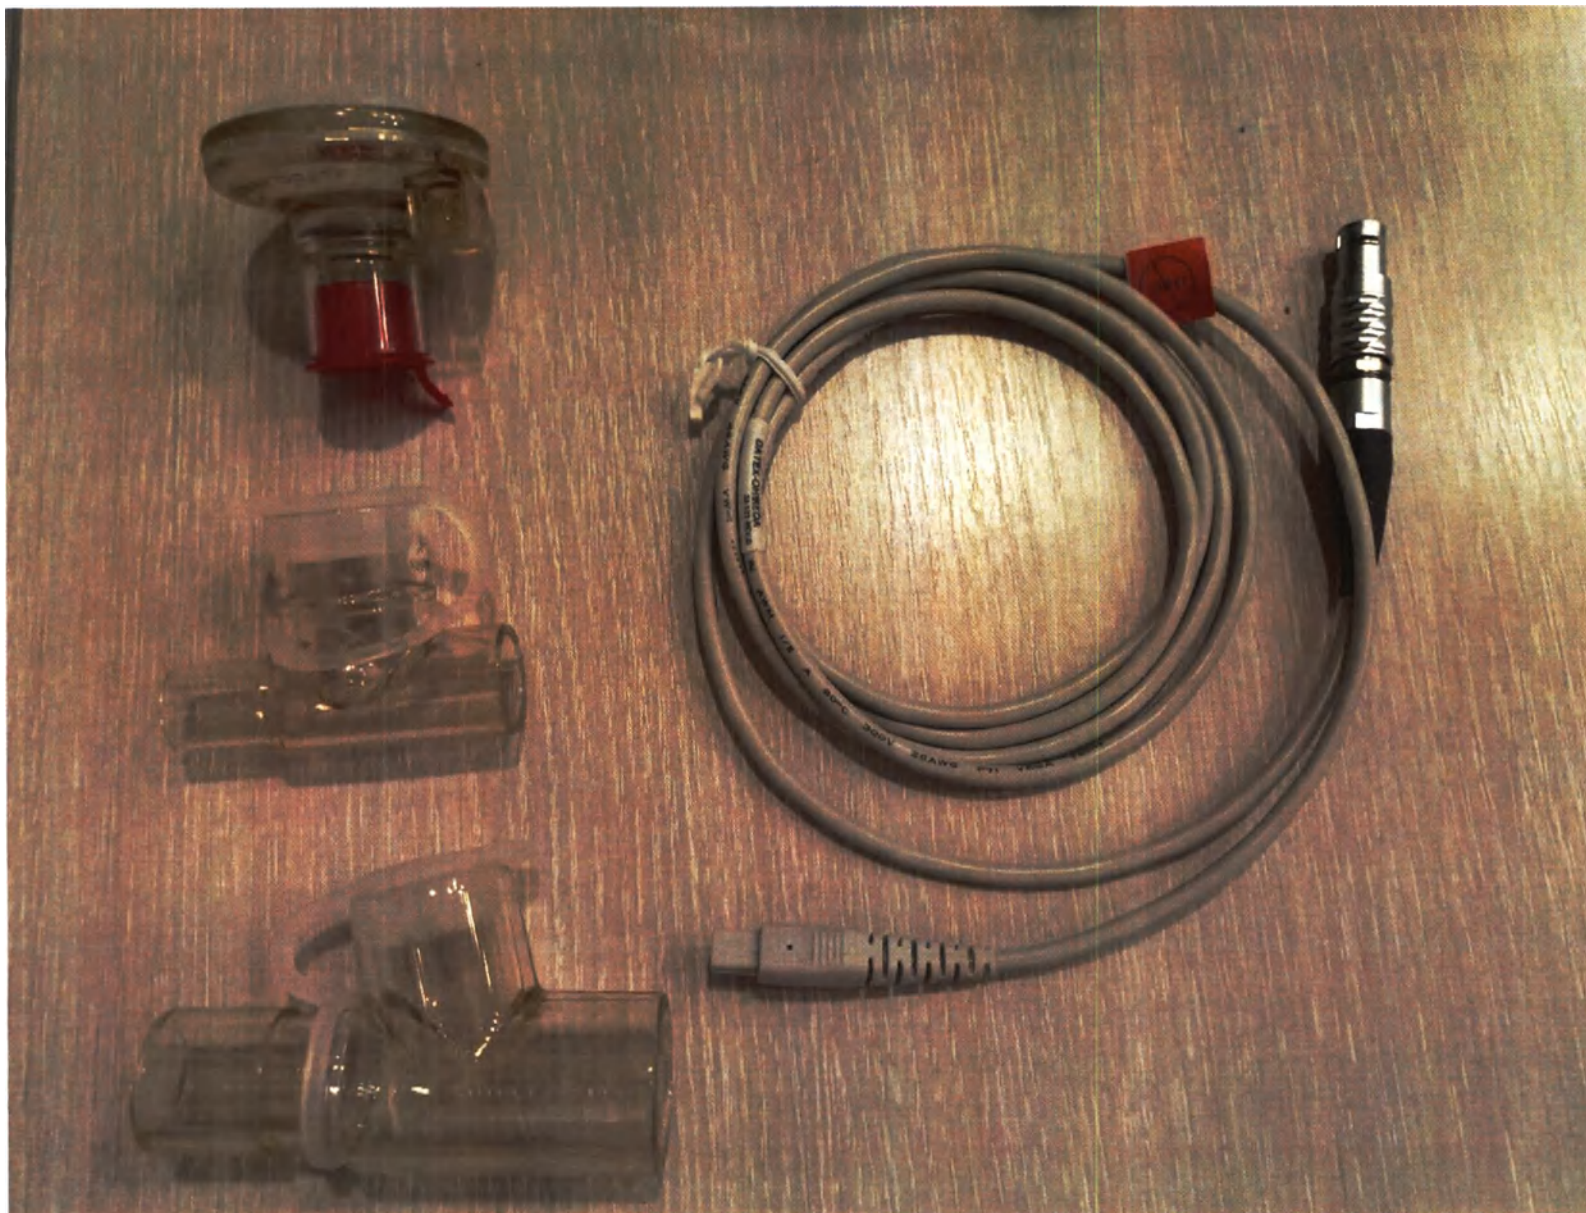


Фото 28. Заглушка камеры небулайзера

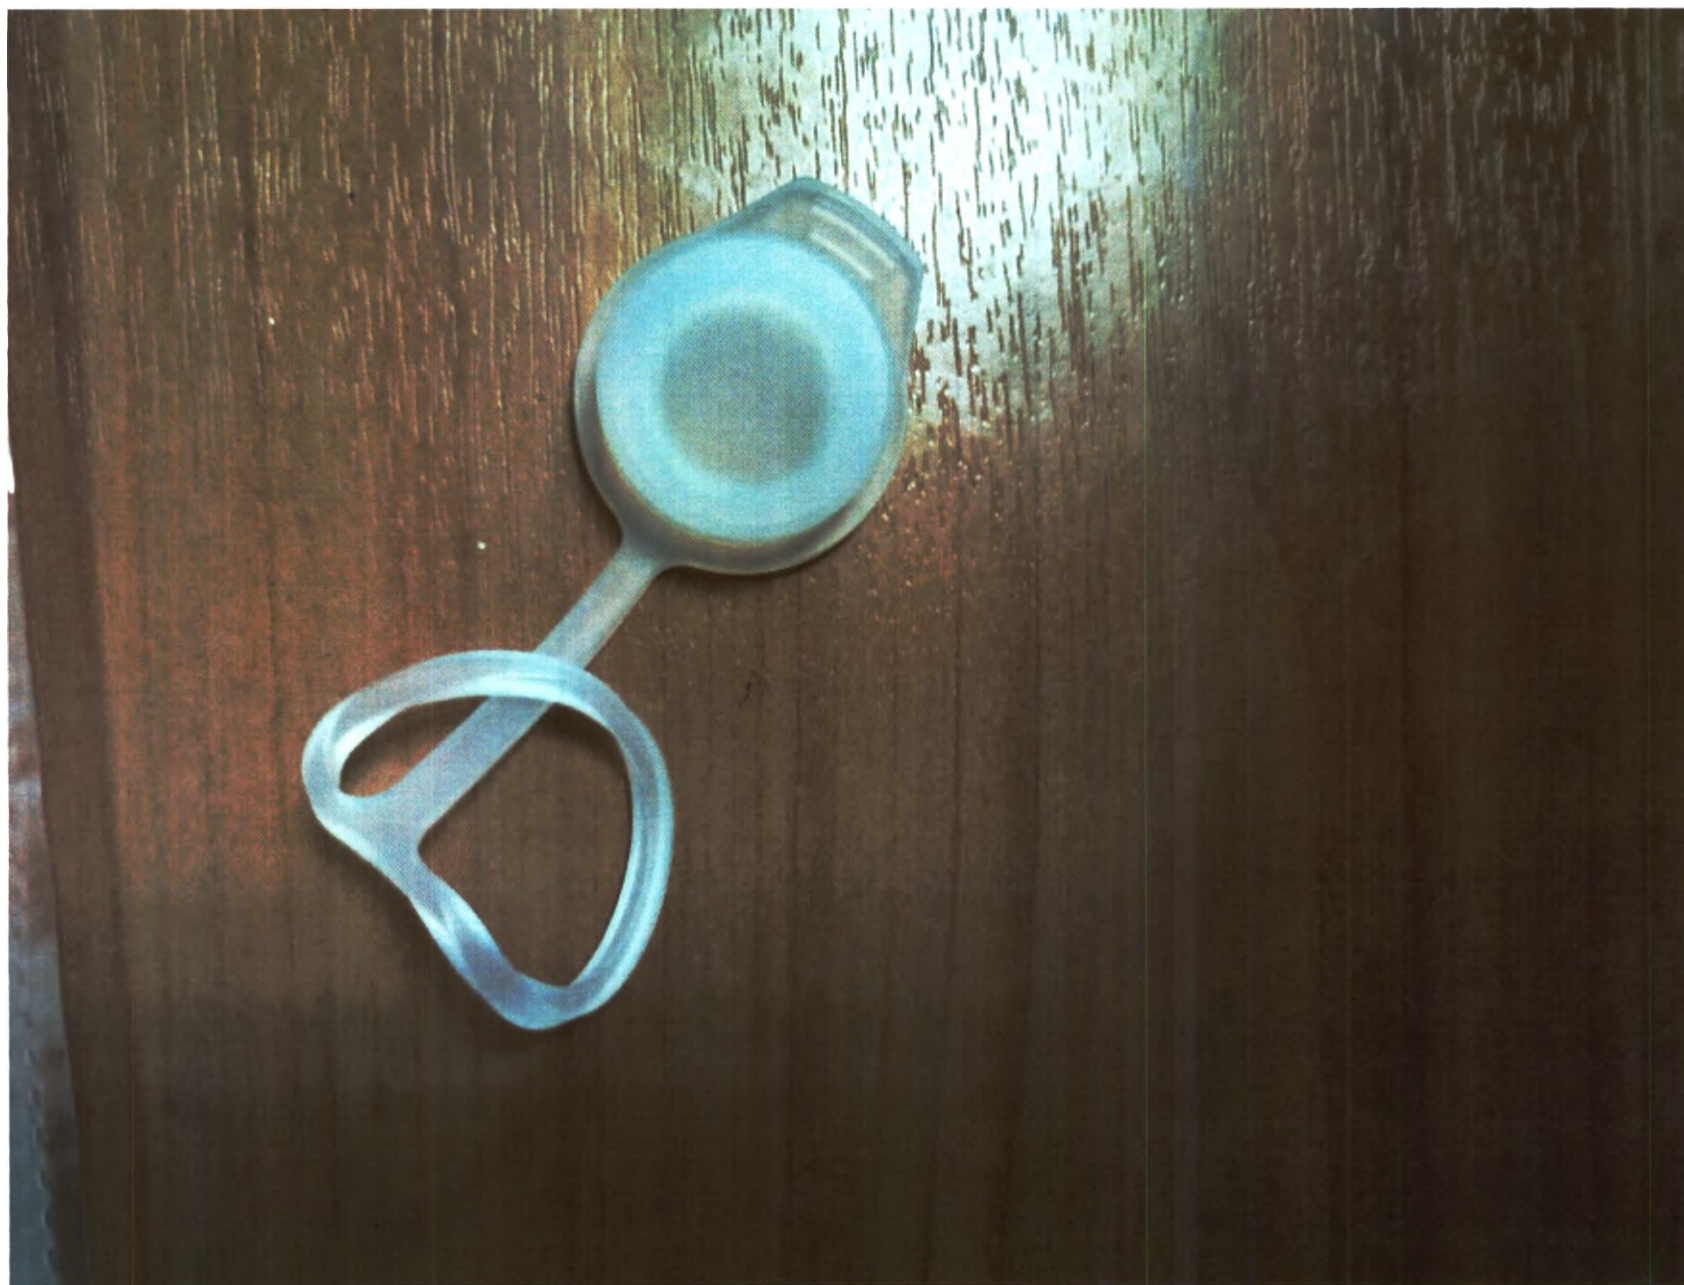


Фото 29. Одноразовые камеры небулайзера

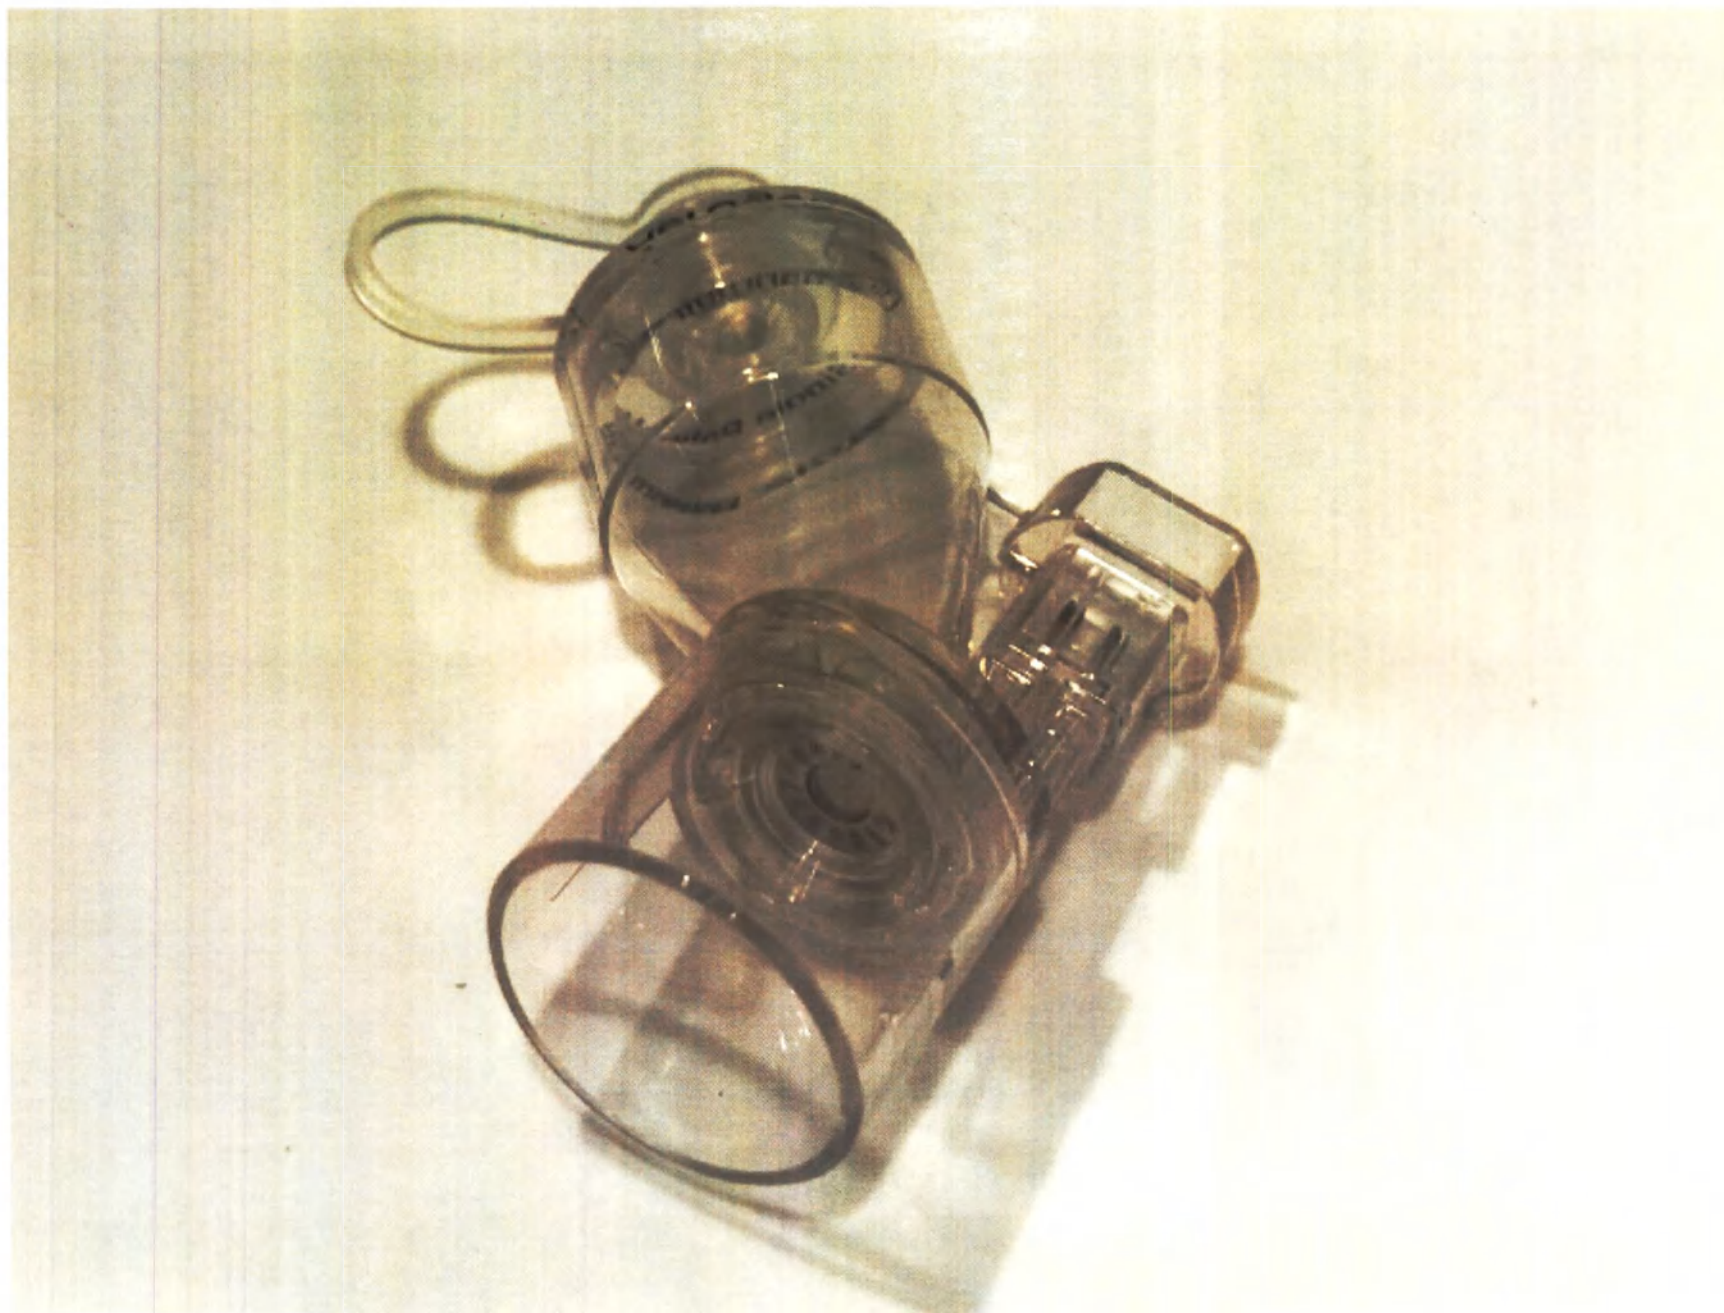


Фото 30. Т-образные переходники небулайзера взрослые, одноразовые



Фото 31. Т-образные переходники небулайзера неонатальные, однокоразовые



Фото 32. Т-образные переходники небулайзера педиатрические, одноразовые



Фото 33. Кабель для небулайзера



Фото 34. Крышка камеры небулайзера с отверстием для заполнения

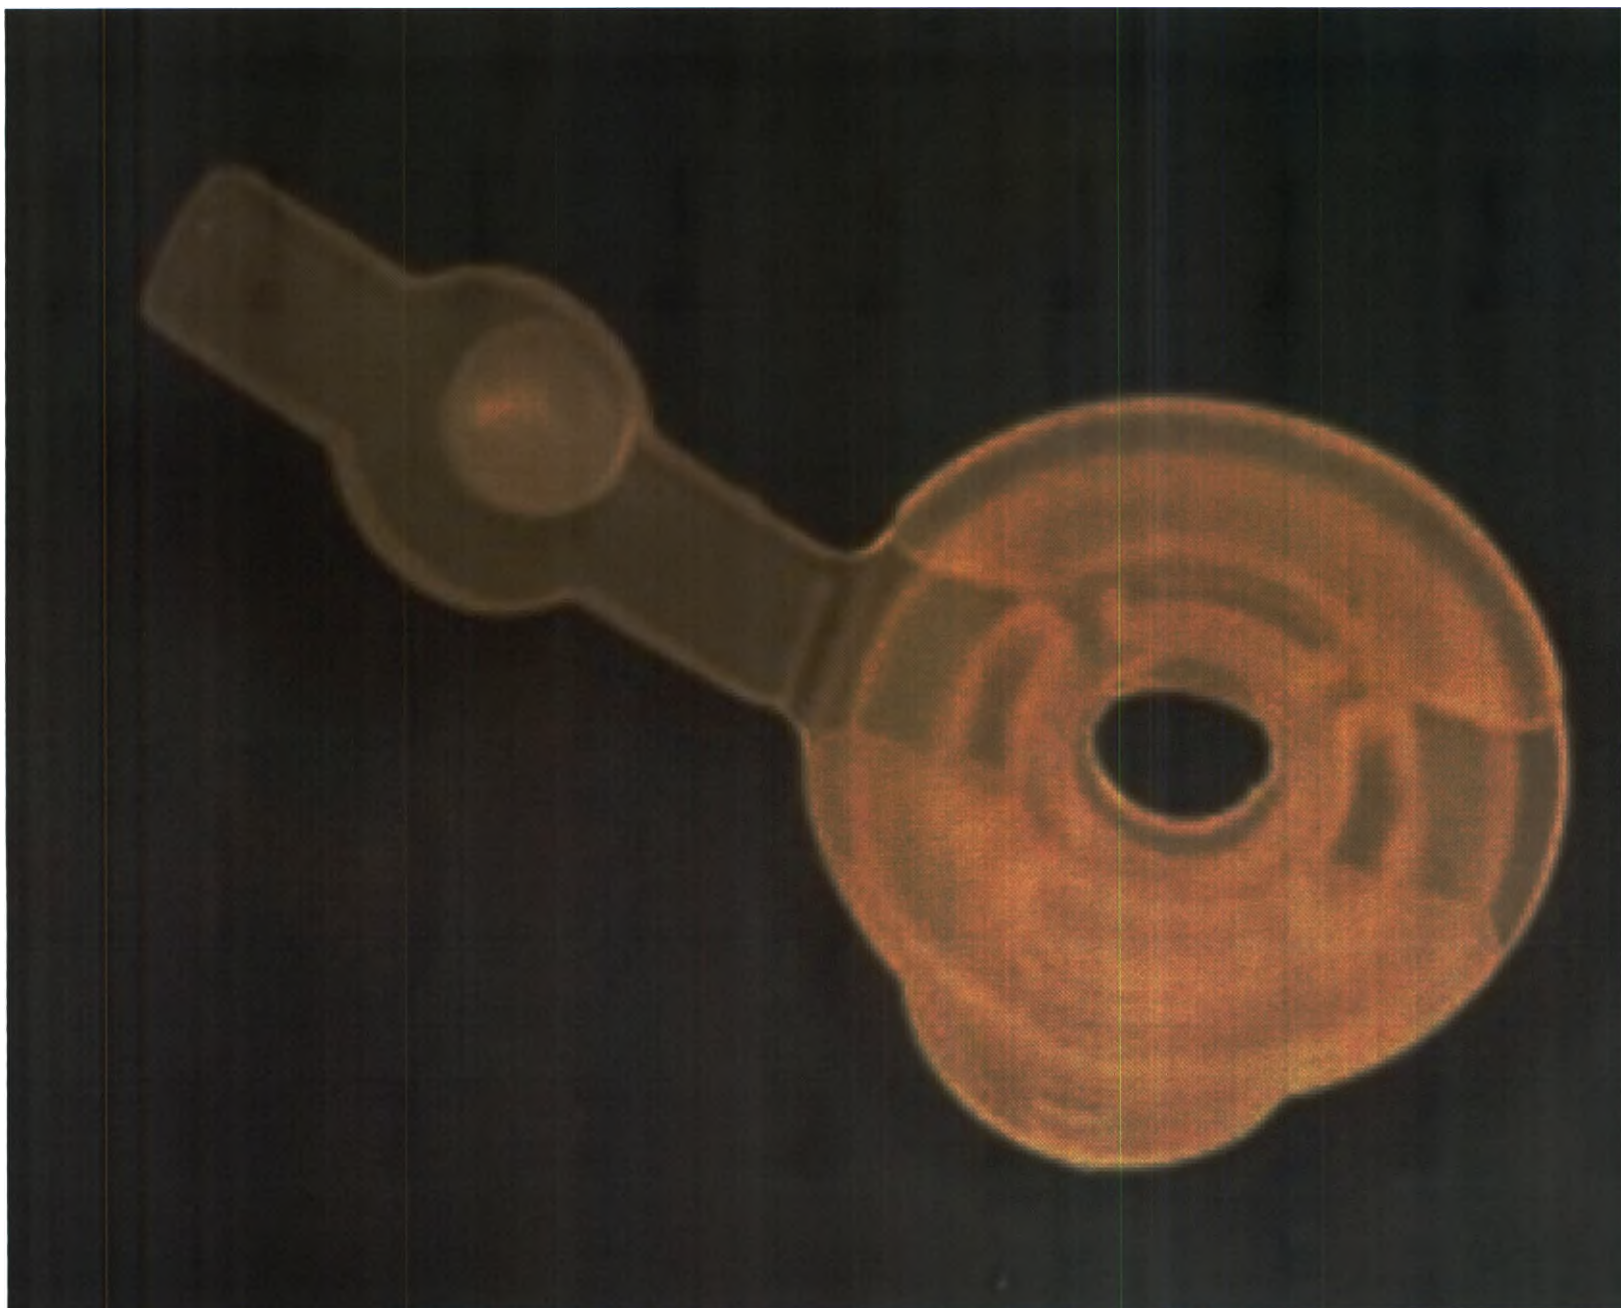


Фото 35. Небулайзер



Фото 36. Т-образный переходник небулайзера с силиконовой заглушкой многоразовый



Фото 37. Т-образный переходник небулайзера с силиконовой заглушкой многоразовый

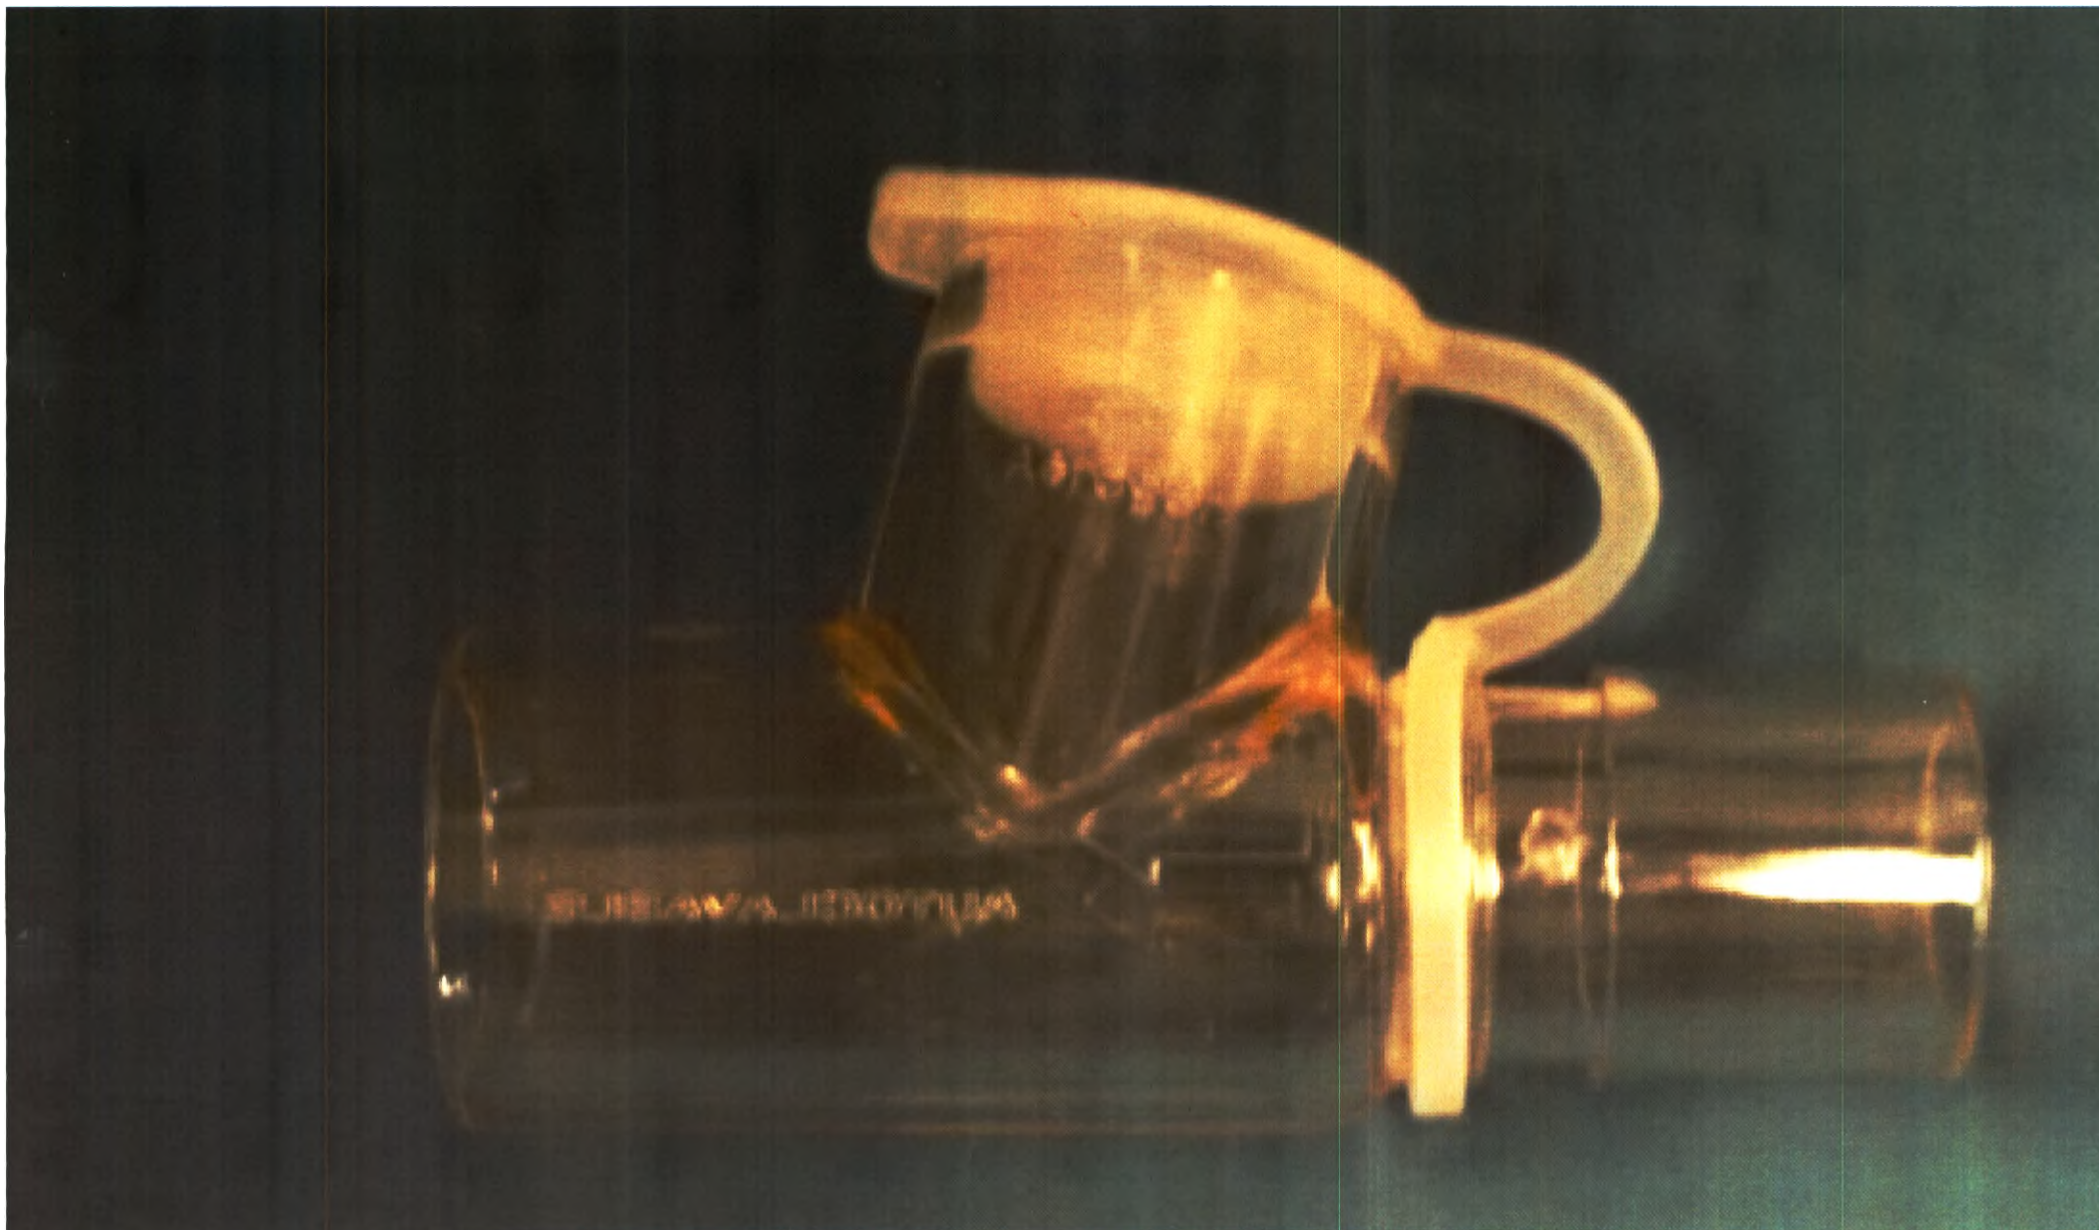


Фото 38. Т-образный переходник небулайзера с силиконовой заглушкой многоходовый



Фото 39 Т-образный переходник небулайзера с силиконовой заглушкой многоходовый



Фото 40. Заглушки камеры небулайзера силиконовые

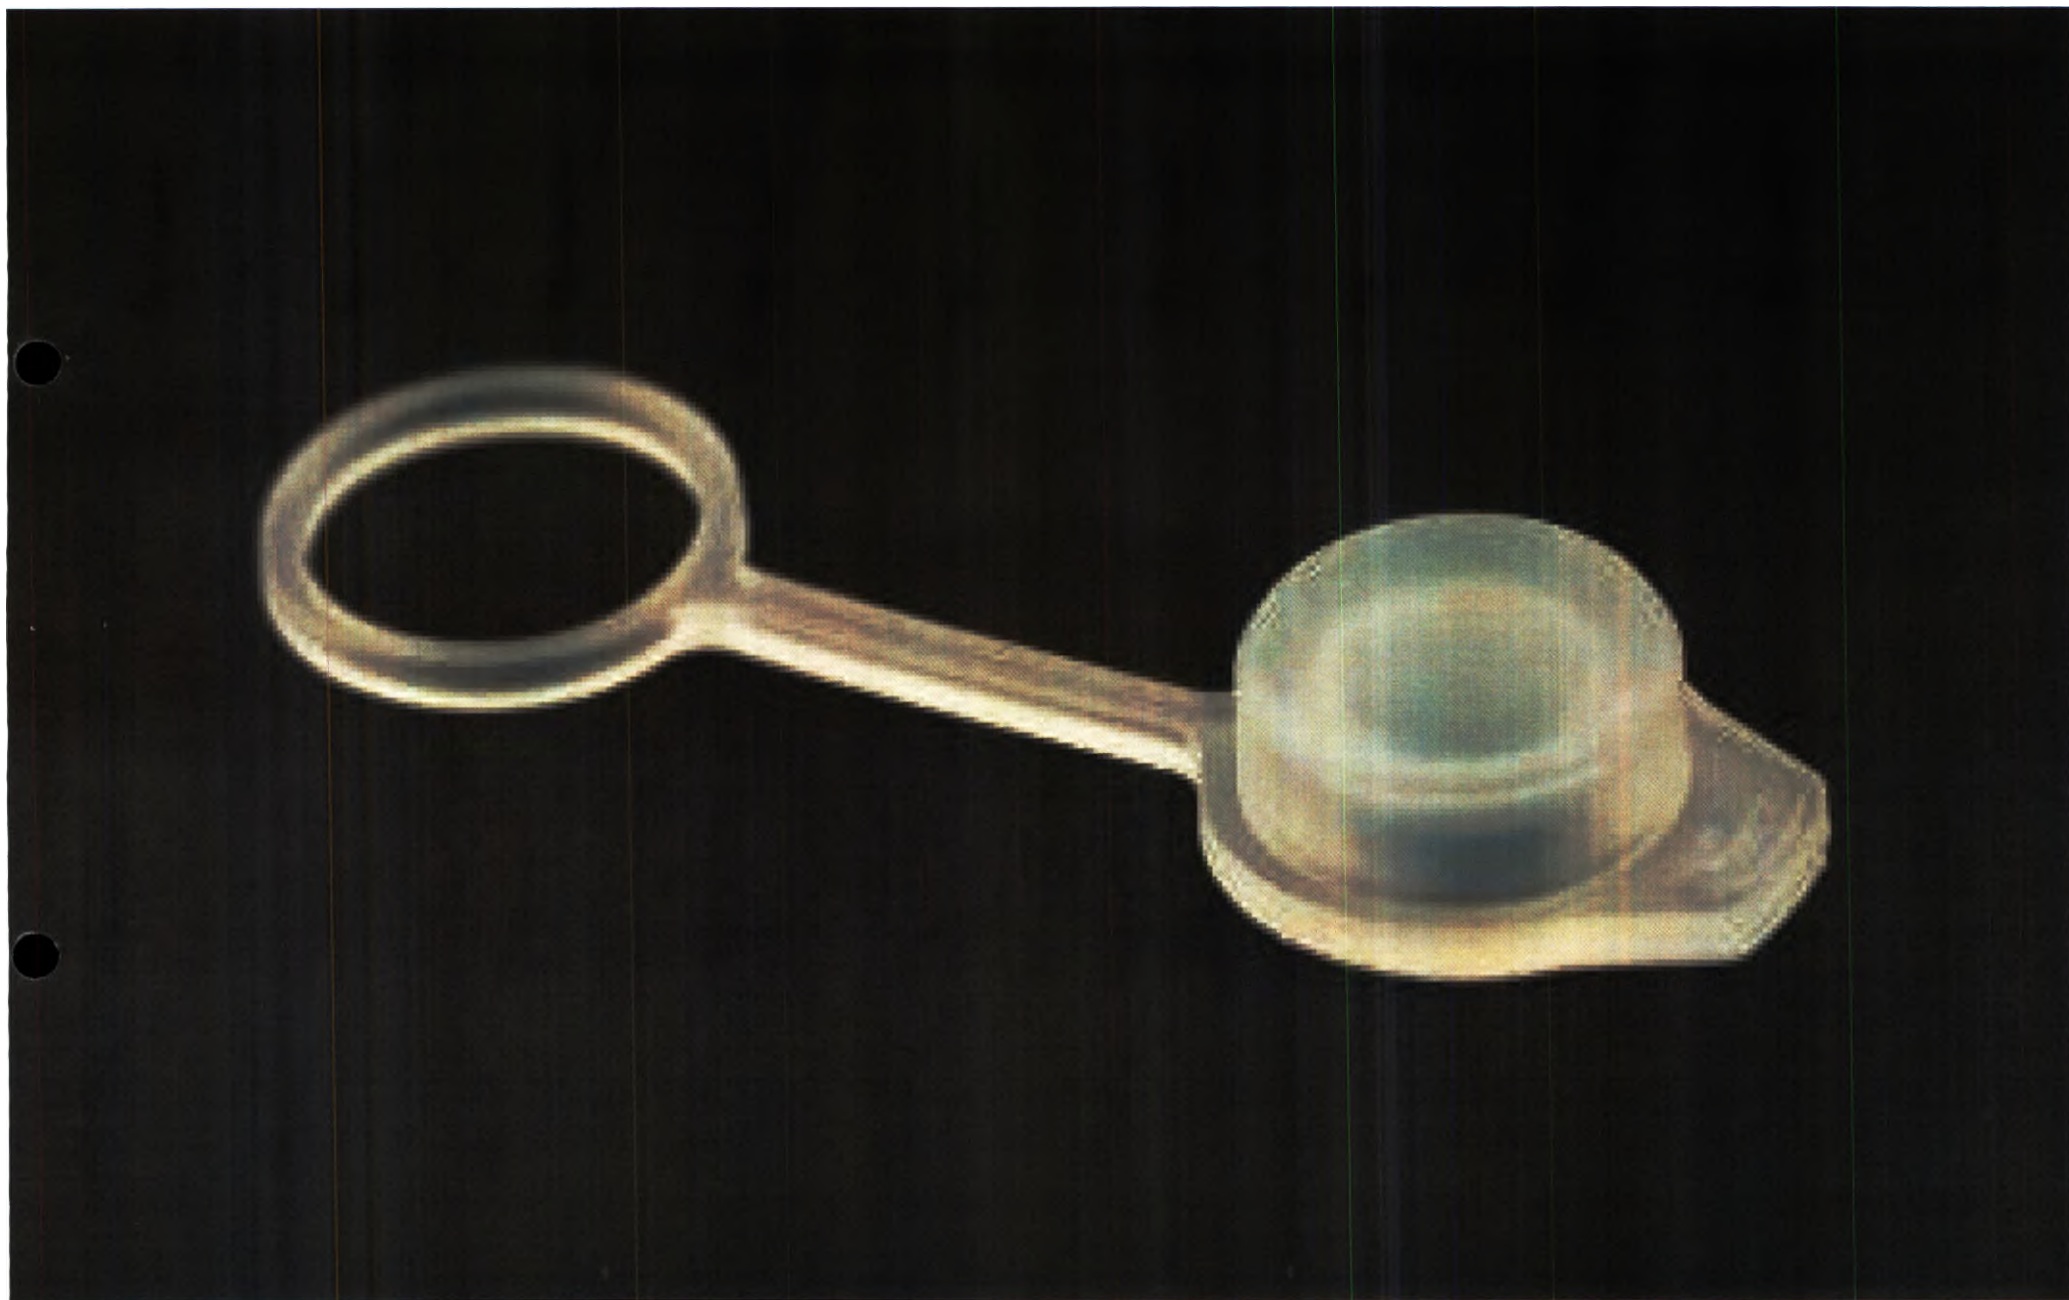


Фото 41. Экспираторный фильтр



Фото 42. Экспираторный фильтр



Фото 43. Экспираторный фильтр



Фото 44. Экспираторный фильтр



Фото 45. Инспираторный защитный фильтр, одноразовый

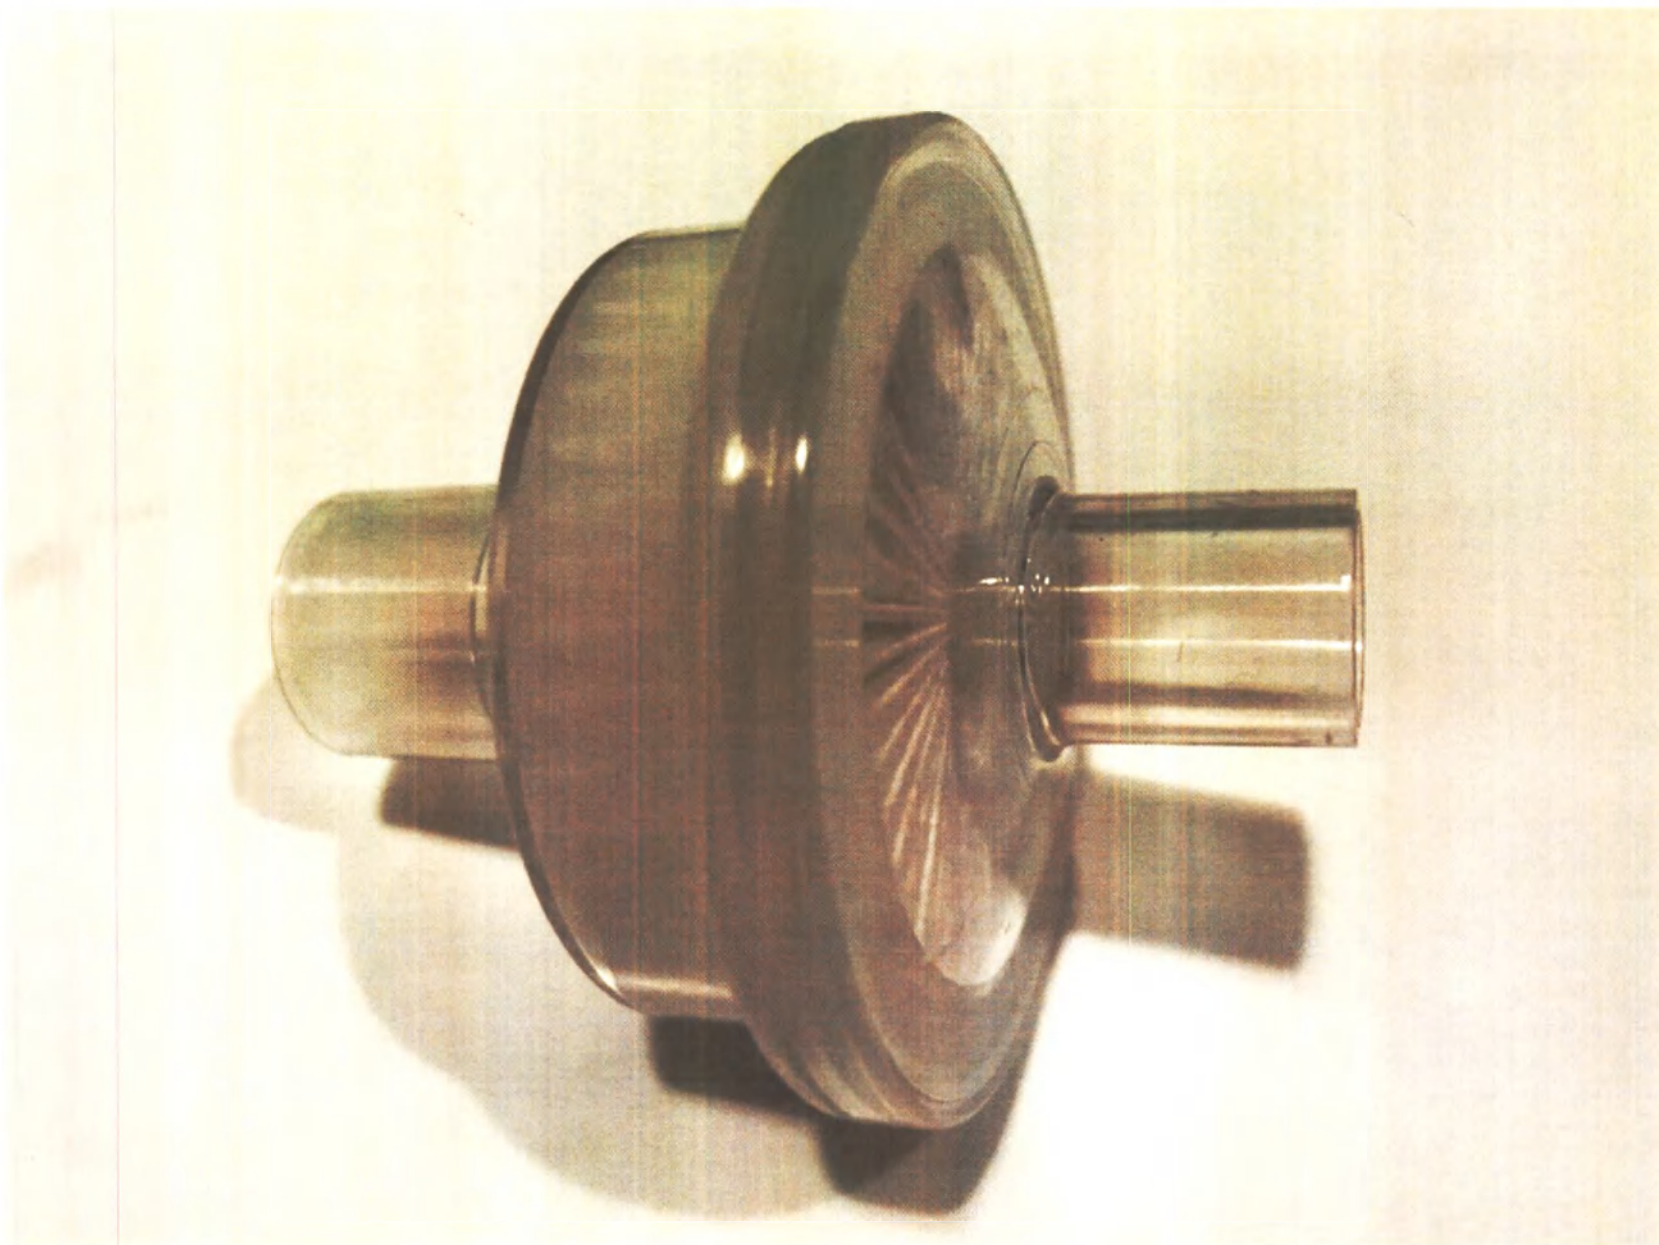


Фото 46. Инспираторный защитный фильтр, одноразовый

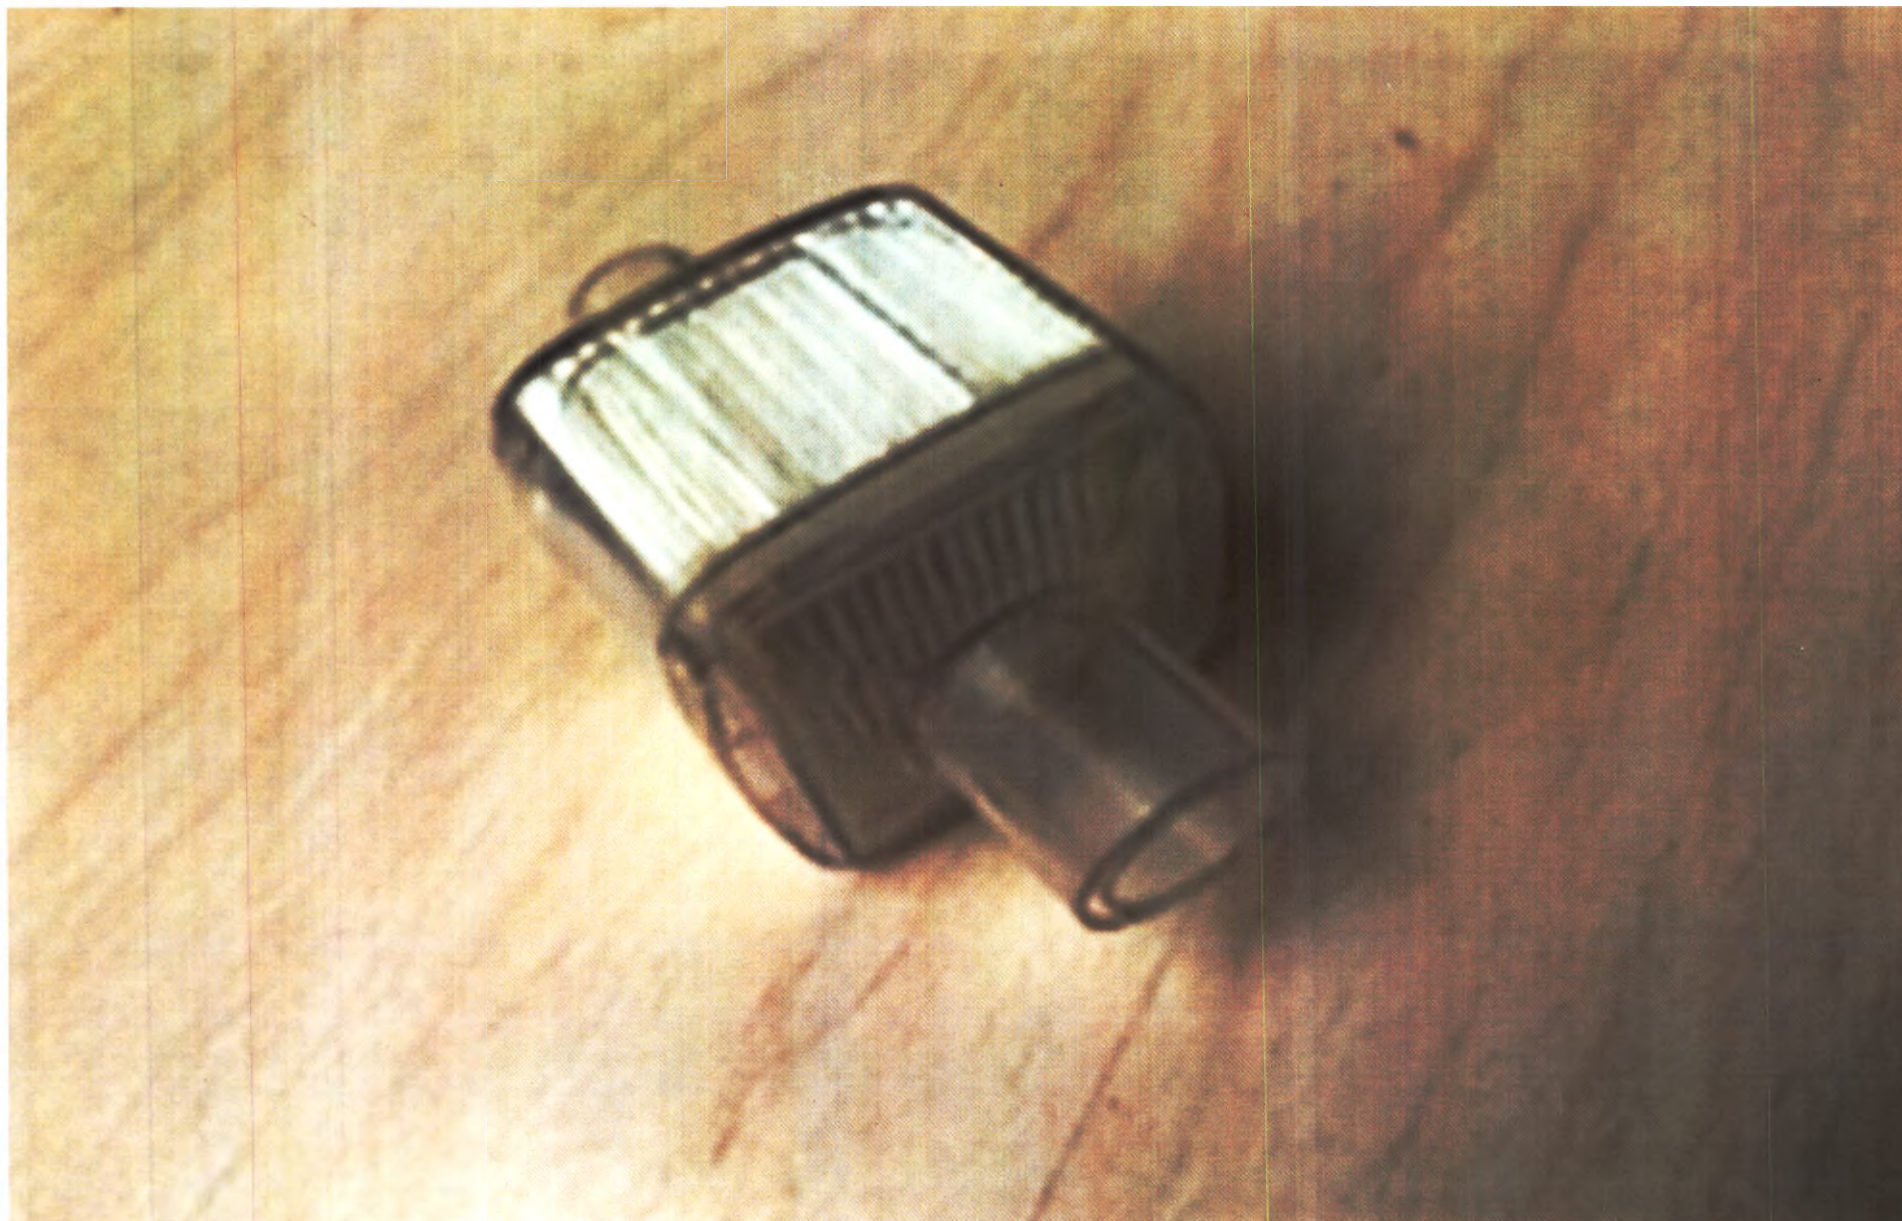


Фото 47. Катетер для измерения внутритрахеального давления

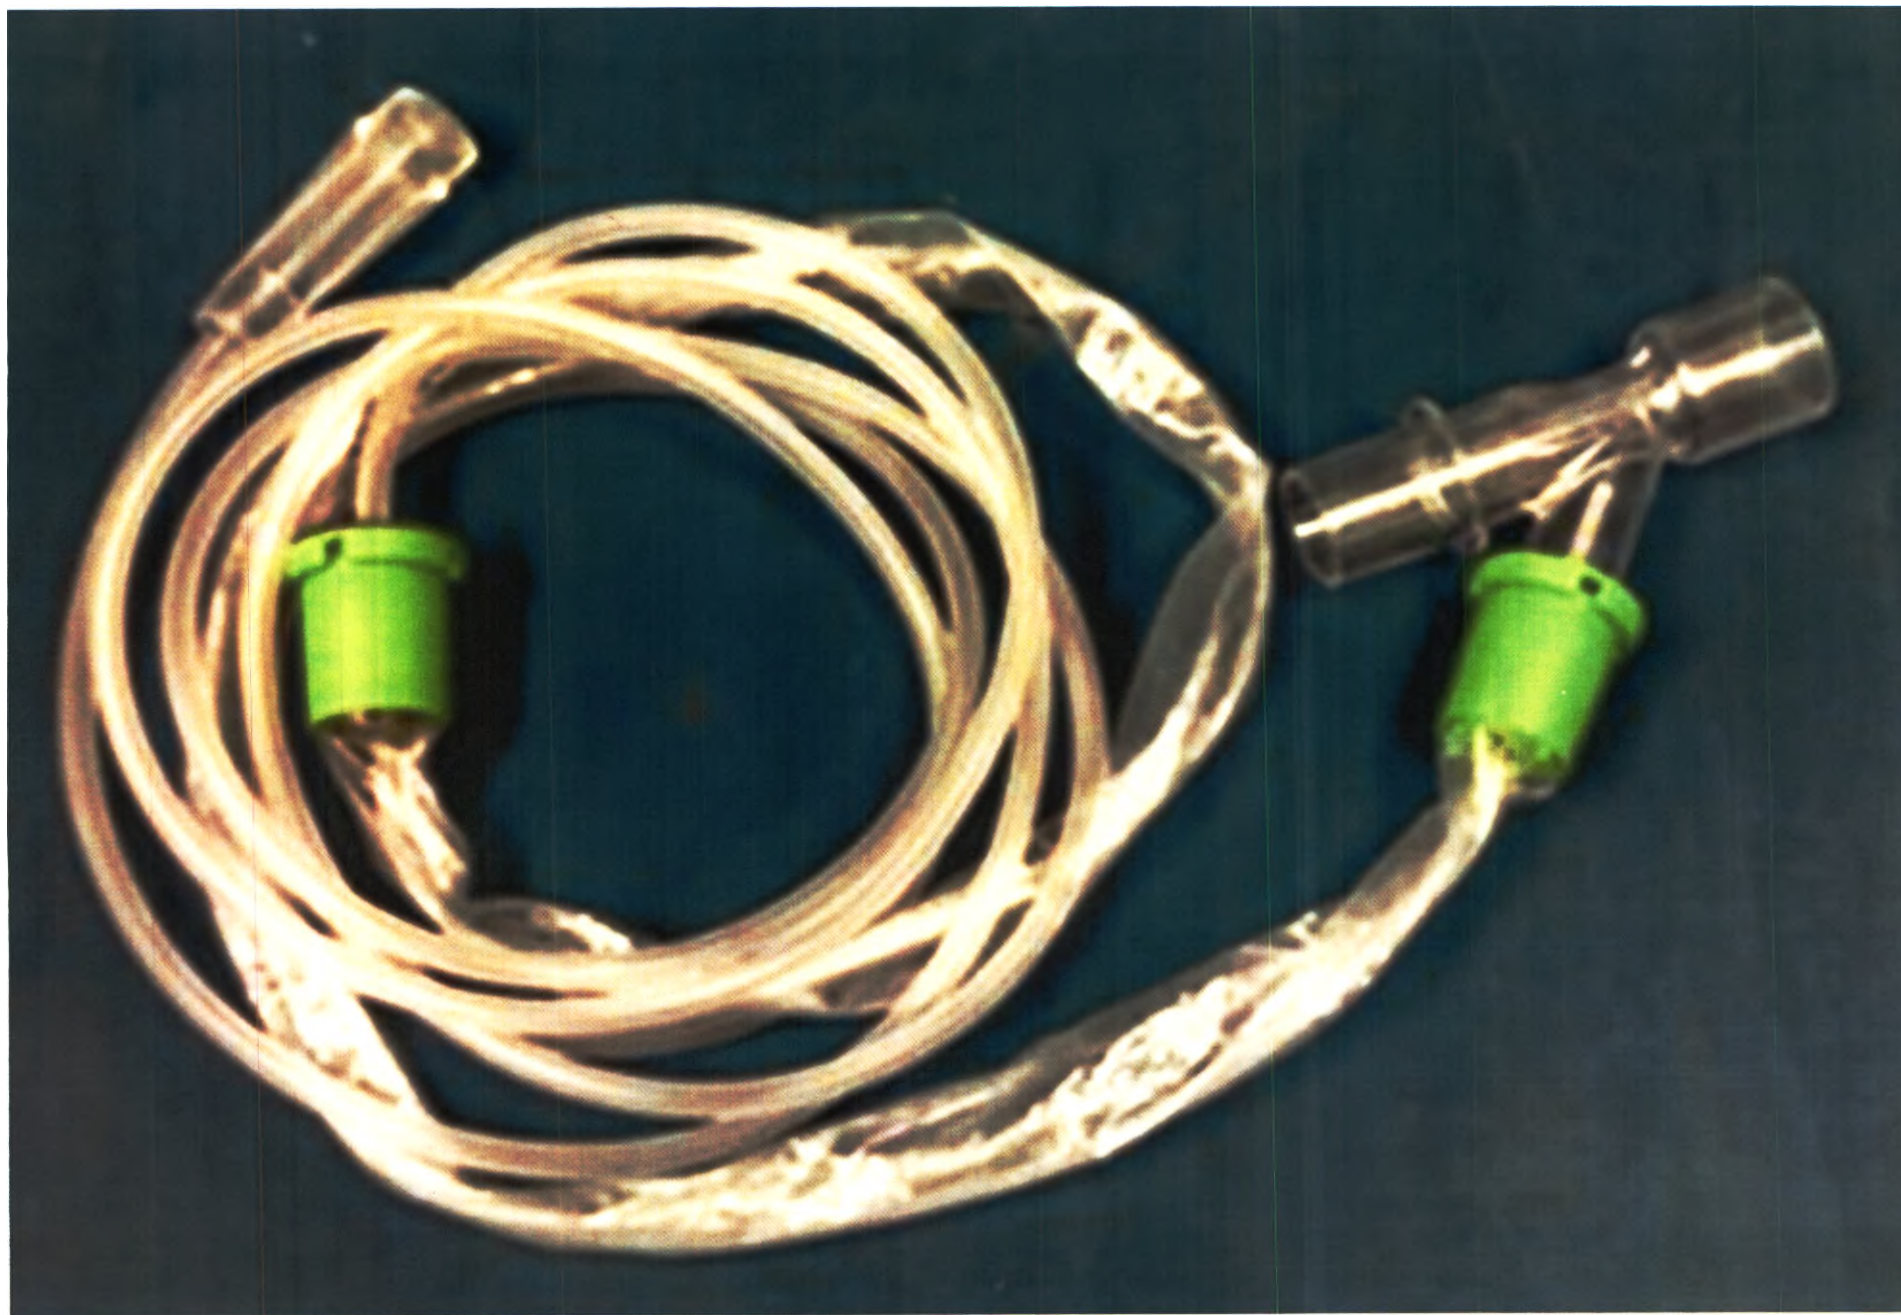


Фото 48. Рамы для газового модуля с кабелем

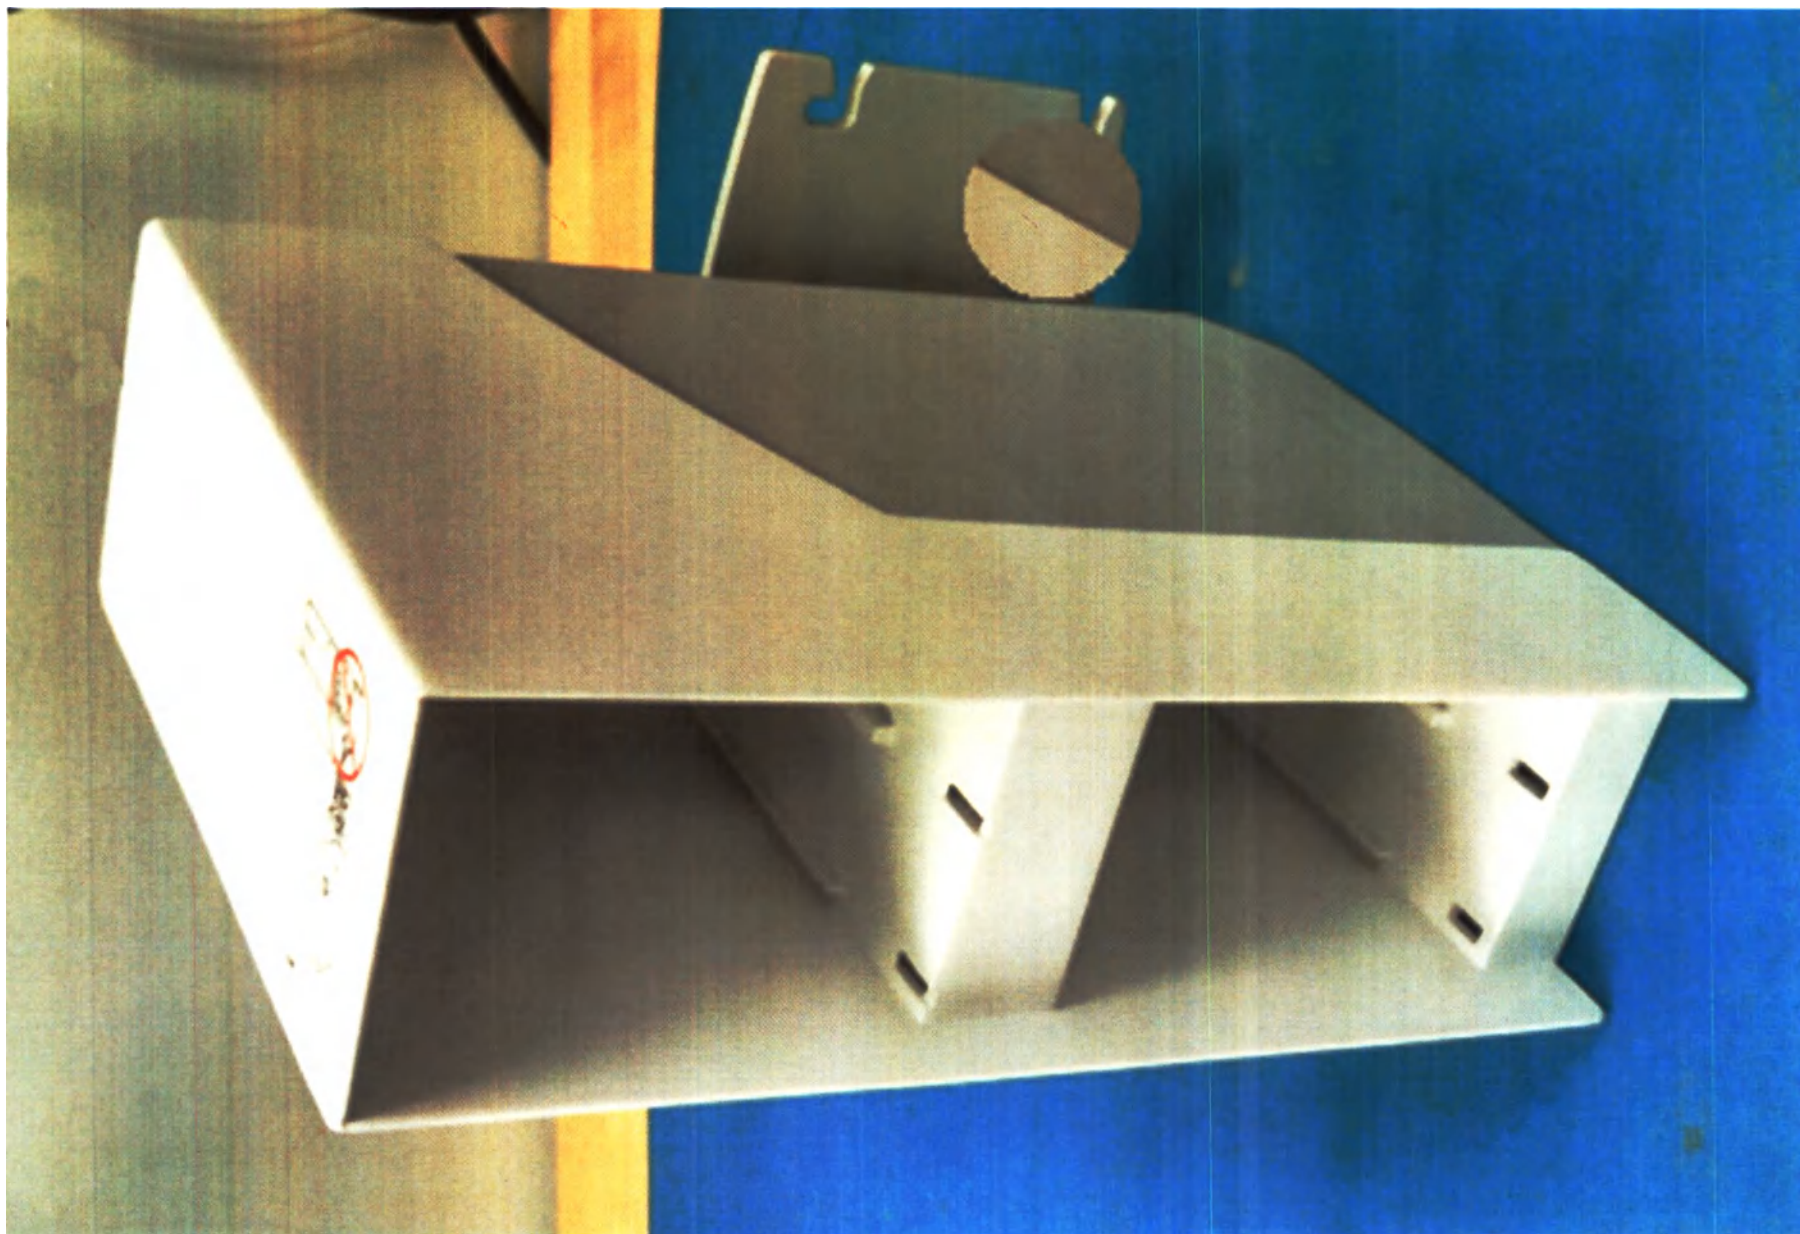


Фото 49. Рамы для газового модуля с кабелем.

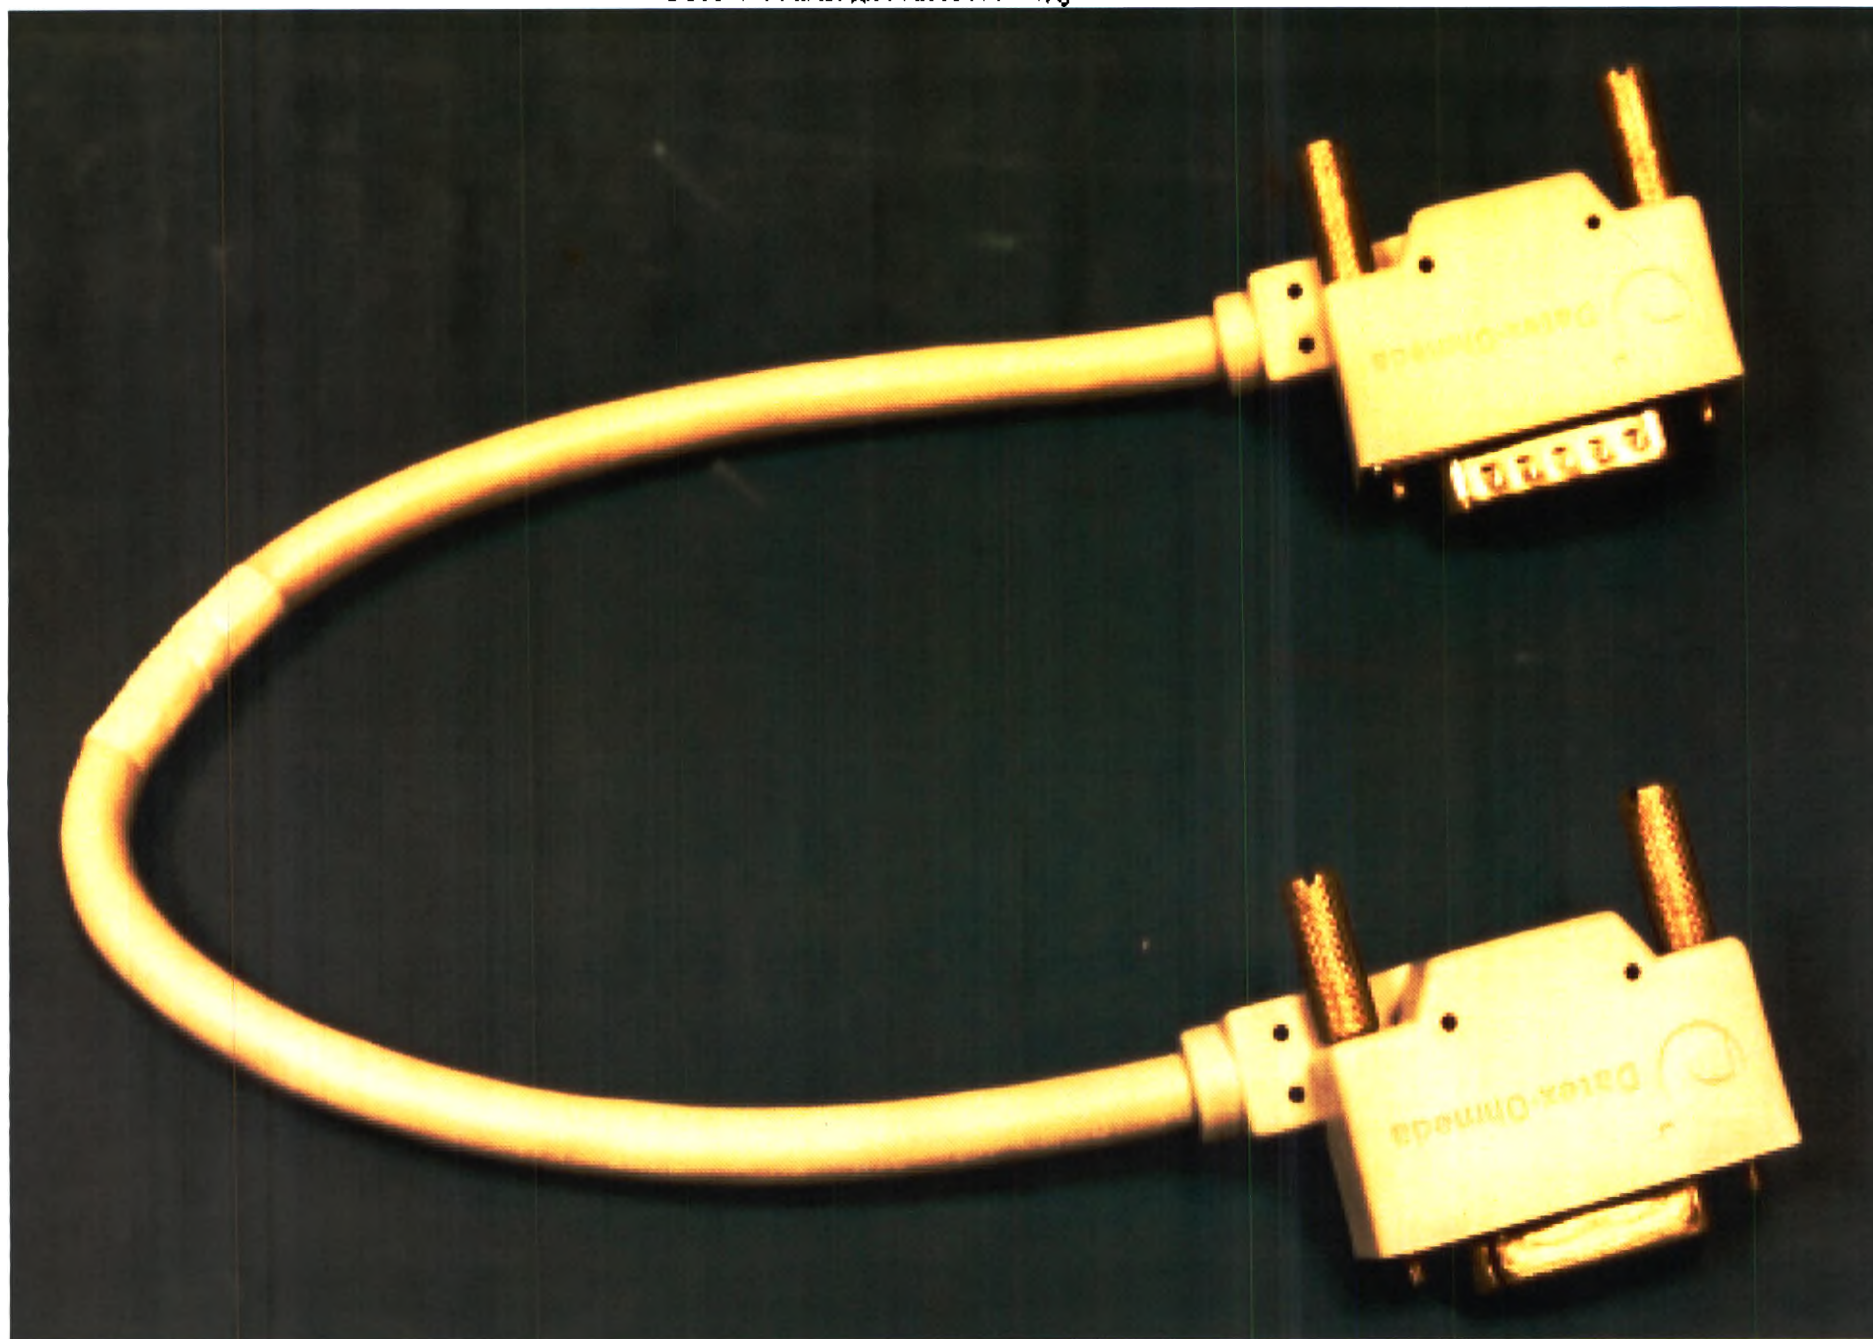


Фото 50. Регулируемая монтажная рейка

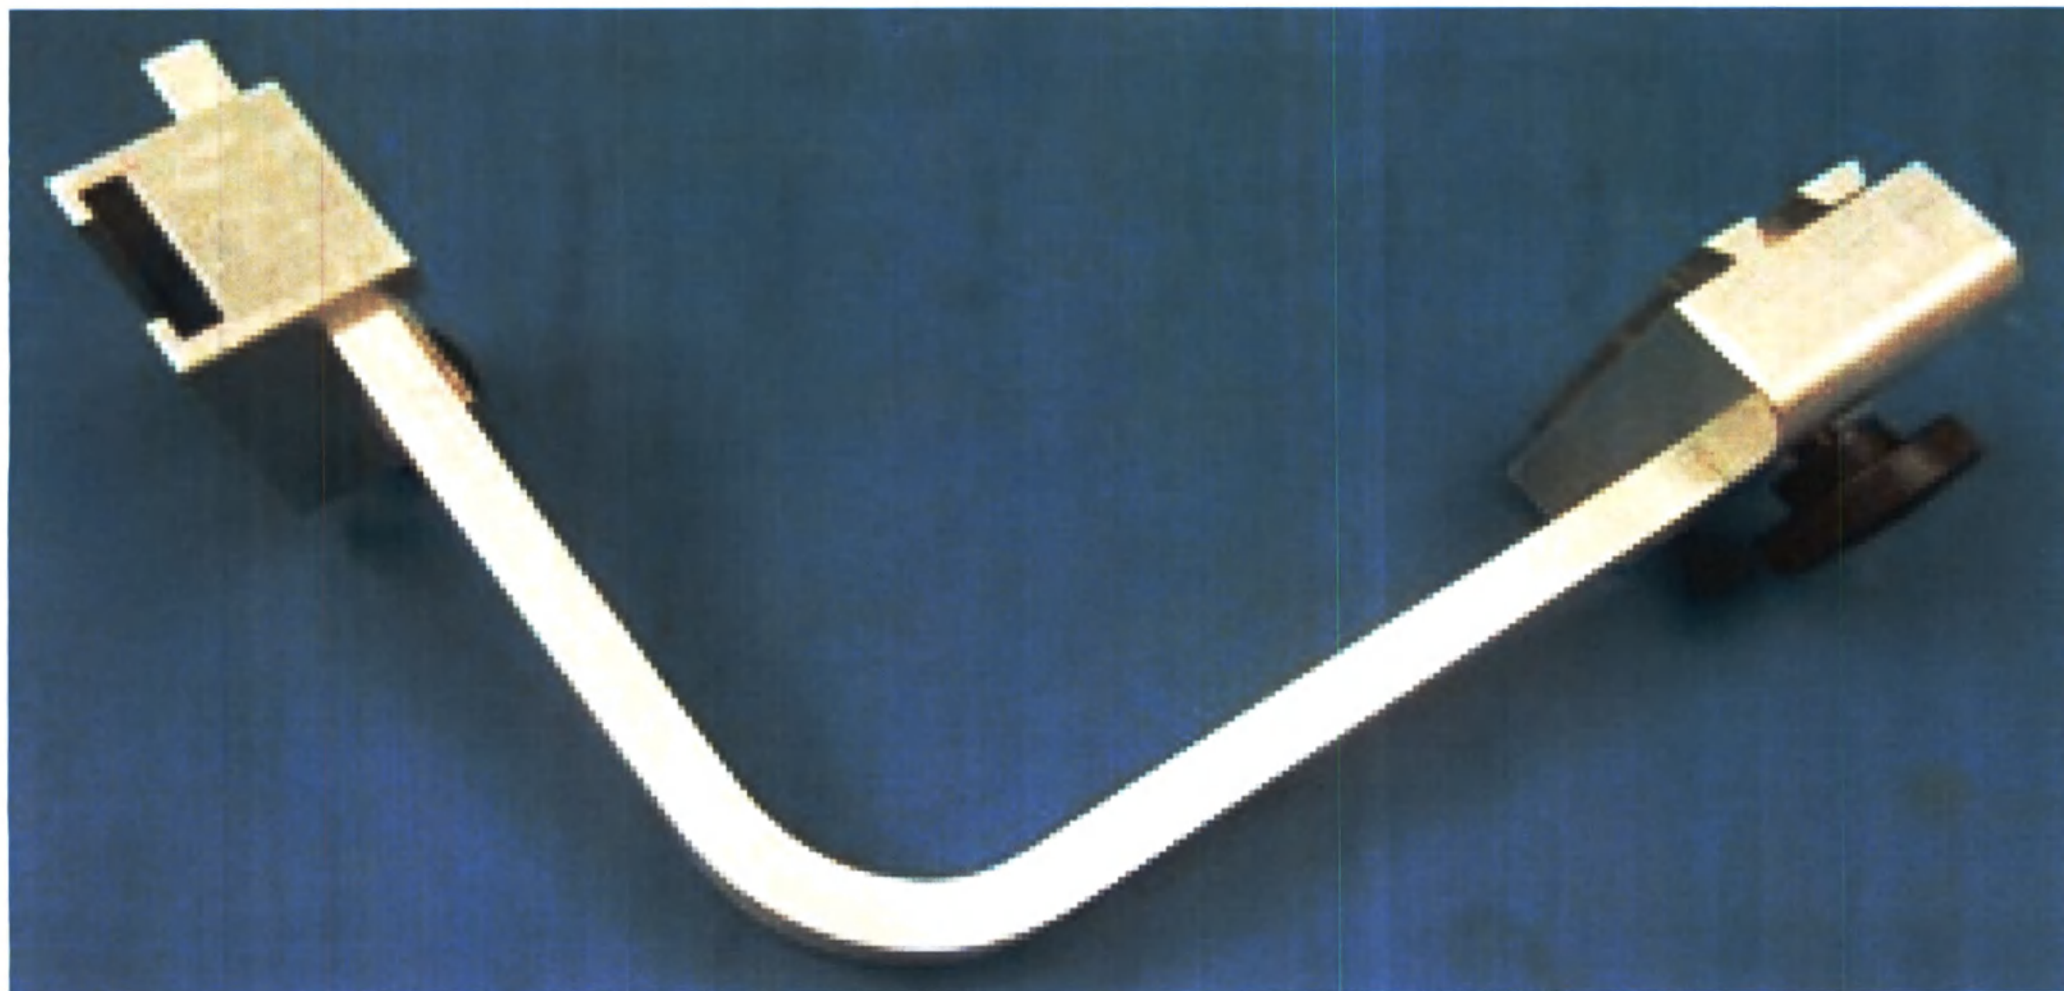


Фото 51. Адаптер регулируемой монтажной рейки

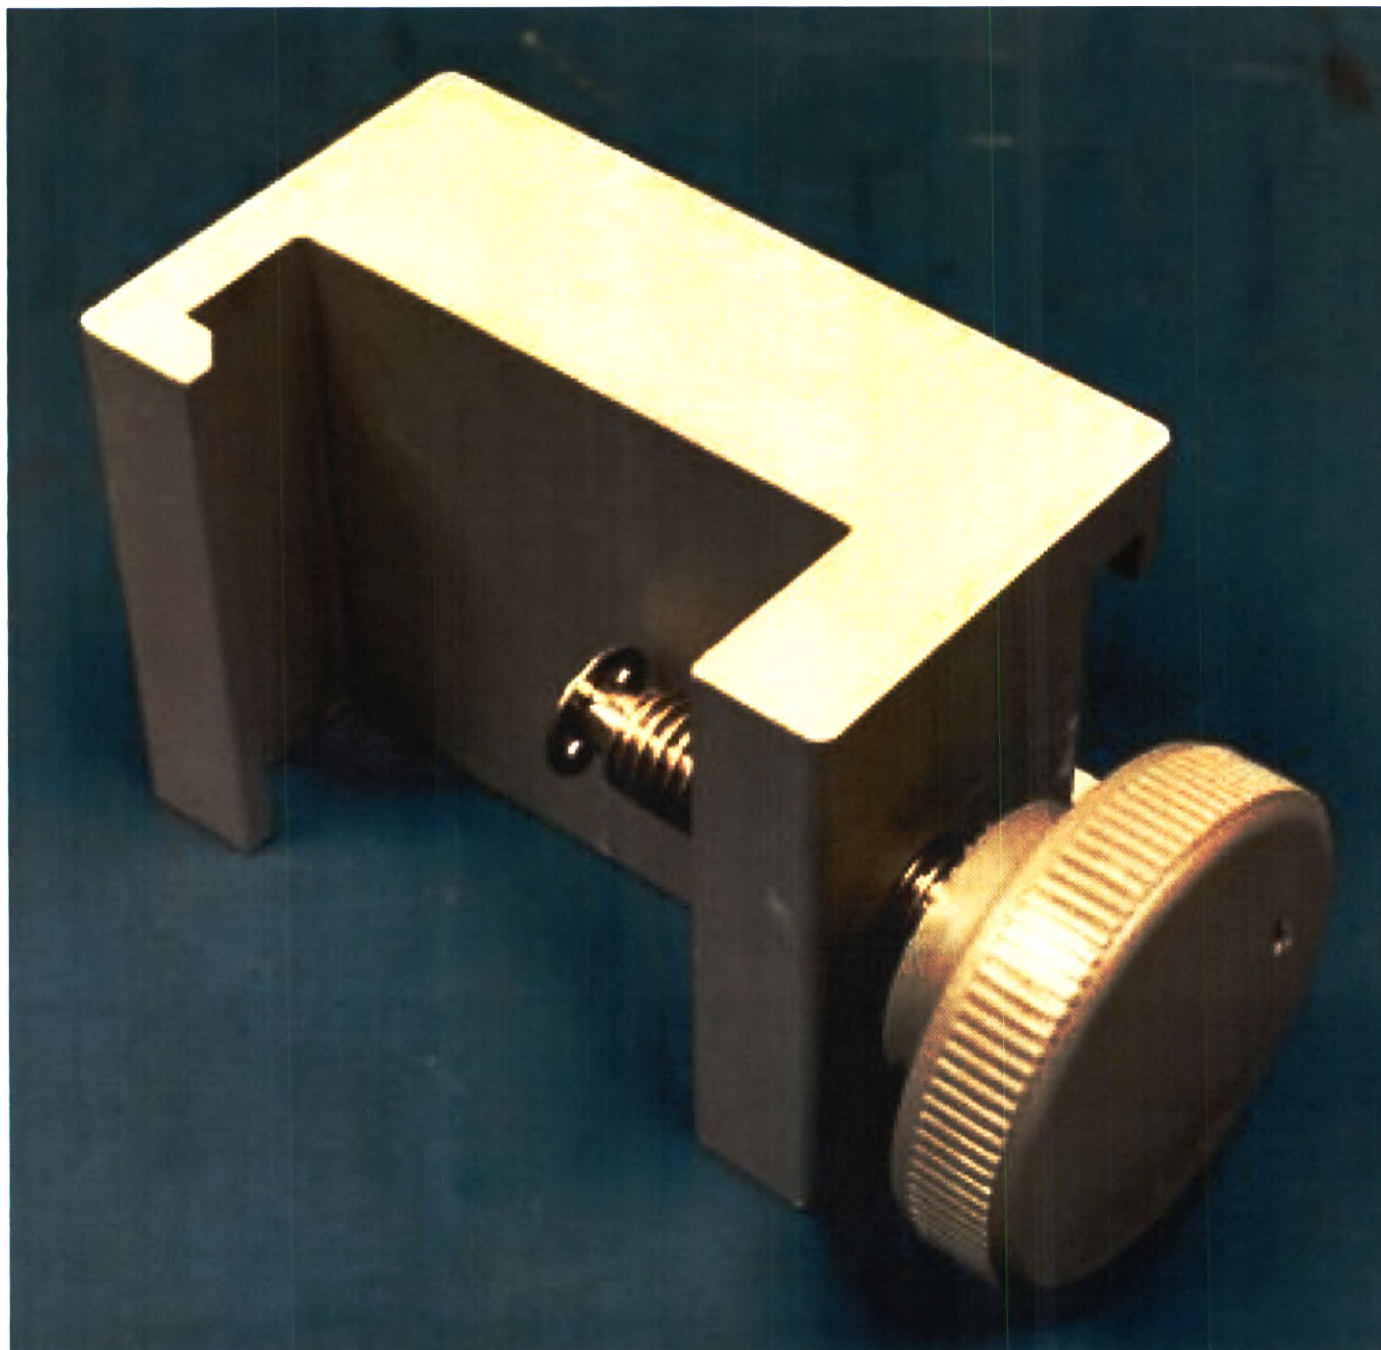


Фото 52. Адаптер для мониторинга

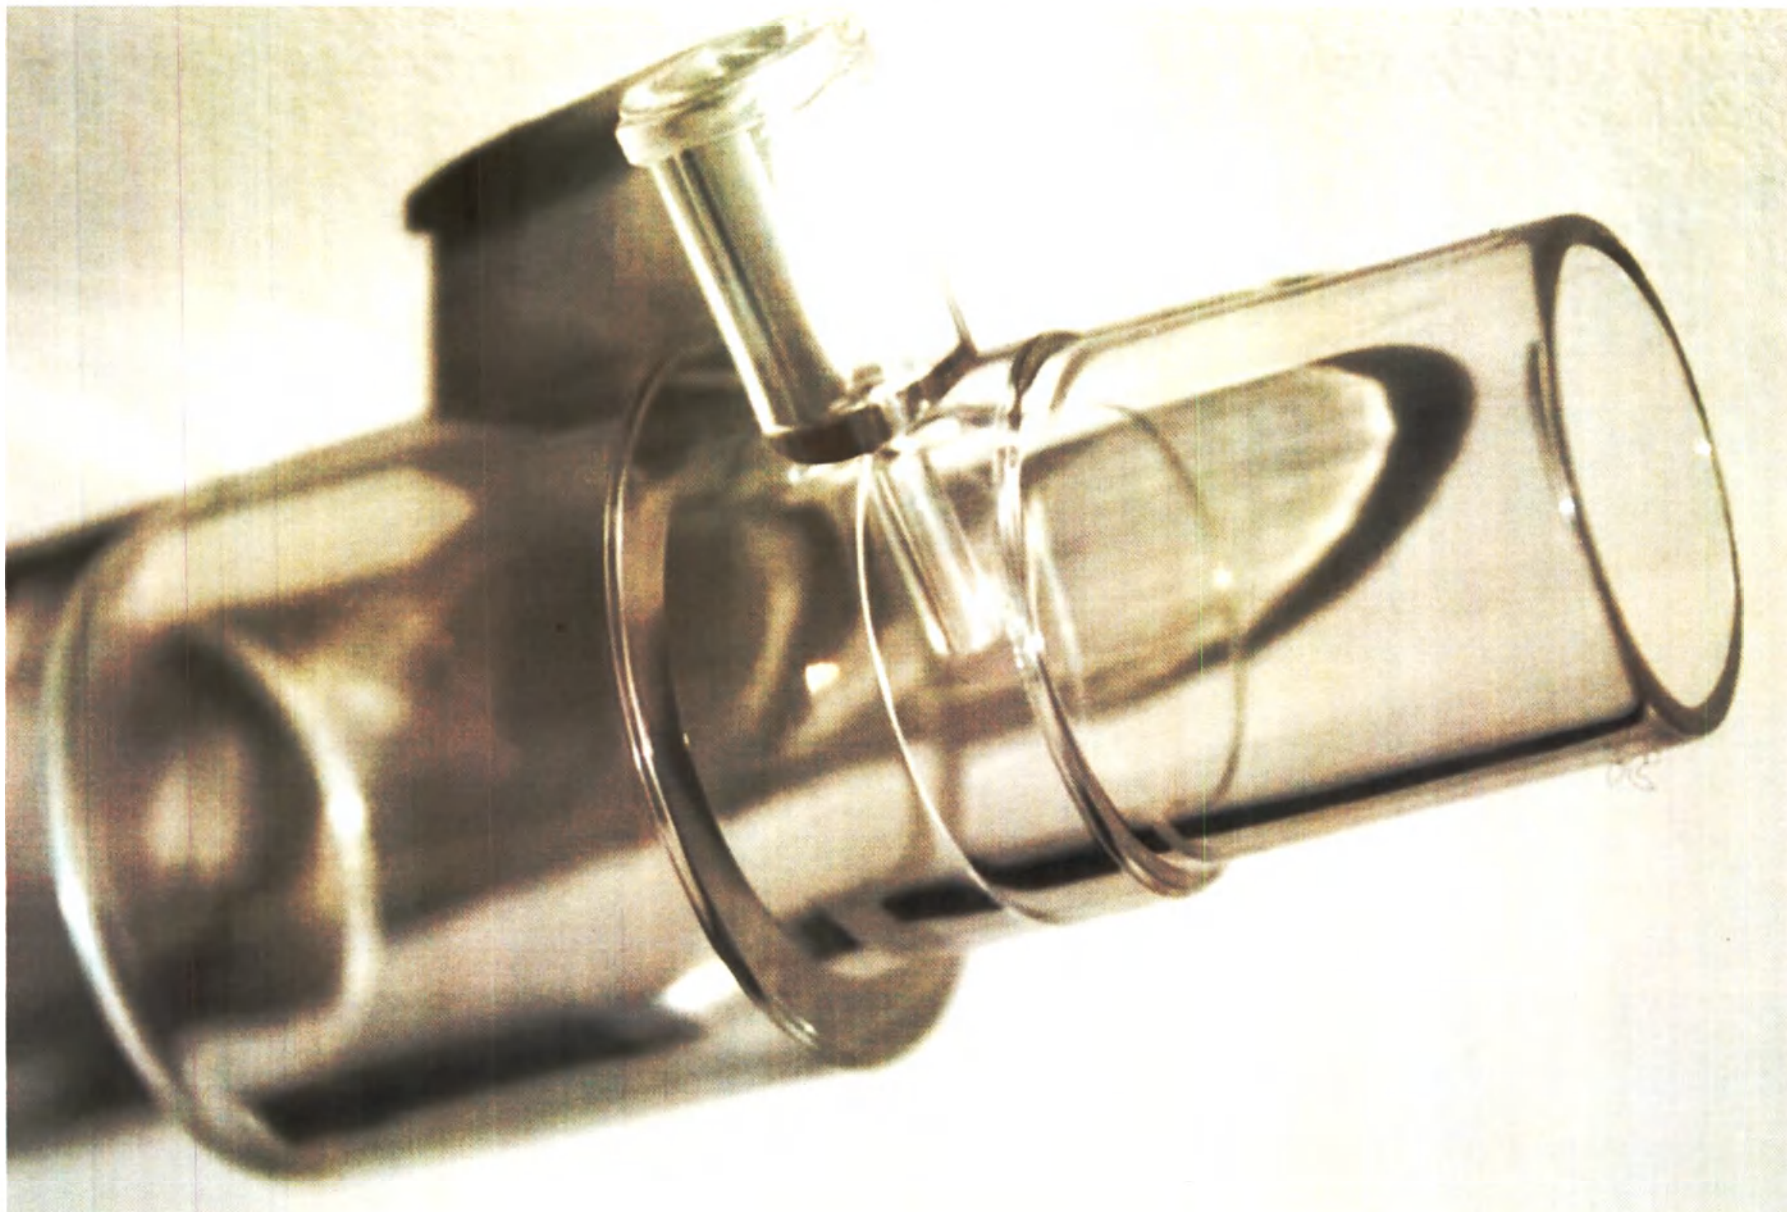


Фото 53-54. Клапаны выдоха с датчиками потока многоразовые



Фото 55. Клапаны выдоха многоразовые



Фото 56. Наборы для спирометрии



Фото 57. Наборы для спирометрии

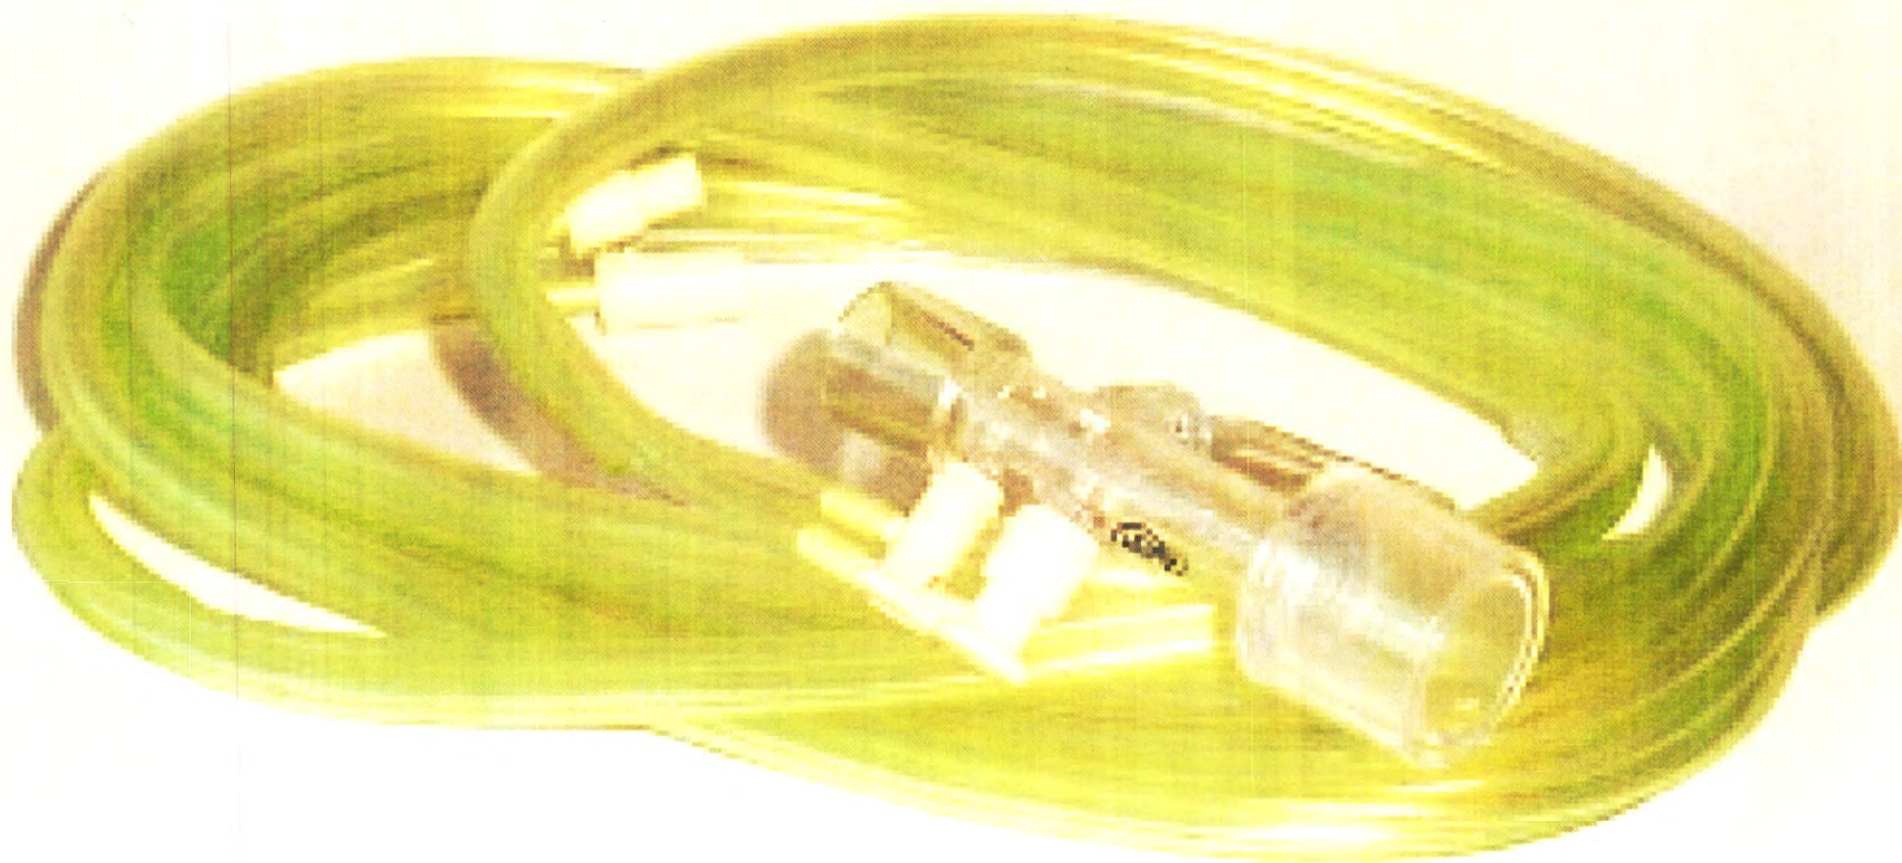


Фото 58. Наборы для спирометрии

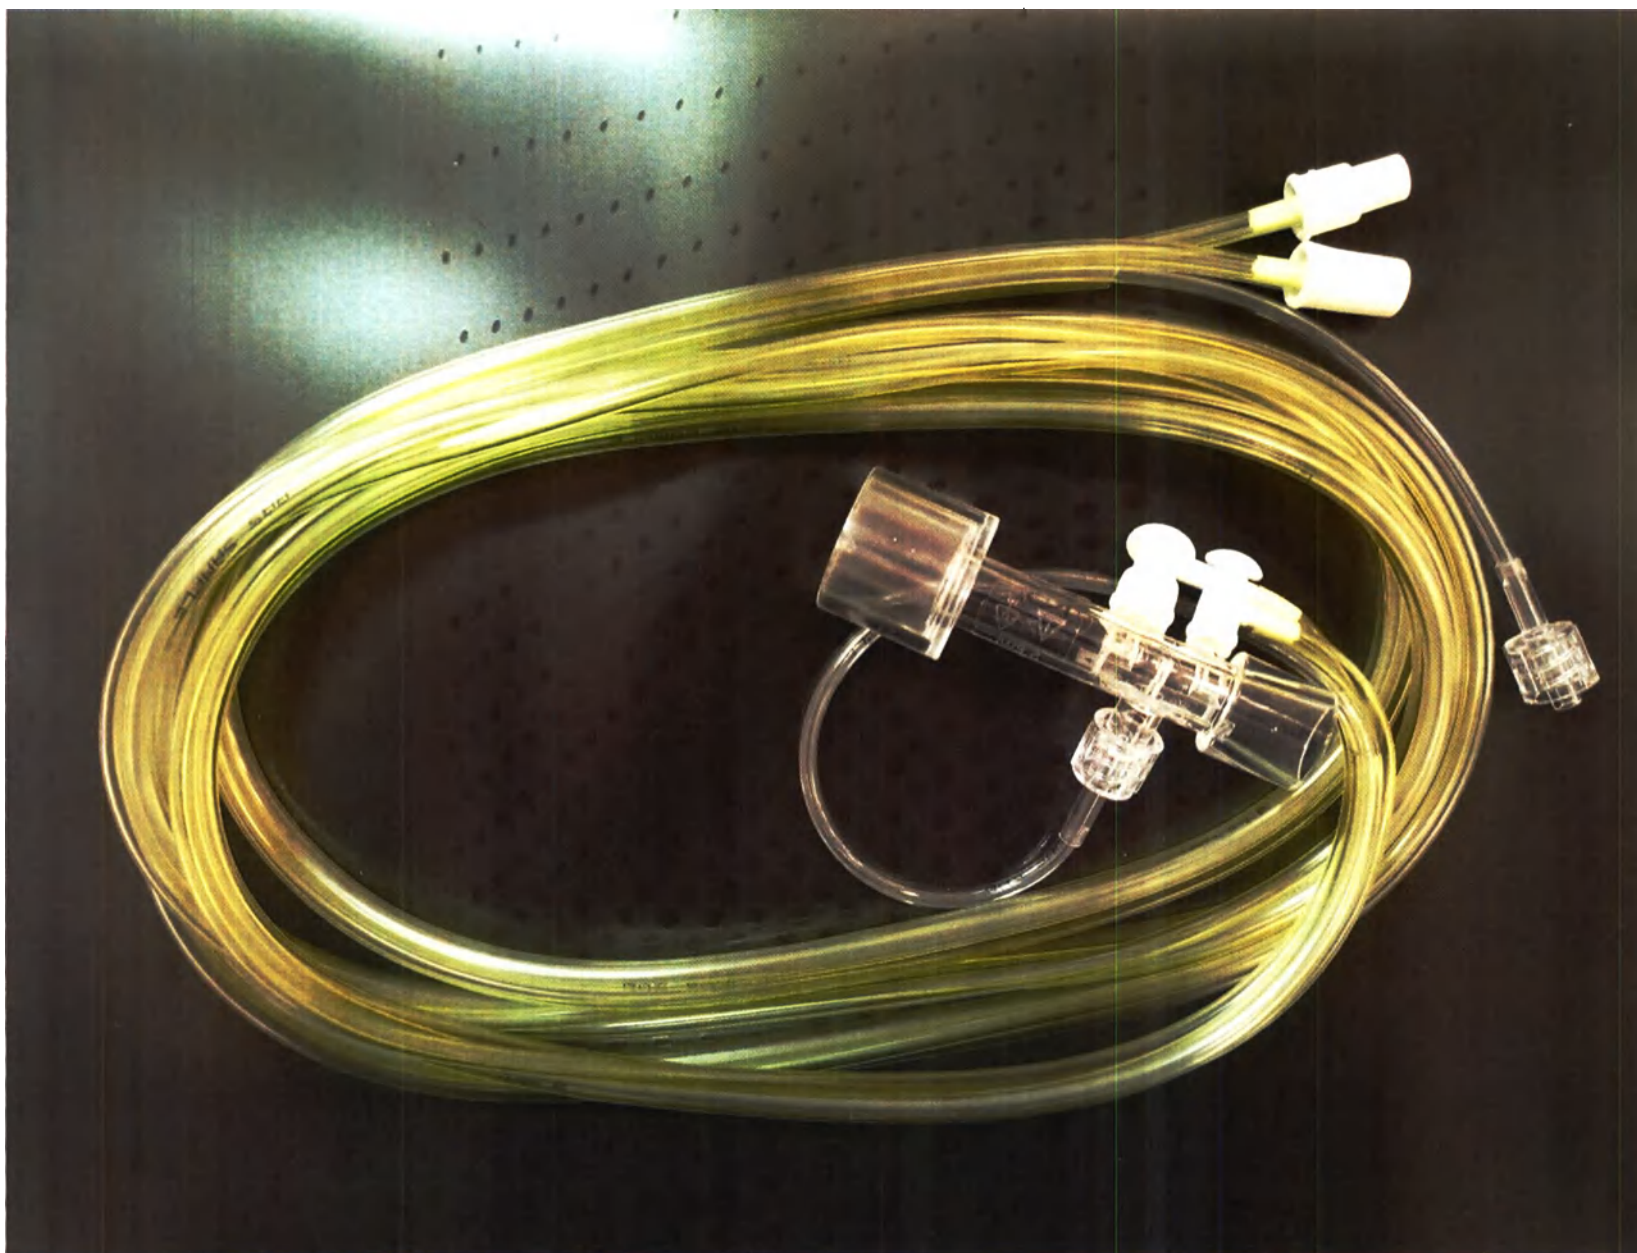


Фото 59. Фильтр для дисплея



Фото 60. Фильтр охлаждающего вентилятора двигателя аппарата ИВЛ

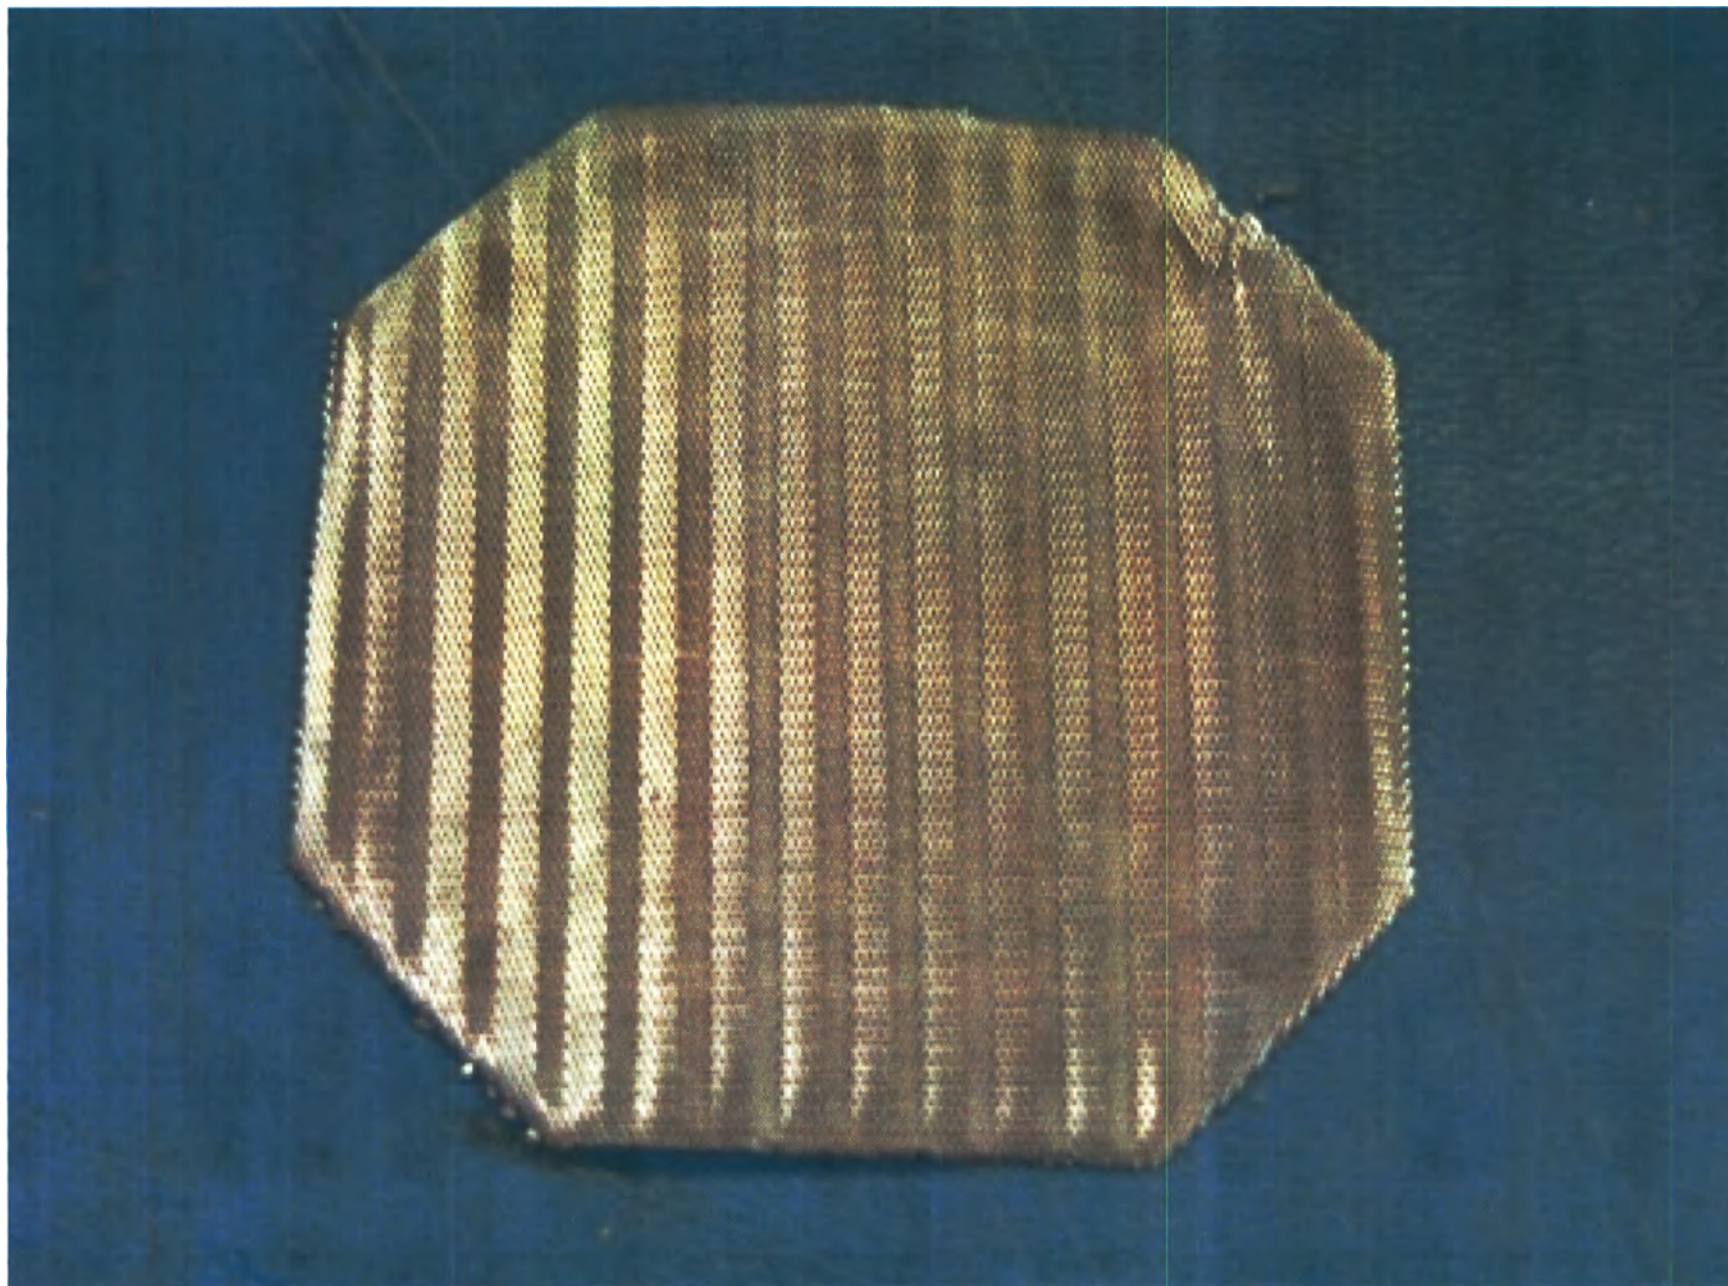


Фото 61. Влаготделители D-fend Pro+, одноразовые



Фото 62. Влагоотделители Mini D-fend, одноразовые

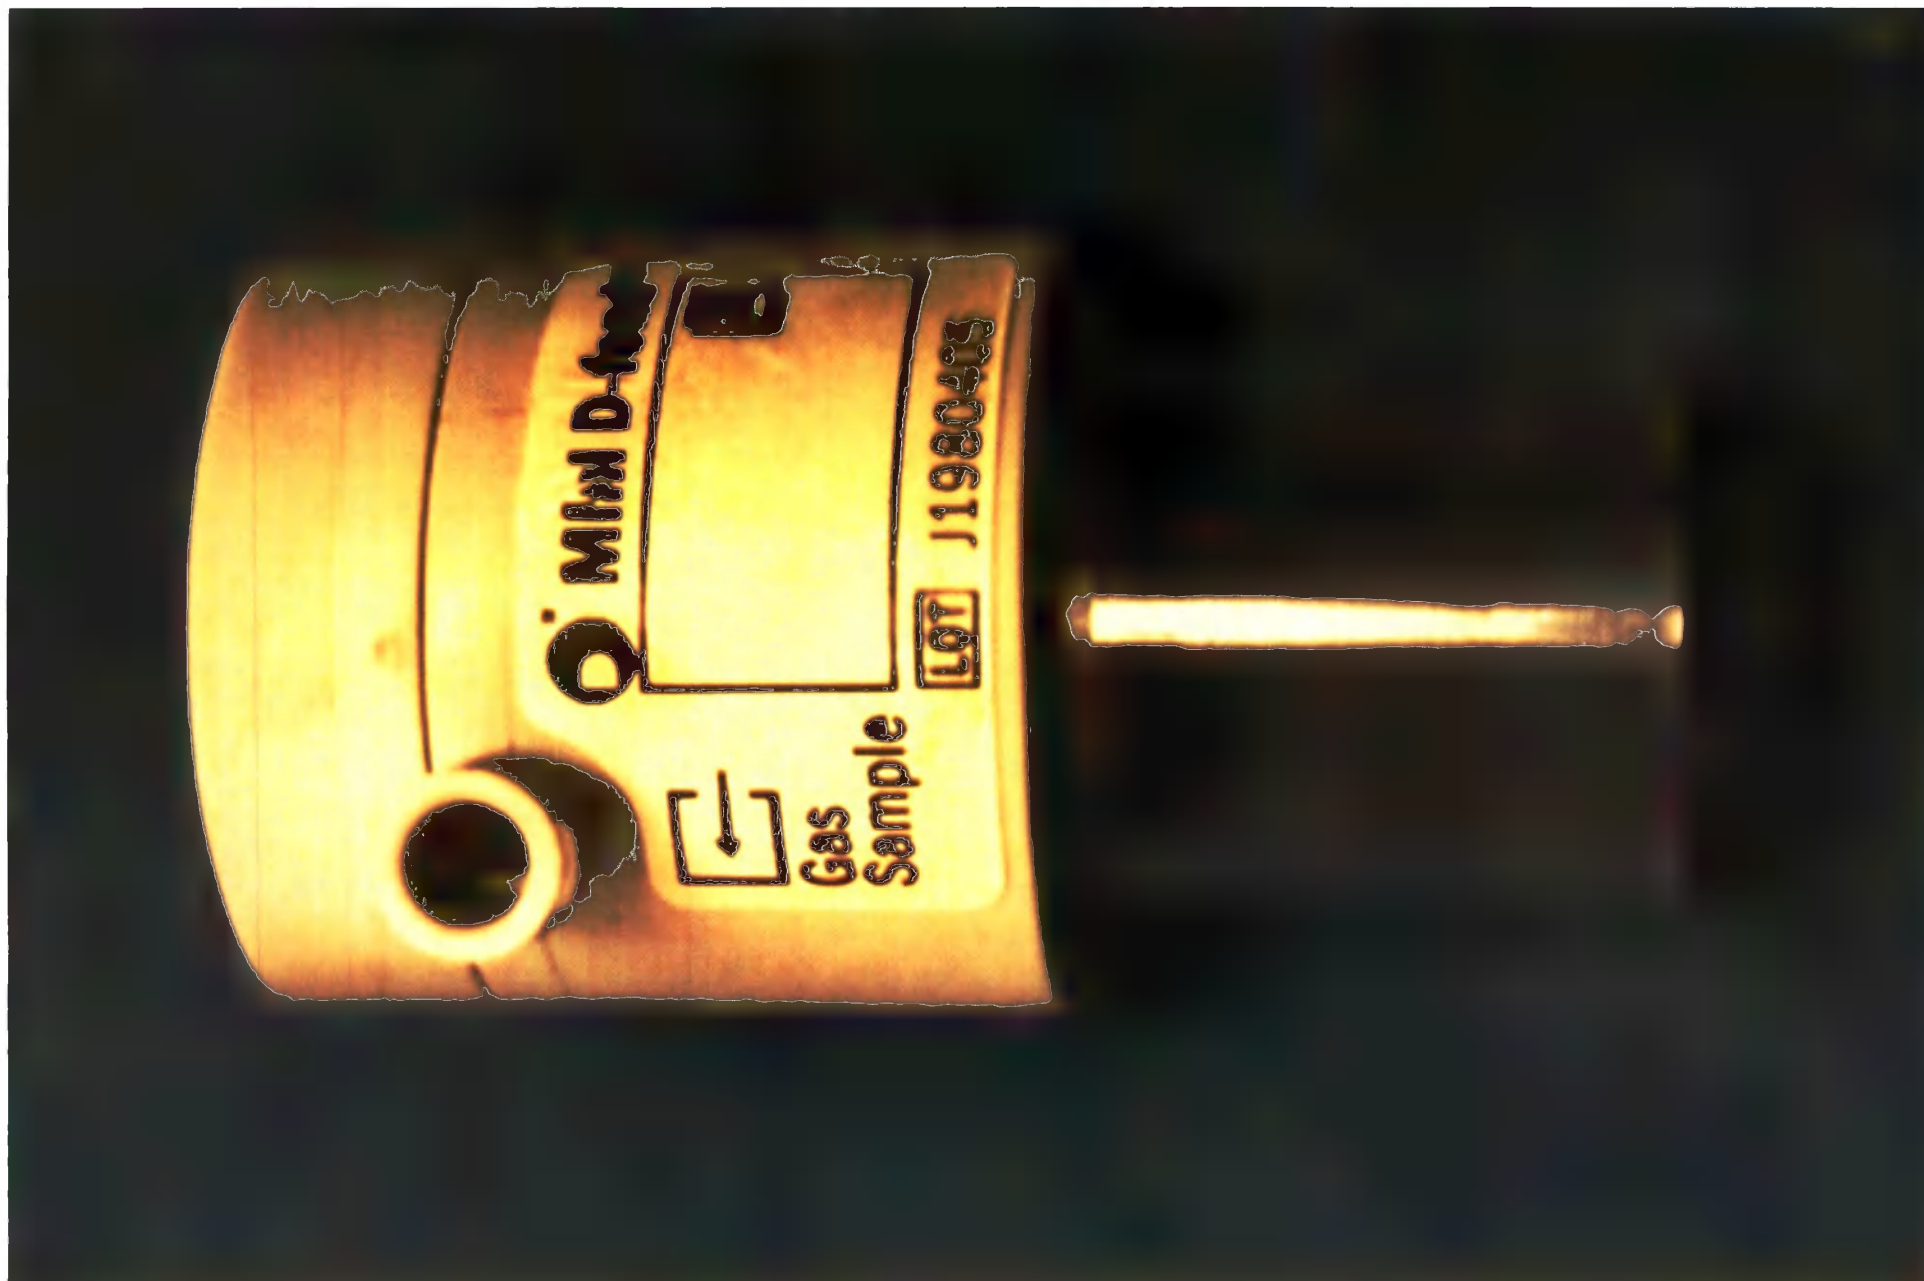


Фото 63. Адаптер для спирометрии D-lite+, взрослый для использования во влажных условиях, одноразовый



Фото 64. Адаптер для спирометрии Red-lite+, детский для использования во влажных условиях, одноразовый

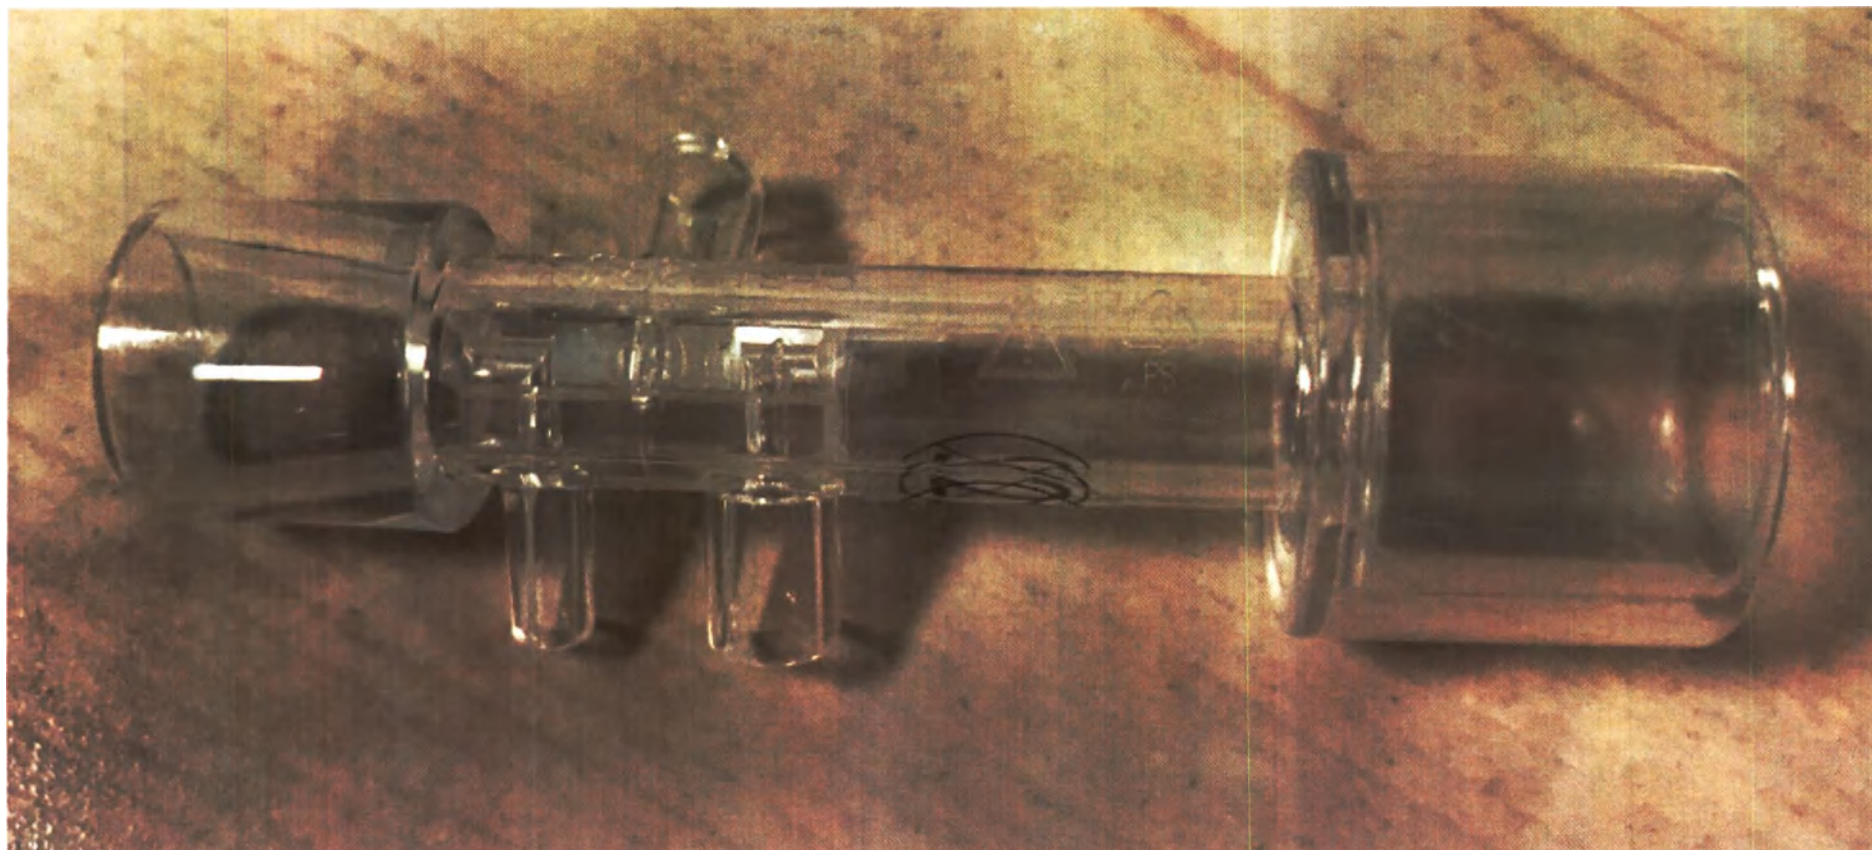


Фото 65. Адаптеры для спирометрии D-lite, взрослые, многоразовые



Фото 66. Адаптеры для спирометрии Pedi-lite, детские, многоразовые



Фото 67. Линии для спирометрии одноразовые

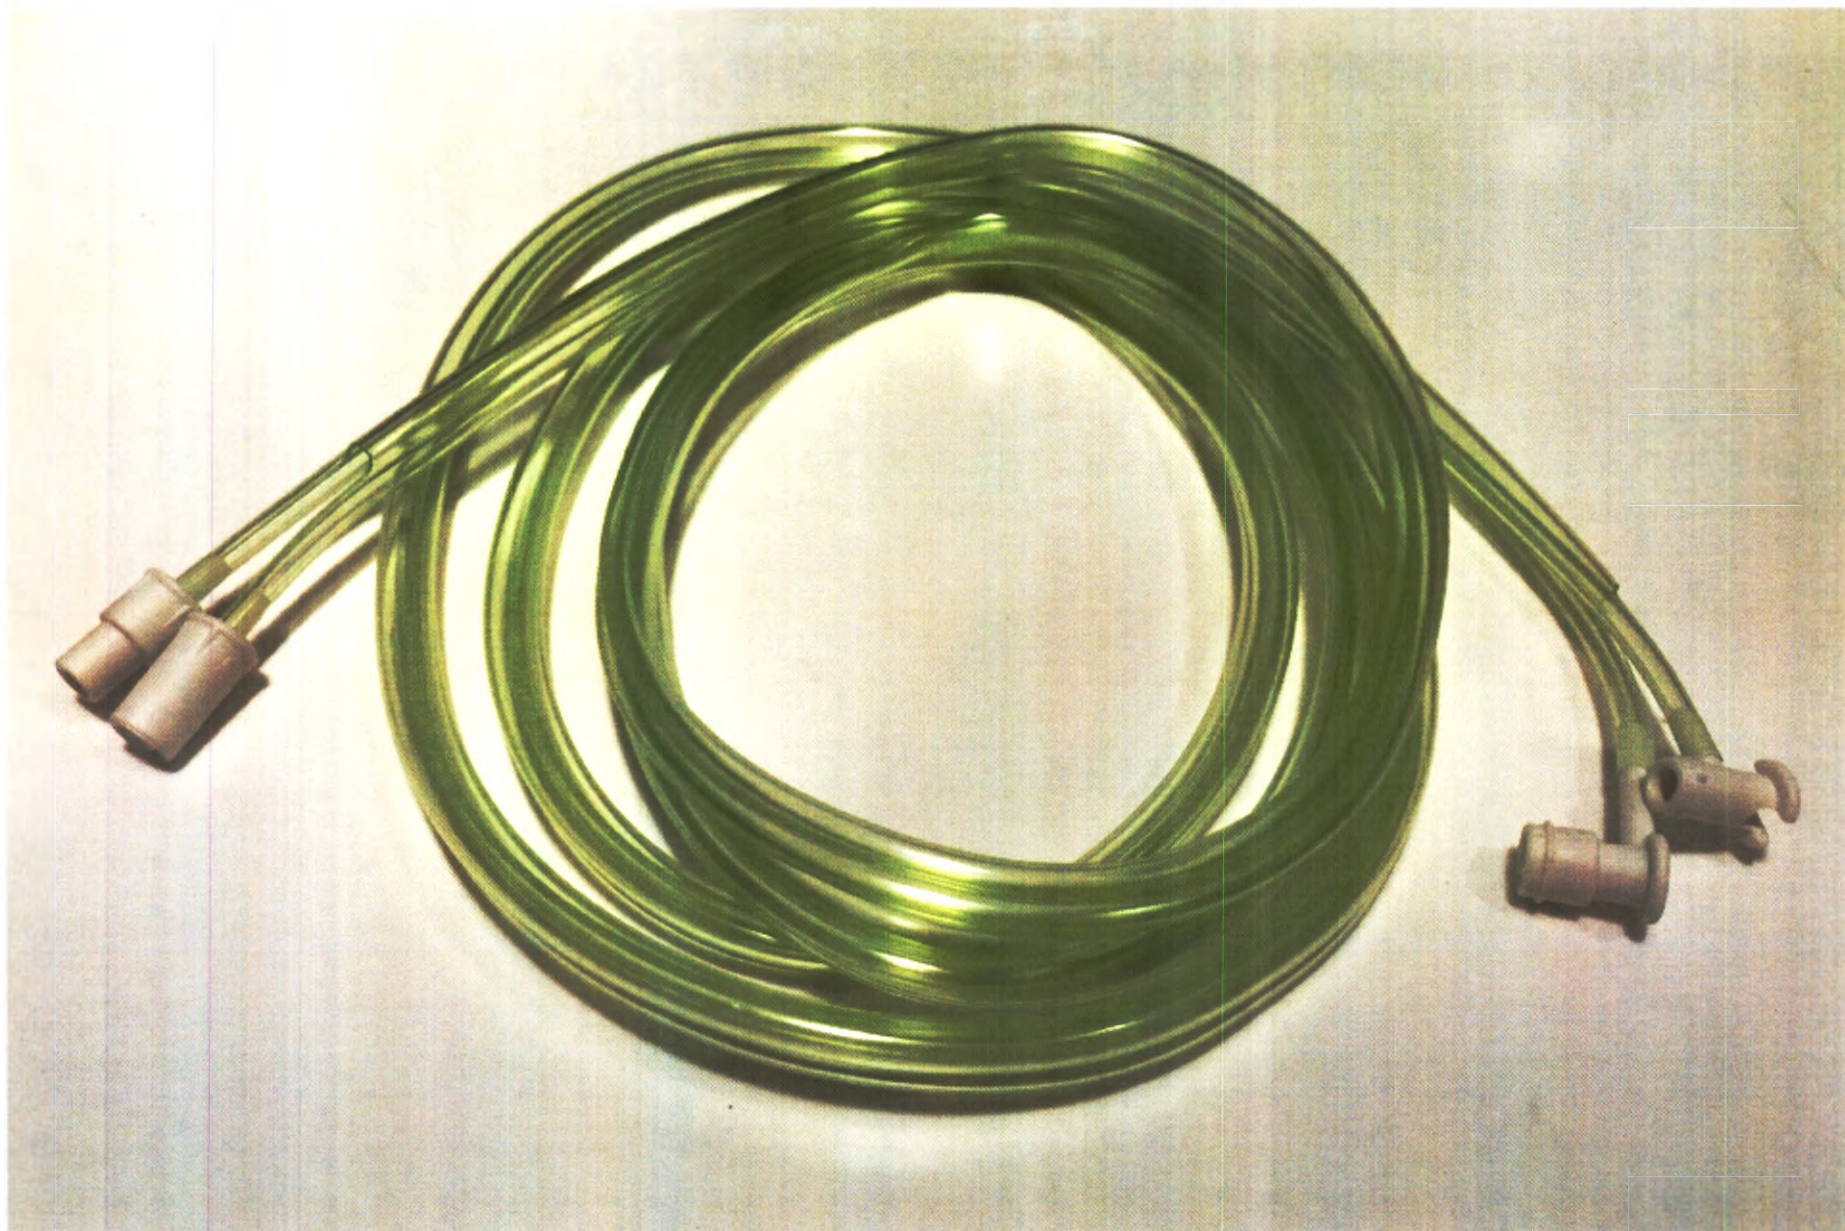


Фото 68. Линии отбора проб CO₂

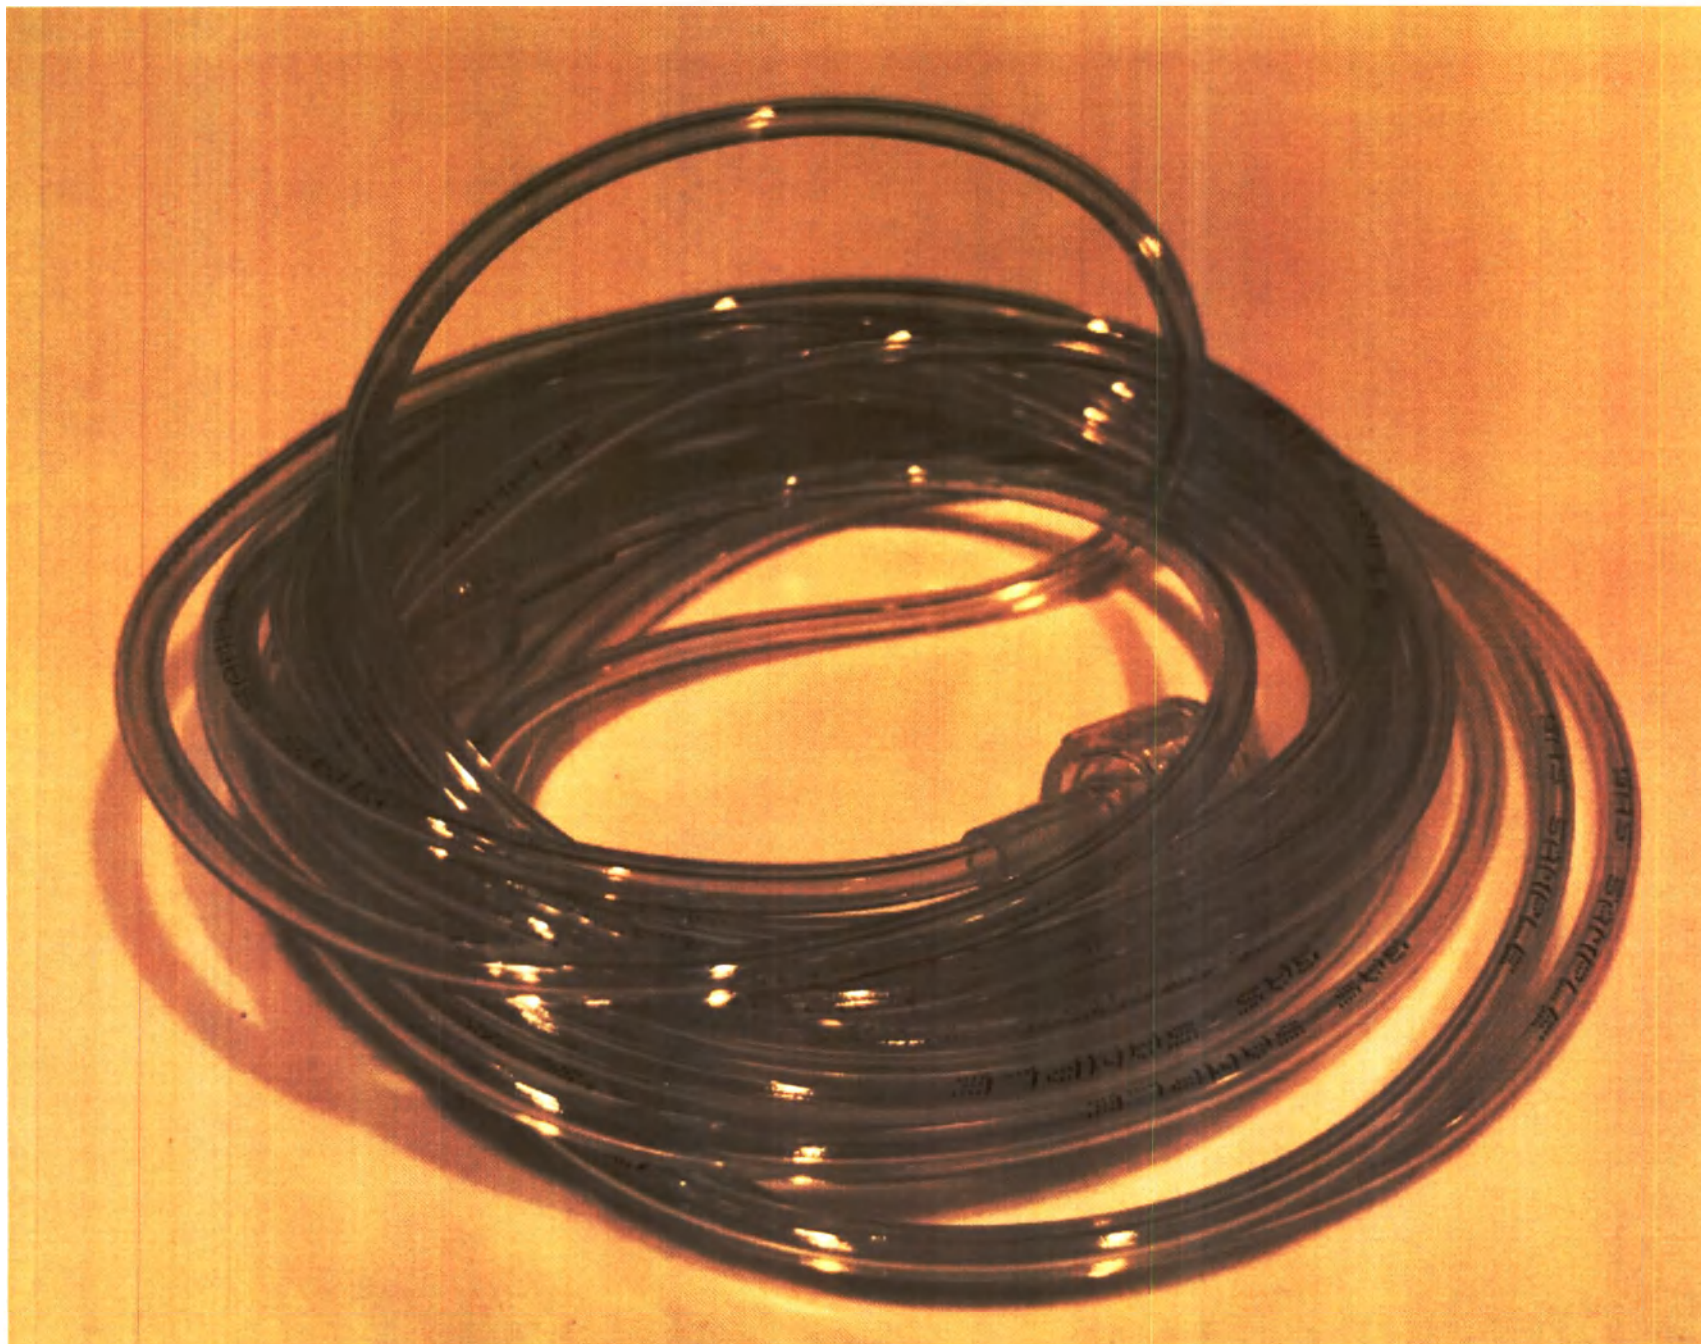


Фото 69. Заглушка для газового модуля

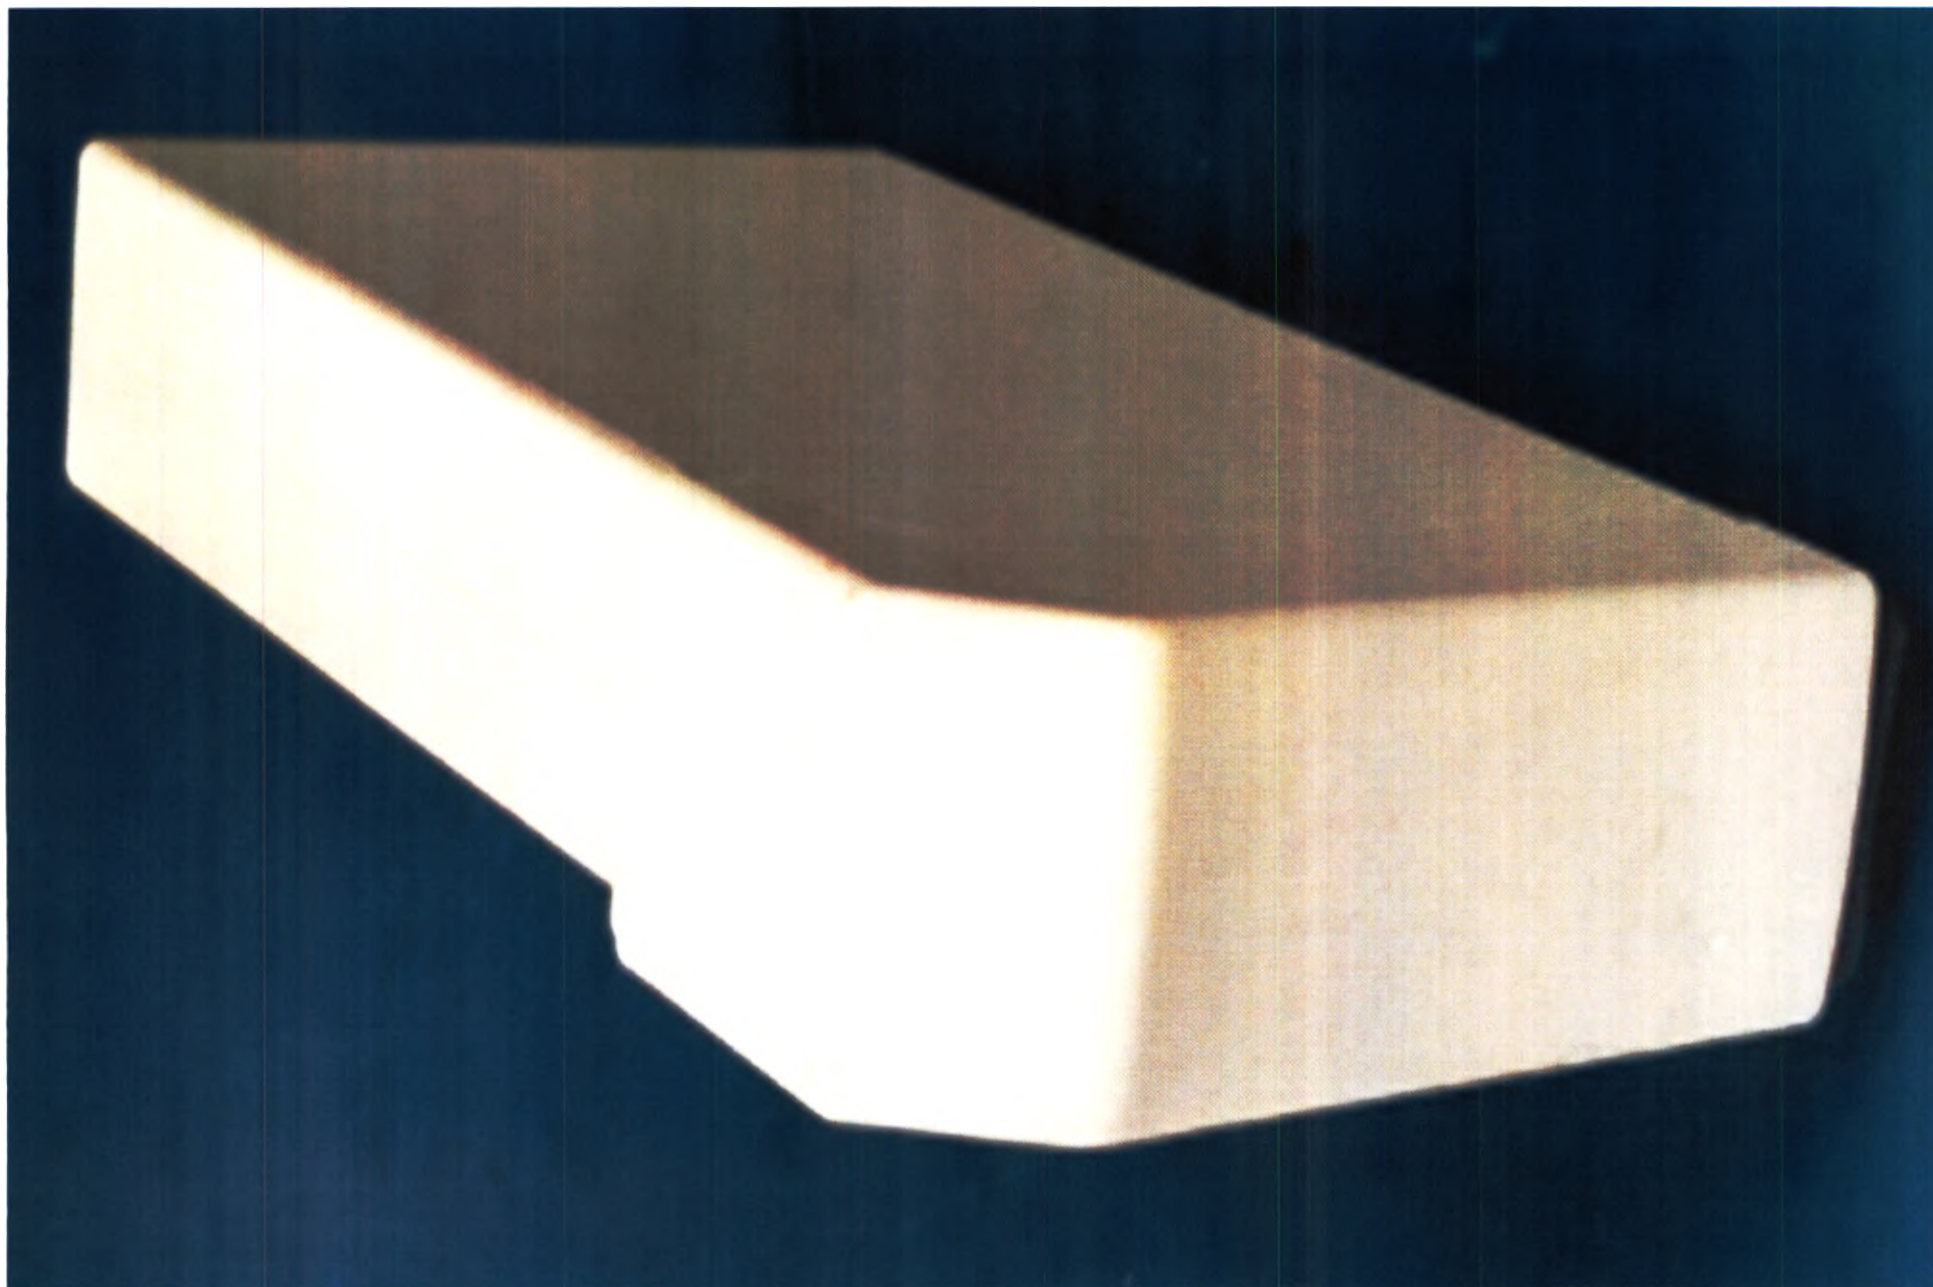


Фото 70. Газовые модули (E-miniC)

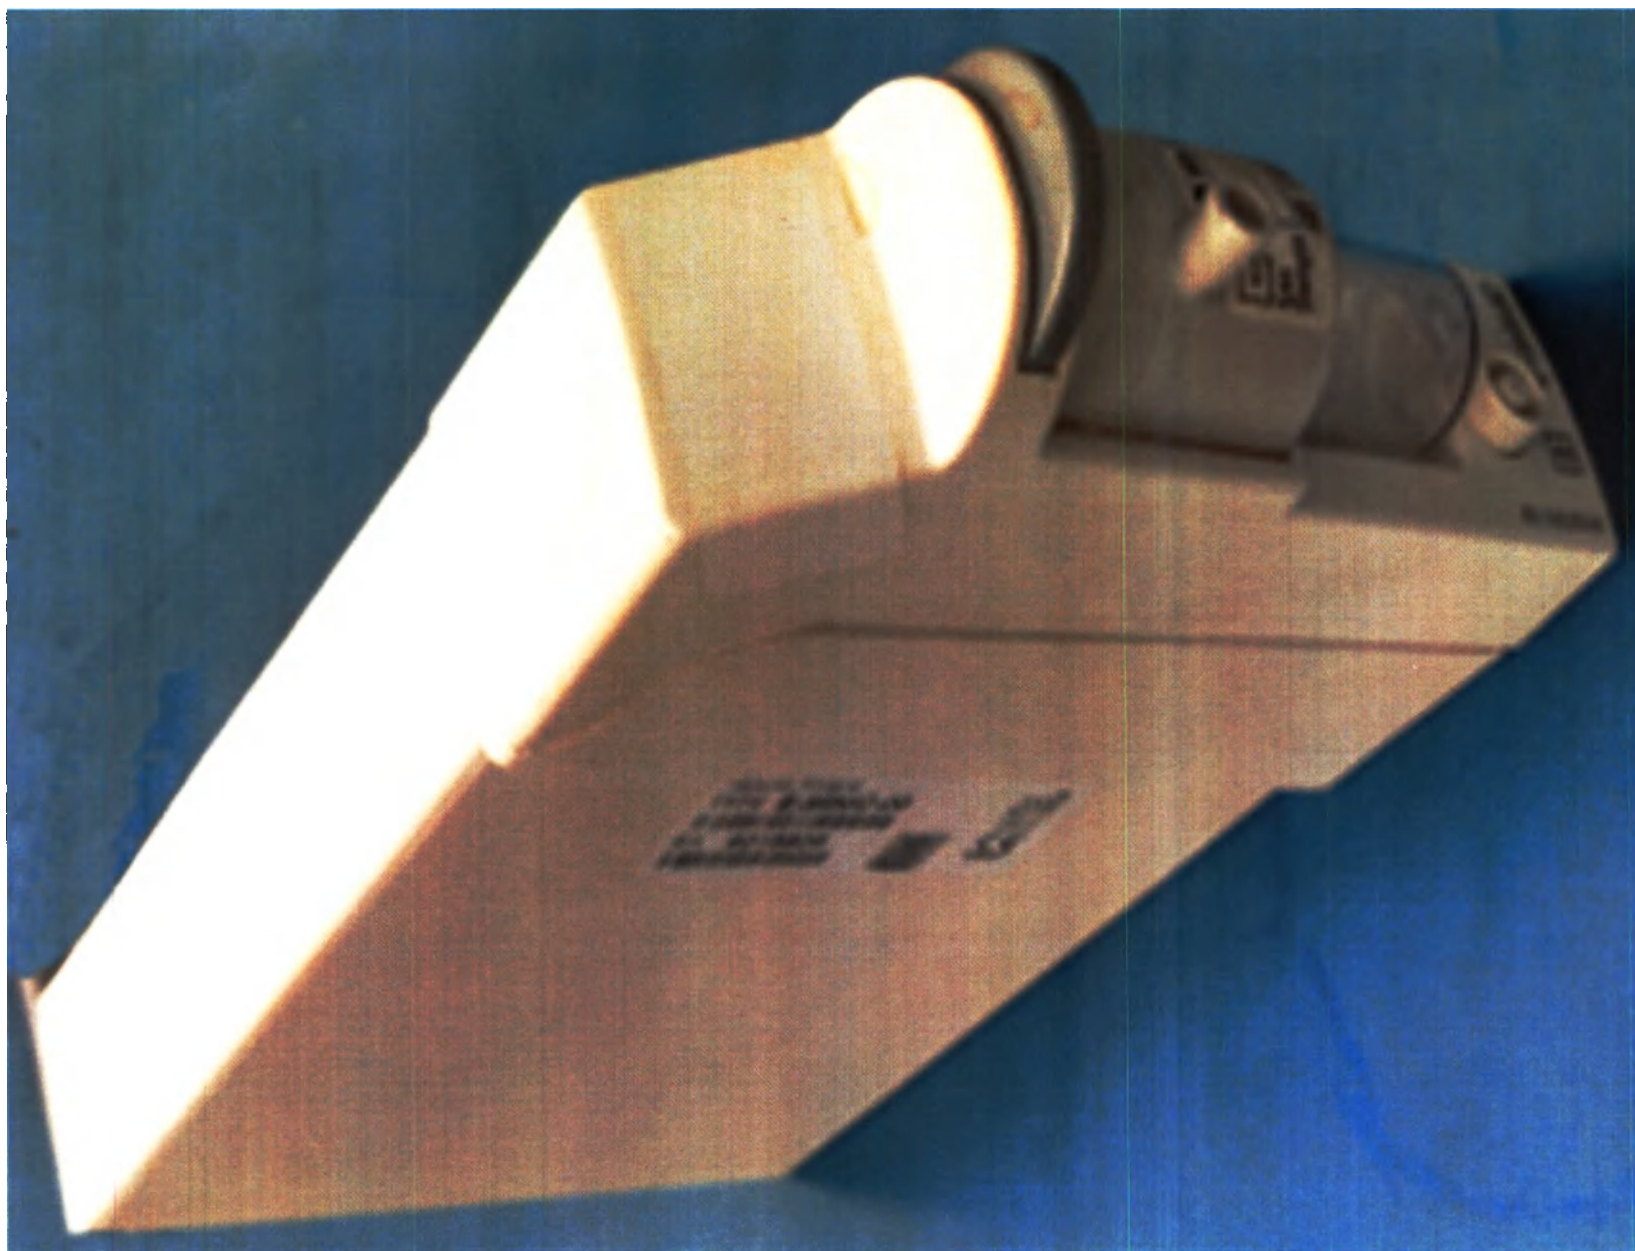


Фото 71. Газовые модули (E-sCOVX)

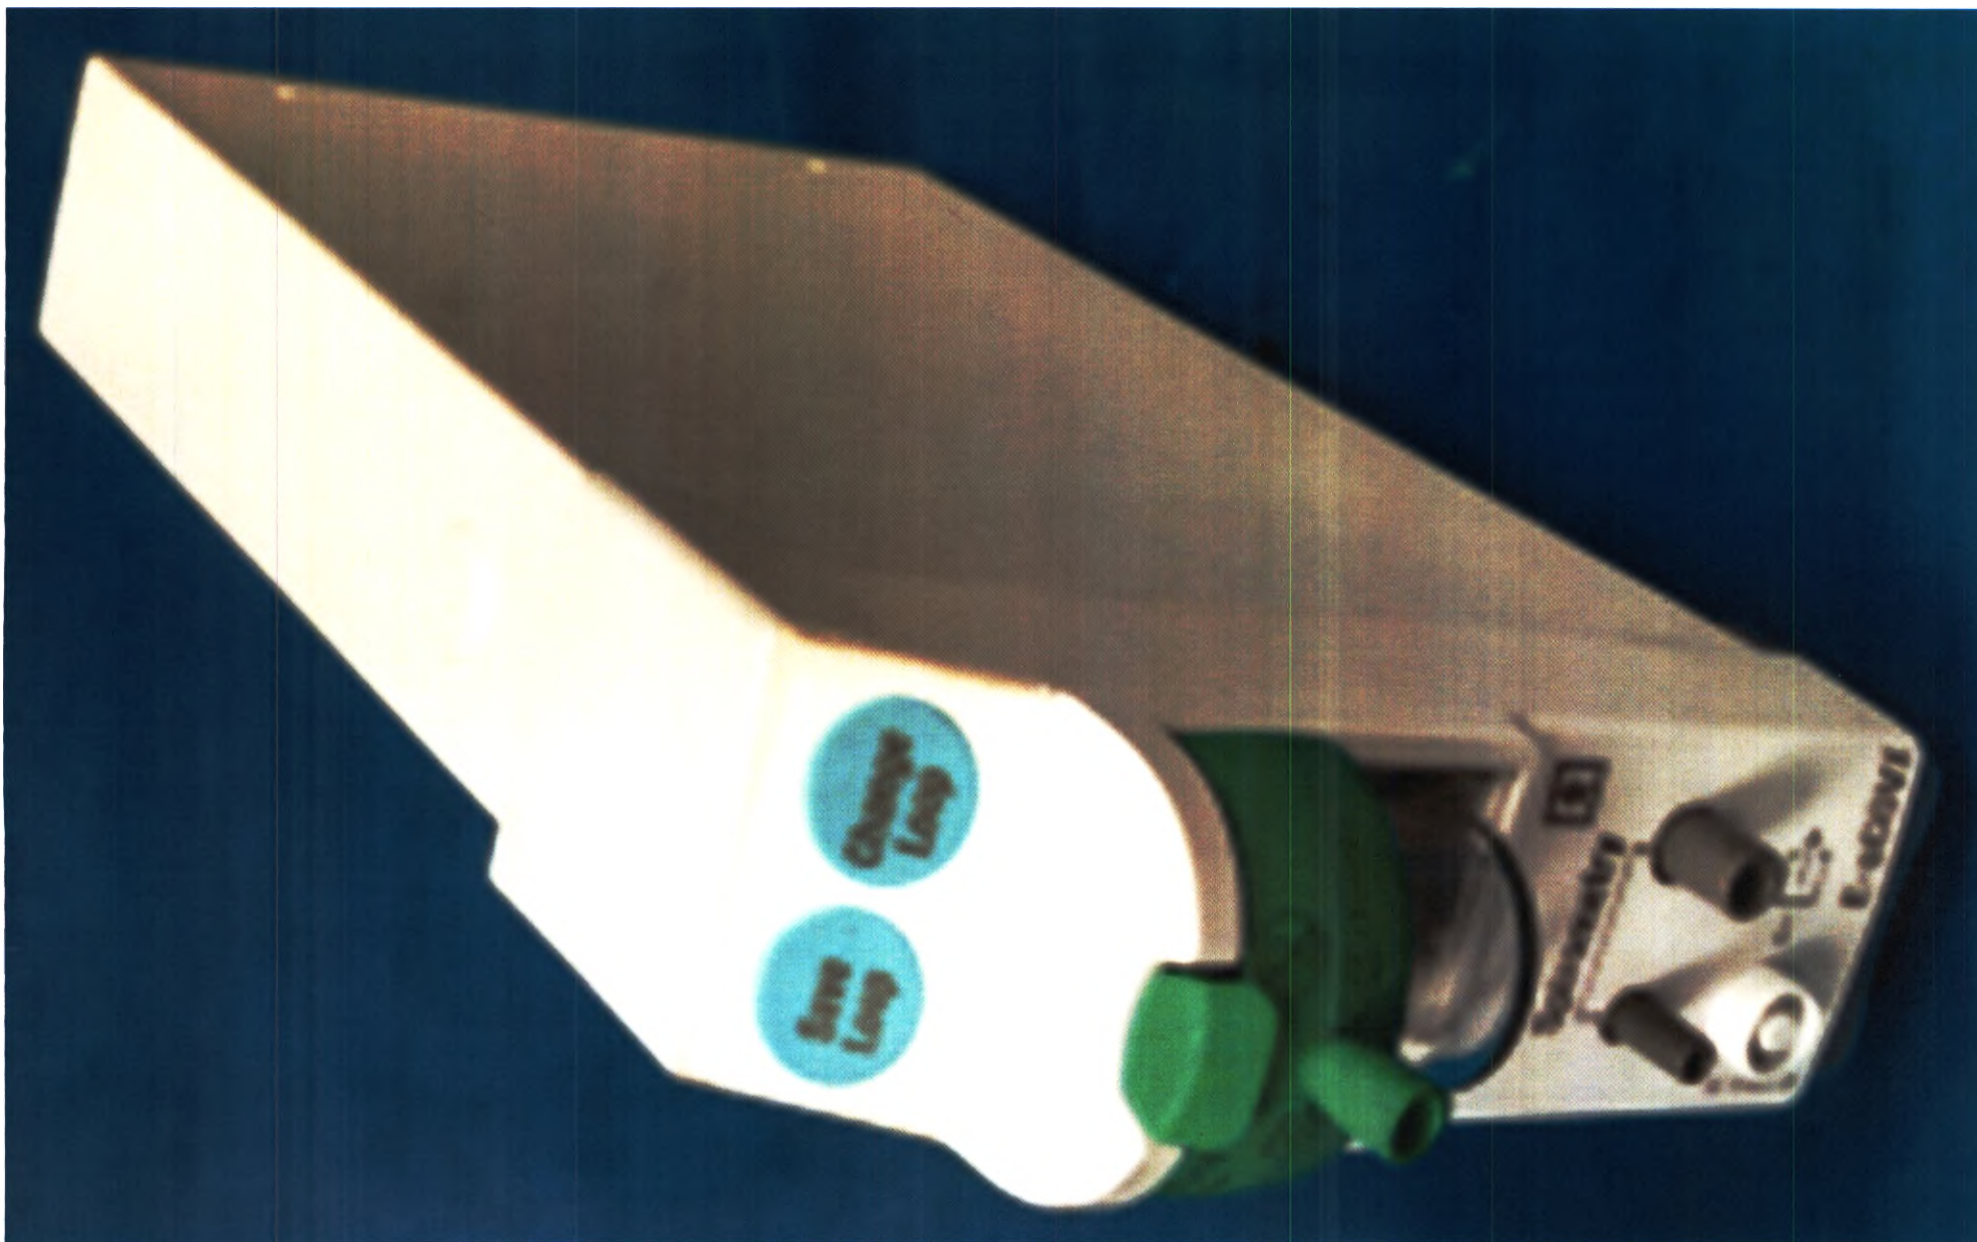


Фото 72. Газовые модули (E-sCO)



Фото 73. Газовые модули (E-sCOV)

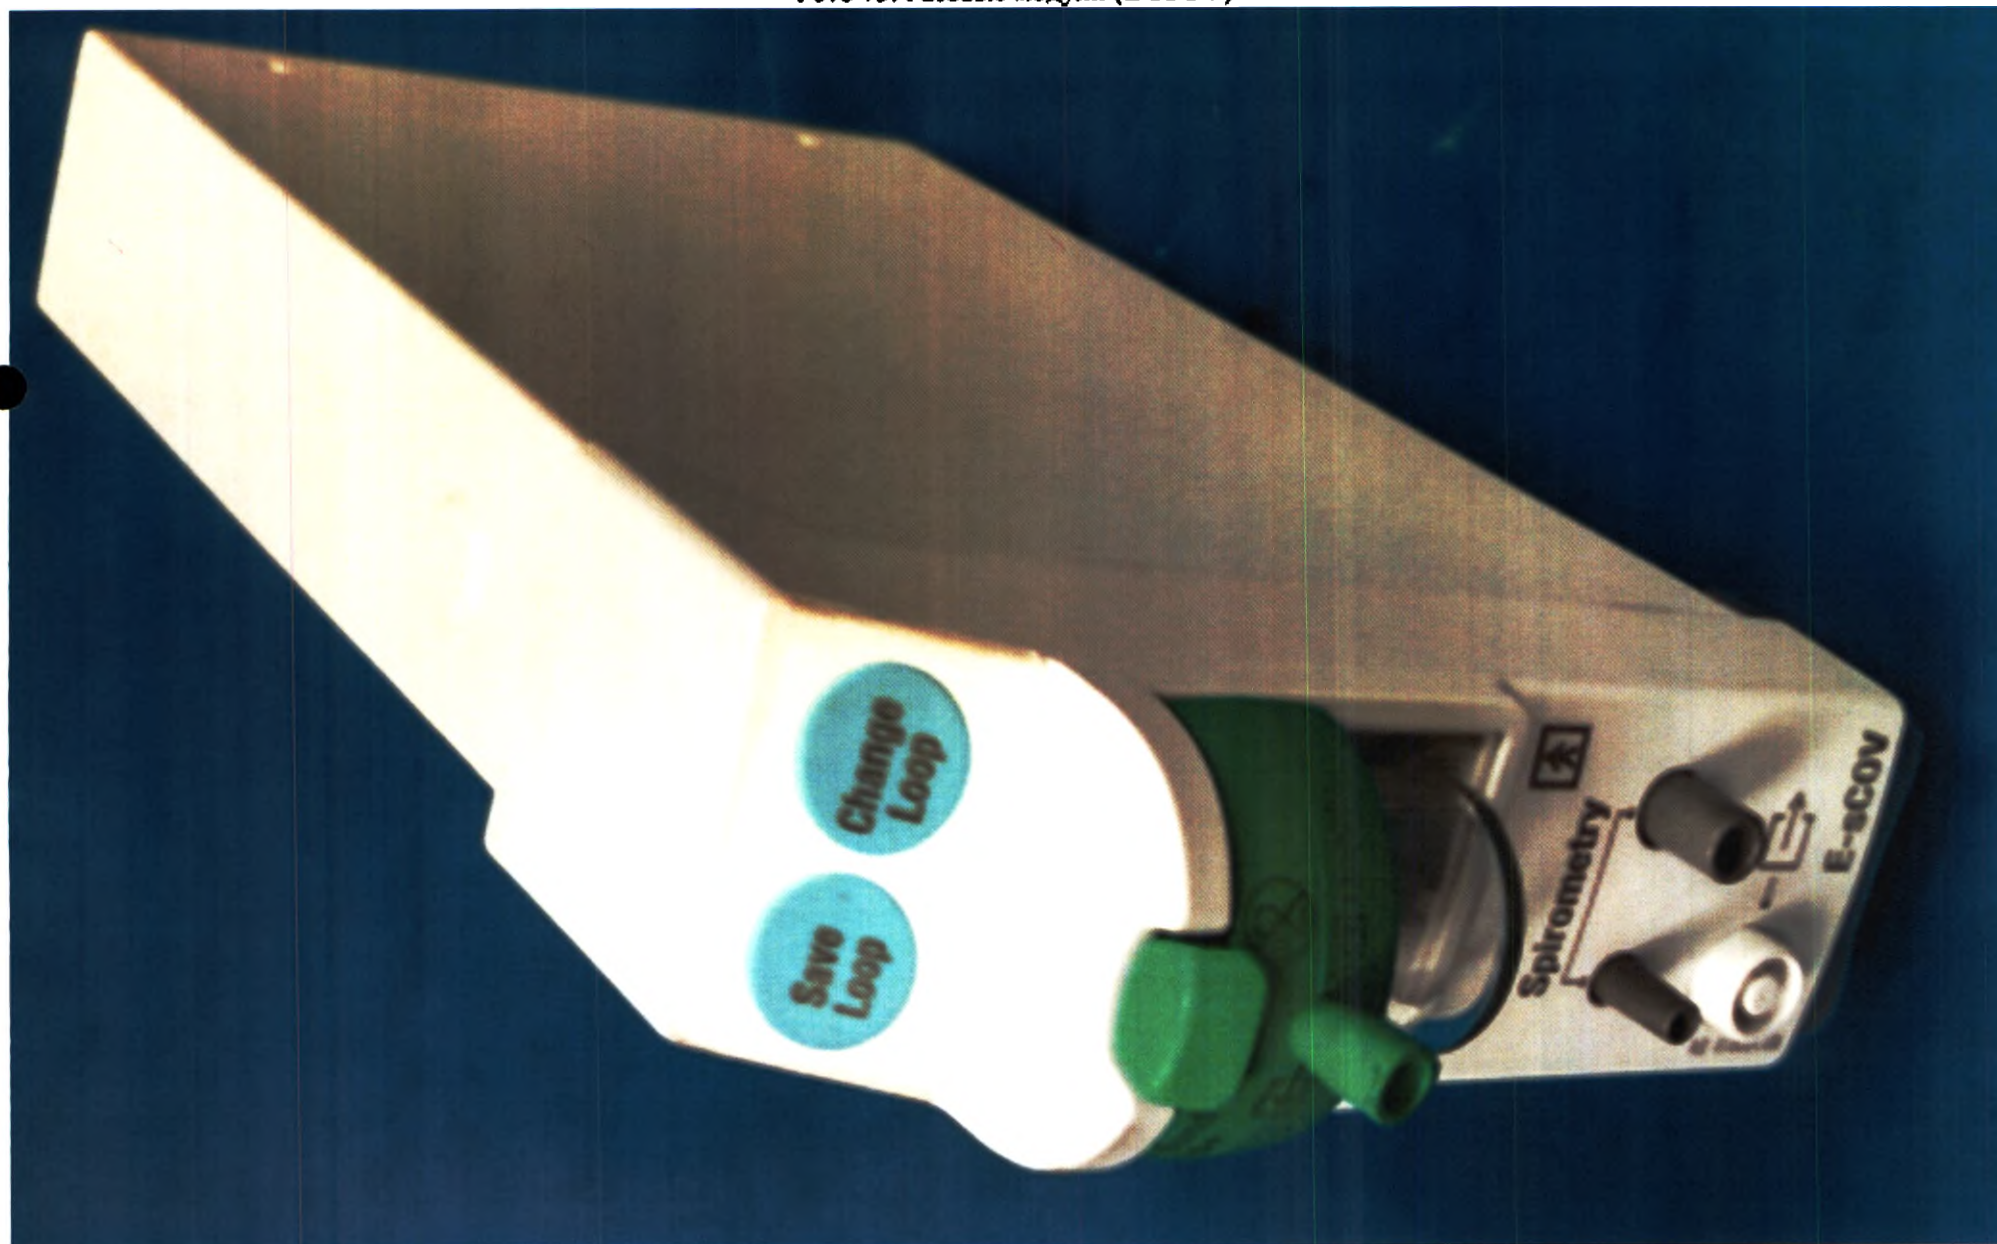


Фото 74. Газовые модули (E-sCAiO)

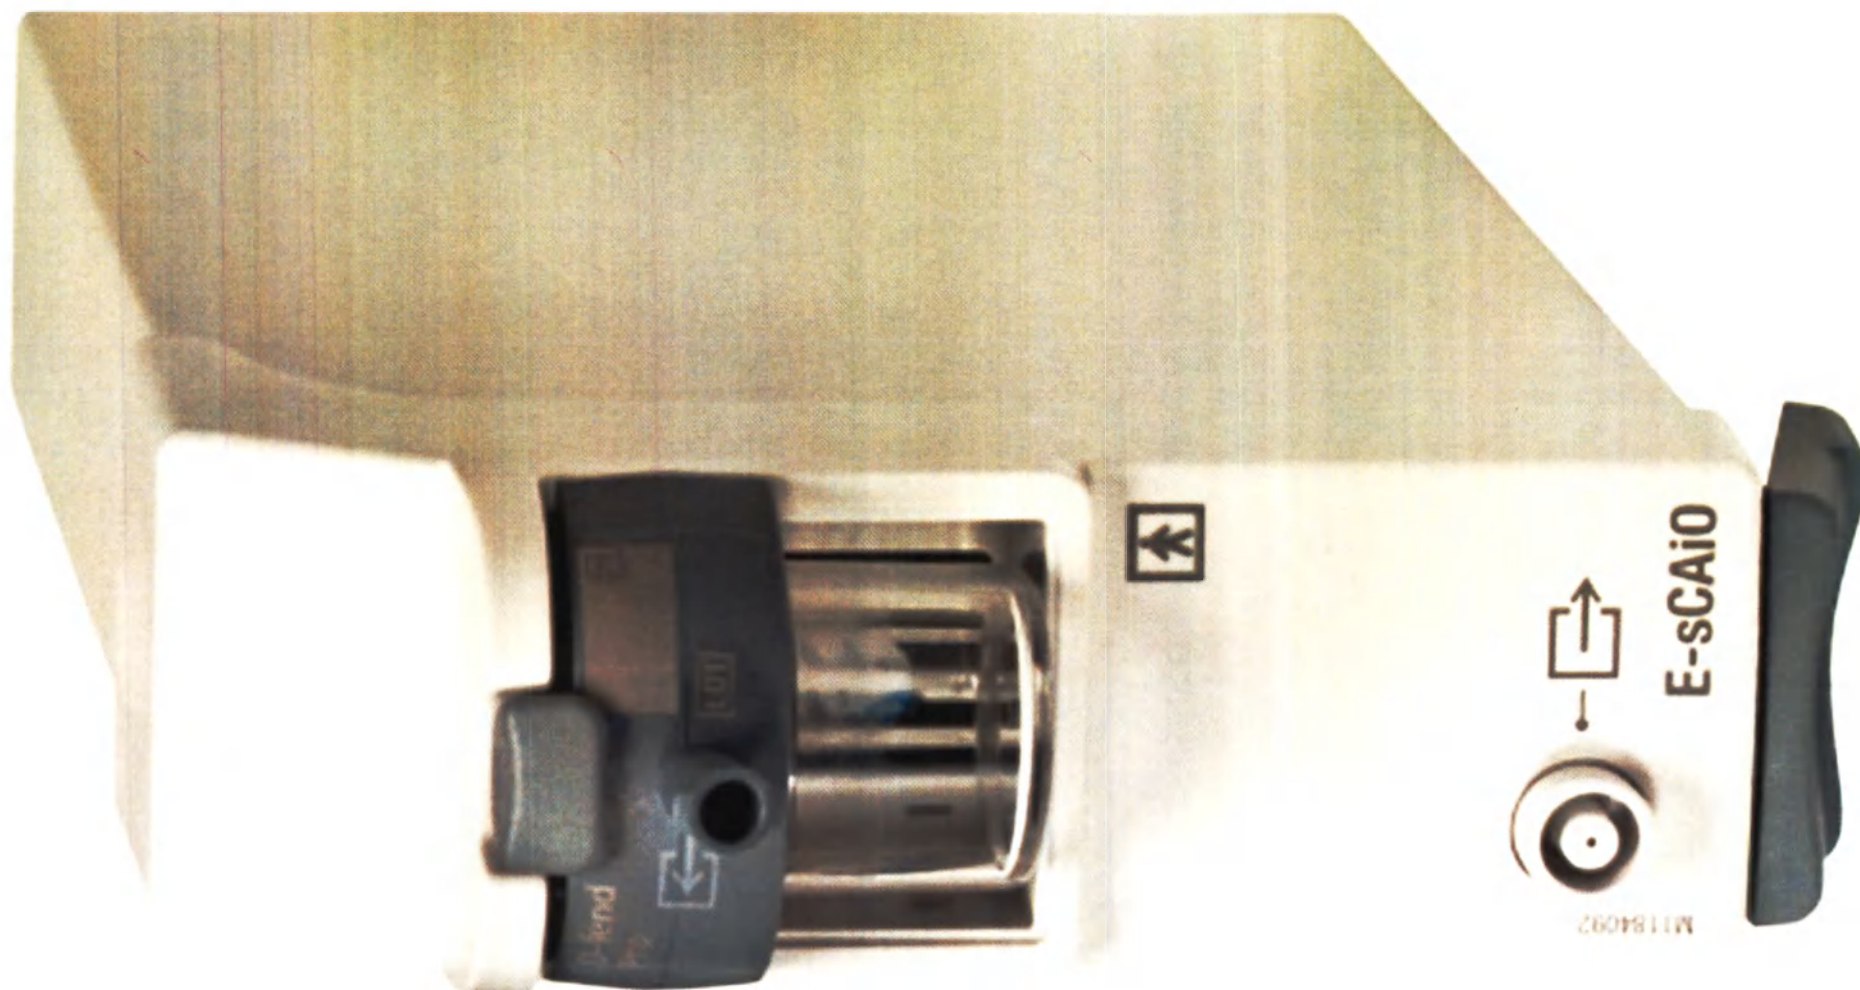


Фото 75. Газовые модули (E-sCAiOV)



Фото 76. Газовые модули (E-sCAiOVX)



Фото 77. Датчики потока многоразовые

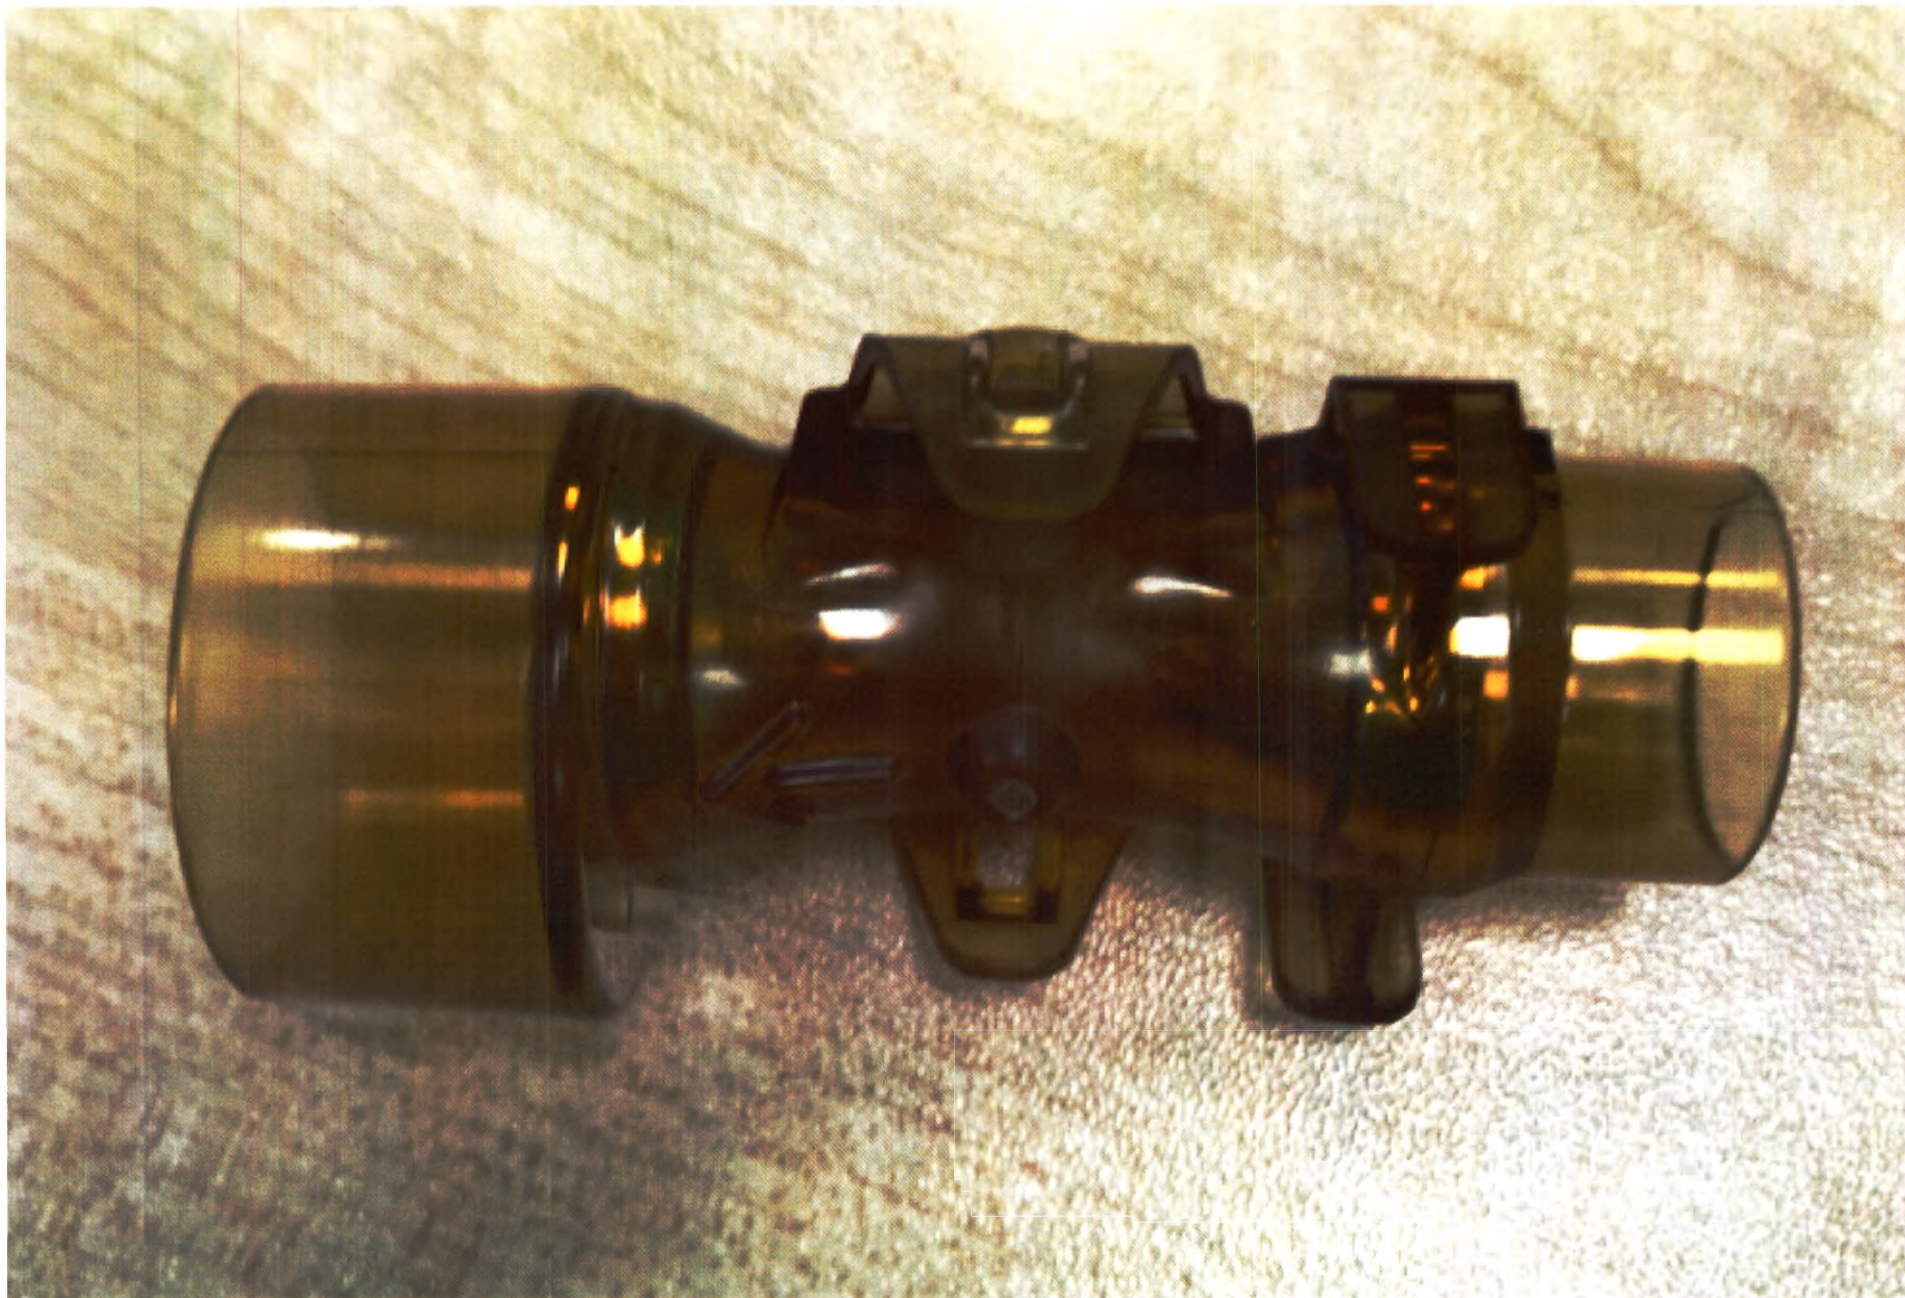


Фото 78. Нагреватели клапана выдоха

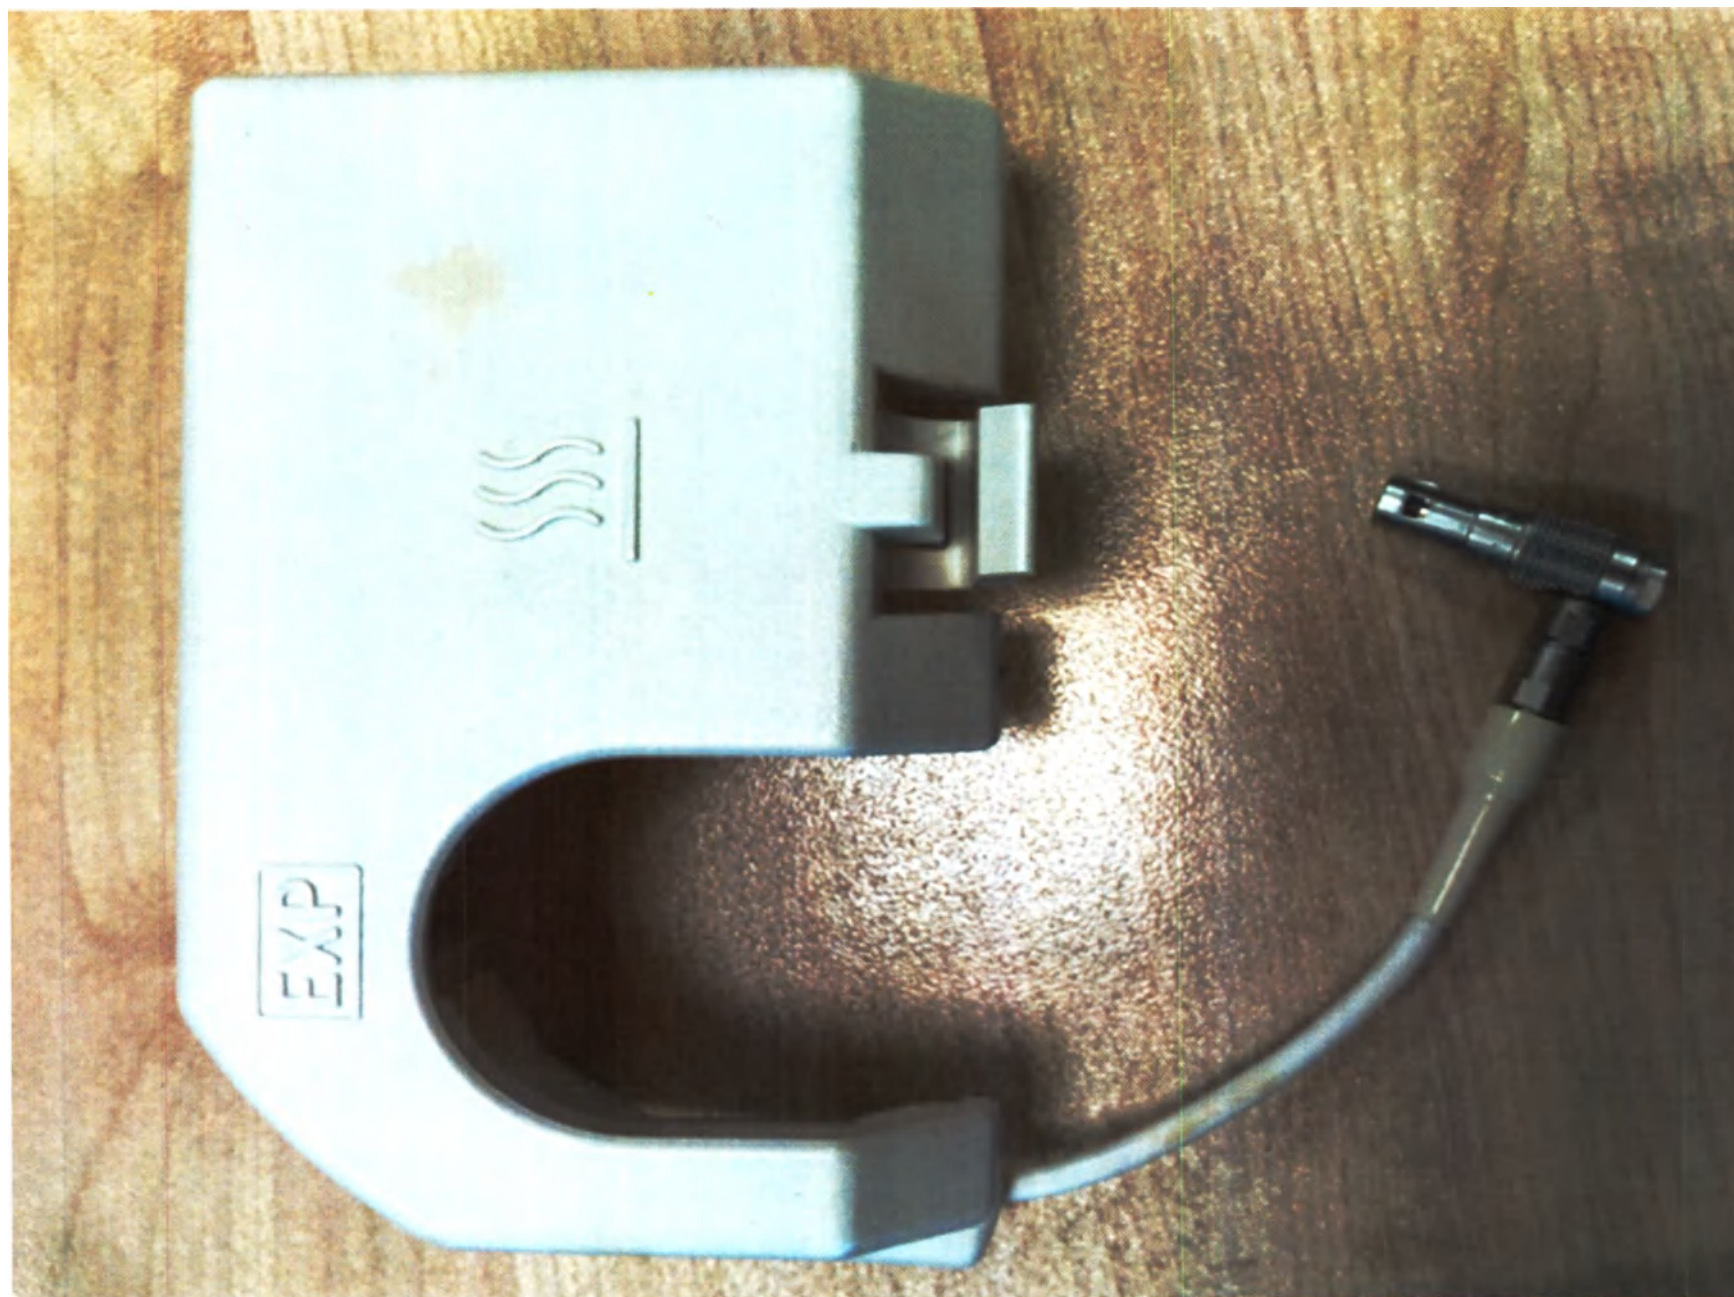


Фото 79. Кабели нагревателя клапана выдоха

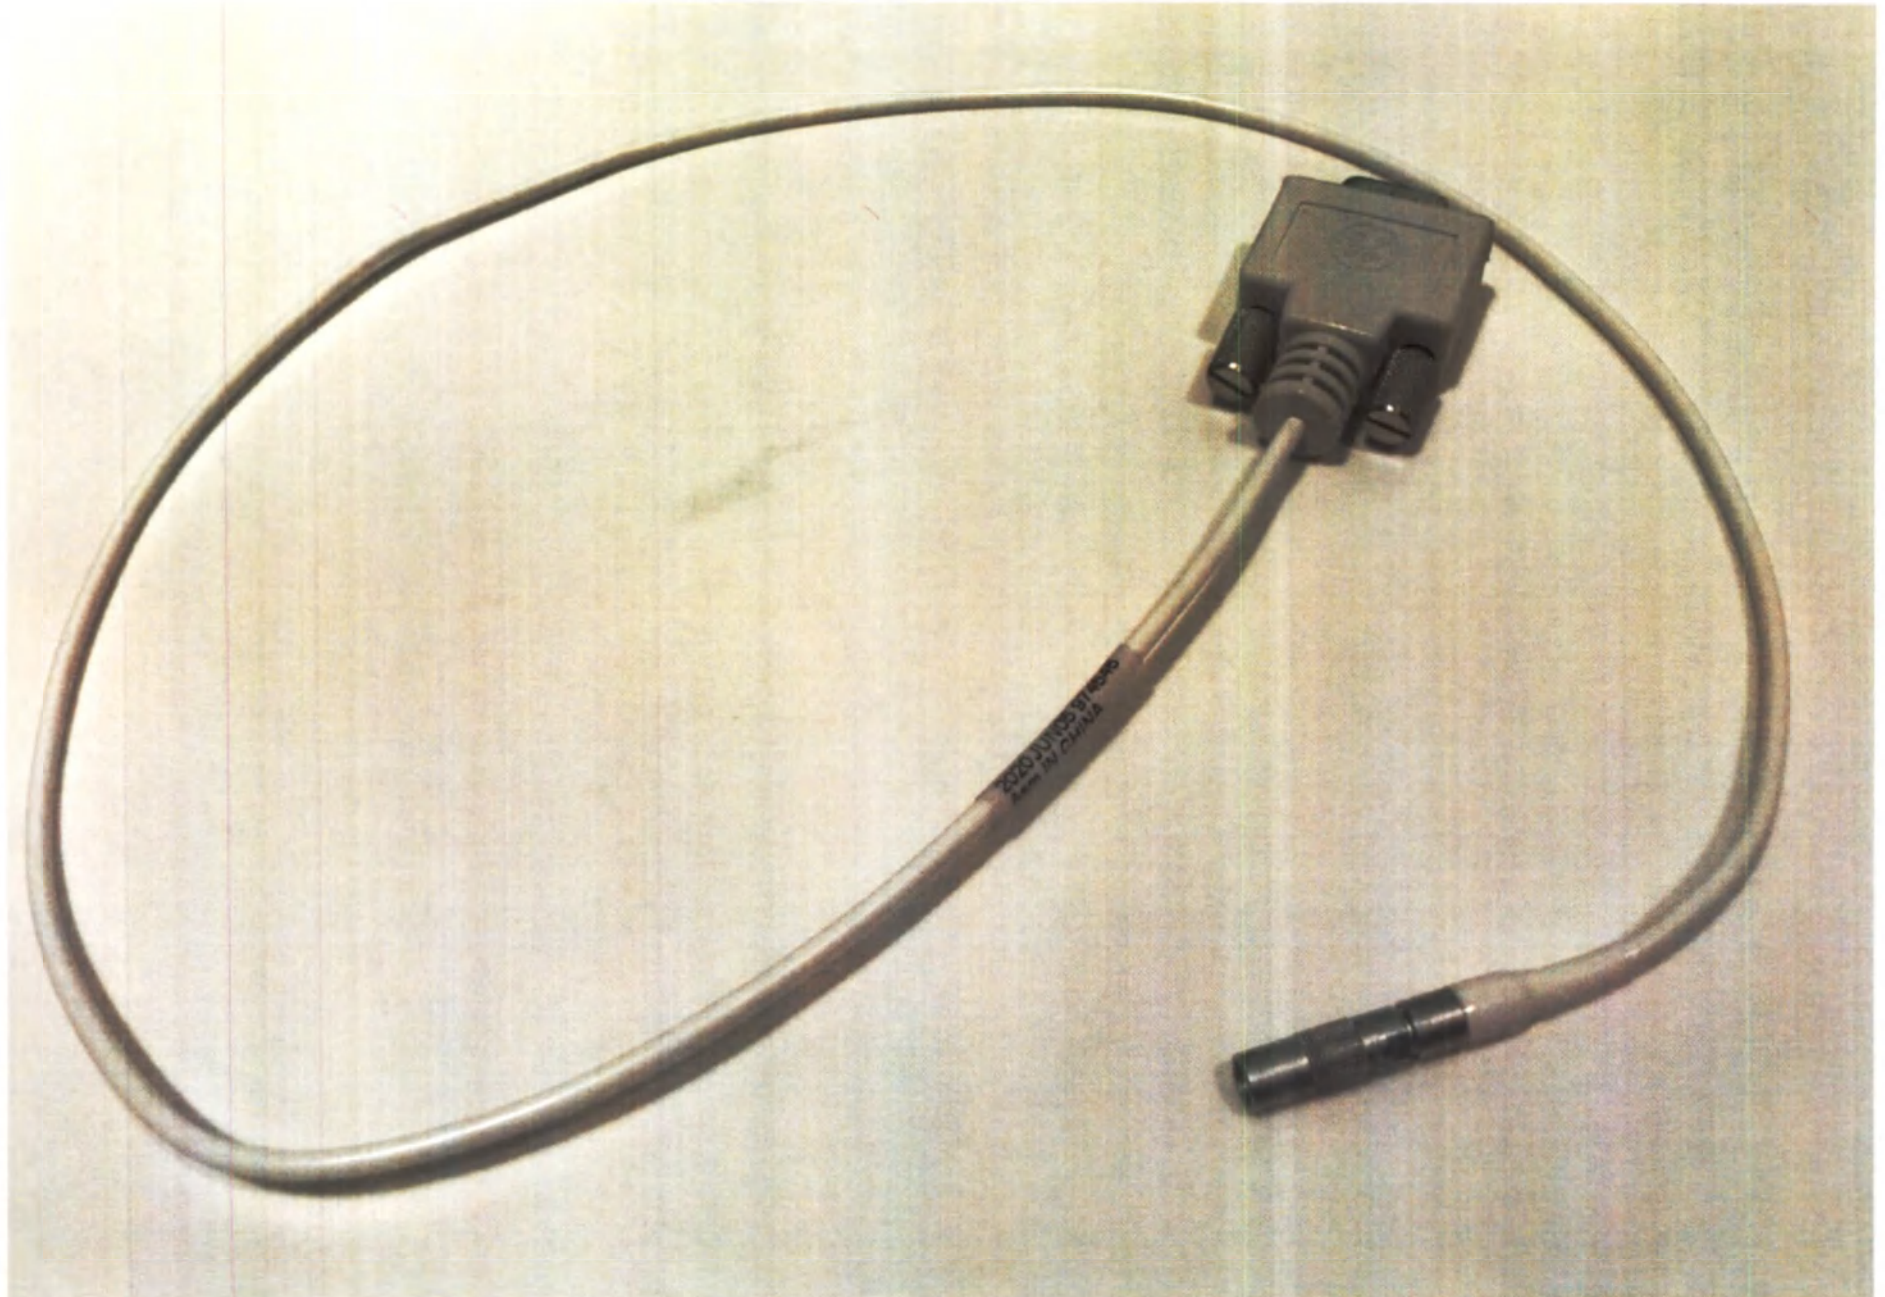


Фото 80. Кабель для подключения неонатального датчика потока



Фото 81. Неонатальный датчик потока



Фото 82. Тележка на колесах.

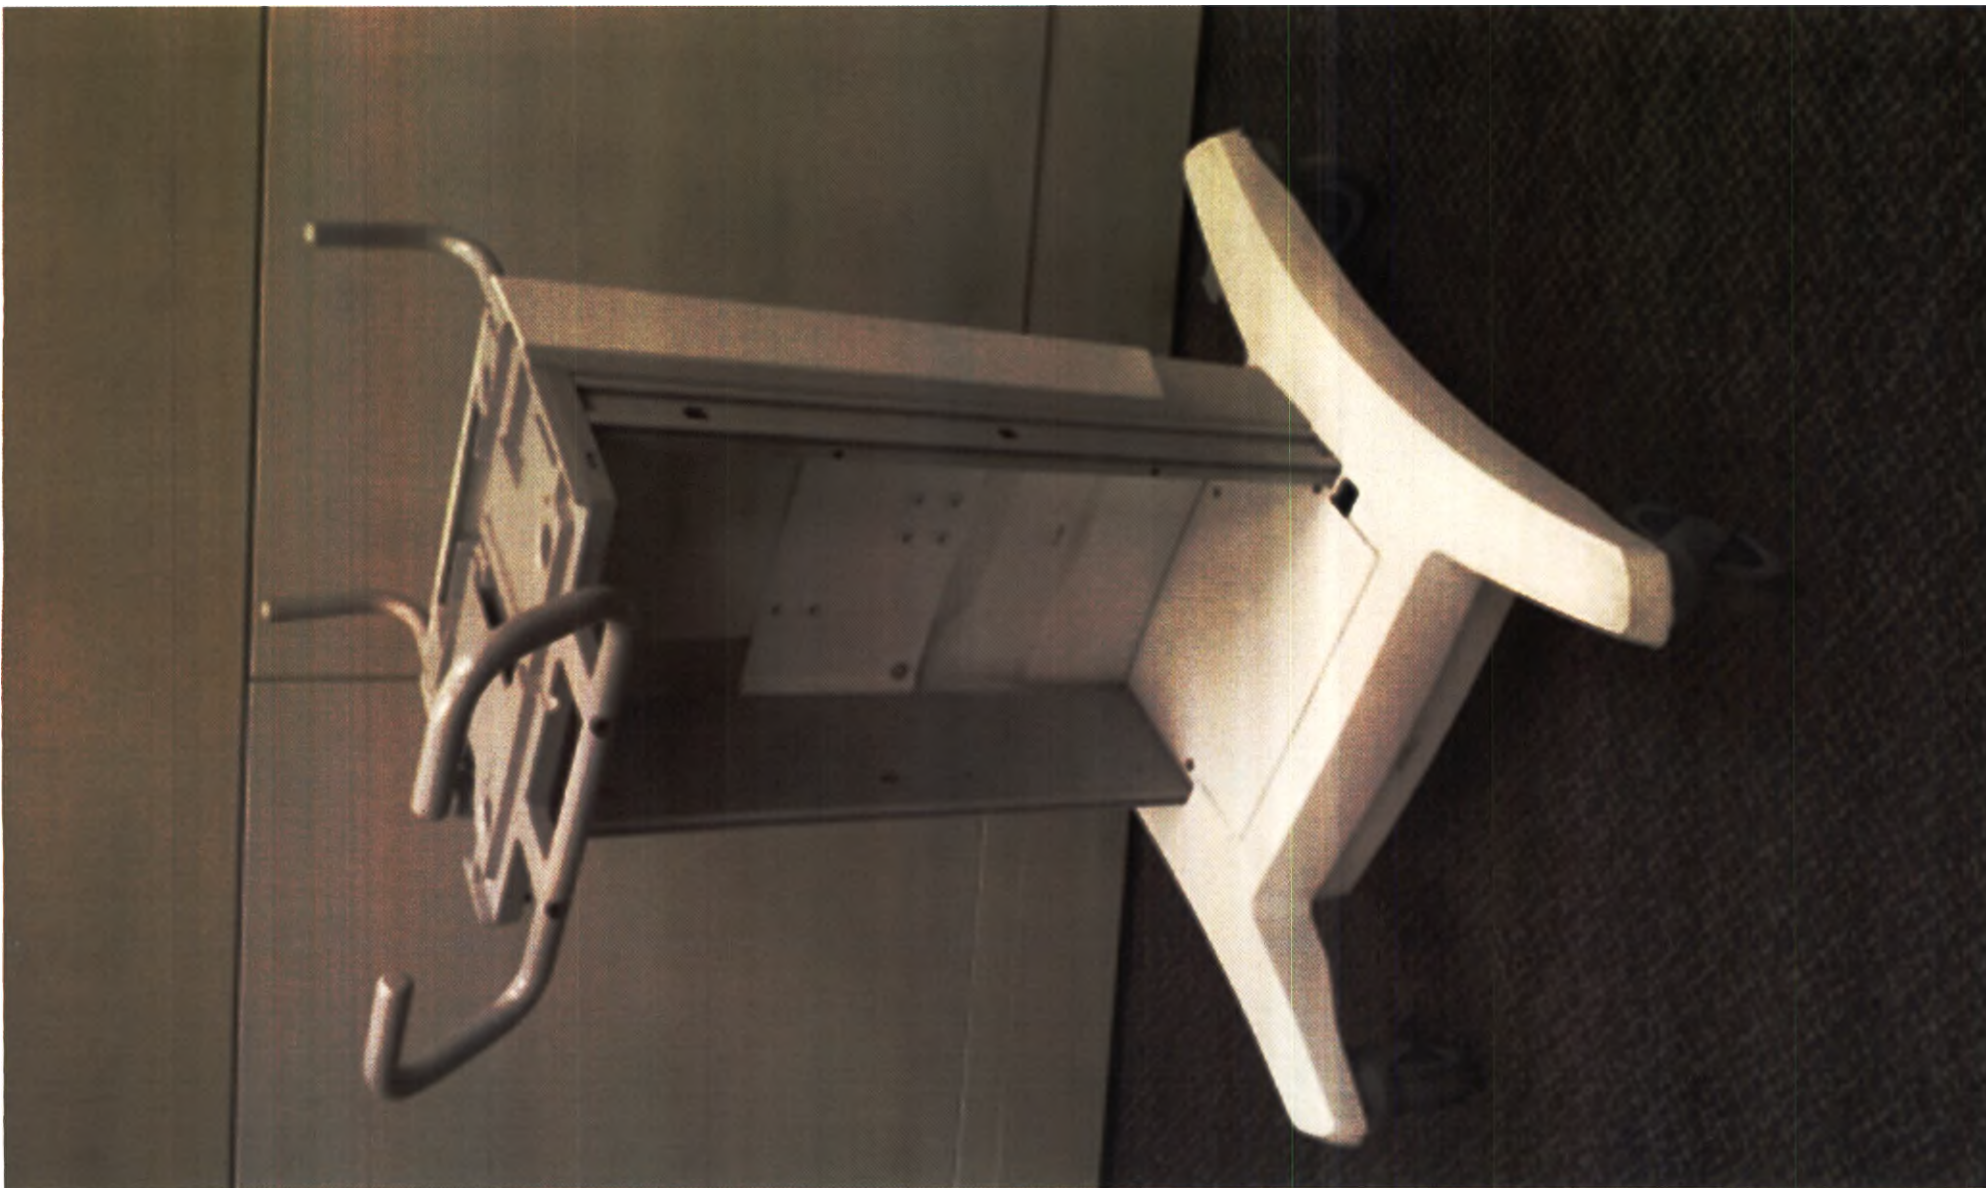


Фото 83. Тележка на колесах с задней панелью.



Фото 84. Тележка с блоком электророзеток.

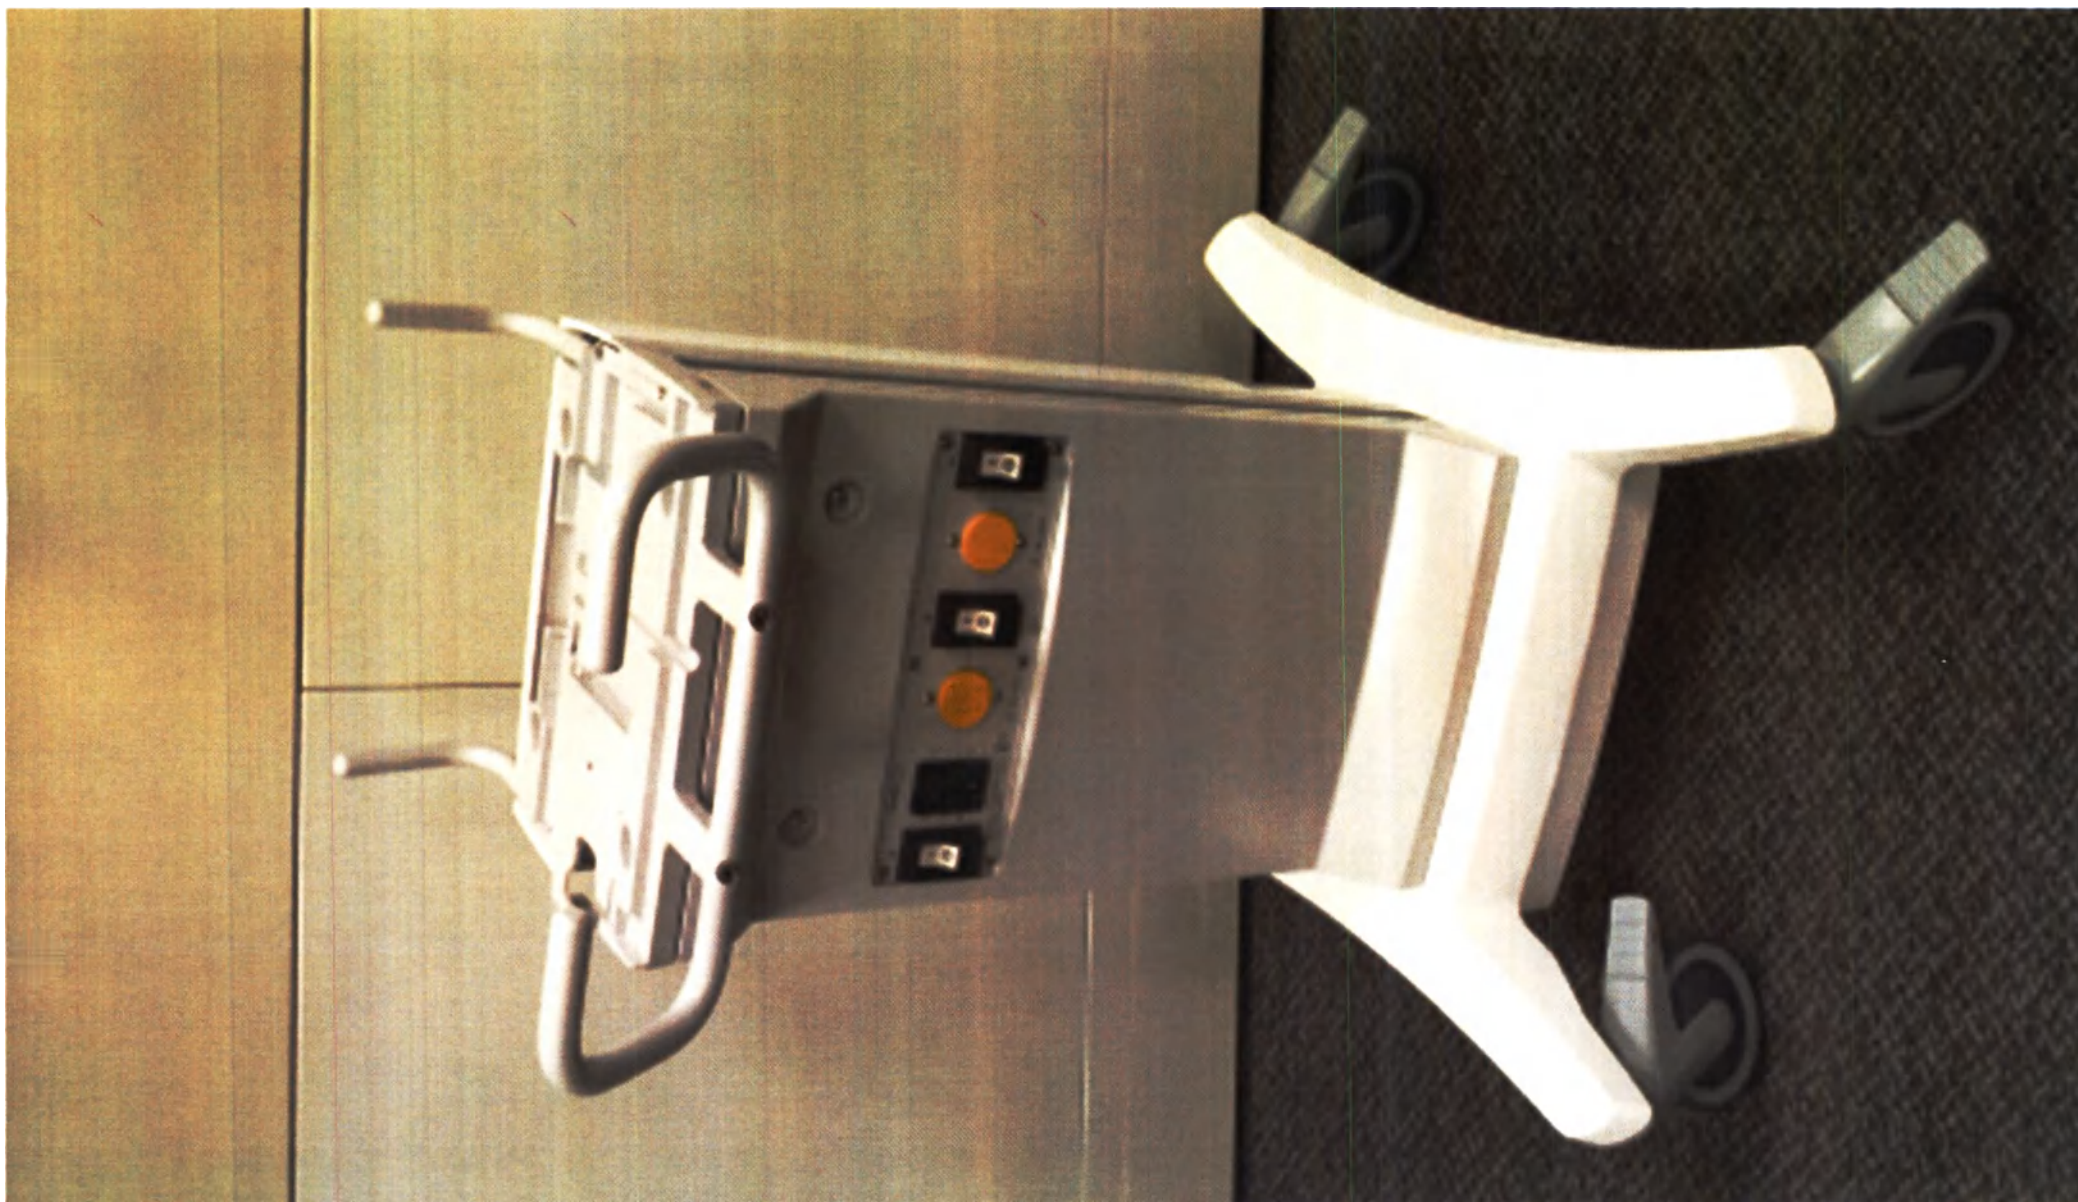


Фото 85. Крепление на консоль.

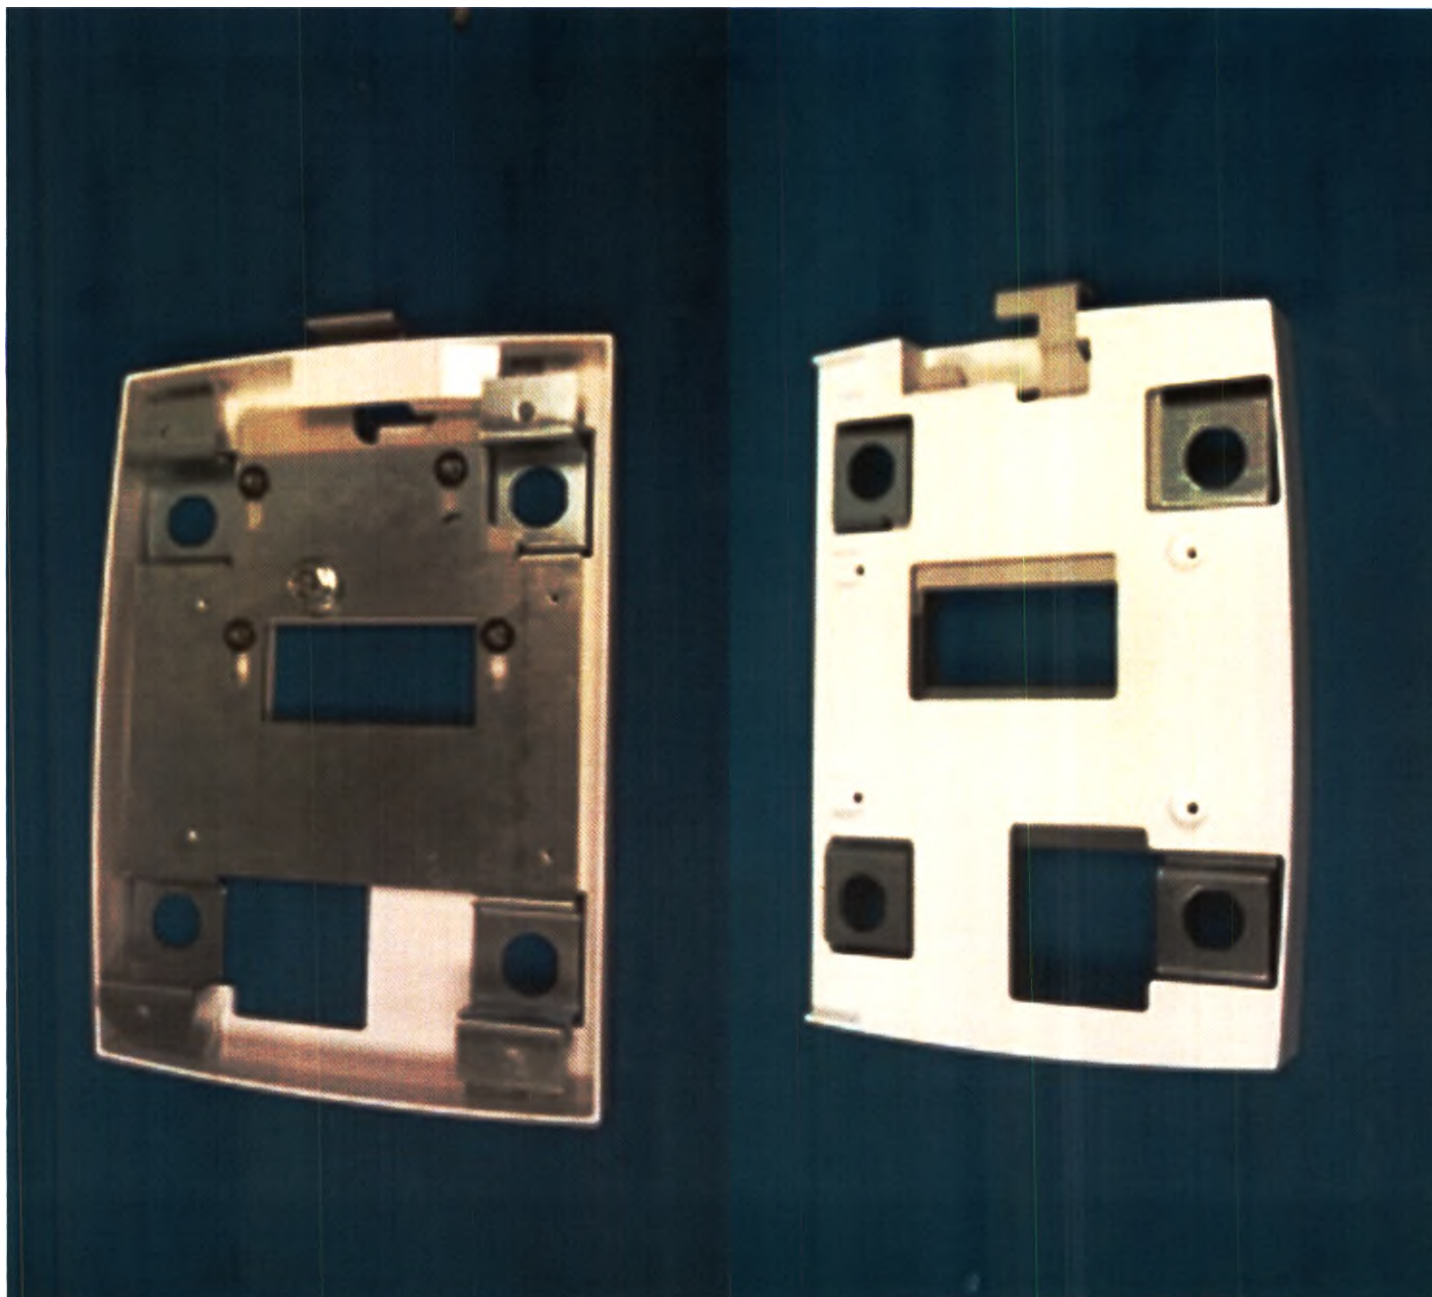


Фото 86. Провод для штепсельного разъема стандарта СЕЕ 7/7 АС.



Фото 87. Провод для штепсельного разъема тележки.



Фото 88. Тележка на колесах с компрессором.



Фото 89. Тележка на колесах с компрессором и розетками.

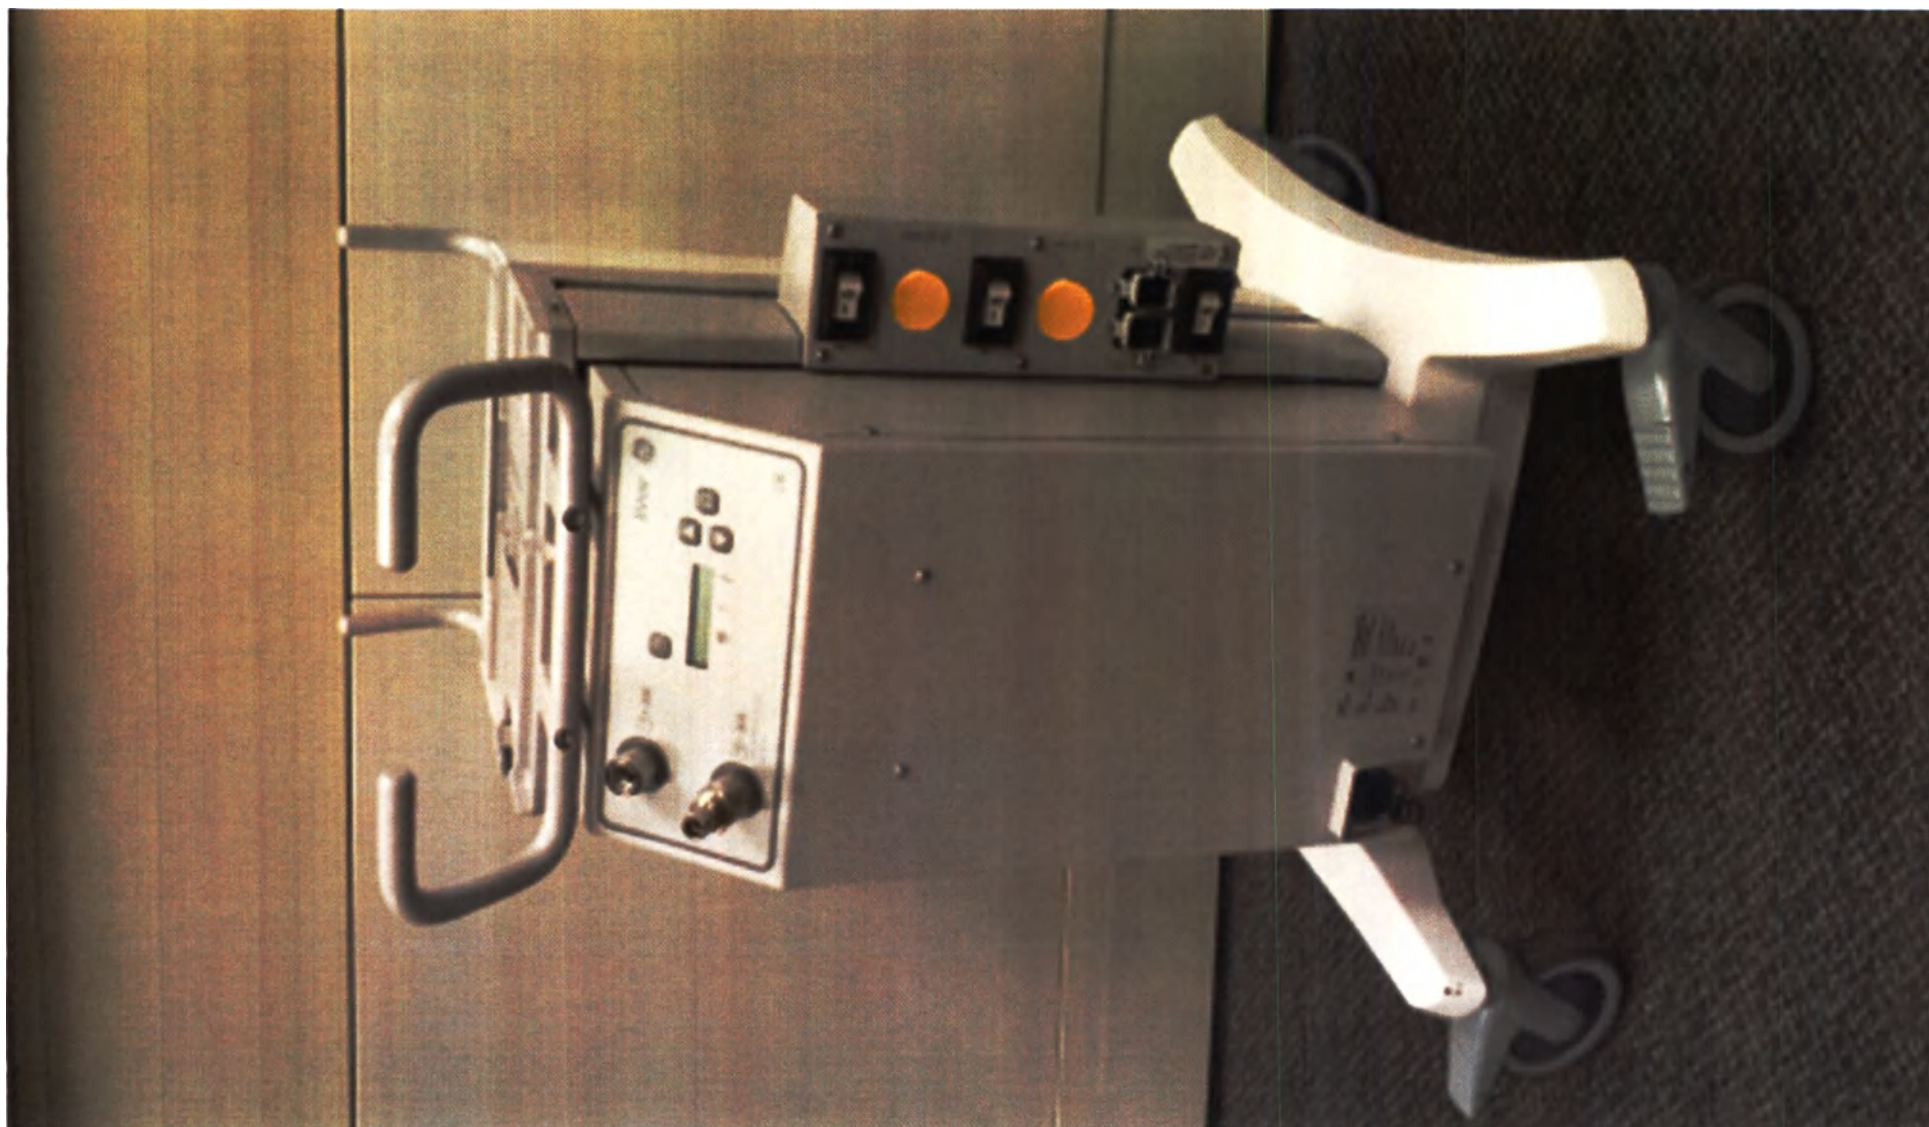


Фото 90. Медицинские компрессоры

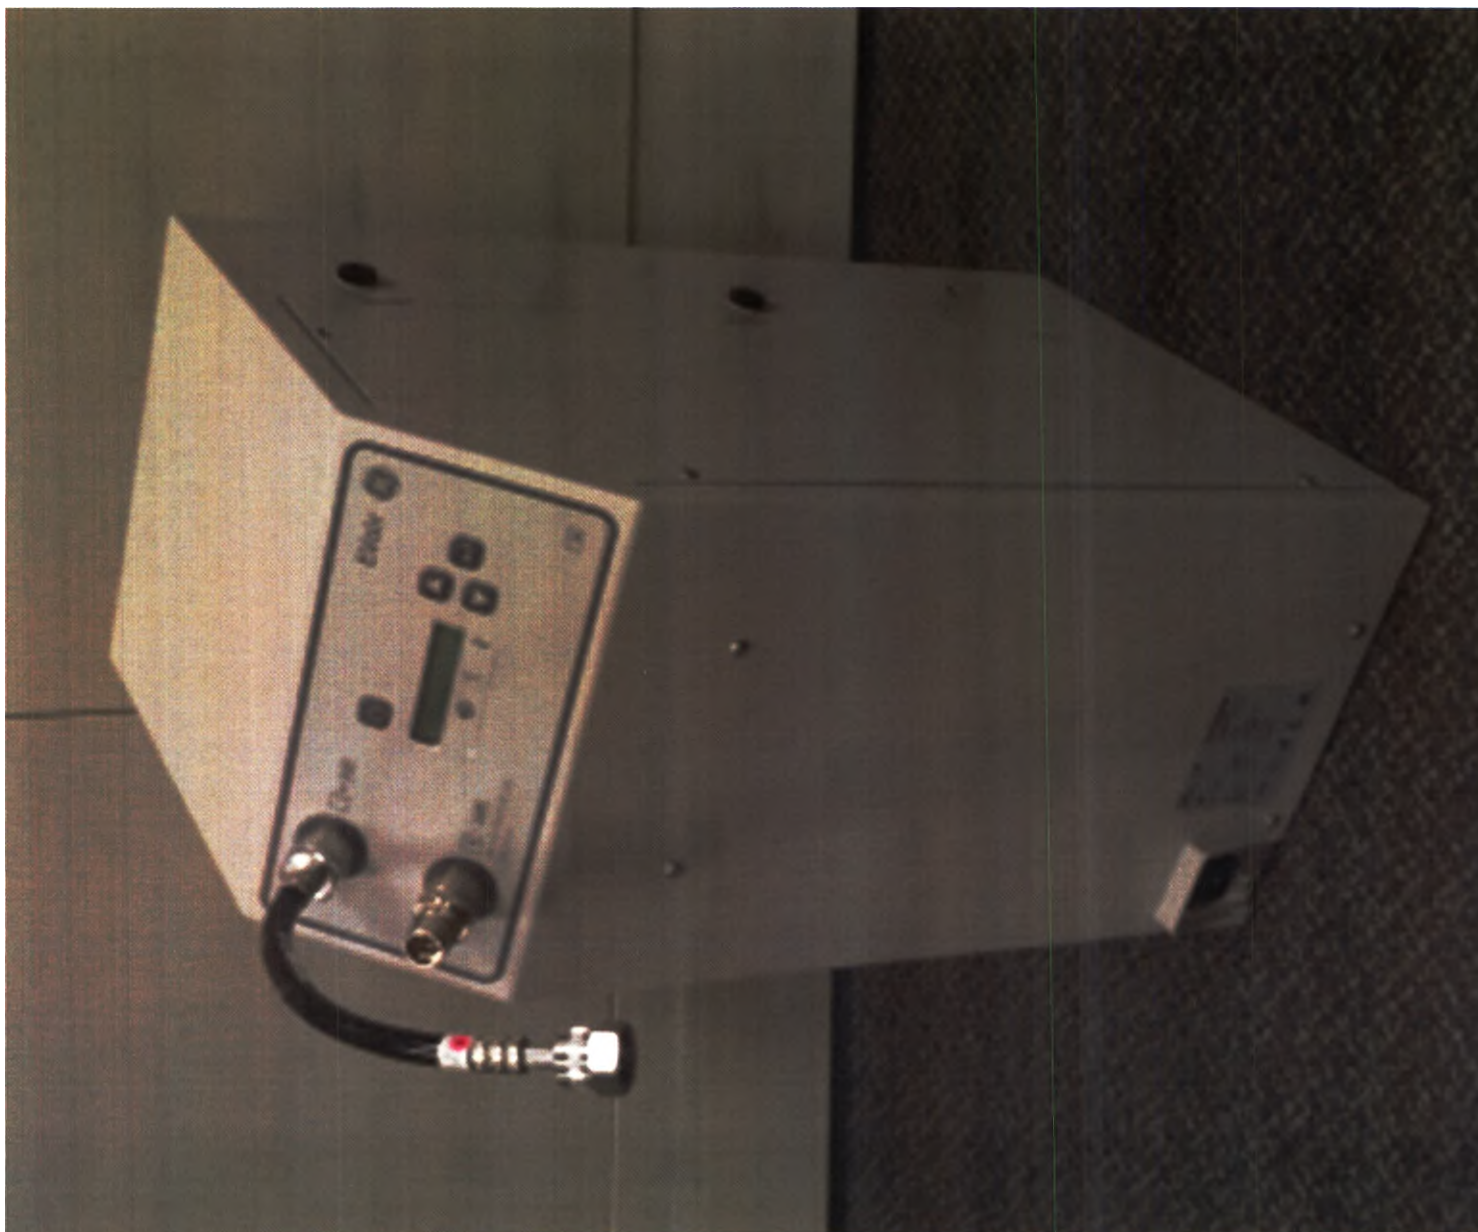


Фото 91. Электрическая конфигурация СЕЕ 7/7 медицинского компрессора.



Фото 92. Шланги для подачи кислорода

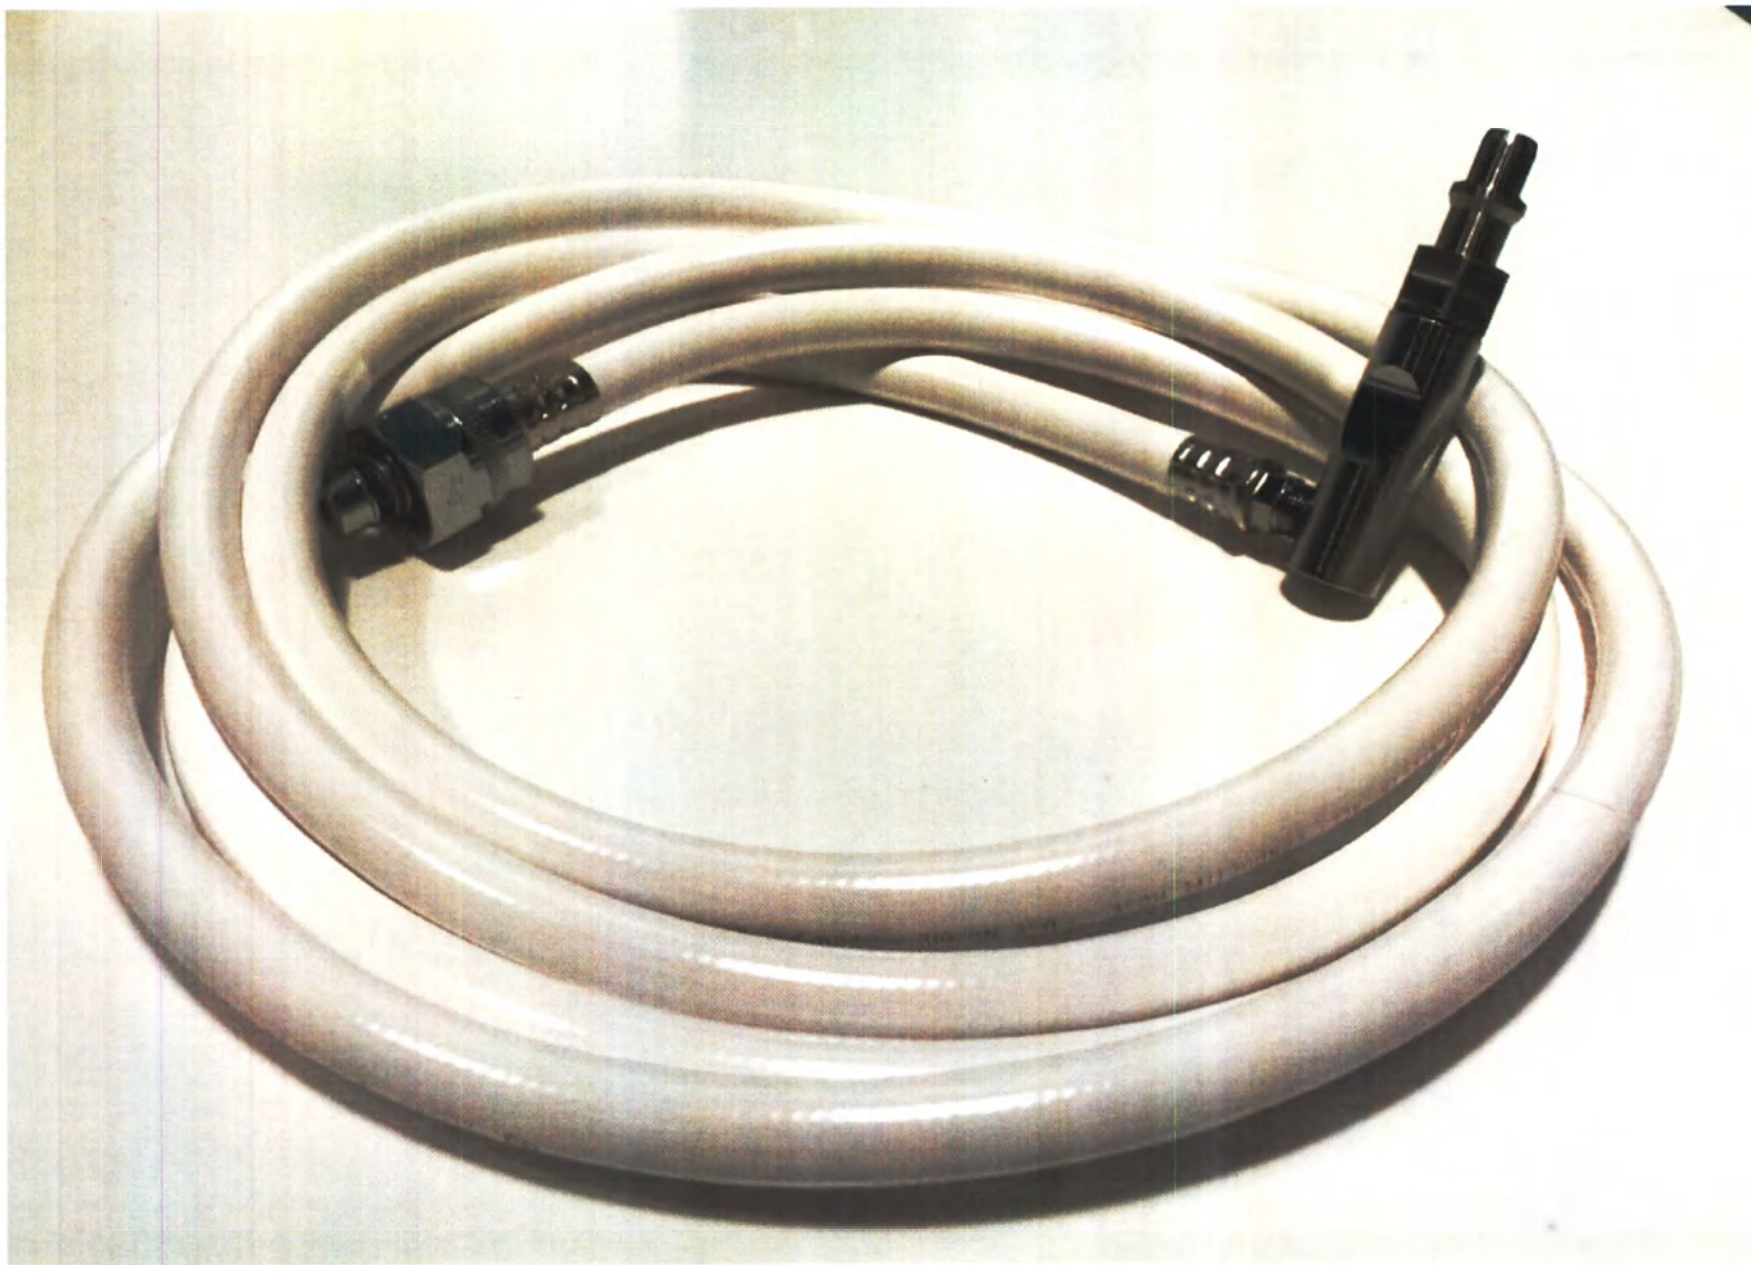


Фото 93. Шланги для подачи воздуха



Фото 94. Карта для активации программного обеспечения VS на оптическом или электронном носителе.



Фото 95. Карта для активации программного обеспечения NIV на оптическом или электронном носителе.



Фото 96. Карта для активации программного обеспечения НСРАР на оптическом или электронном носителе.



Фото 97. Карта для активации программного обеспечения APRV на оптическом или электронном носителе.



Фото 98. Карта для активации программного обеспечения BiLevel на оптическом или электронном носителе.



Фото 99. Карта для активации программного обеспечения SIMV-PRVC на оптическом или электронном носителе.



Фото 100. Карта для активации программного обеспечения BiLevel-VG на оптическом или электронном носителе.



Фото 101. Карта для активации программного обеспечения FRC на оптическом или электронном носителе.



Фото 102. Карта для активации программного обеспечения Spirodynamics на оптическом или электронном носителе.



Фото 103. Карта для активации программного обеспечения для новорожденных на оптическом или электронном носителе.



Фото 104. Адаптер для крепления увлажнителя и влагоотделителя

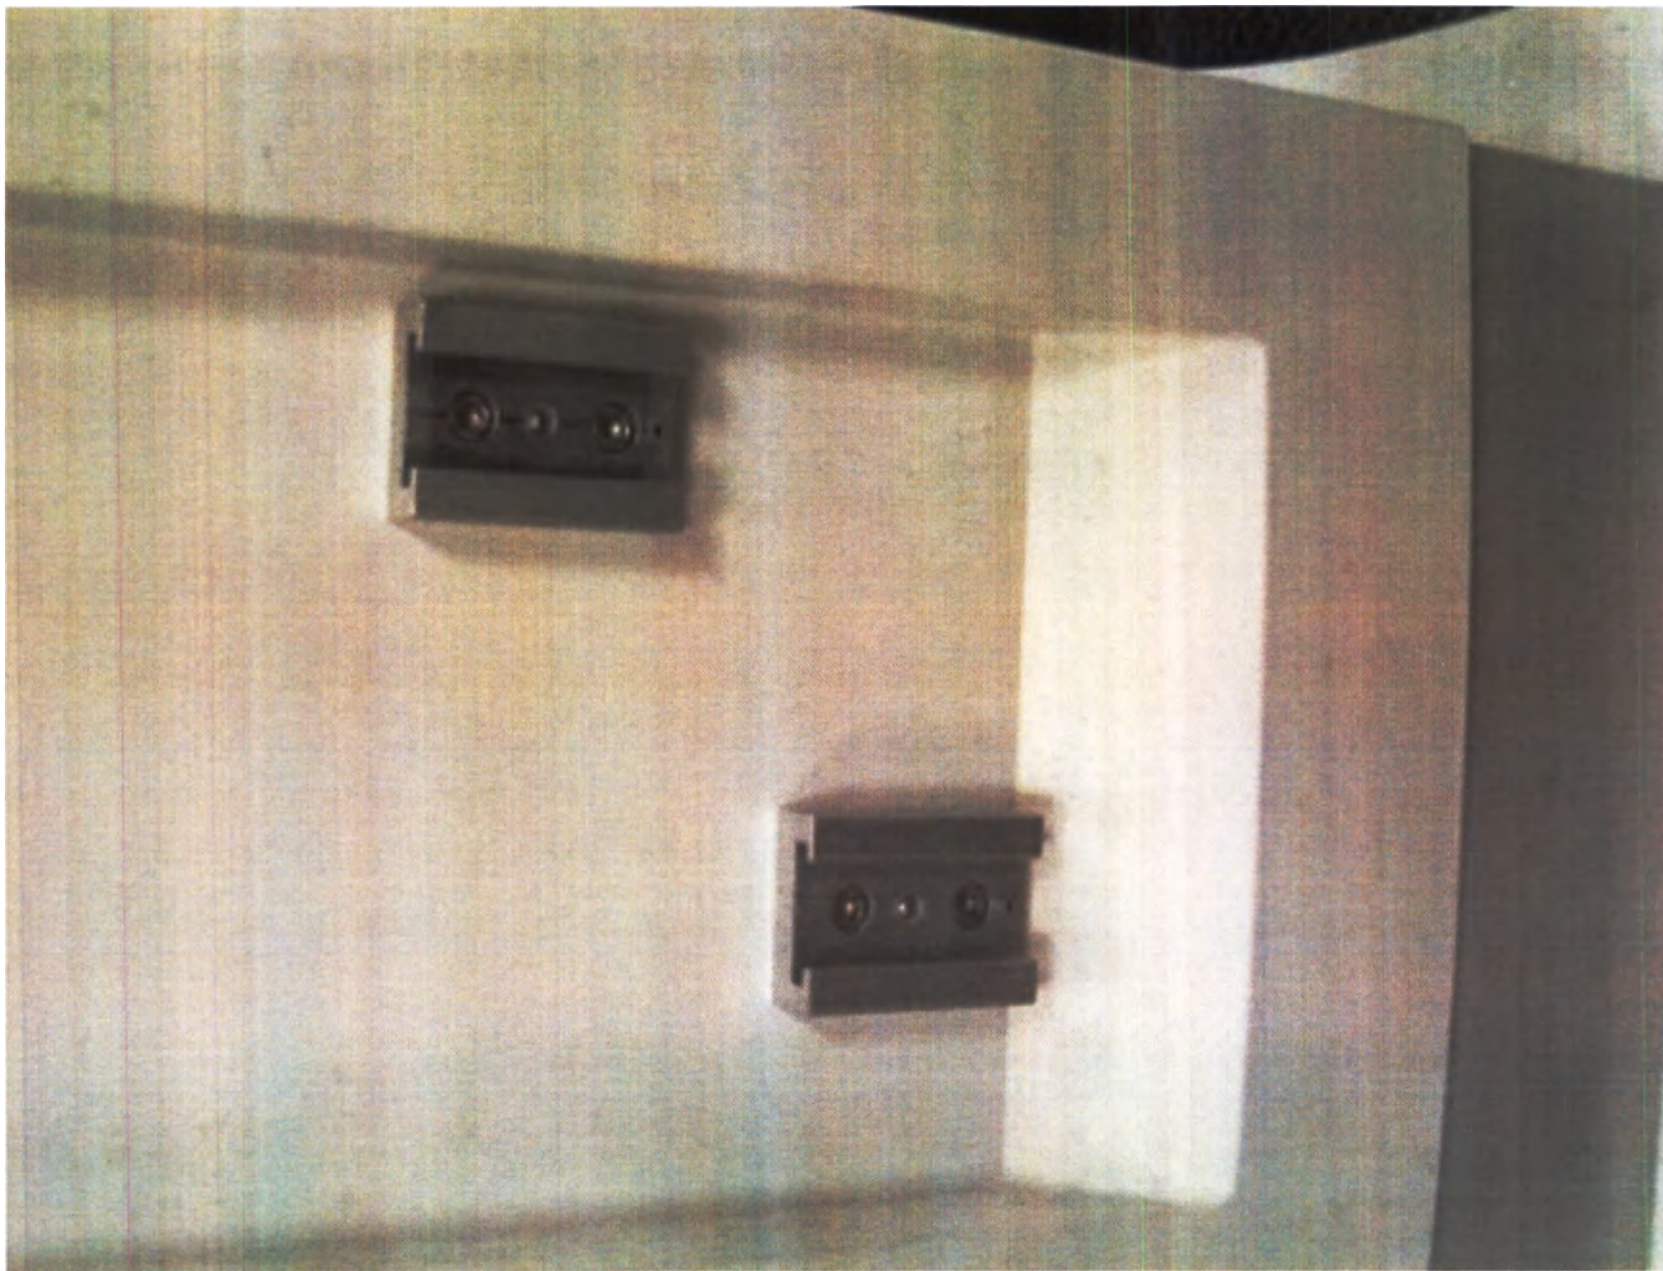


Фото 105. Адаптер для крепления увлажнителя

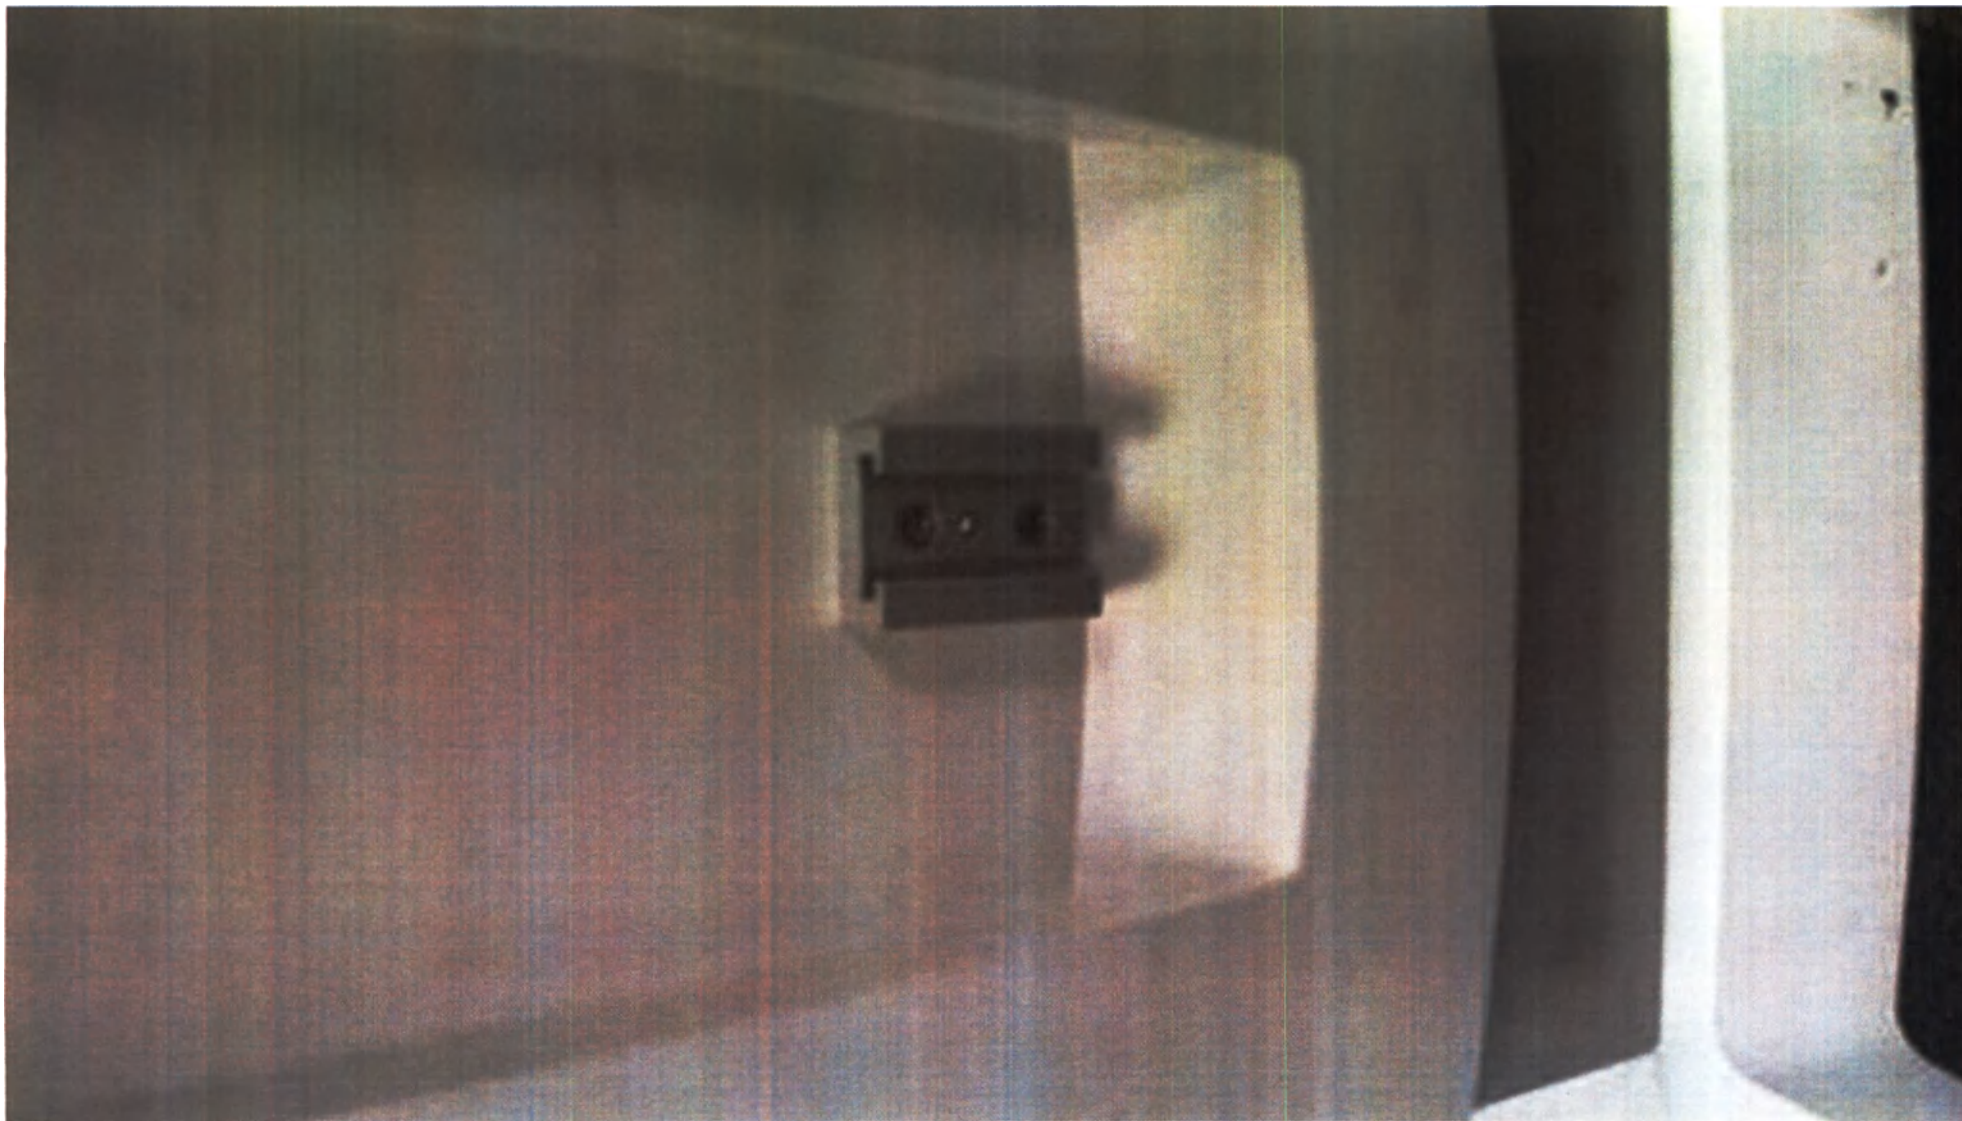


Фото 106. Кабель для дисплея (2 м)


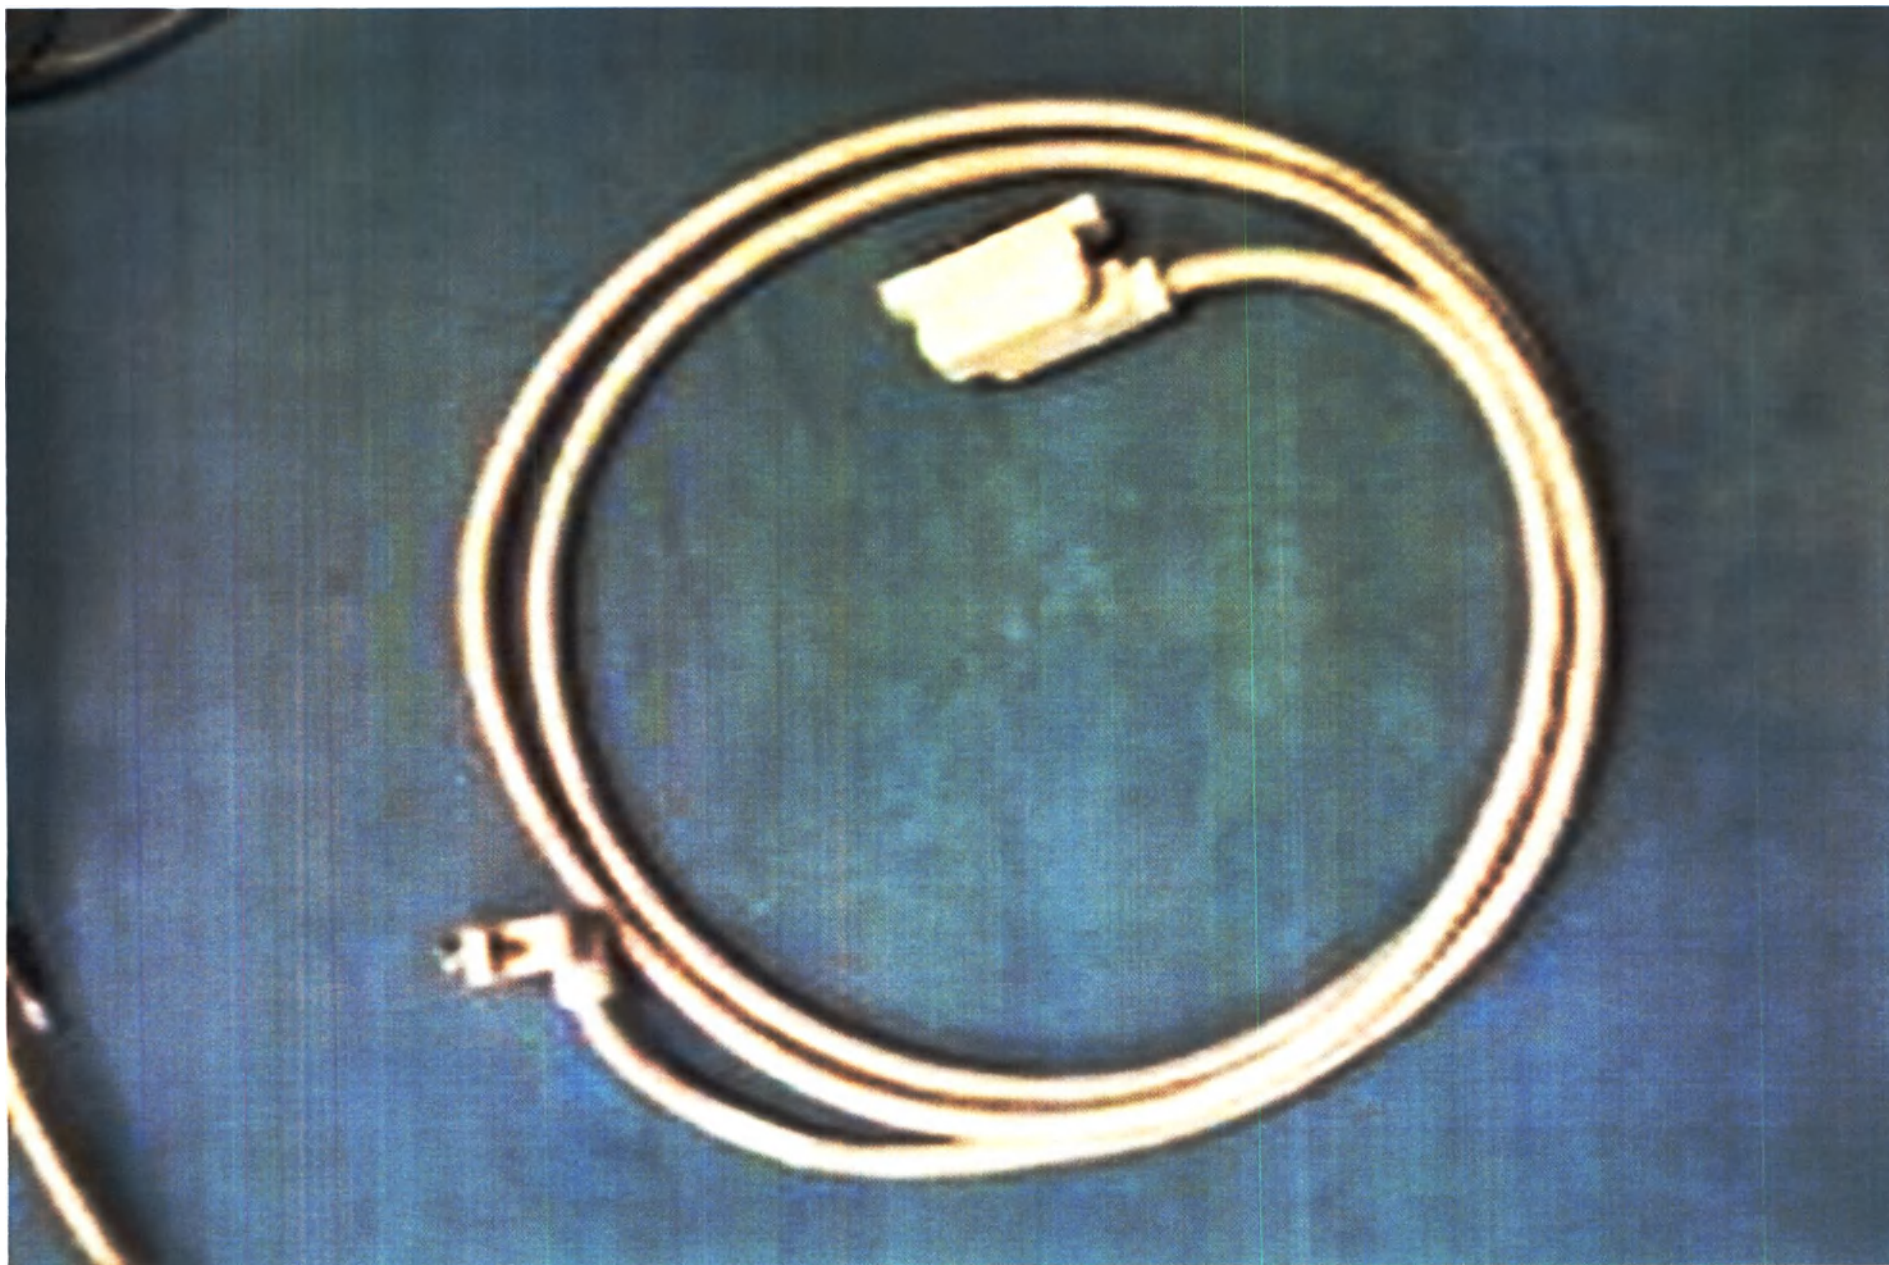


Фото 107. Кабель для дисплея (5 м)

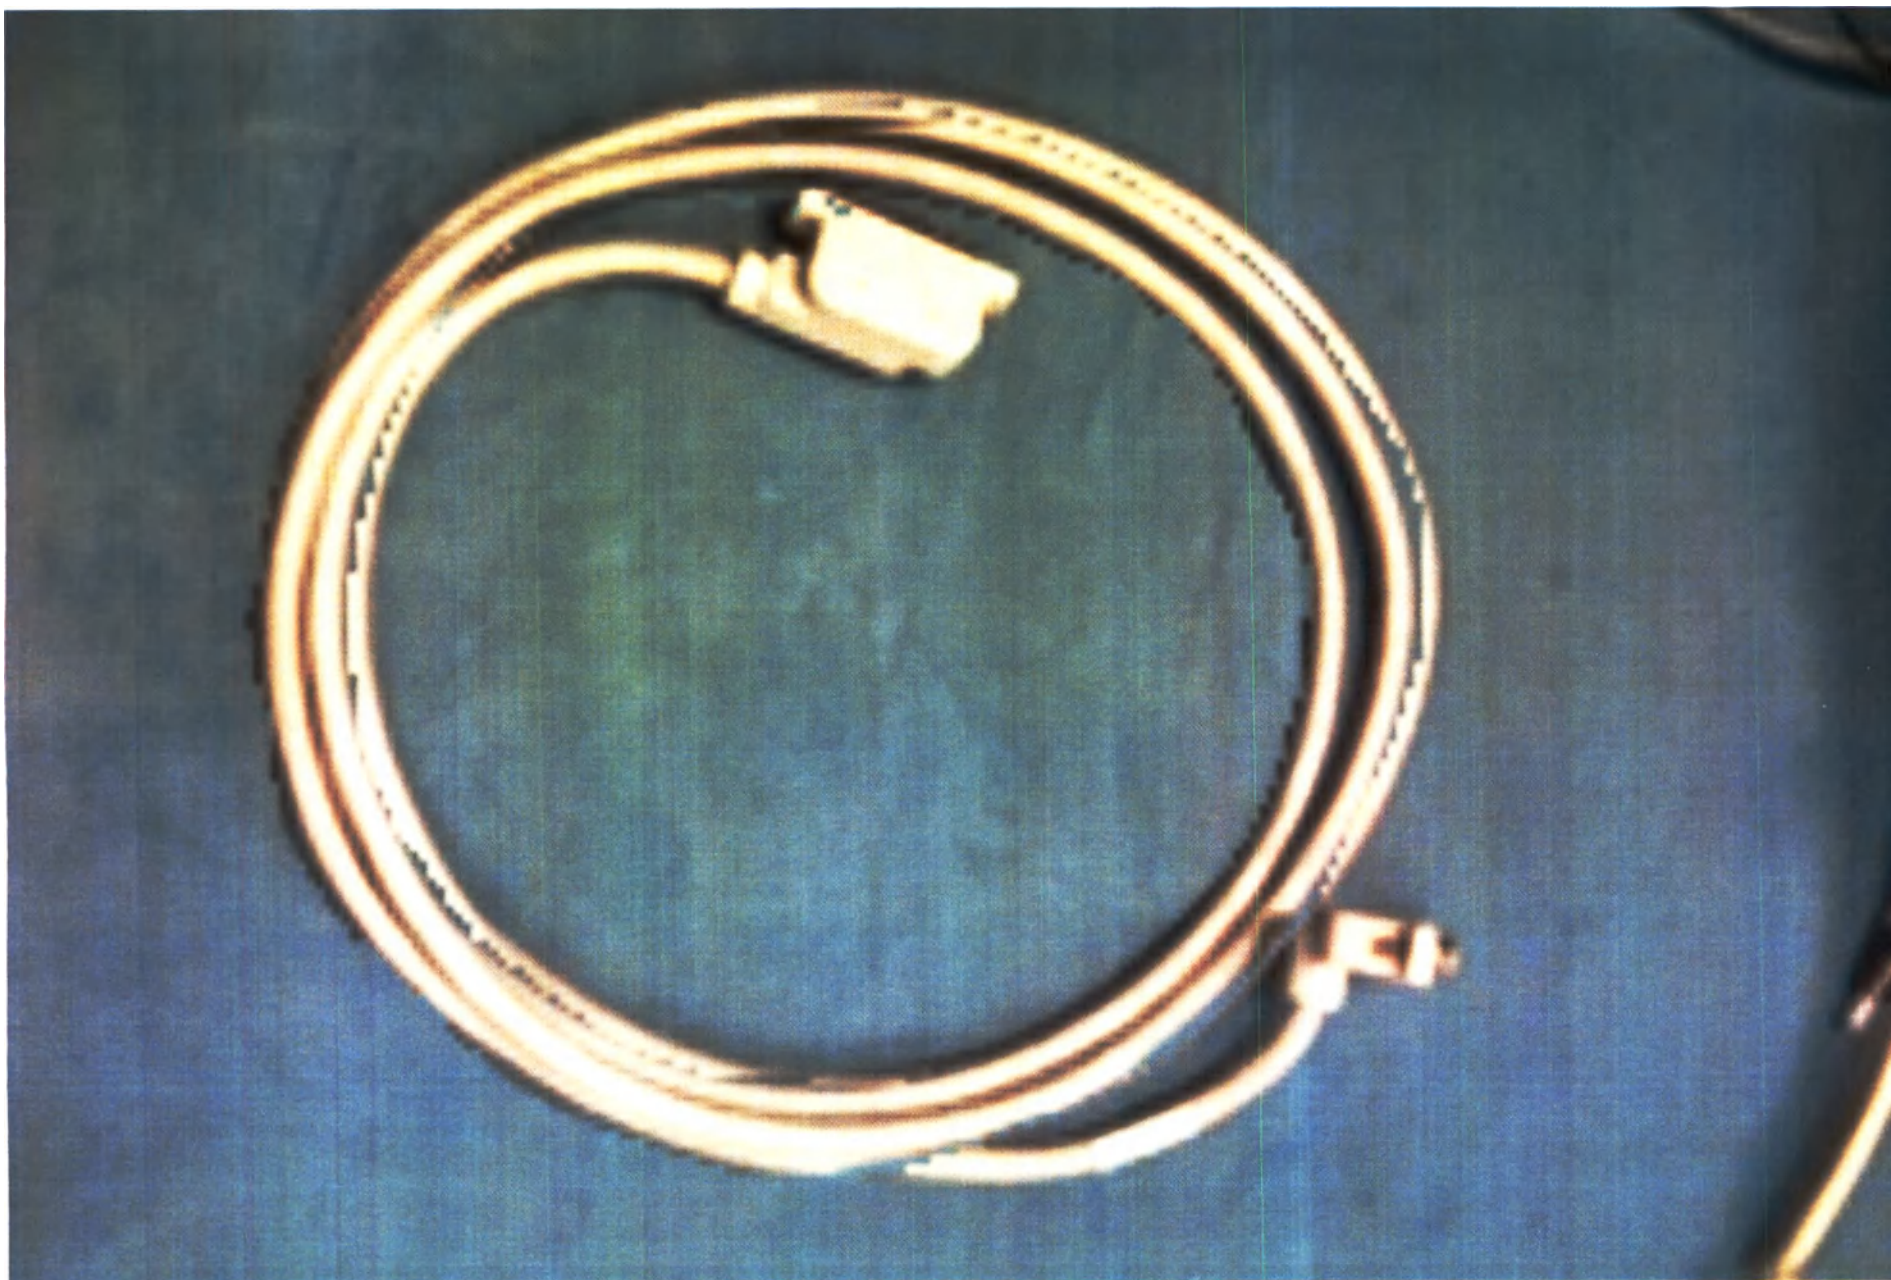

GE Healthcare

Компрессор EVair

Справочное руководство для пользователя



Фото 108. Справочное руководство для компрессора

Фото 109. Тестовое легкое

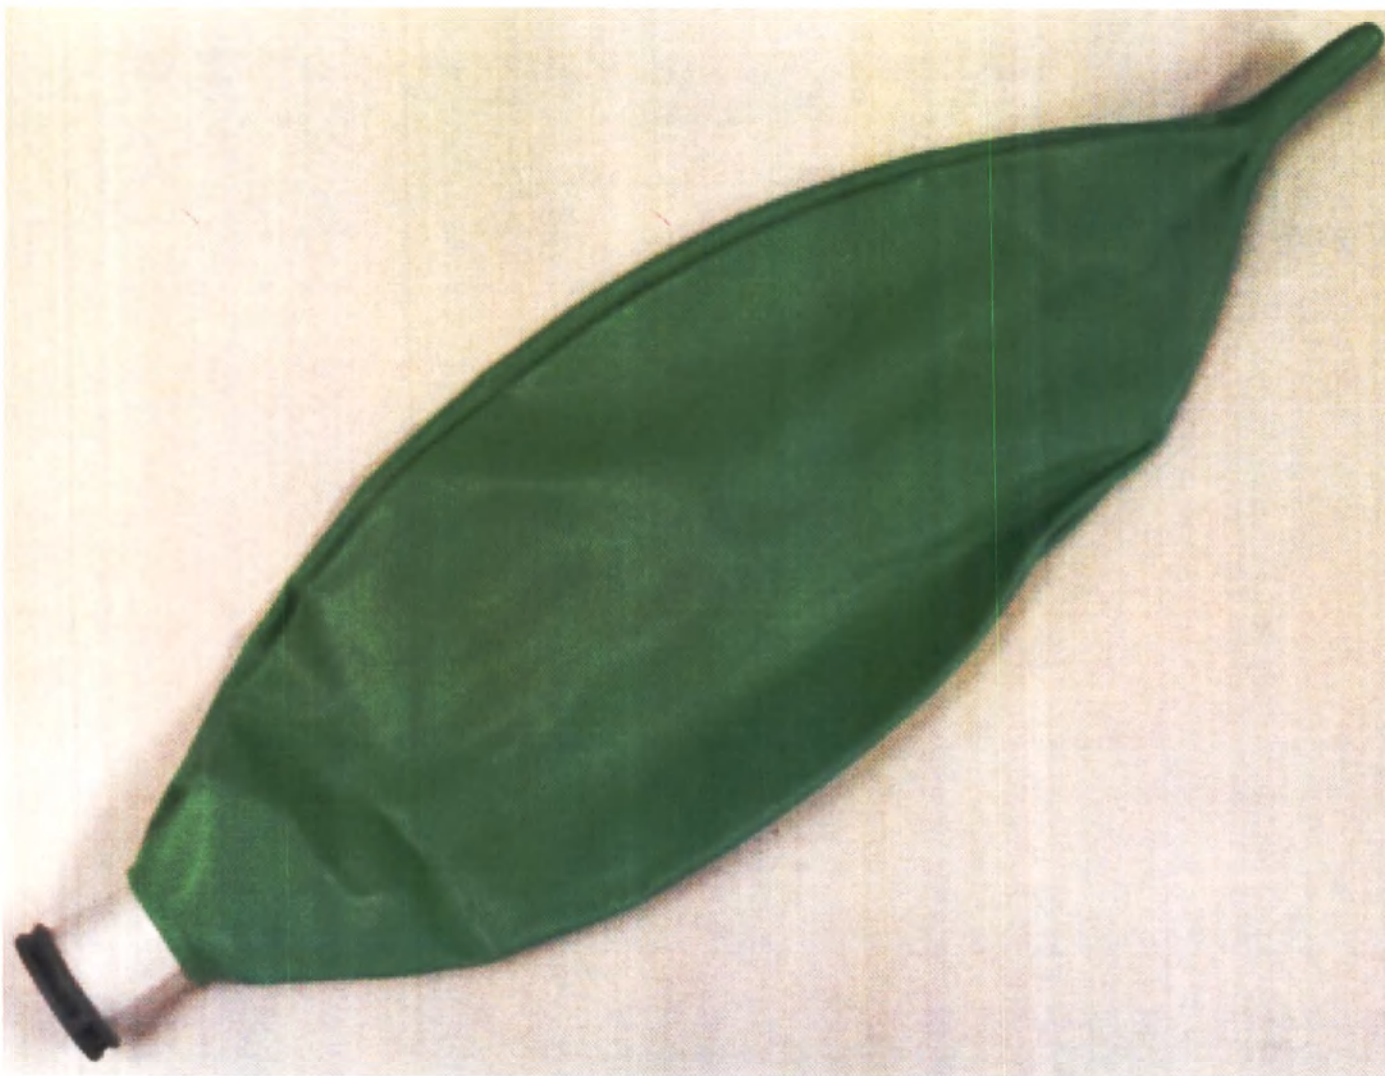


Фото 110. Клапаны выдоха с датчиком потока одноразовые



Фото 111. Клапаны выдоха одноразовые

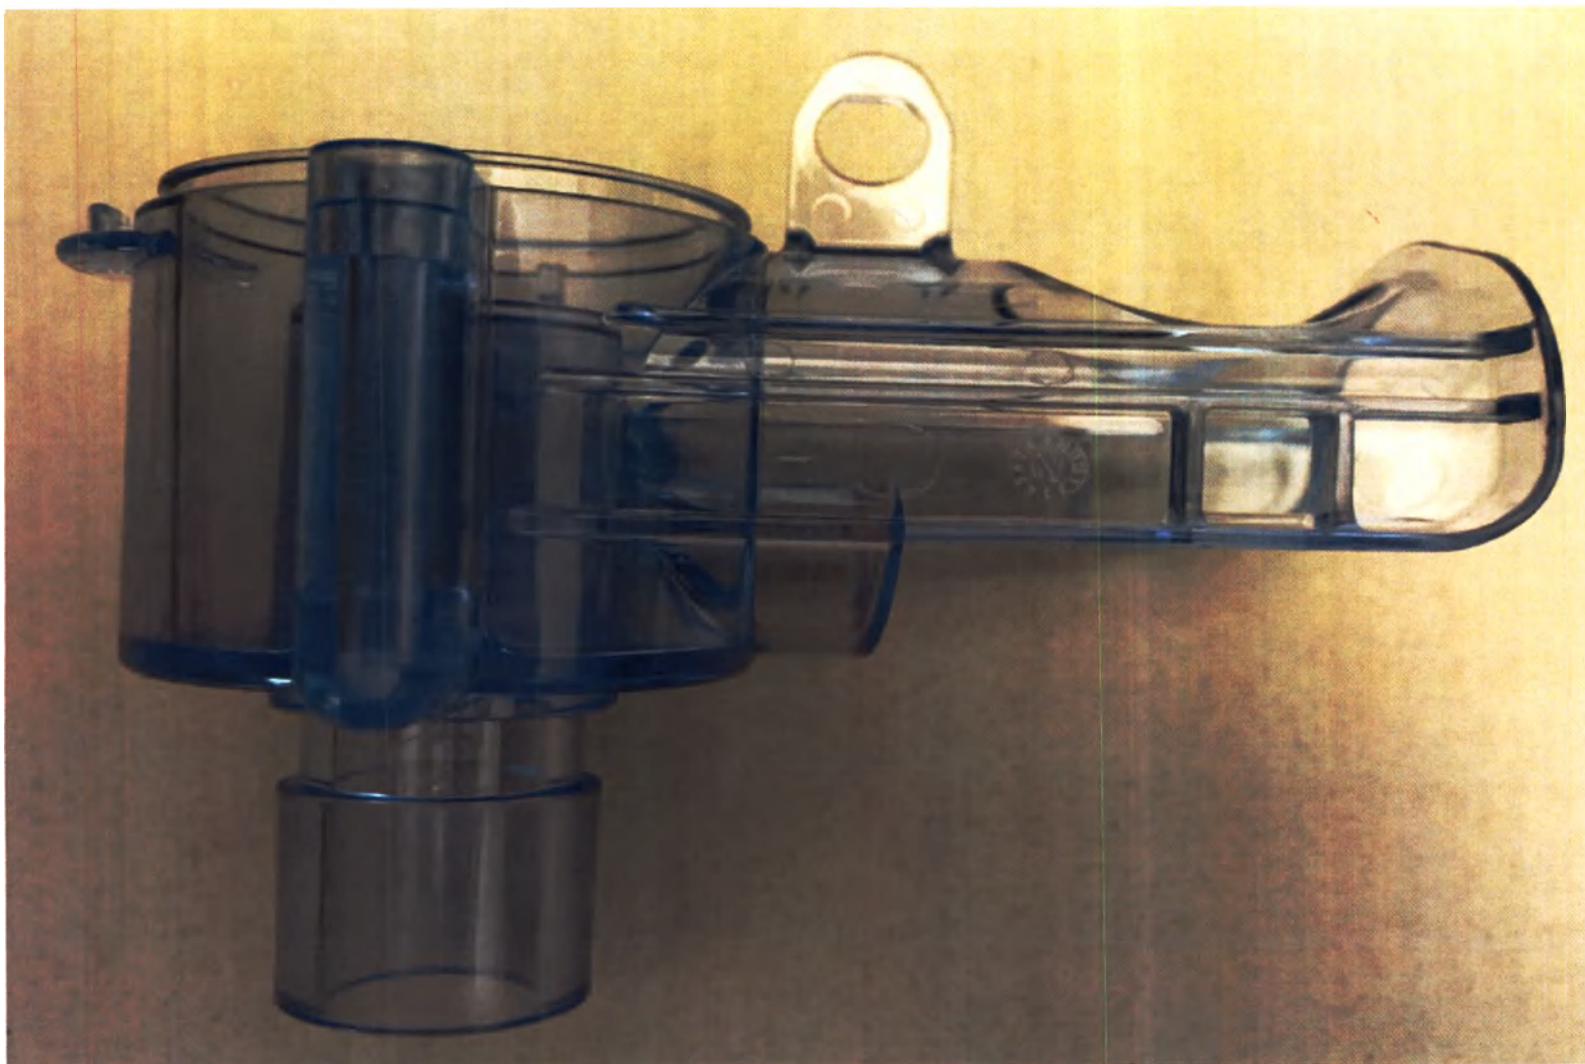


Фото 112. Датчики потока одноразовые



Фото 113. Кабели для передачи данных


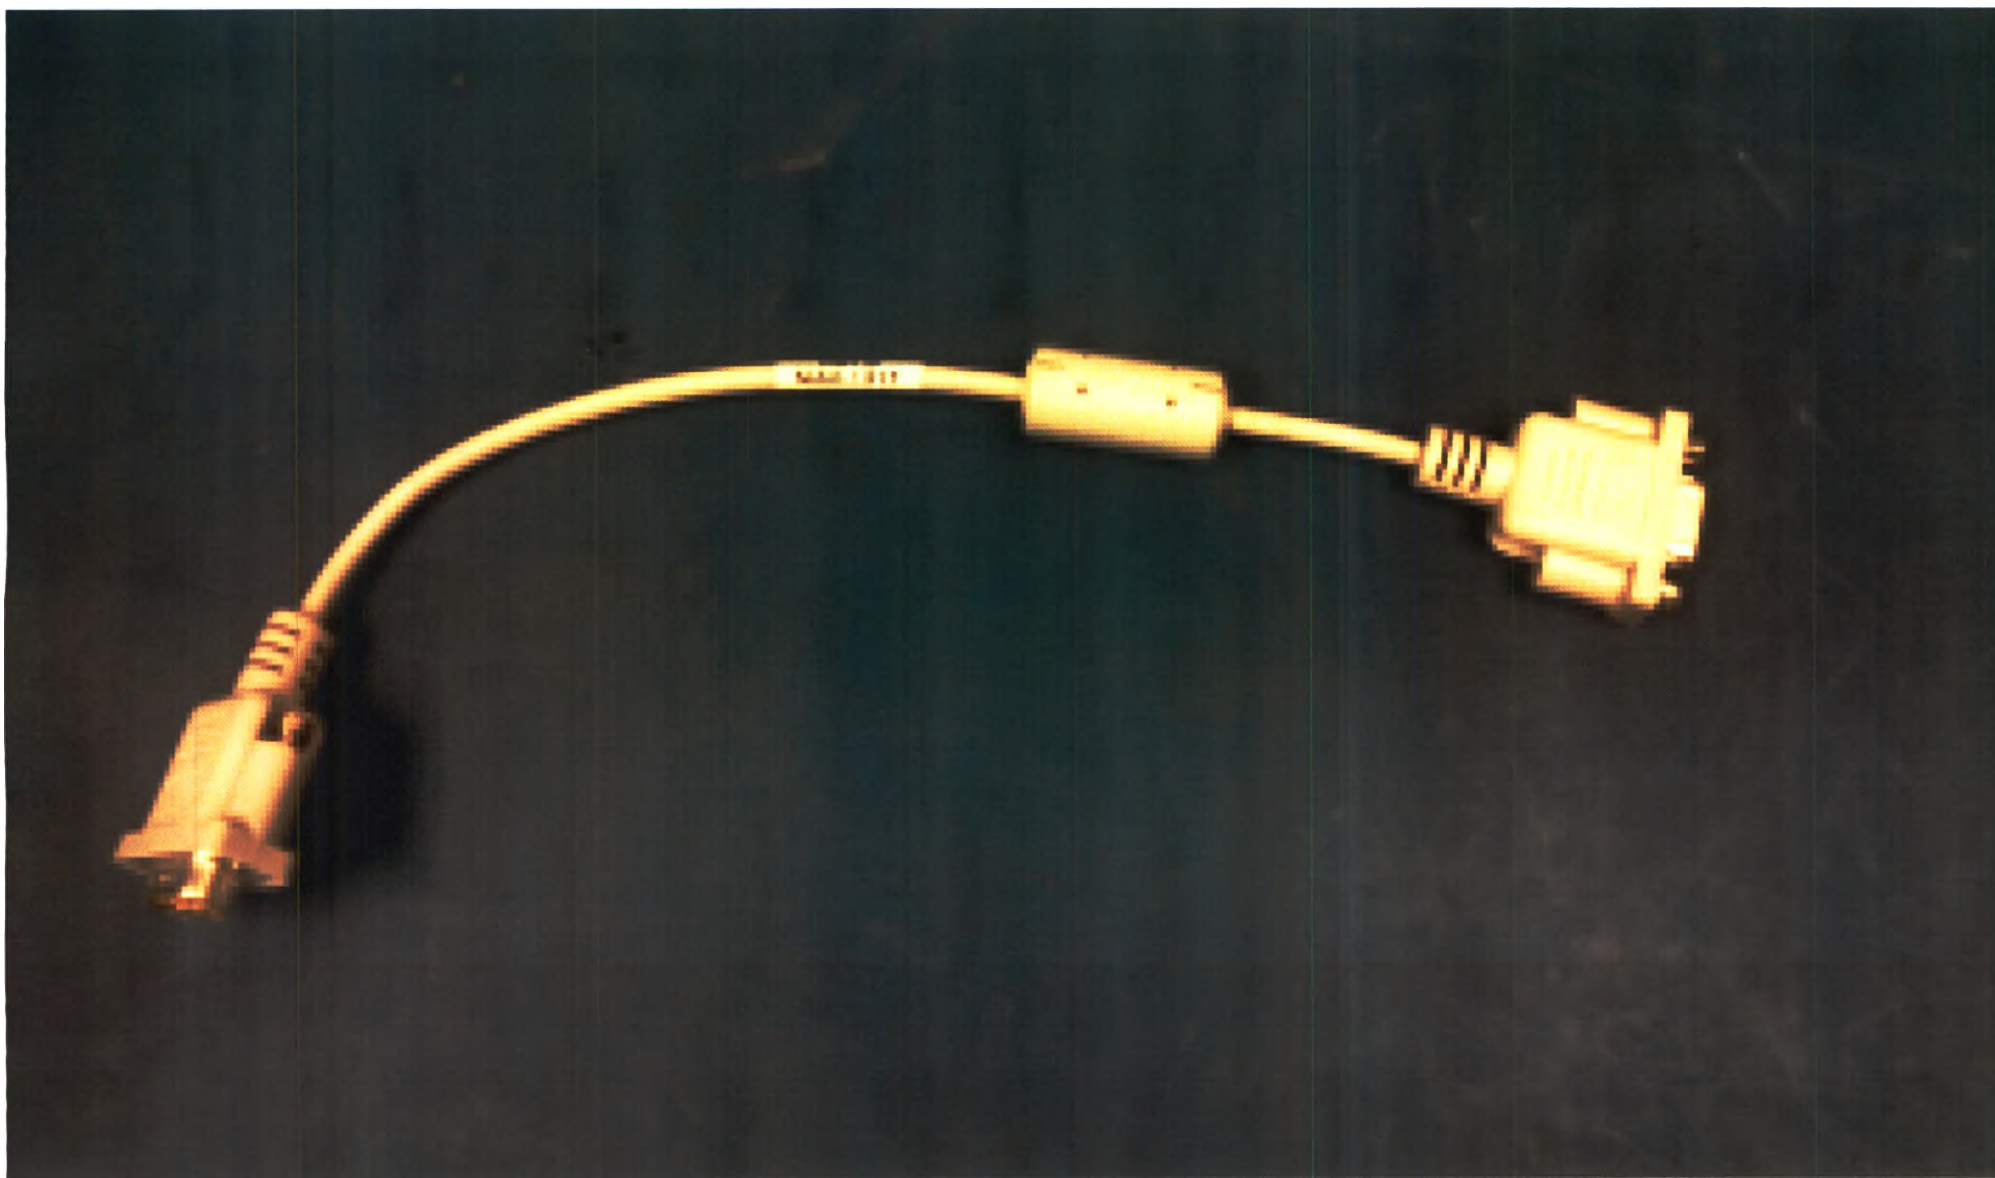


Фото 114-115. Крепления для дополнительных устройств



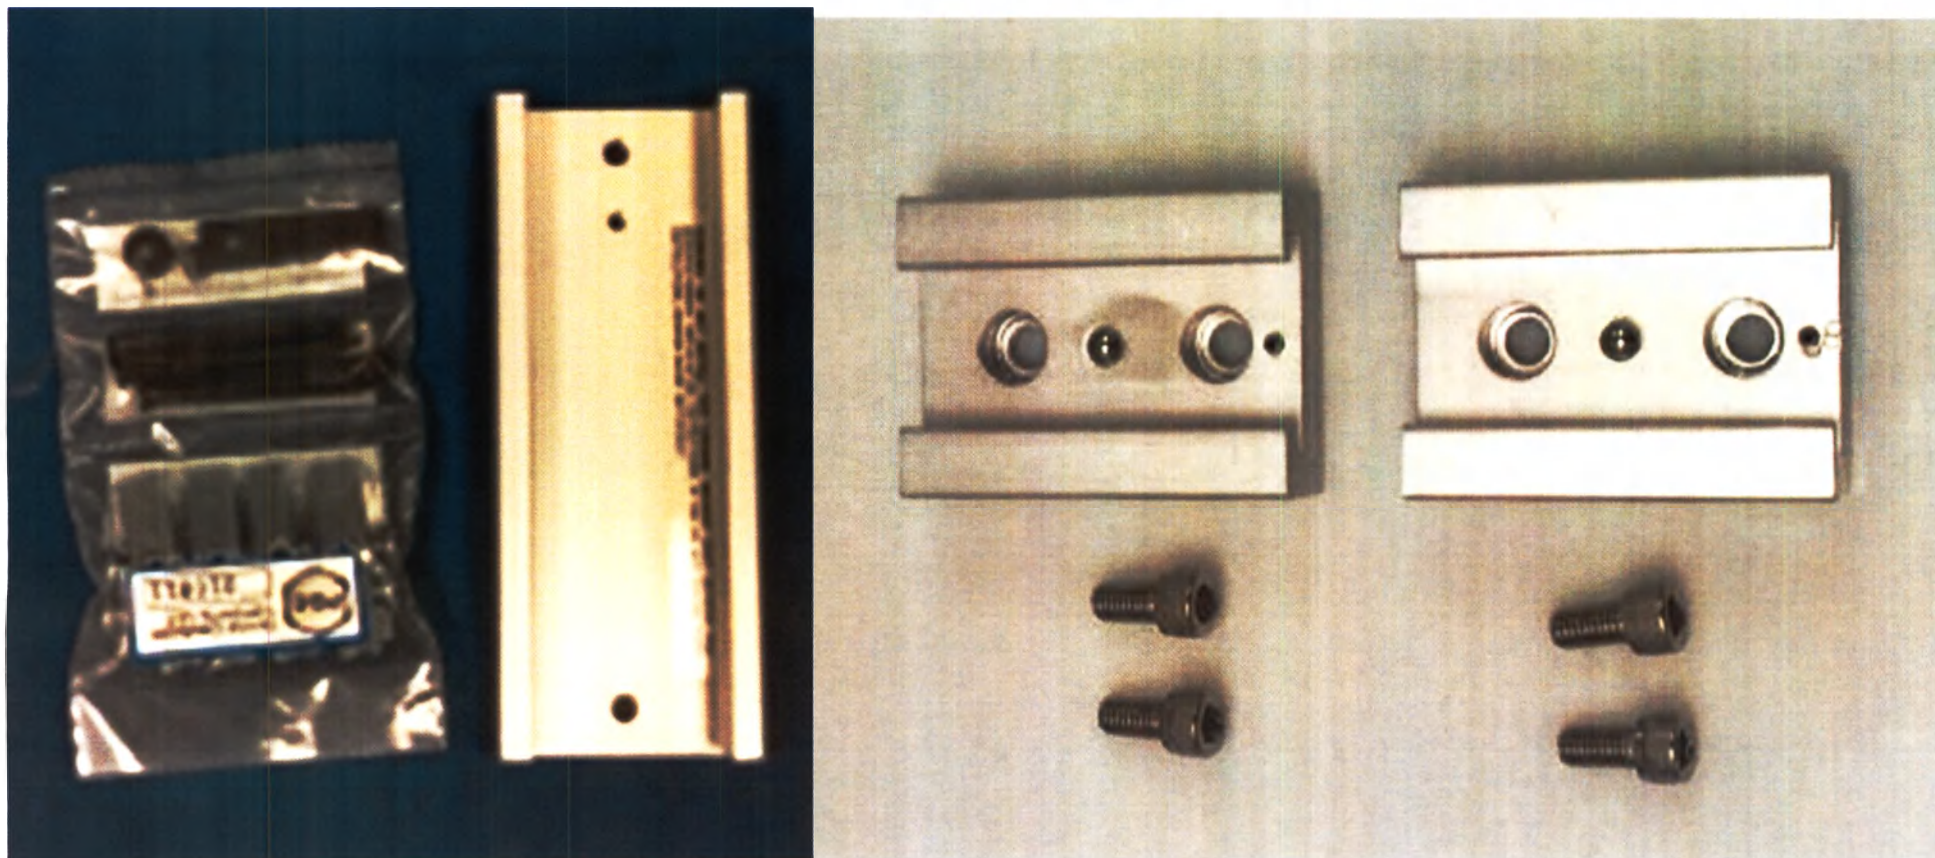

ПРОШЕНО И СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ 115 ЛИСТА(ОВ)

Исполнительный директор
ООО «Джи И Хэлска»
О.А. Лукина

