

ПОДТВЕРЖДАЮ
Руководитель группы по регистрации продукции
для in vitro диагностики, иммунохимия,
гематология и гемостаз
ООО «Сименс Здравоохранение»


Чигринец Е.А.
«14» сентября 2023 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**«Набор контрольных материалов для определения антител к тиреопероксидазе на анализаторах
иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Anti-Thyroid Peroxidase Quality Control (Atellica IM aTPO QC))»**

производства «Сименс Хелскеа Диагностика Инк.», Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США

2023

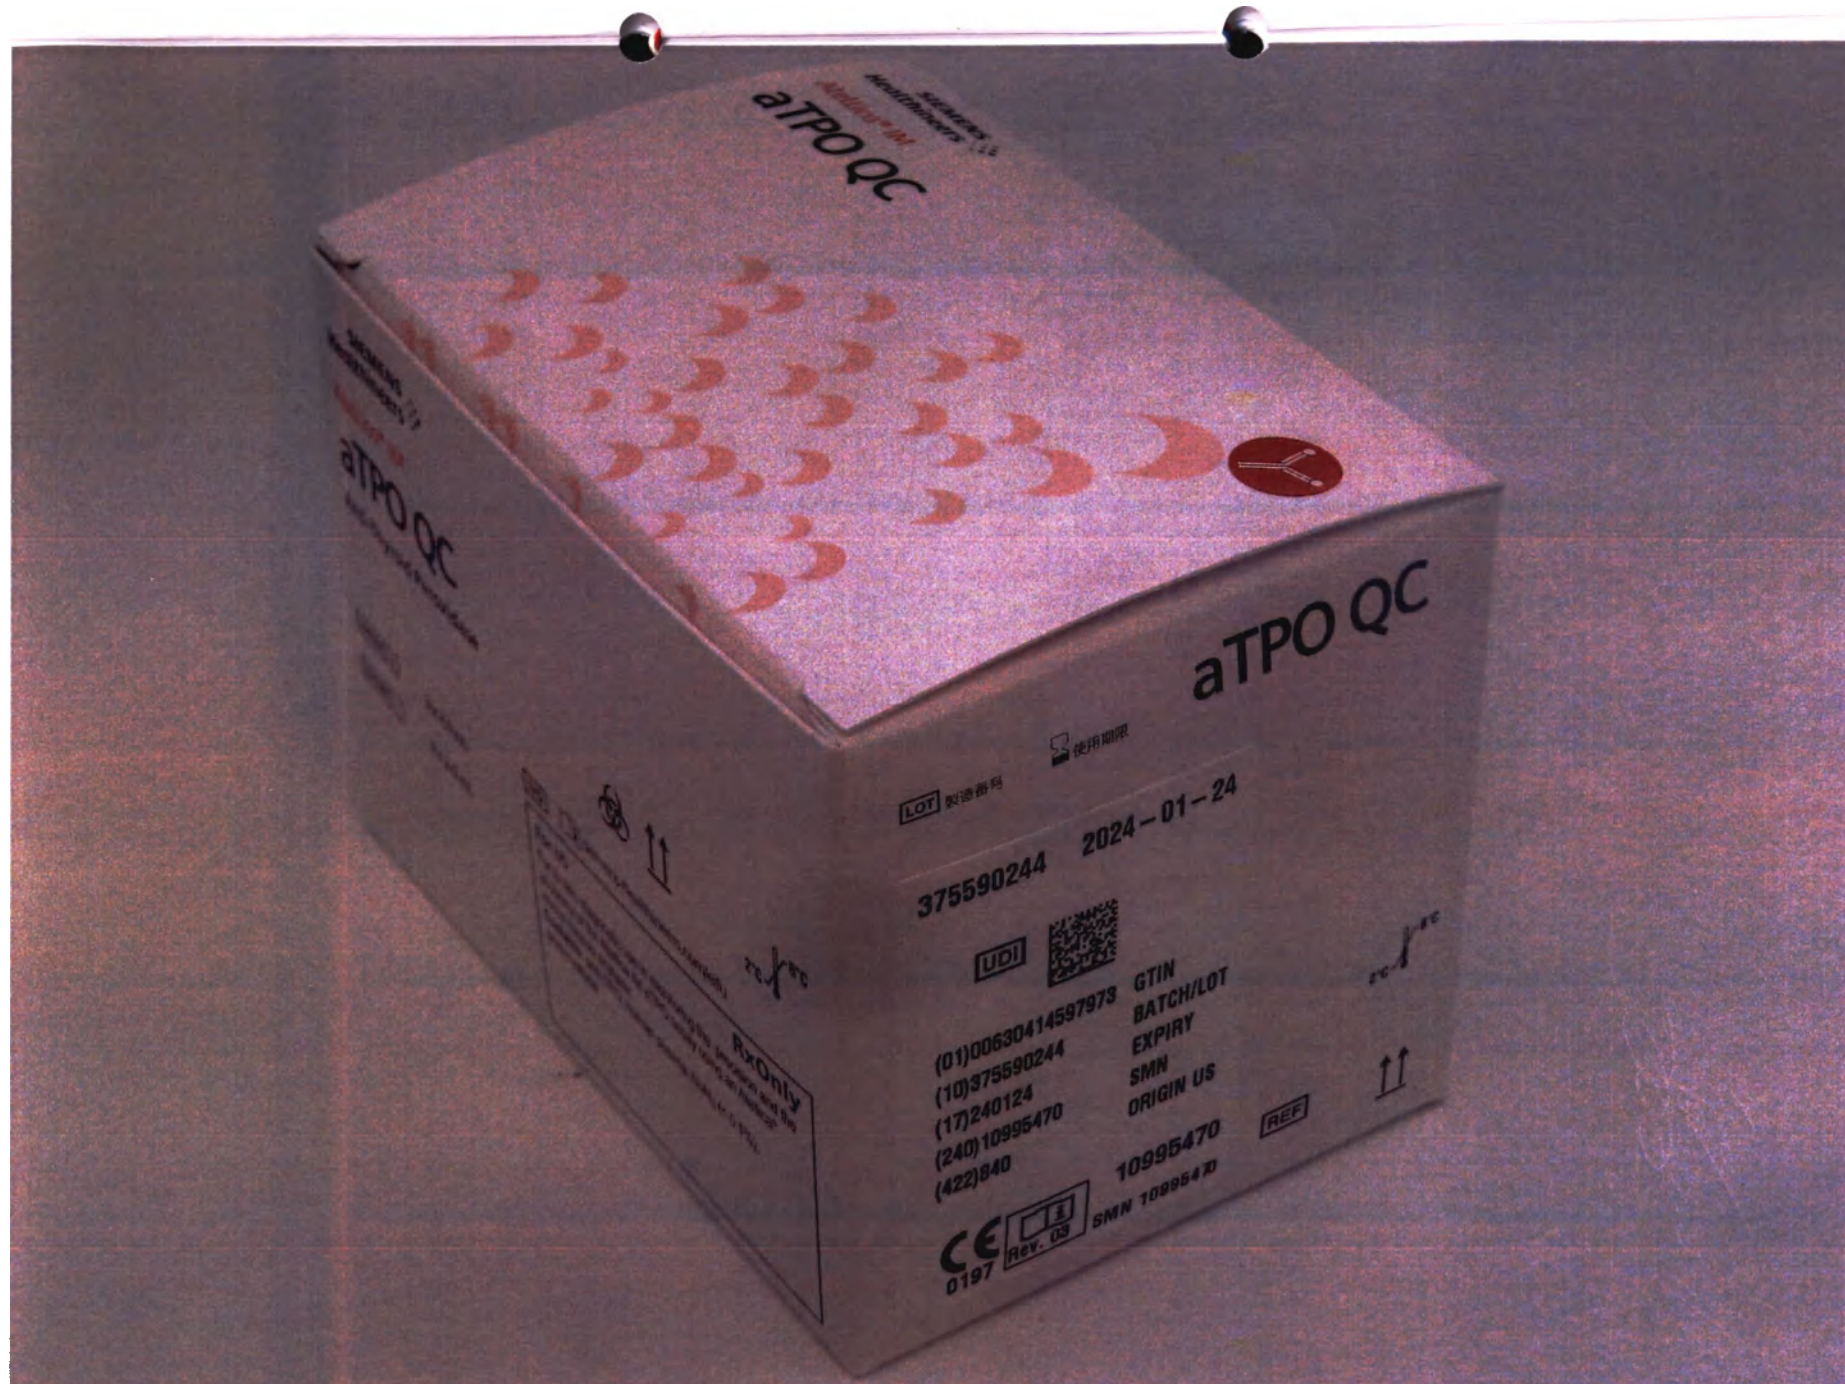


Рисунок 1. Набор контрольных материалов для определения антител к тиреопероксидазе на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Anti-Thyroid Peroxidase Quality Control (Atellica IM aTPO QC)). Общий вид

SIEMENS
Healthineers

Atellica® IM

aTPO QC




Рисунок 2. Набор контрольных материалов для определения антител к тиреопероксидазе на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Anti-Thyroid

LOT 製造番号

使用期限

aTPO QC

375590244 2024-01-24

UDI



(01)00630414597973	GTIN
(10)375590244	BATCH/LOT
(17)240124	EXPIRY
(240)10995470	SMN
(422)840	ORIGIN US



CE
0197



10995470

SMN 10995470

REF



Рисунок 3. Набор контрольных материалов для определения антител к тиреопероксидазе на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Anti-Thyroid Peroxidase Quality Control (Atellica IM aTPO QC)). Общий вид

SIEMENS
Healthineers

Atellica® IM

aTPO QC

Anti-Thyroid Peroxidase



IVD



[siemens-healthineers.com/eifu](https://www.siemens-healthineers.com/eifu)

CONTROL +

3 x 2.0 mL

CONTROL -

3 x 2.0 mL

For US

RxOnly

For *in vitro* diagnostic use in monitoring the precision and the accuracy of the Atellica IM aTPO assay using an Atellica® immunoassay analyzer.


Contains: anti-TPO; human plasma; NaN₃ (< 0.1%); preservatives.

Рисунок 4. Набор контрольных материалов для определения антител к тиреопероксидазе на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Anti-Thyroid Peroxidase Quality Control (Atellica IM aTPO QC)). Общий вид


SIEMENS
Healthineers

Atellica® IM

aTPO QC



Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
511 Benedict Avenue
Tarrytown, NY 10591 USA
siemens-healthineers.com



Siemens Healthcare Diagnostics
Manufacturing Ltd.
Chapel Lane
Swords, Co. Dublin, Ireland

Рисунок 5. Набор контрольных материалов для определения антител к тиреопероксидазе на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Anti-Thyroid Peroxidase Quality Control (Atellica IM aTPO QC)). Общий вид

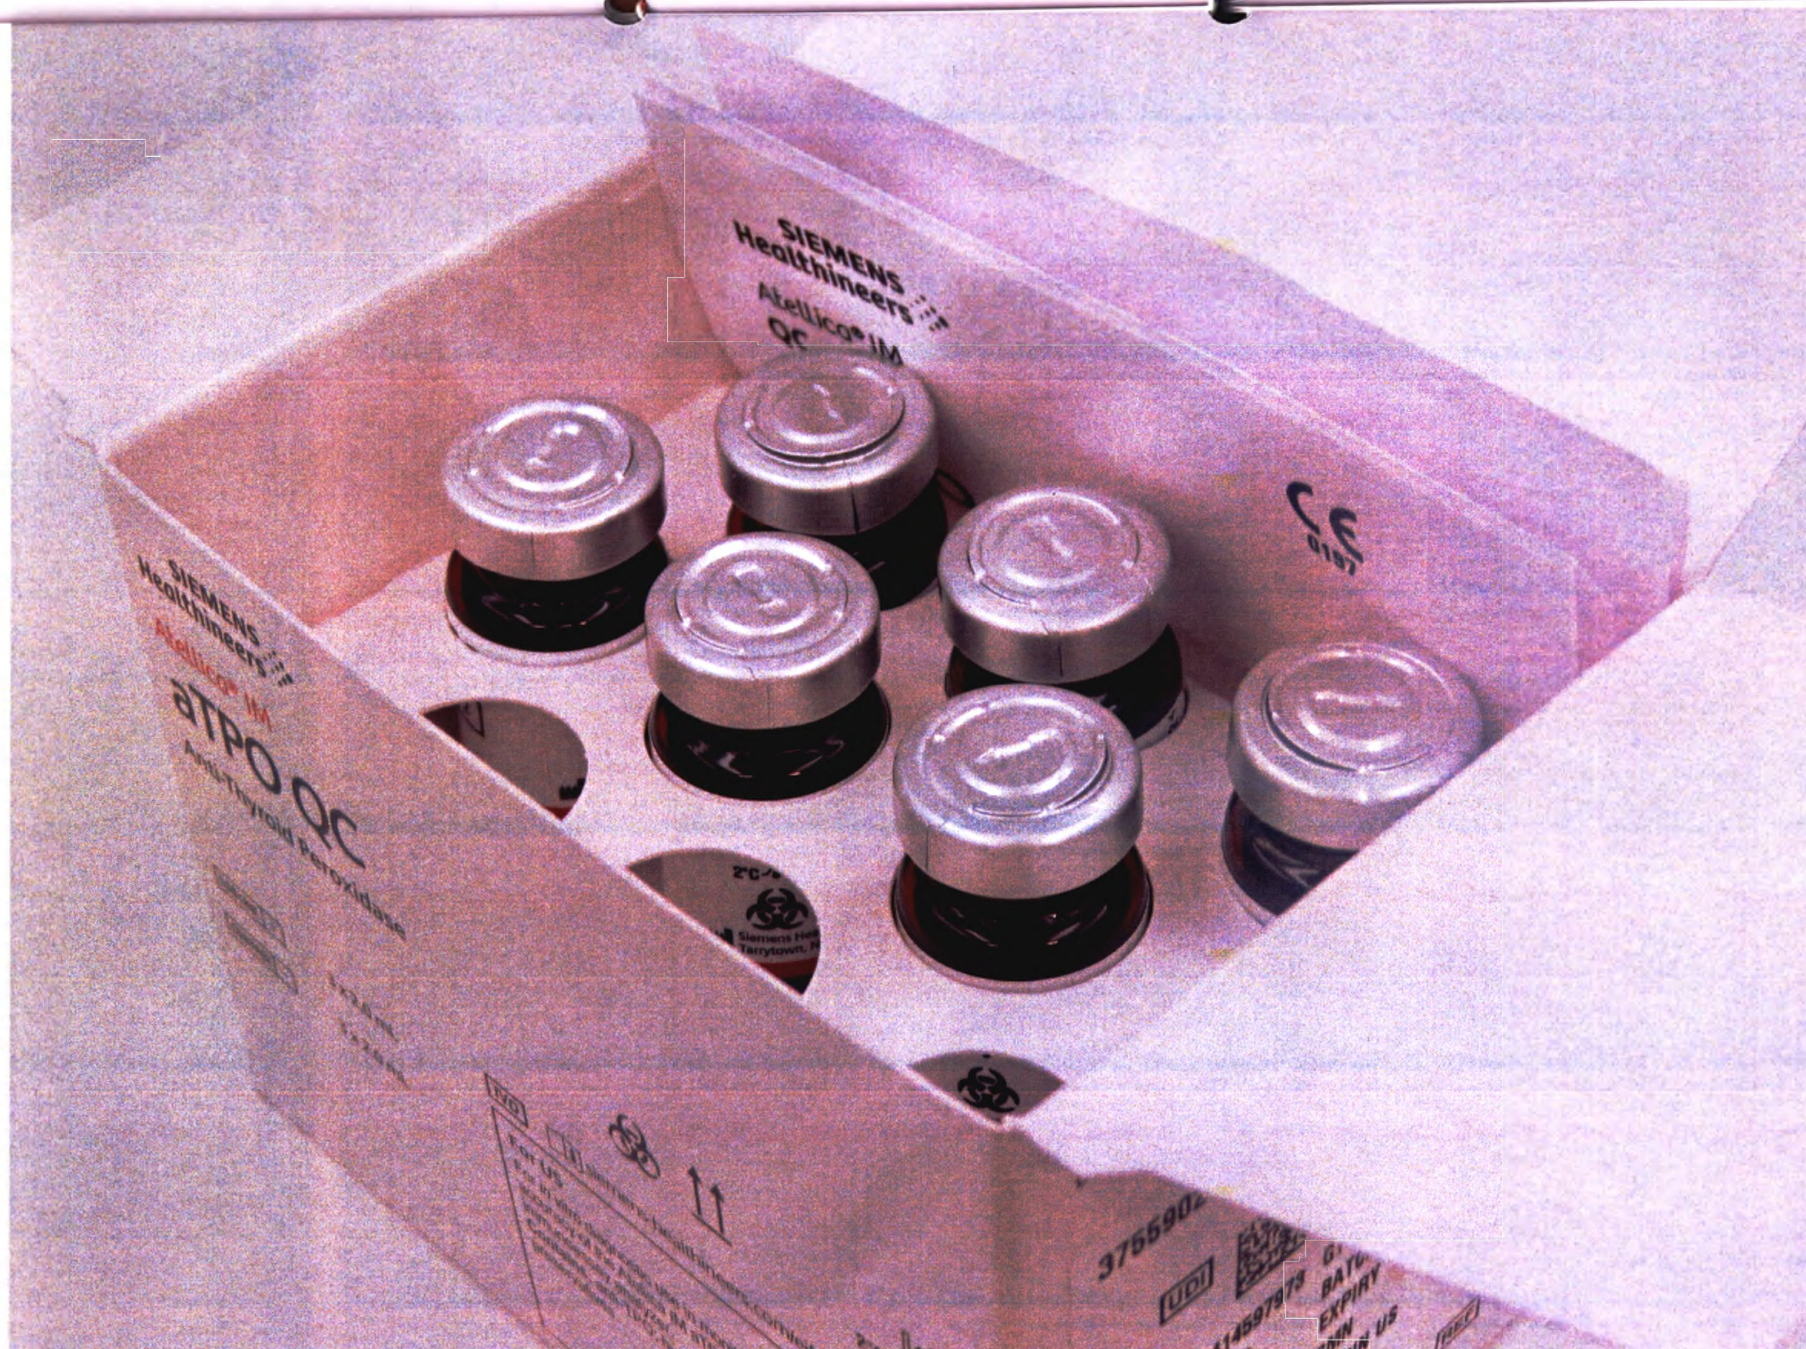


Рисунок 6. Набор контрольных материалов для определения антител к тиреопероксидазе на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Anti-Thyroid Peroxidase Quality Control (Atellica IM ATPO QC)). Общий вид



Рисунок 7. Набор контрольных материалов для определения антител к тиреопероксидазе на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Anti-Thyroid Peroxidase Quality Control (Atellica IM aTPO QC)). Общий вид



Рисунок 8. Набор контрольных материалов для определения антител к тиреопероксидазе на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Anti-Thyroid Peroxidase Quality Control (Atellica IM aTPO QC)): Контрольный материал 1-го уровня Atellica IM aTPO QC CONTROL 1, 2,0 мл.



Рисунок 9. Набор контрольных материалов для определения антител к тиреопероксидазе на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Anti-Thyroid

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU ПО QC)): Контрольный материал 2-го уровня Atellica IM aTPO QC CONTROL 2, 2,0 мл.

SIEMENS
Healthineers
Atellica® IM
QC

aTPO

CONTROL LOT VAL

REF

10995470



使用期限

2020-05-11



siemens.com/document-library

UNITS C

	LOT 製造番号	U/mL → ←	U/mL ← →
CONTROL 1	8413201	78.2	+/- 22.8
CONTROL 2	8413202	482	+/- 98.0

10997642 Rev. 03



Рисунок 10. Набор контрольных материалов для определения антител к тиреопероксидазе на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Anti-Thyroid Peroxidase Quality Control (Atellica IM aTPO QC)): Лист значений параметров серии контрольных материалов.

10995470 Набор контрольных материалов для определения антител к тиреопероксидазе на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Anti-Thyroid Peroxidase Quality Control (Atellica IM aTPO QC))

Информация о производителе и стране производства:
см. на упаковке

Регистрационное удостоверение:
№ РЗН 2021/14566 от 10.06.2021

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на оригинальной упаковке

Инструкция по применению на русском языке Rev. 02

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Авторизованный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96



Всего прошито и пронумеровано
12 листа (ов).

ООО «Сименс Здоровоохранение»

