



Руководитель группы регистрации
ООО «Сименс Здоровоохранение»

Н.А. Горшкова
2020 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO**

**«Набор калибраторов О для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM
Calibrator O (Atellica IM CAL O))»**

производства «Сименс Хелскеа Диагностикс Инк.», Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США

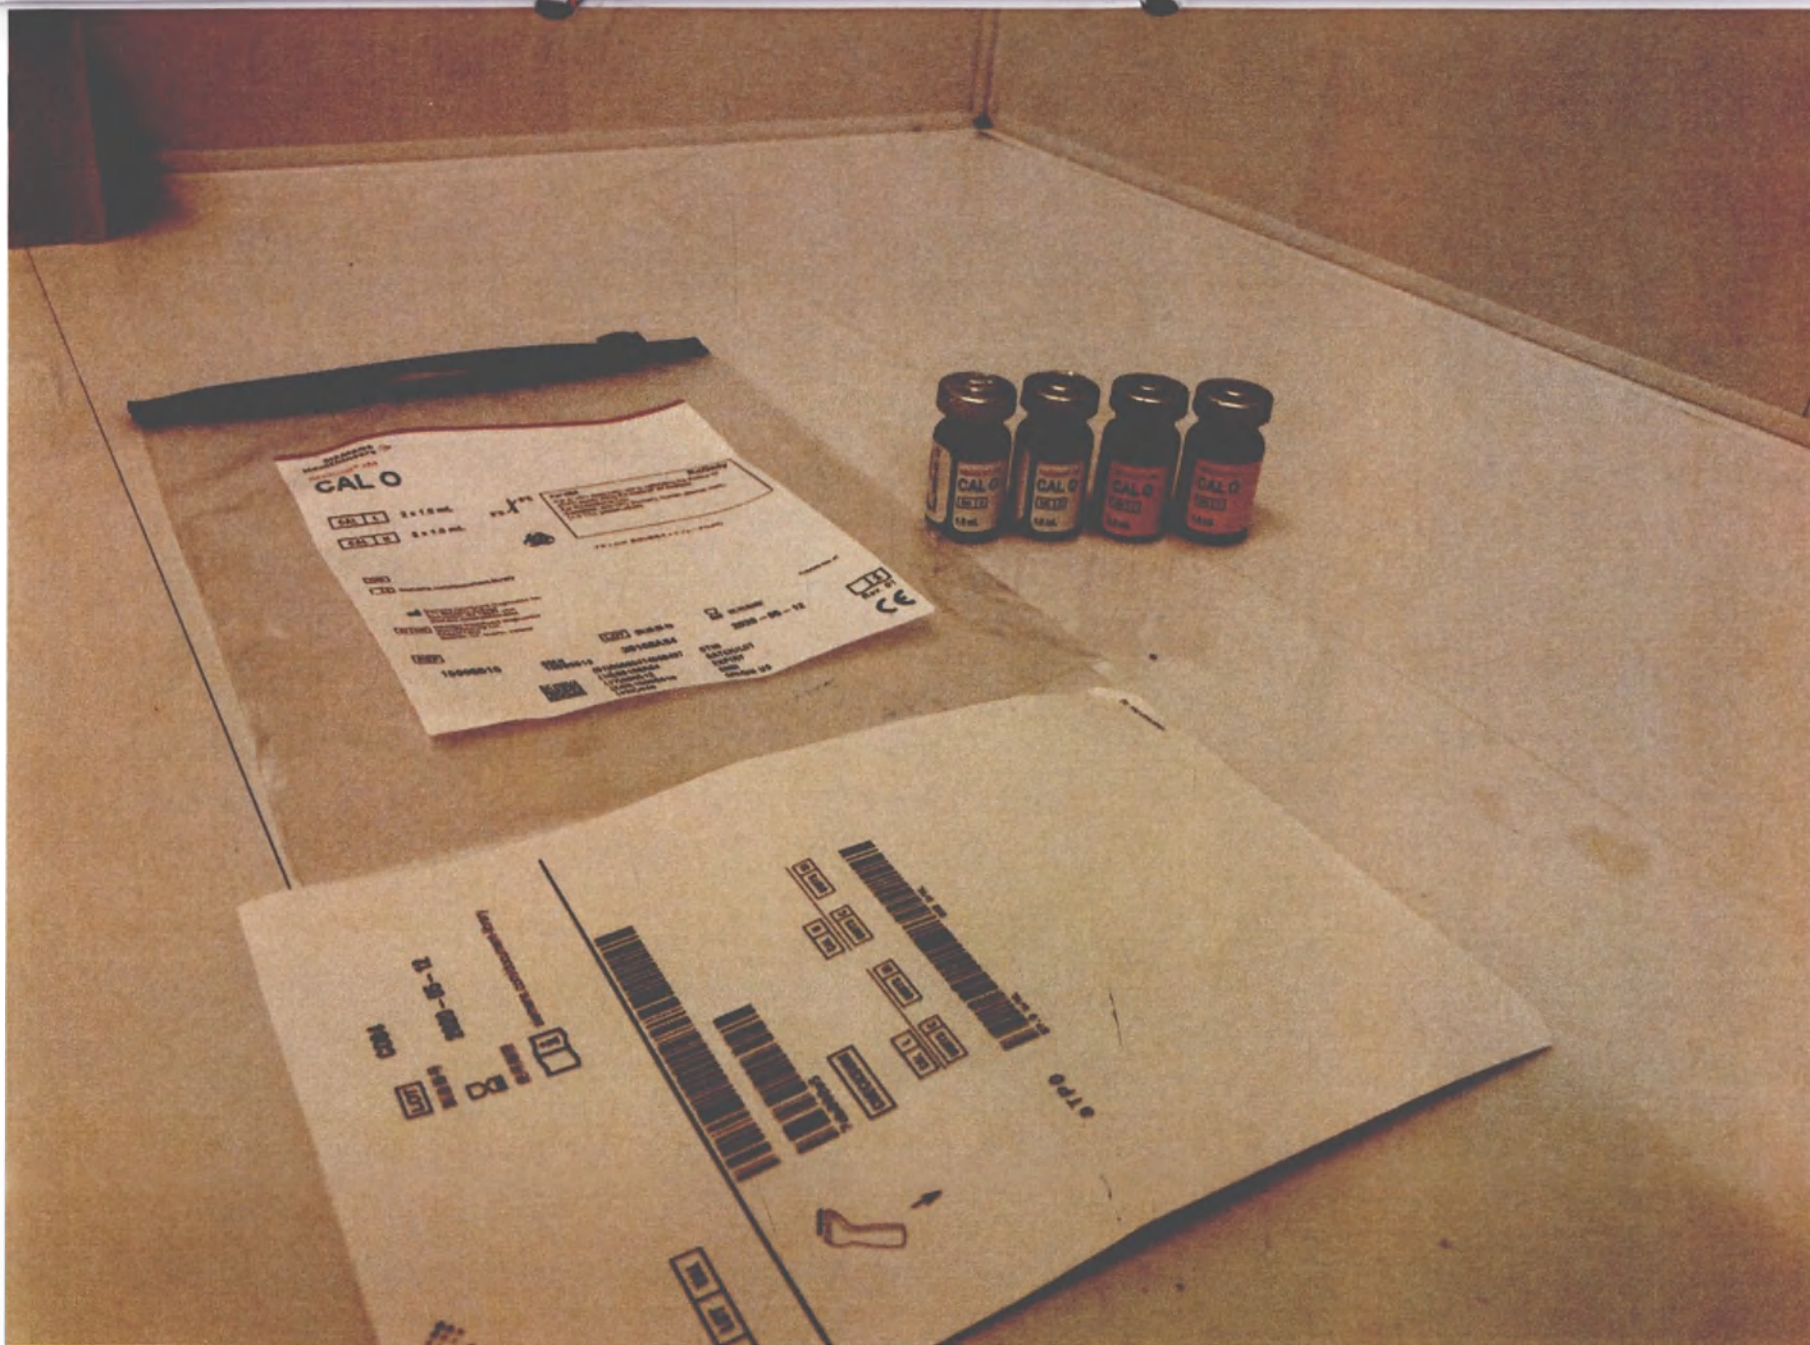


Рисунок 1. Набор калибраторов О для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Calibrator O (Atellica IM CAL O)). Общий вид

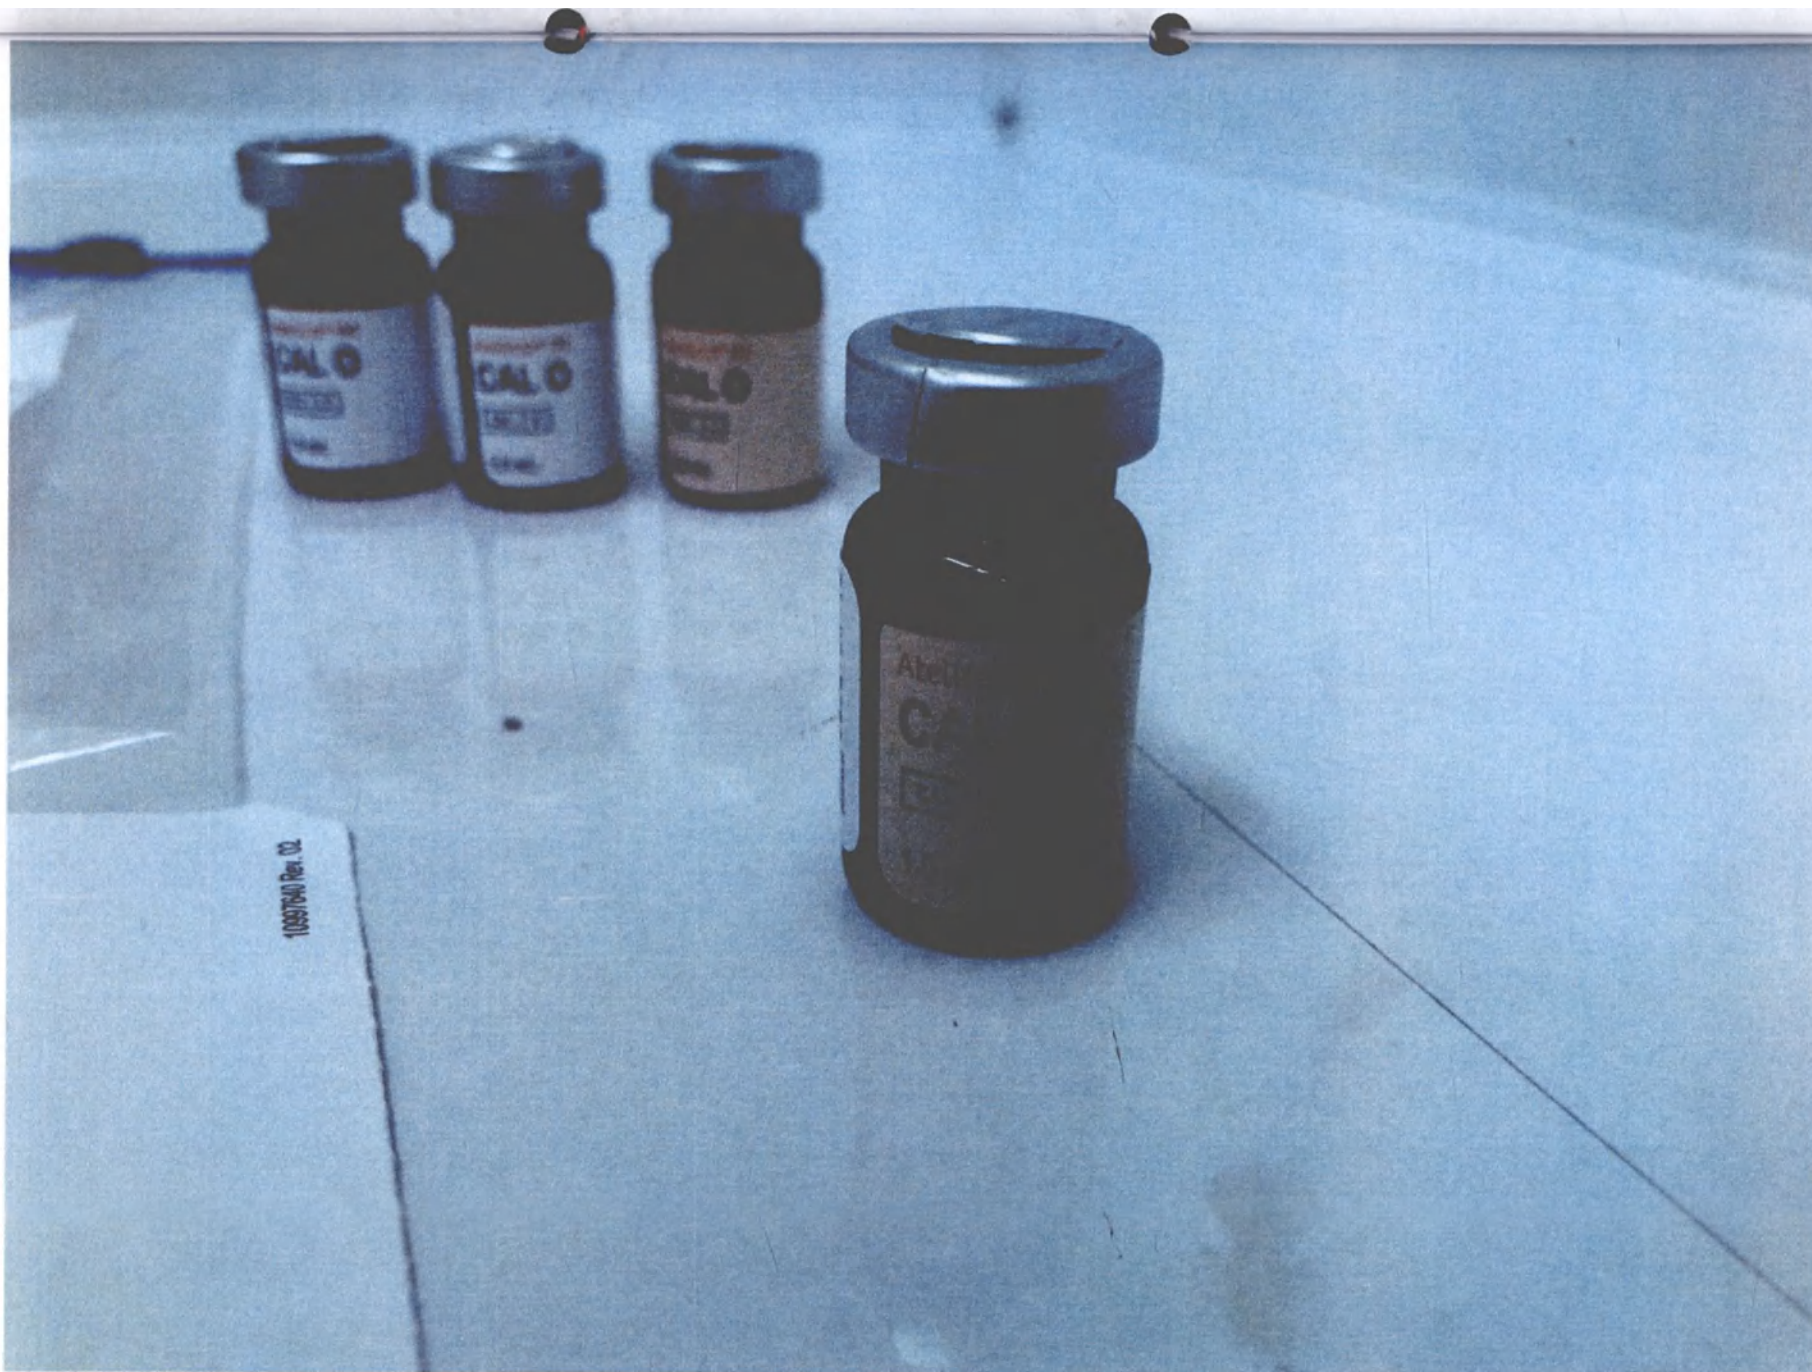


Рисунок 2. Набор калибраторов О для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Calibrator О (Atellica IM CAL О)): Калибратор с низкой концентрацией Atellica IM CAL О L, 1,0 мл



Рисунок 3. Набор калибраторов О для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Calibrator O (Atellica IM CAL O)): Калибратор с низкой концентрацией Atellica IM CAL O L, 1,0 мл



Рисунок 4. Набор калибраторов О для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Calibrator O (Atellica IM CAL O)): Калибратор с низкой концентрацией Atellica IM CAL O L, 1,0 мл

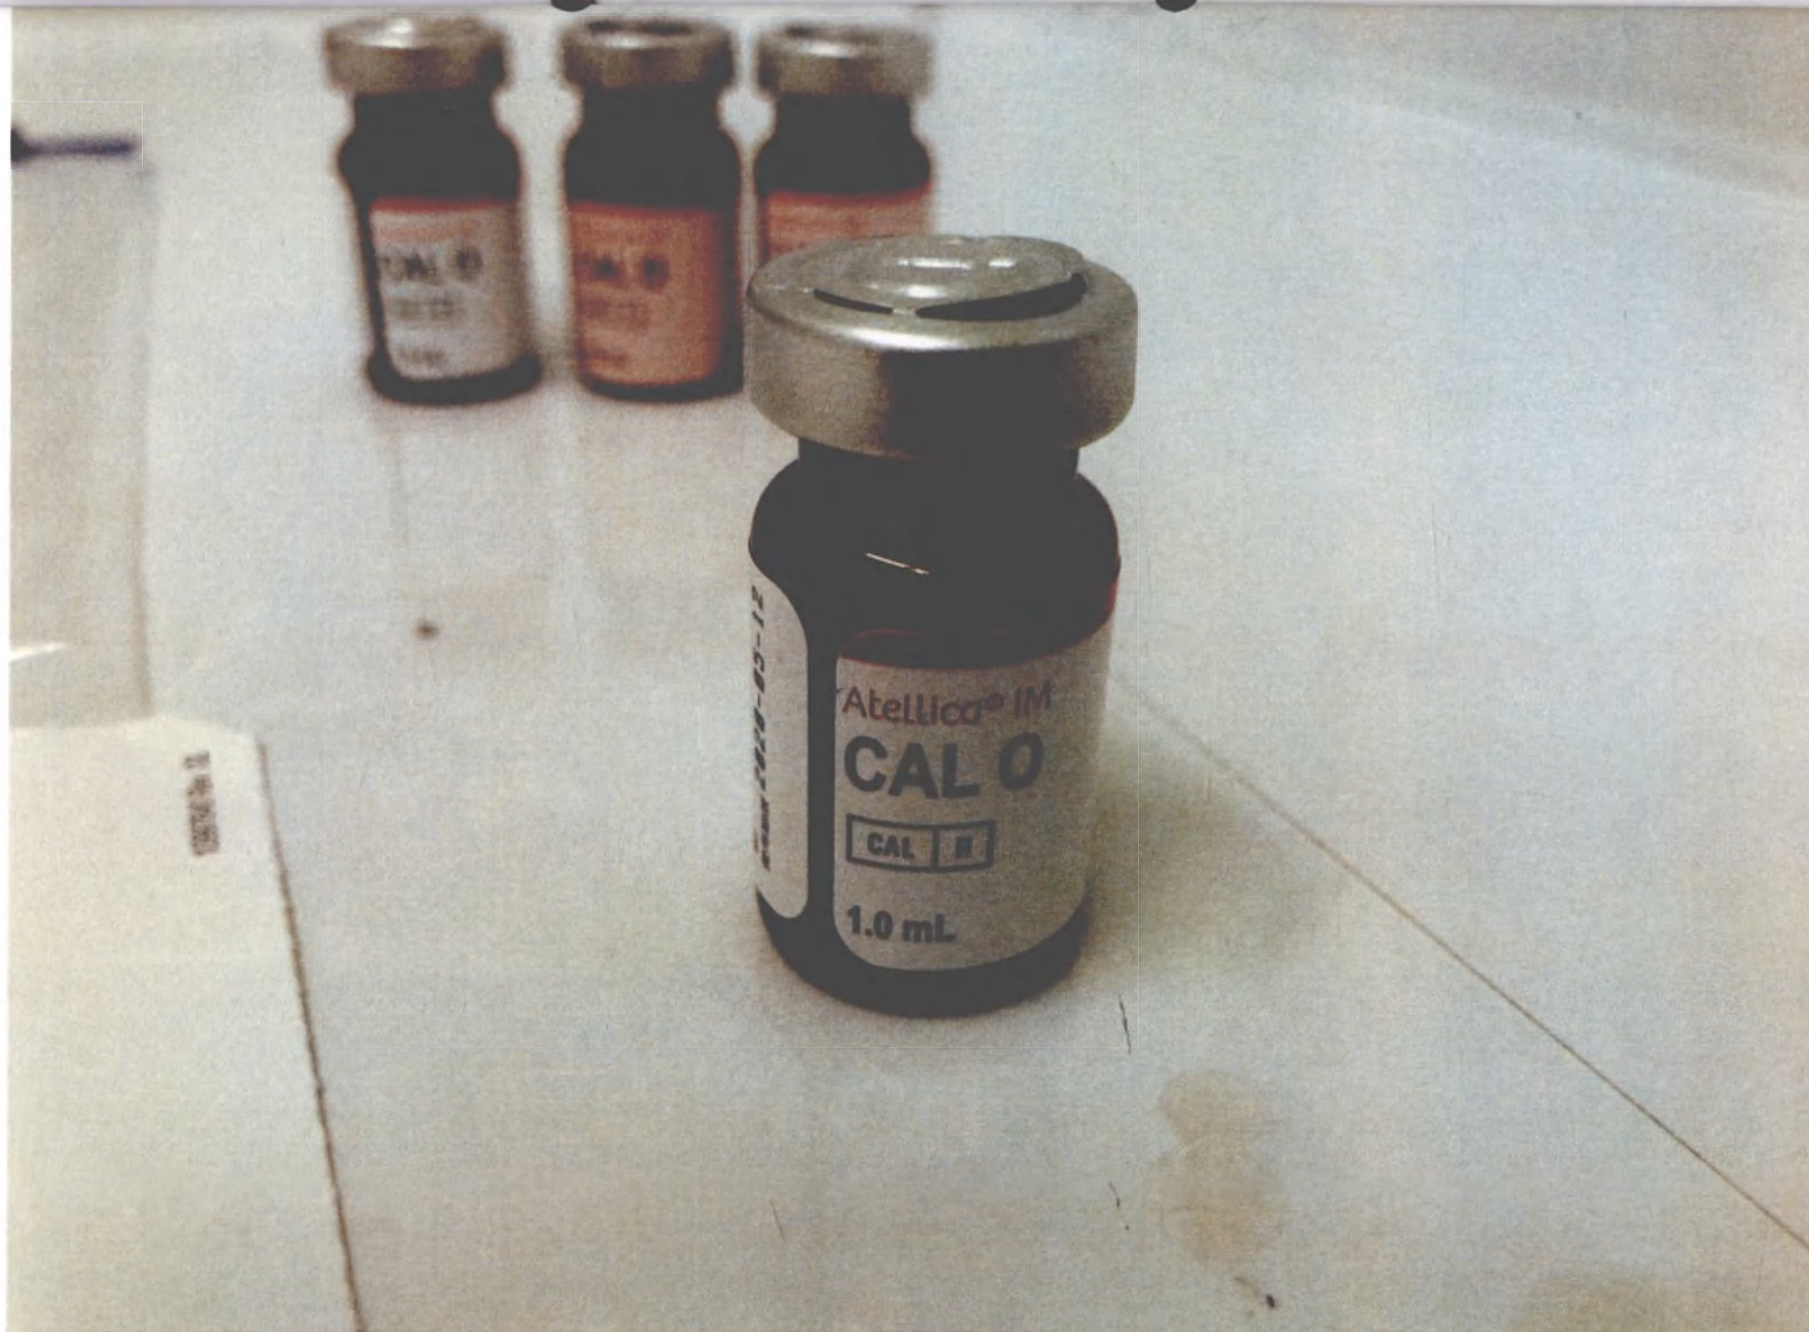


Рисунок 5. Набор калибраторов О для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Calibrator O (Atellica IM CAL O)): Калибратор с высокой концентрацией Atellica IM CAL O H, 1,0 мл

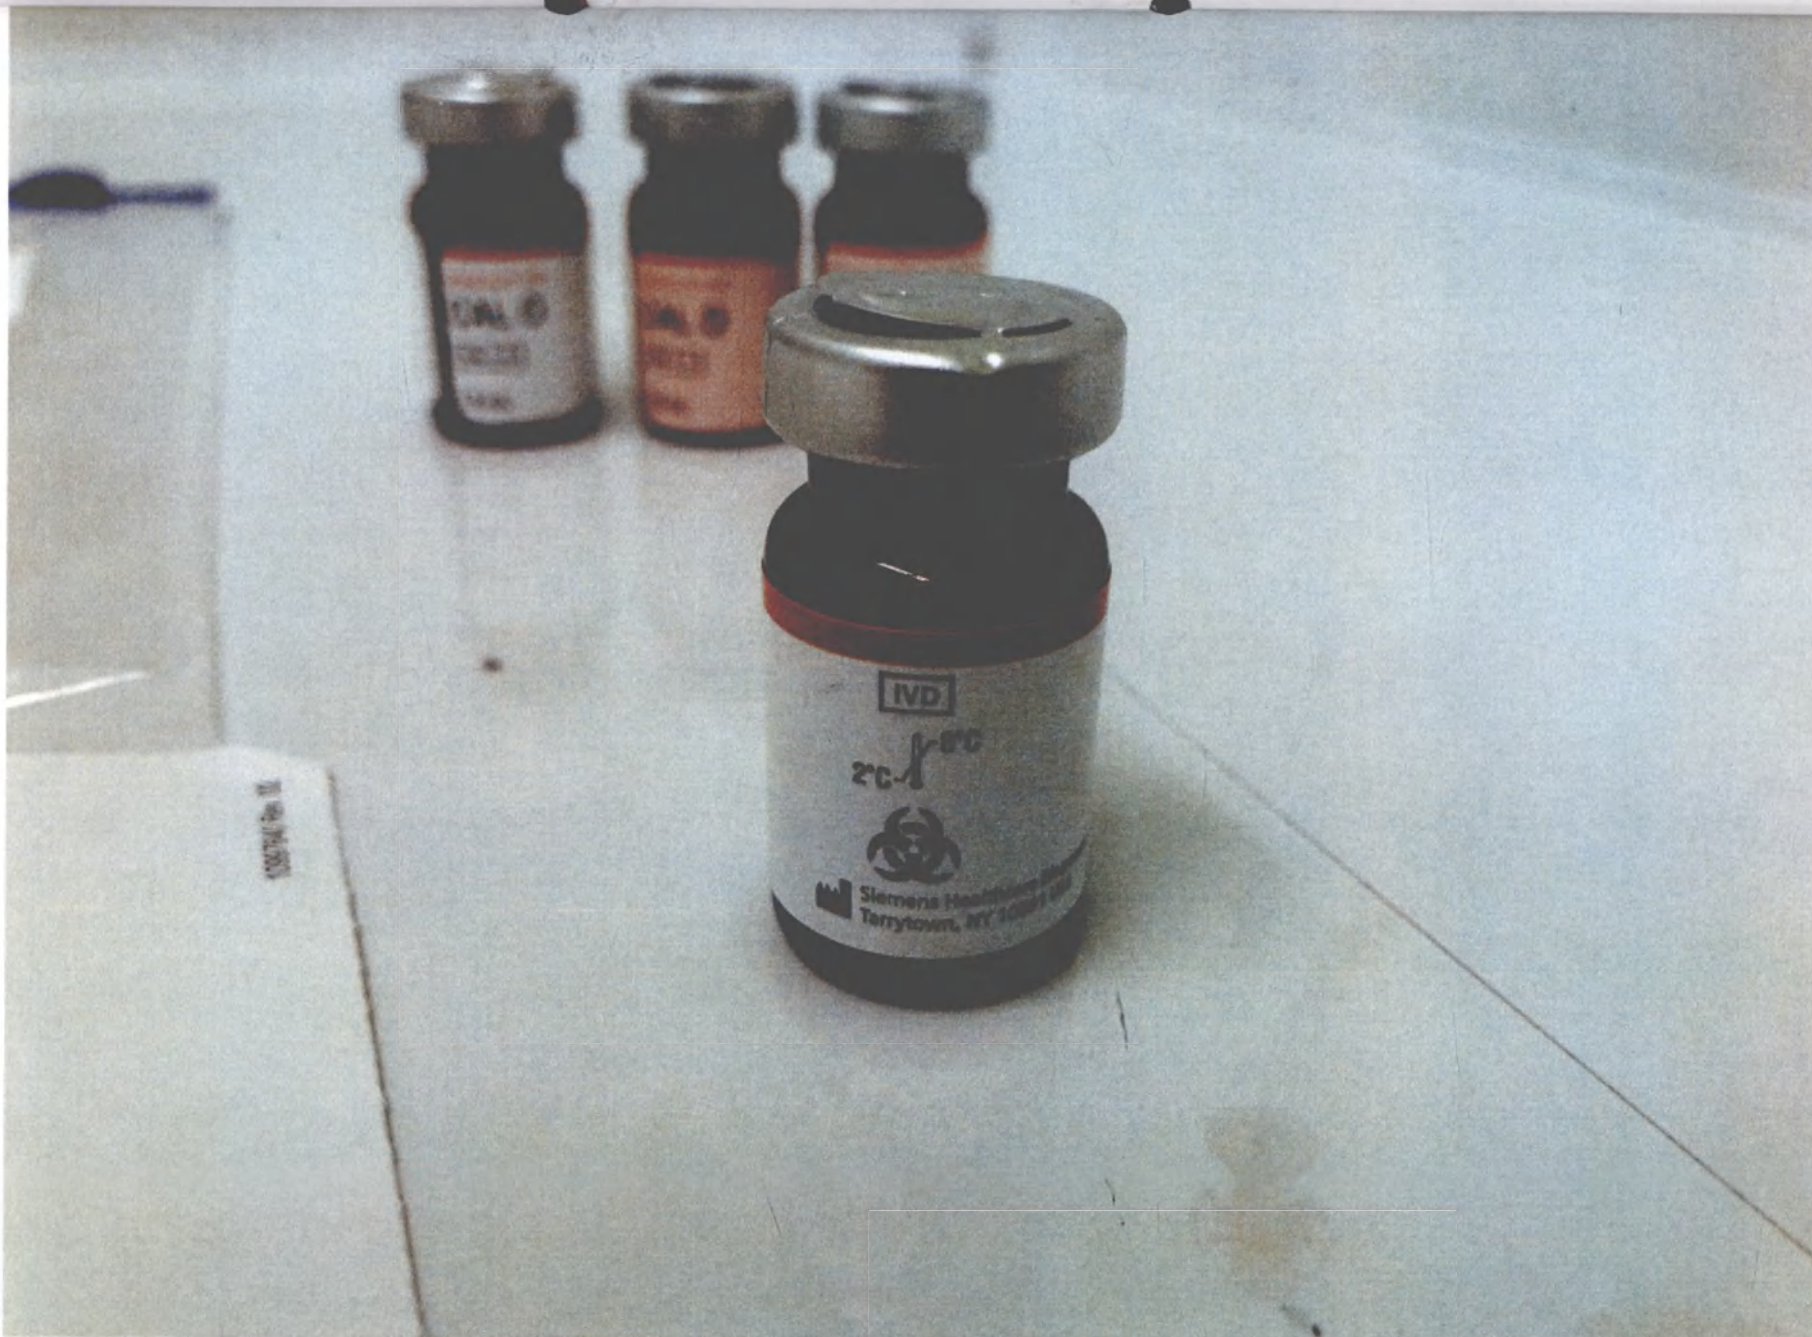


Рисунок 6. Набор калибраторов О для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Calibrator O (Atellica IM CAL O)): Калибратор с высокой концентрацией Atellica IM CAL O H, 1,0 мл



Рисунок 8. Набор калибраторов O для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Calibrator O (Atellica IM CAL O)): Лист значений параметров лота калибратора

Всего прошито и пронумеровано
4 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»

