PHILIPS

*Руководитель*

*Отдела по управлению качеством*

*ООО "ФИЛИПС"*

*Бахвалова О.В.*

*« 8 » декабря 2020г.*

# *ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ*

*«Монитор фетальный Avalon, исполнения Avalon FM20, Avalon FM30 с принадлежностями»*

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

*Принадлежности:*

***1. Фетальный монитор Avalon FM20- блок аппарата базовый***

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

*2. Фетальный монитор Avalon FM30- блок аппарата базовый*

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

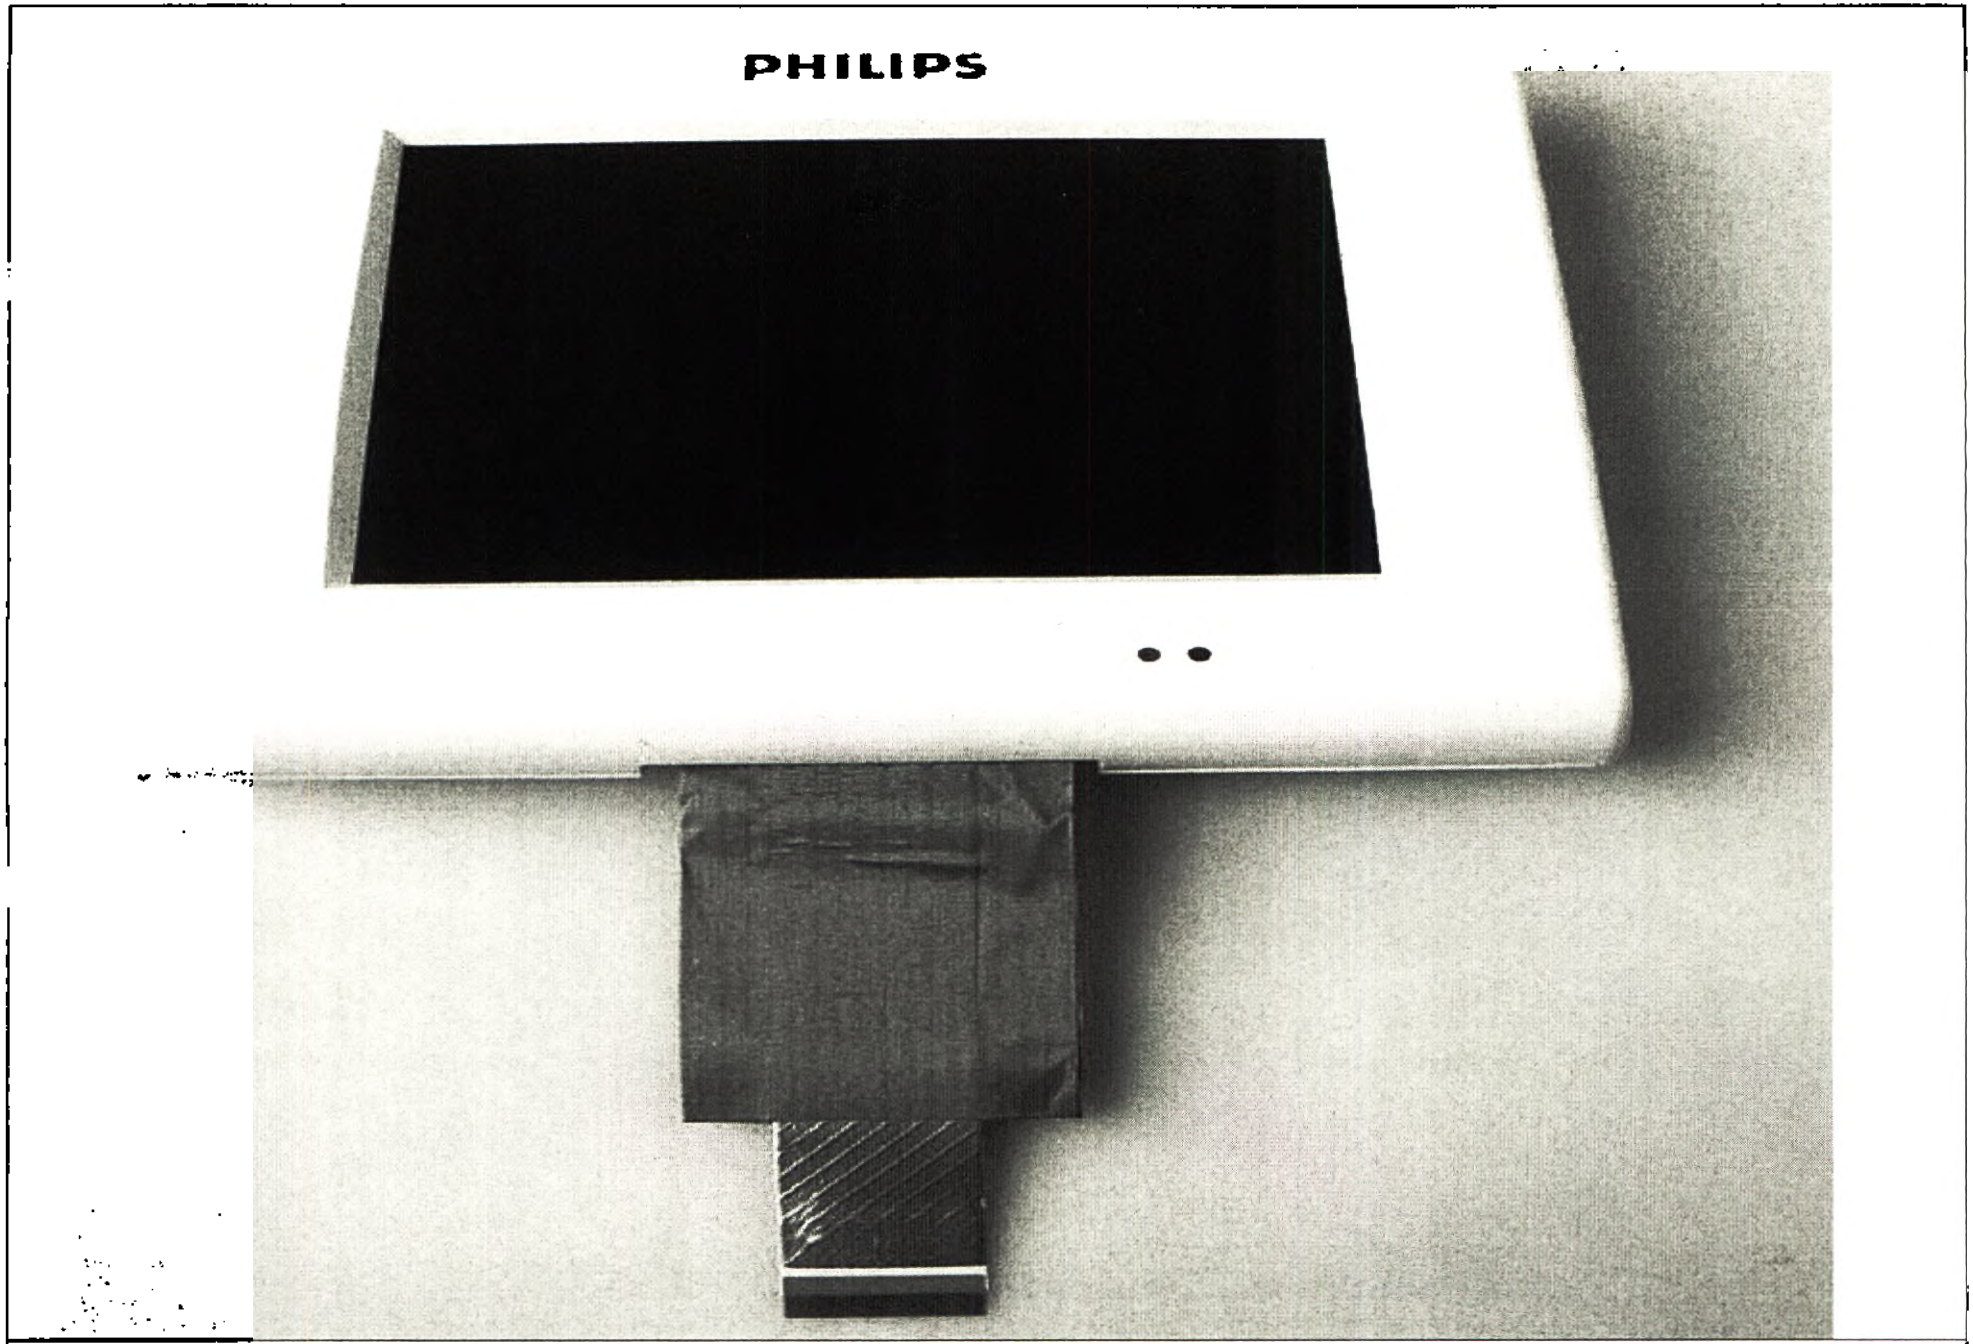


*3. 128x171 мм цветной ЖК TFT дисплей*

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

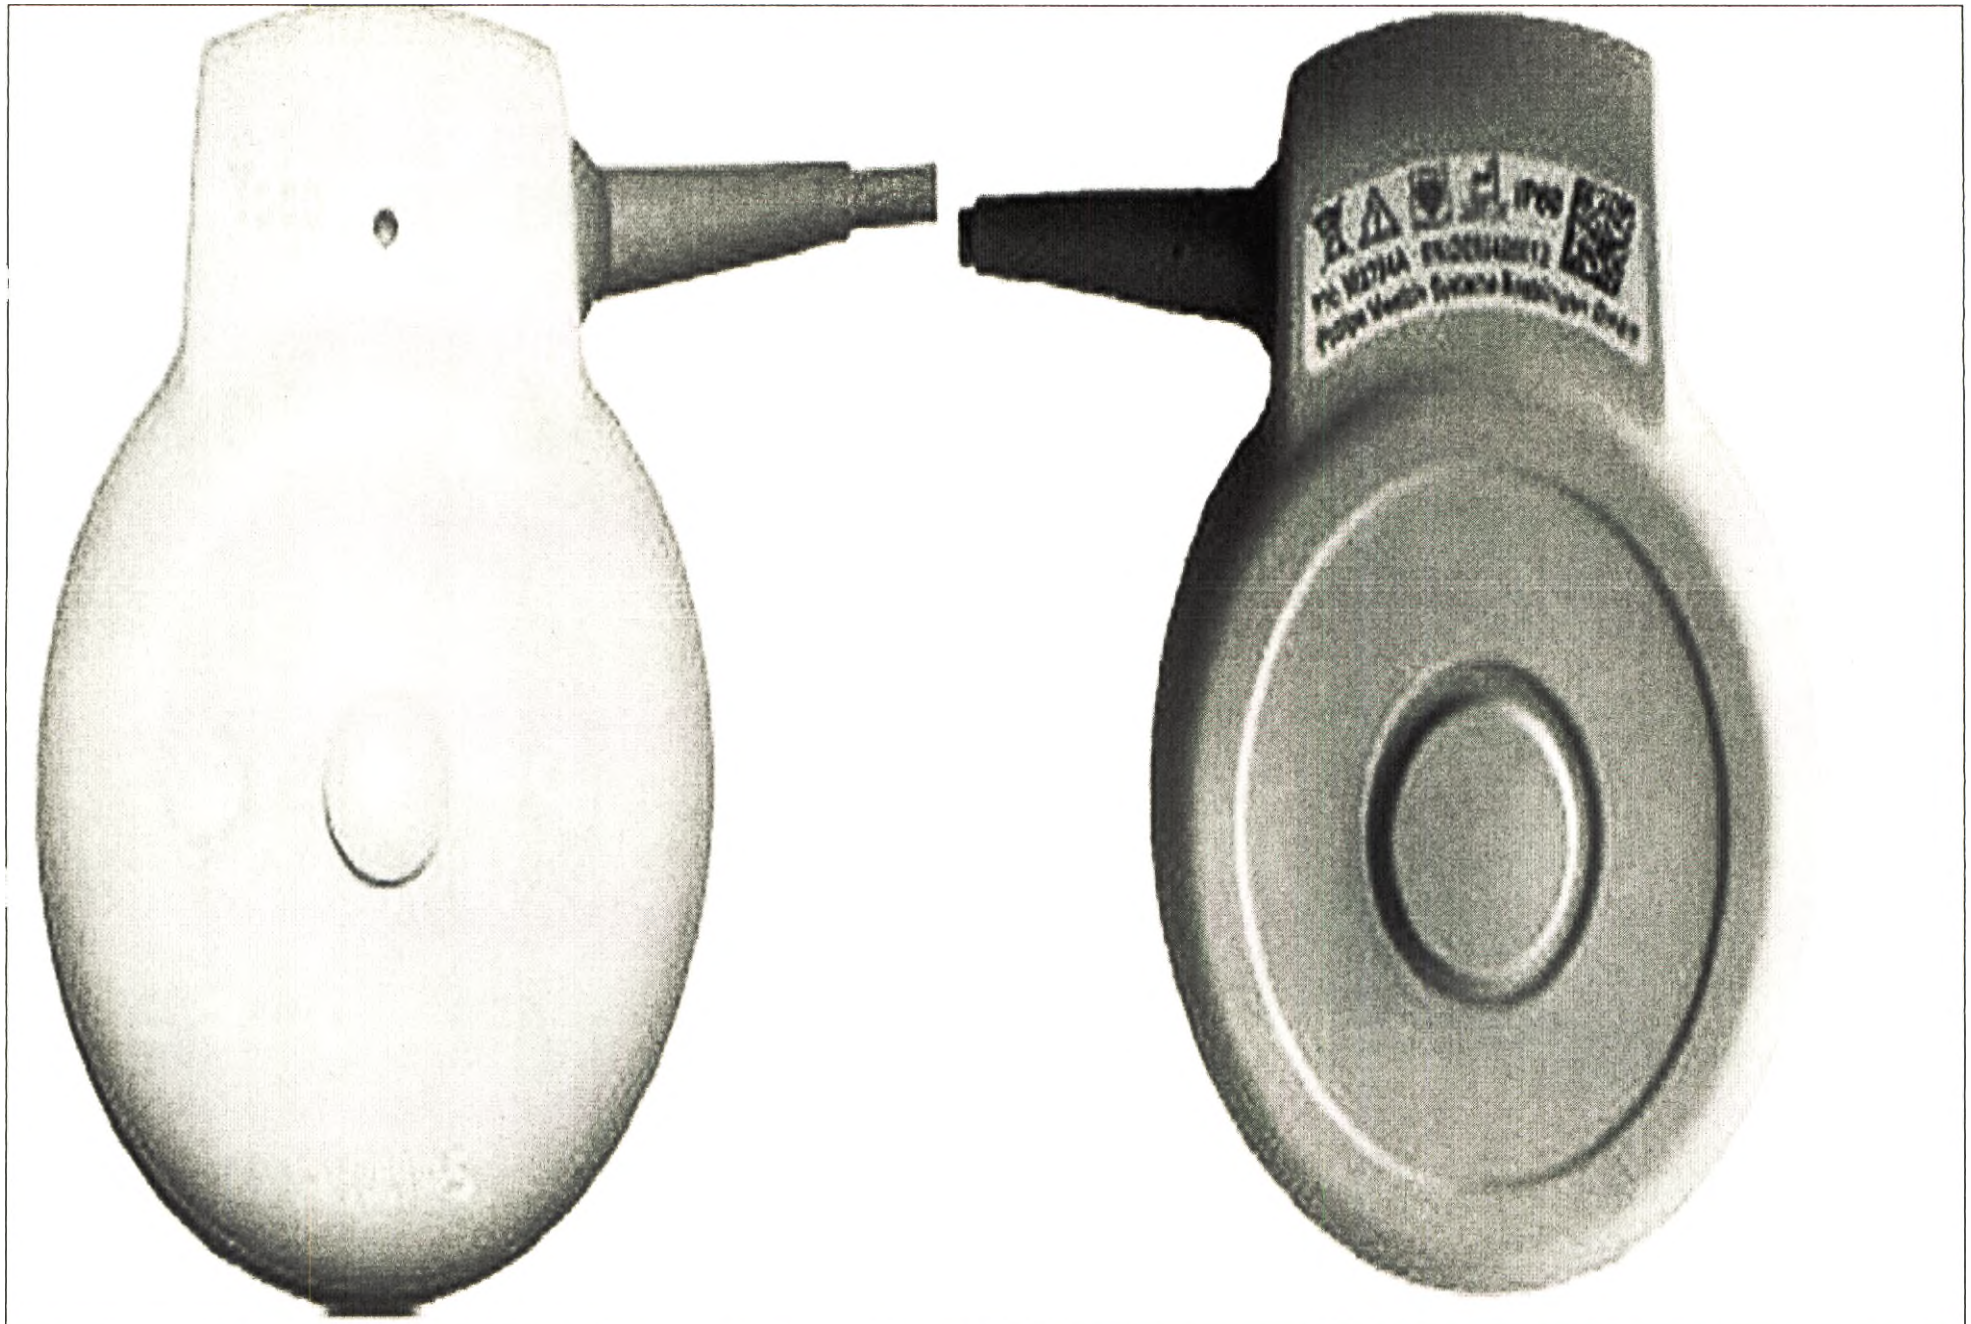

*4. Токо-датчик проводной*

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

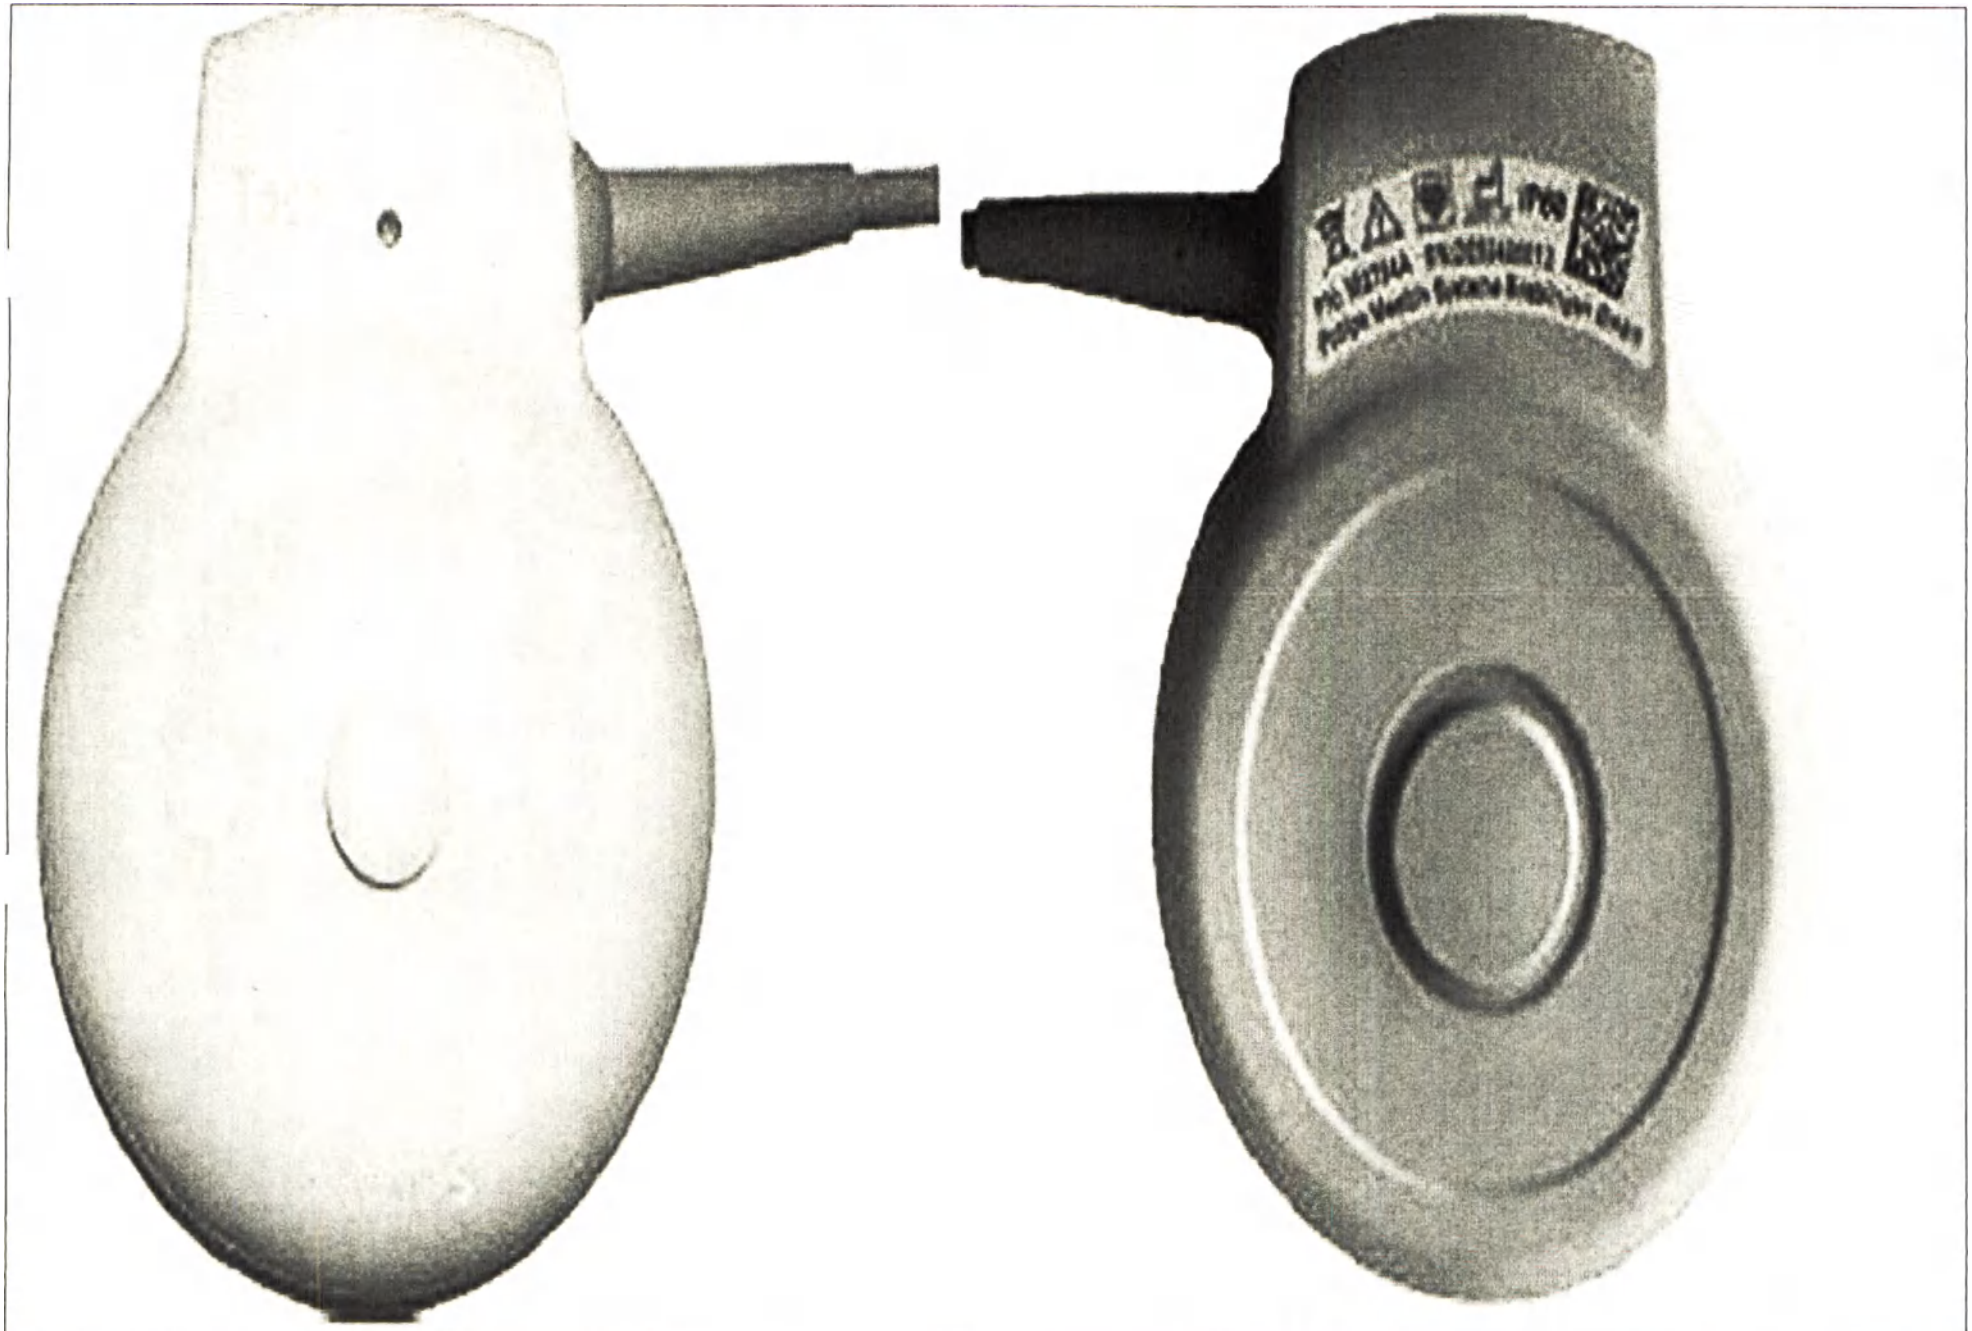

*4. Токо-датчик проводной*

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

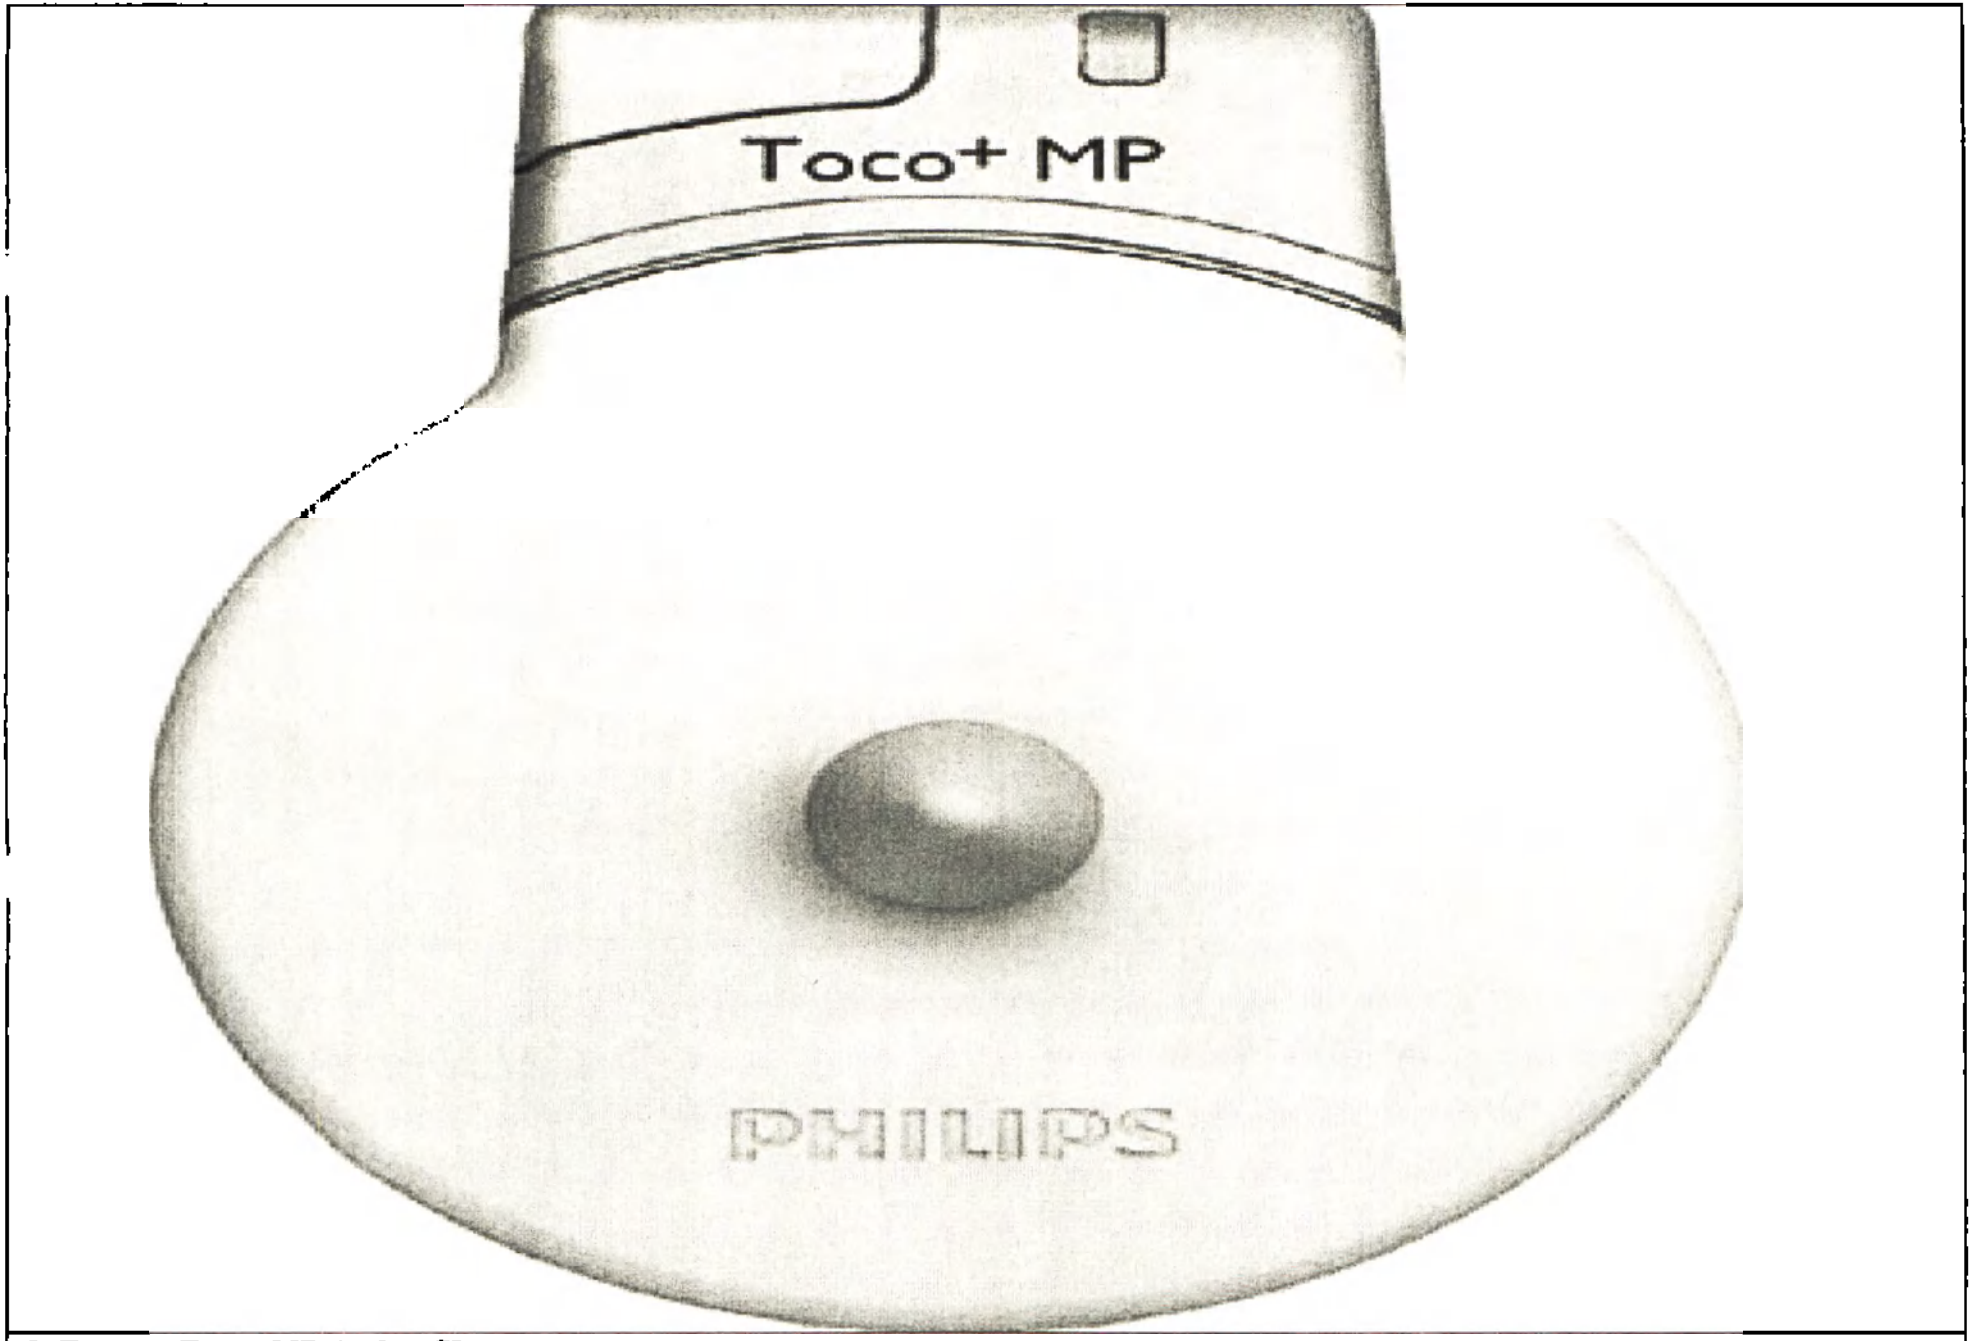


*5. Датчик Toco+ MP Avalon CL*

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

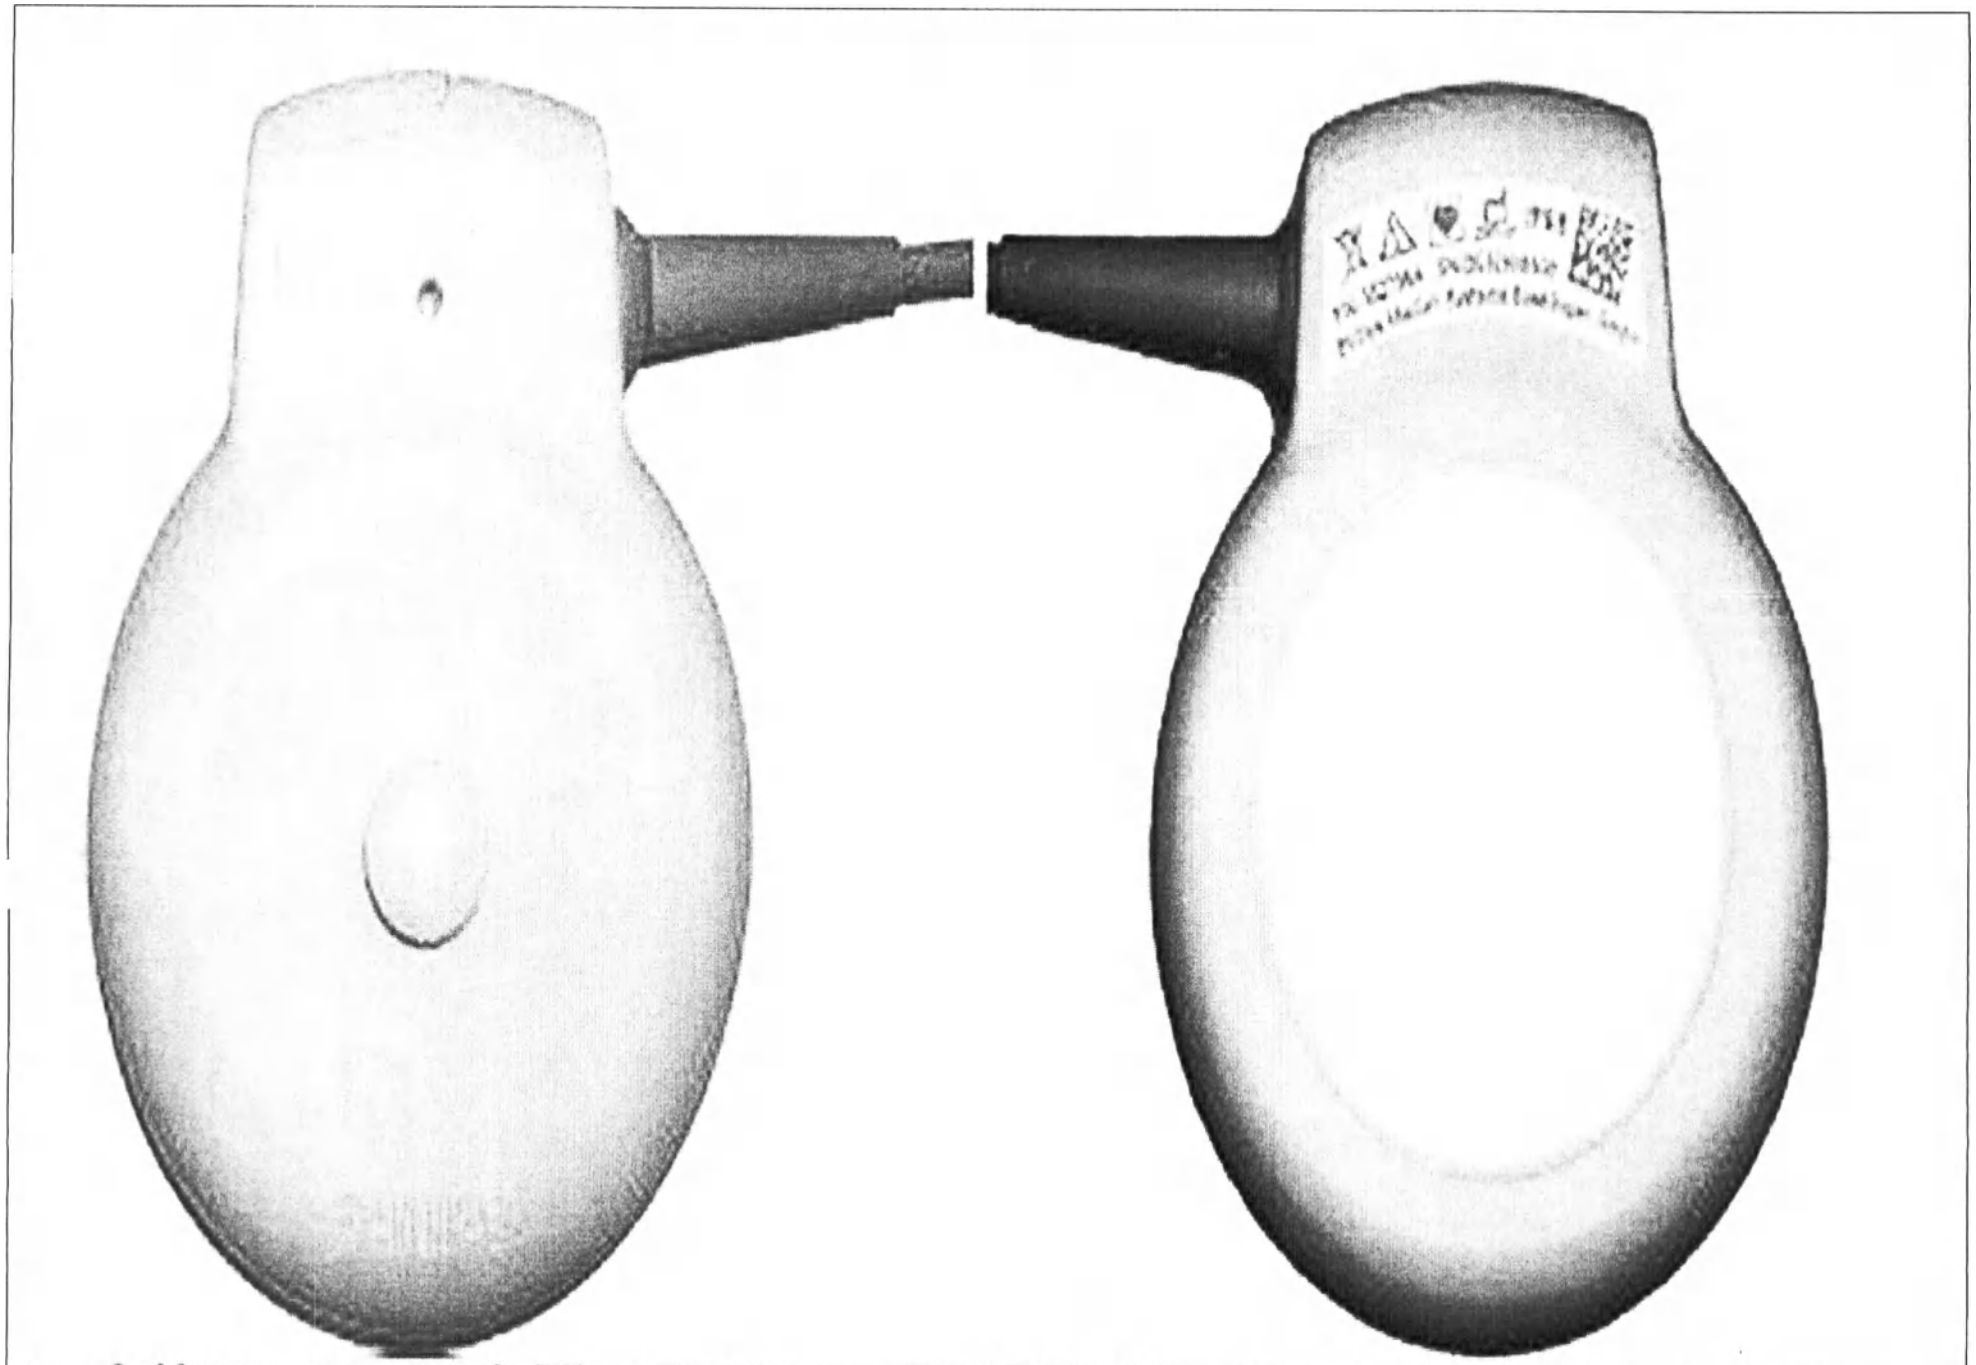

*6. Ультразвуковой датчик проводной*

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

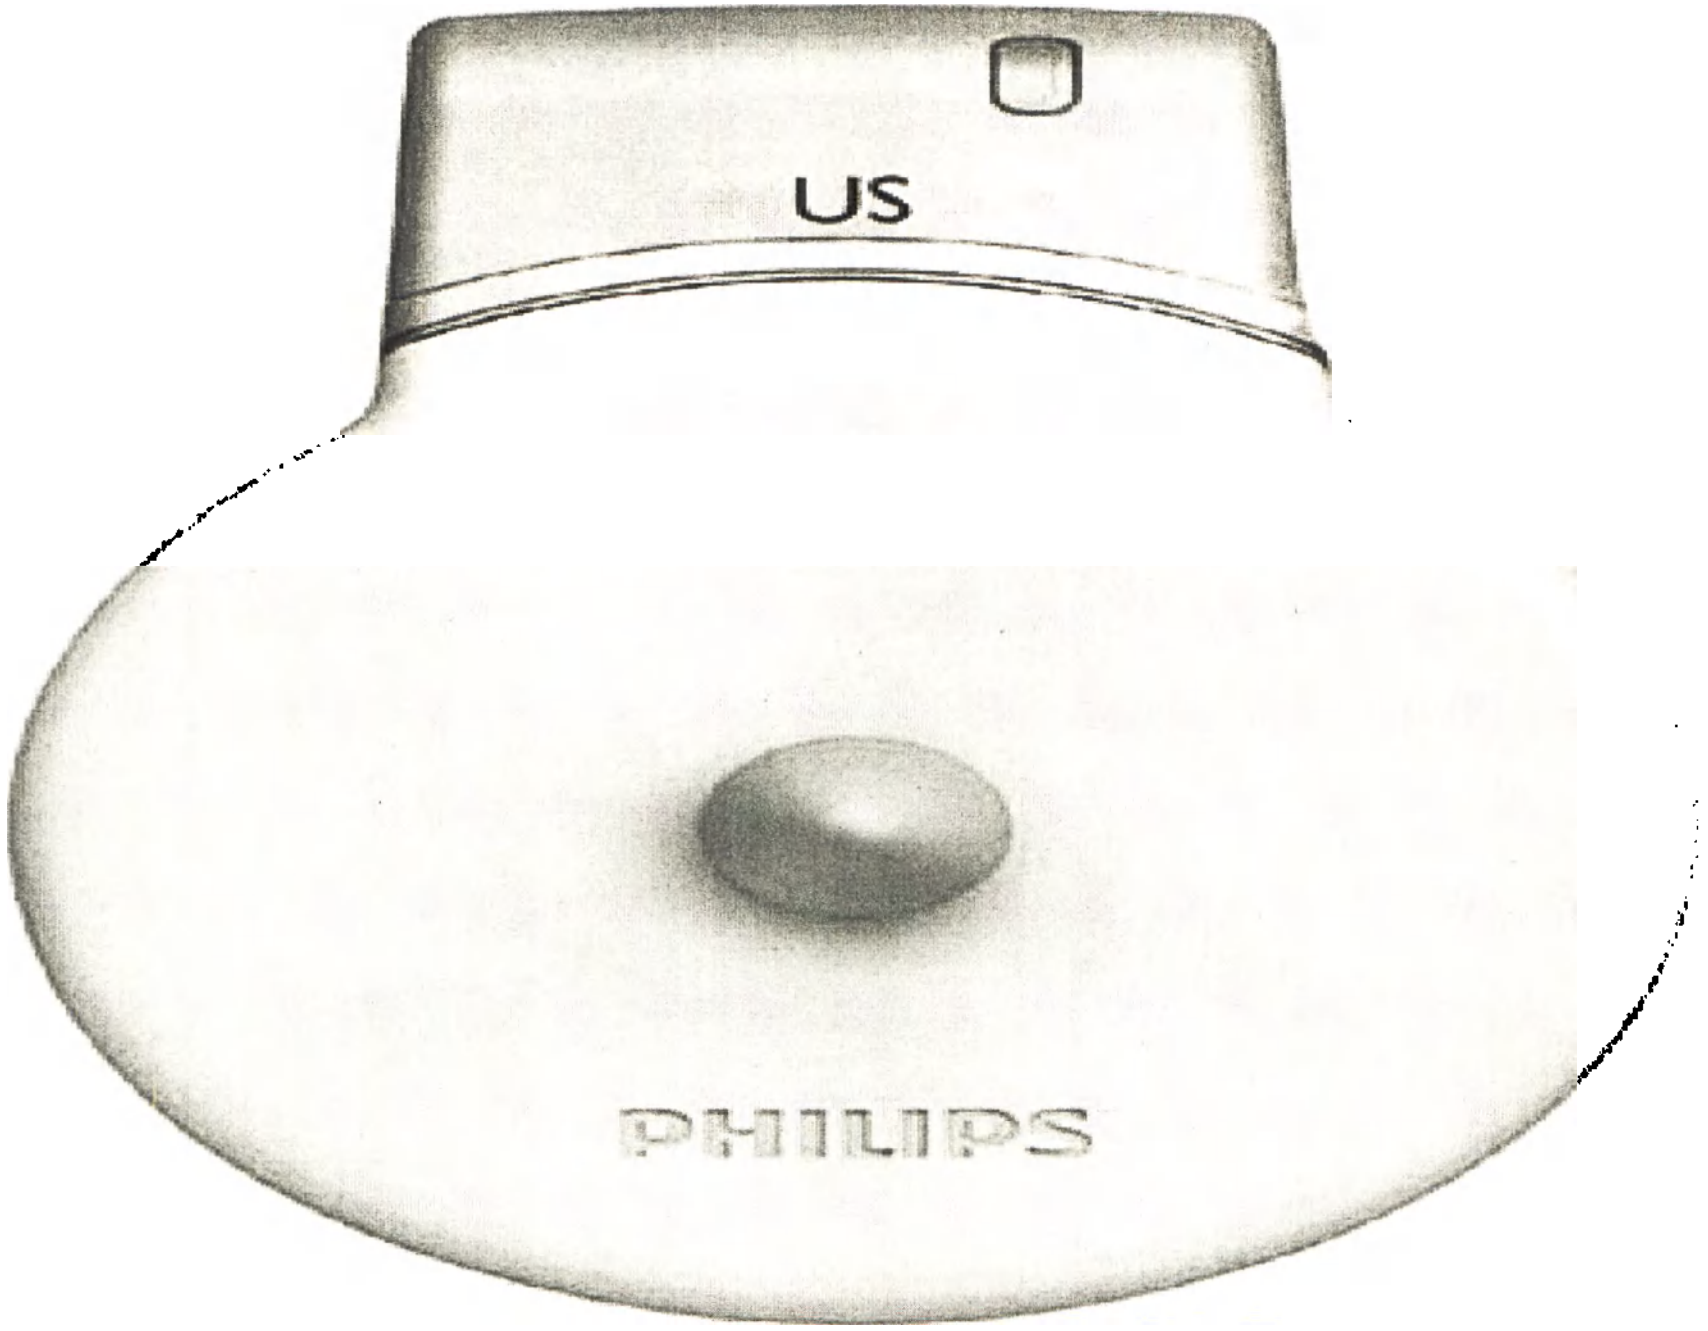


*7.Ультразуковой датчик Avalon CL*

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

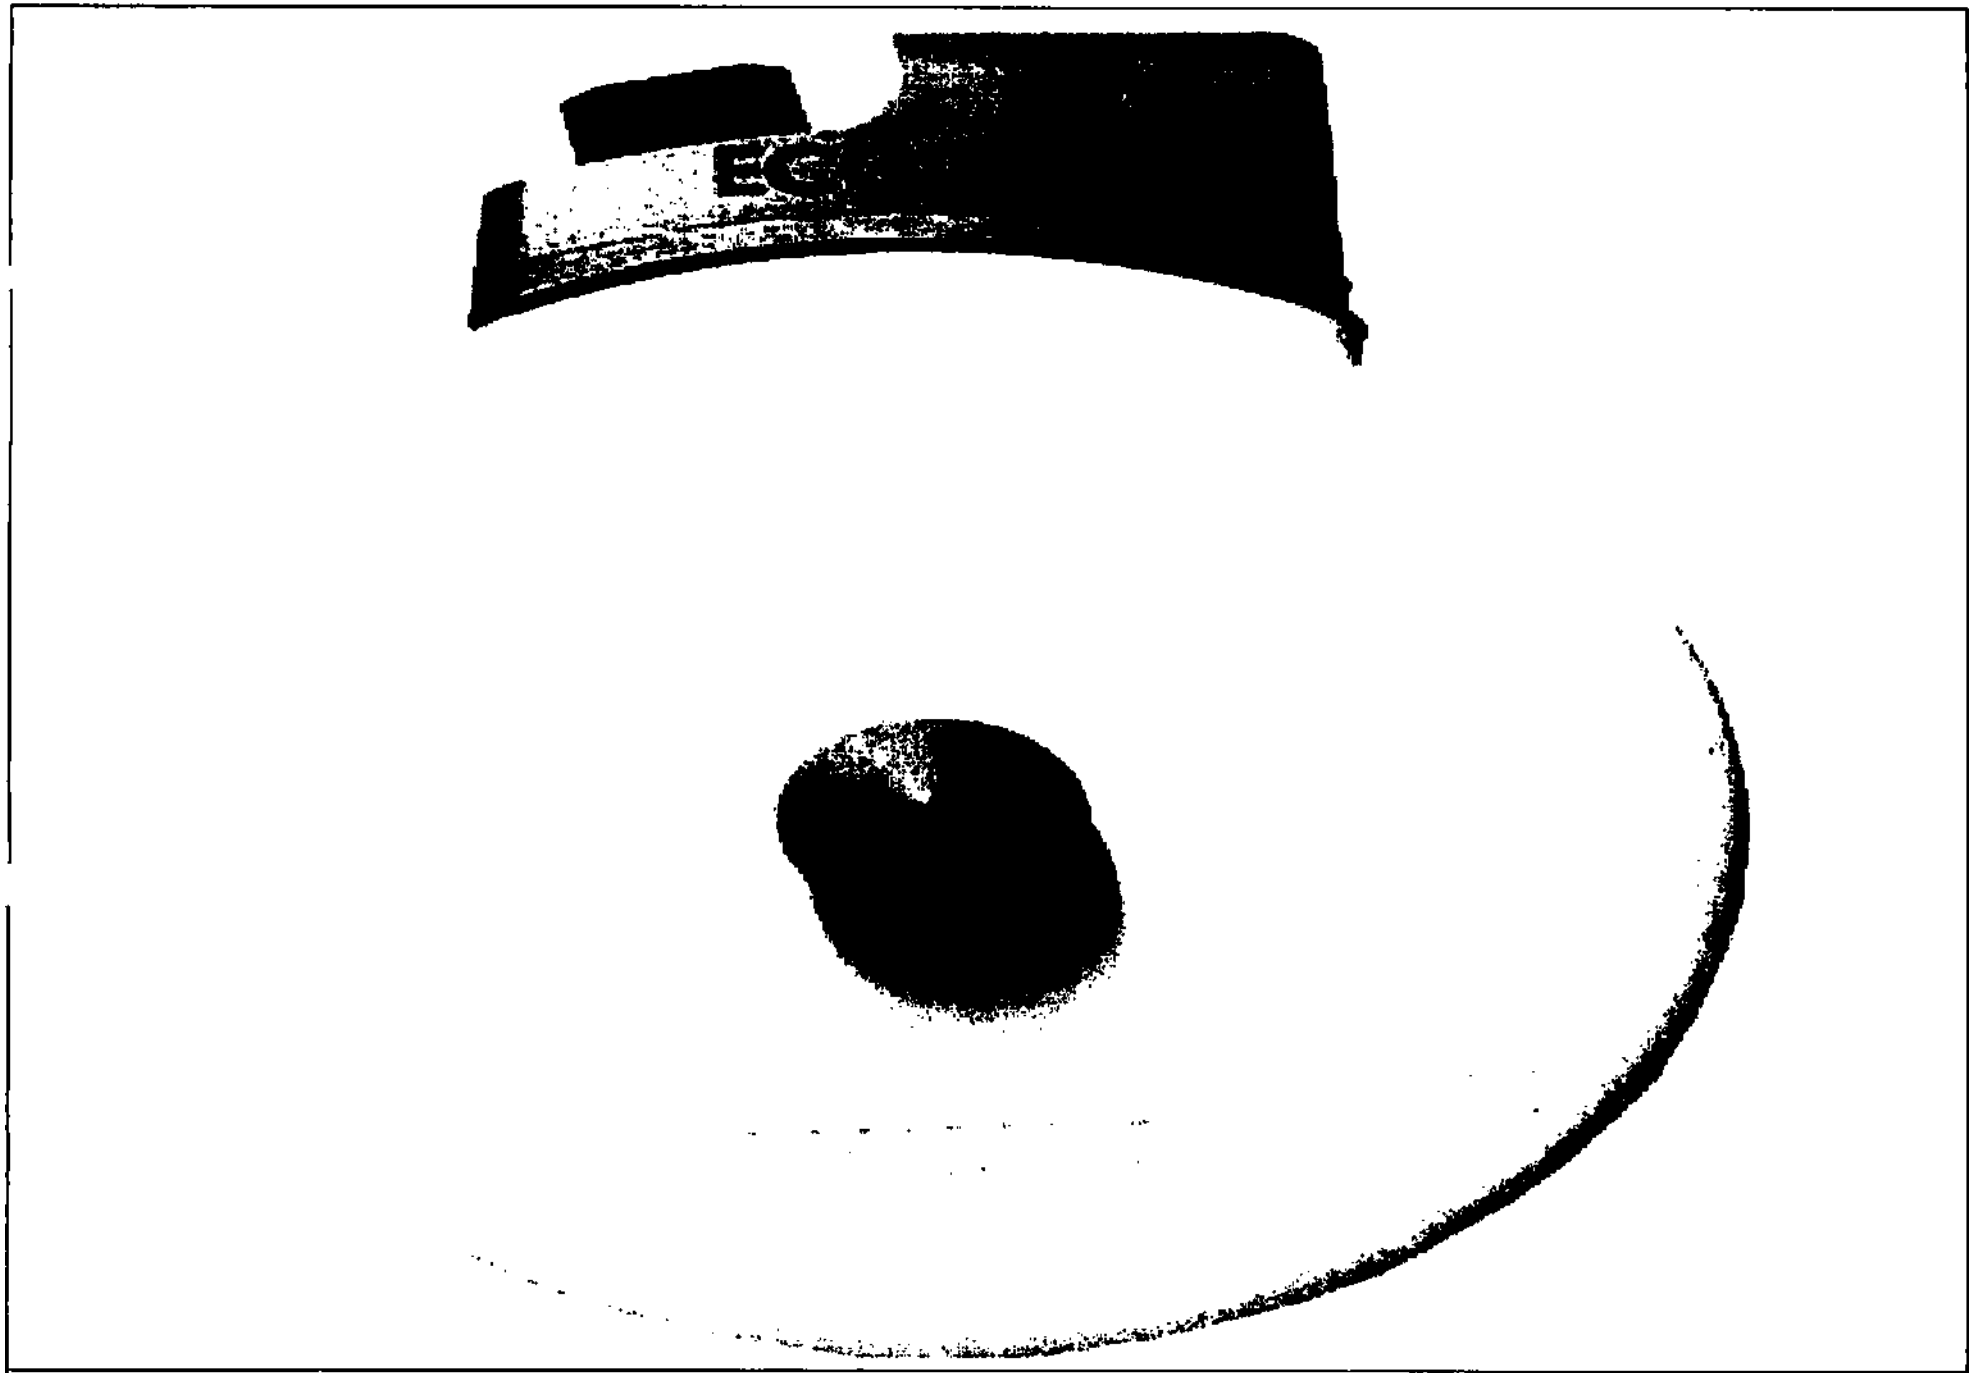

*9. Датчик ЭКГ/ВМД Avalon CL*

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

*10. Измеритель параметров матери и плода Avalon CL*

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

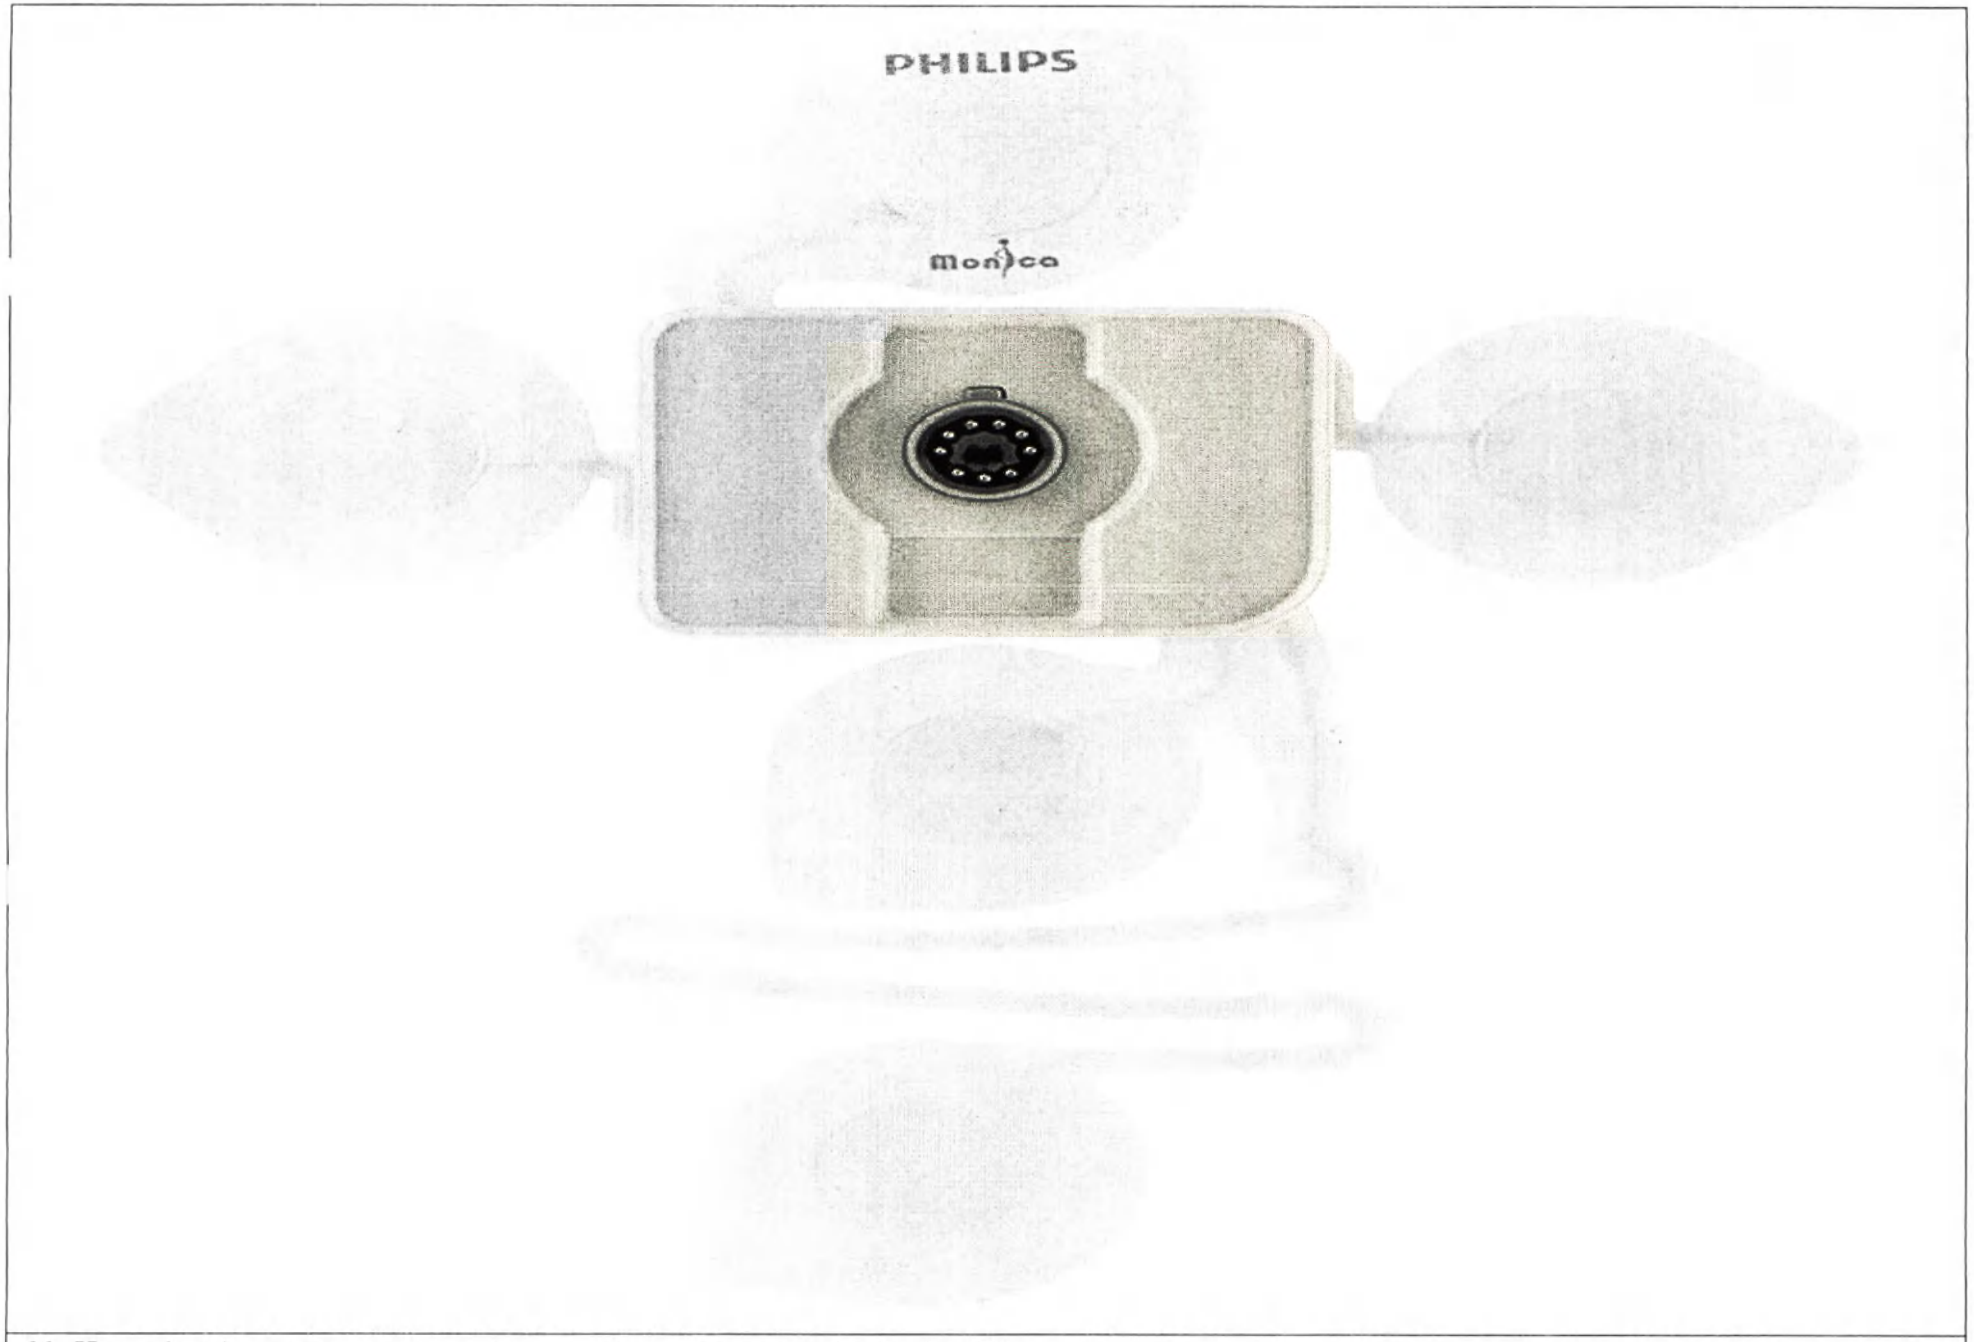


*11. Накладка для измерителя параметров матери и плода Avalon CL*

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

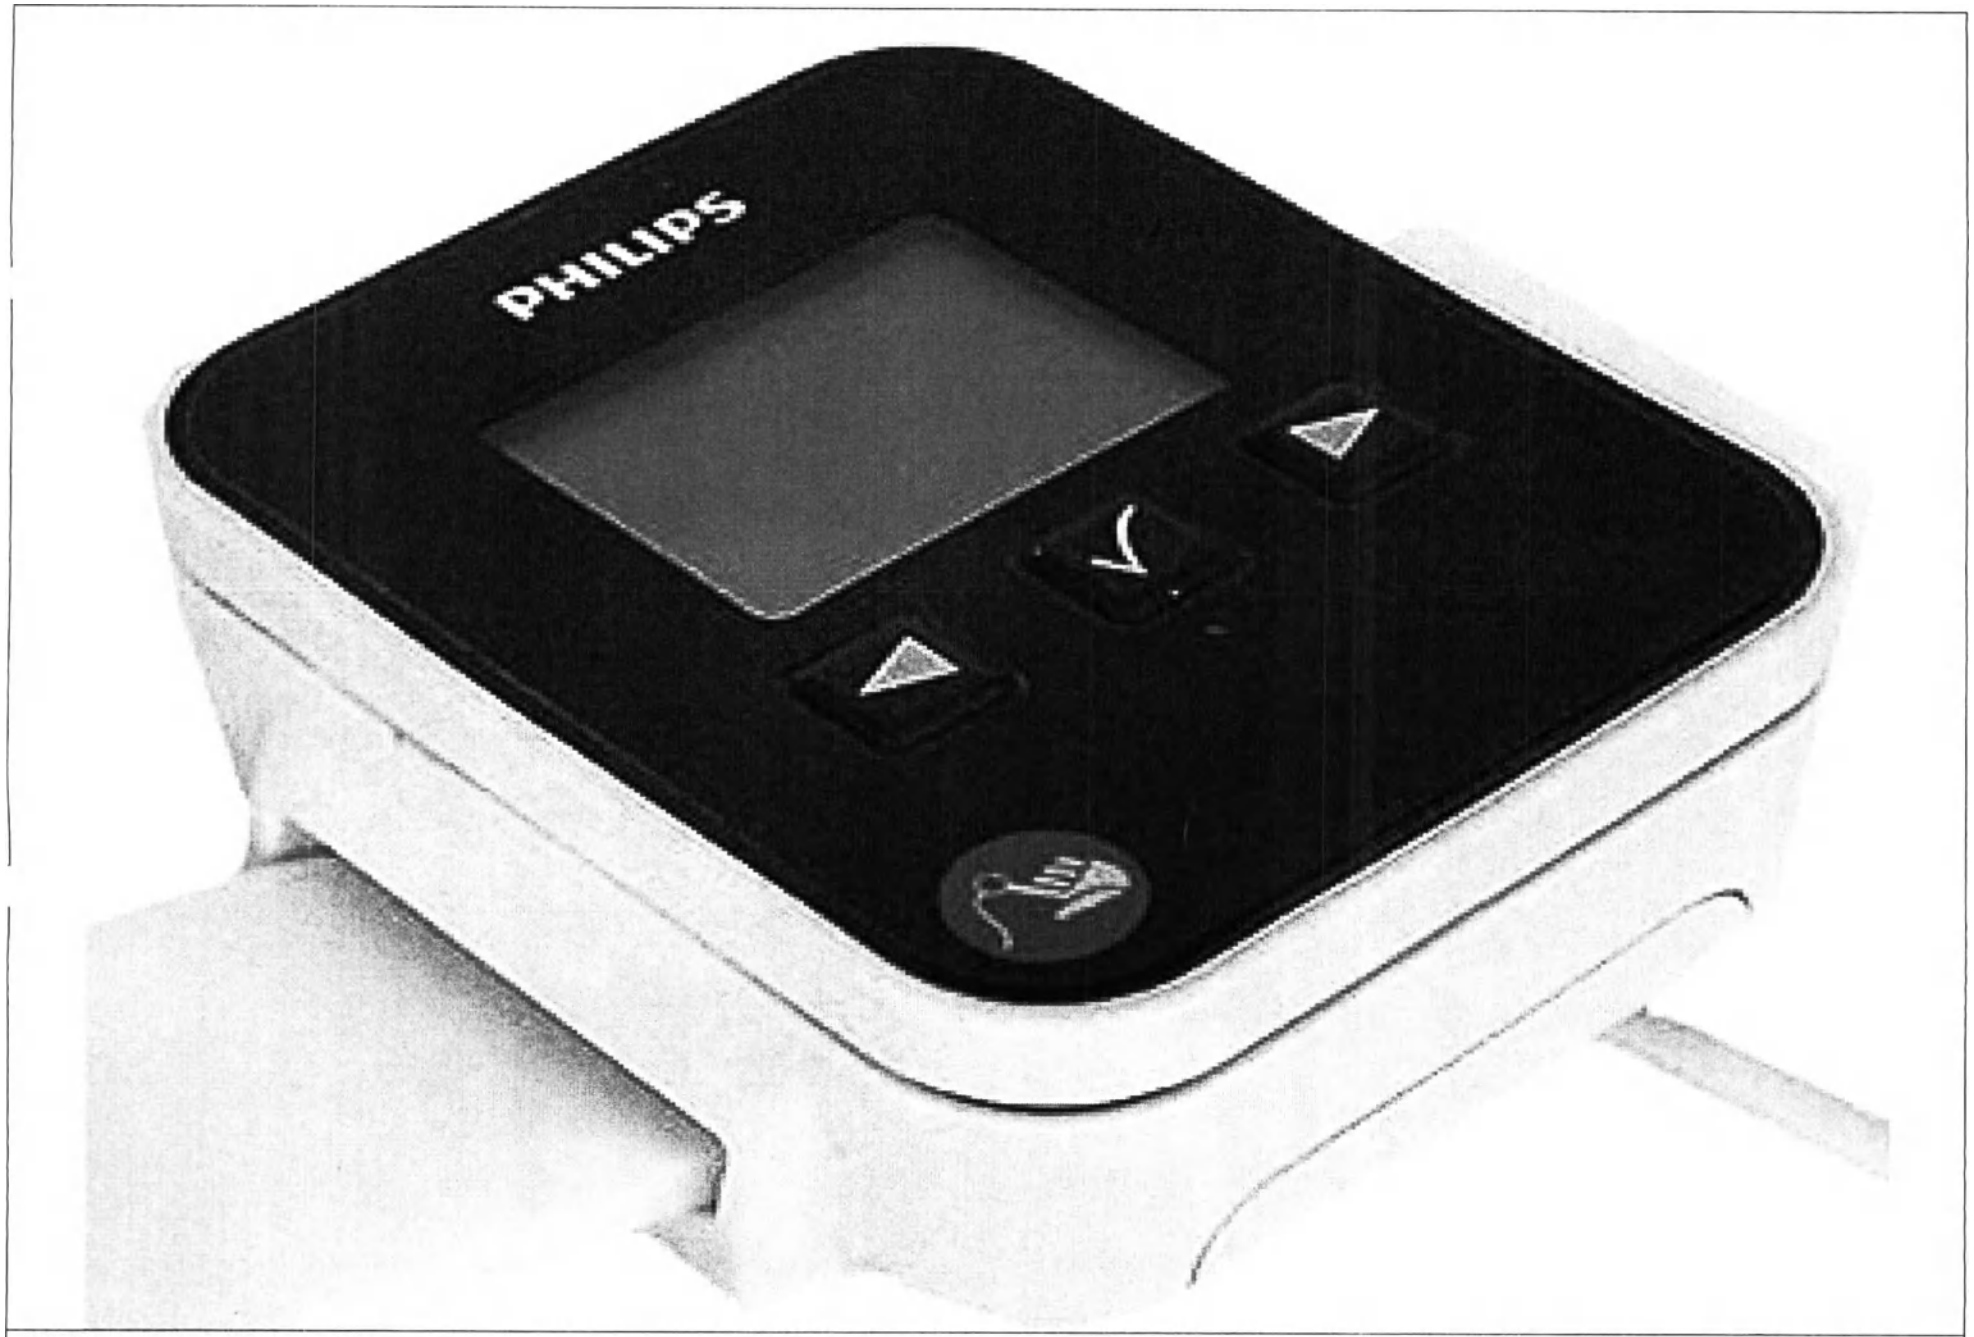


*12. Измеритель SpO2 CL*

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

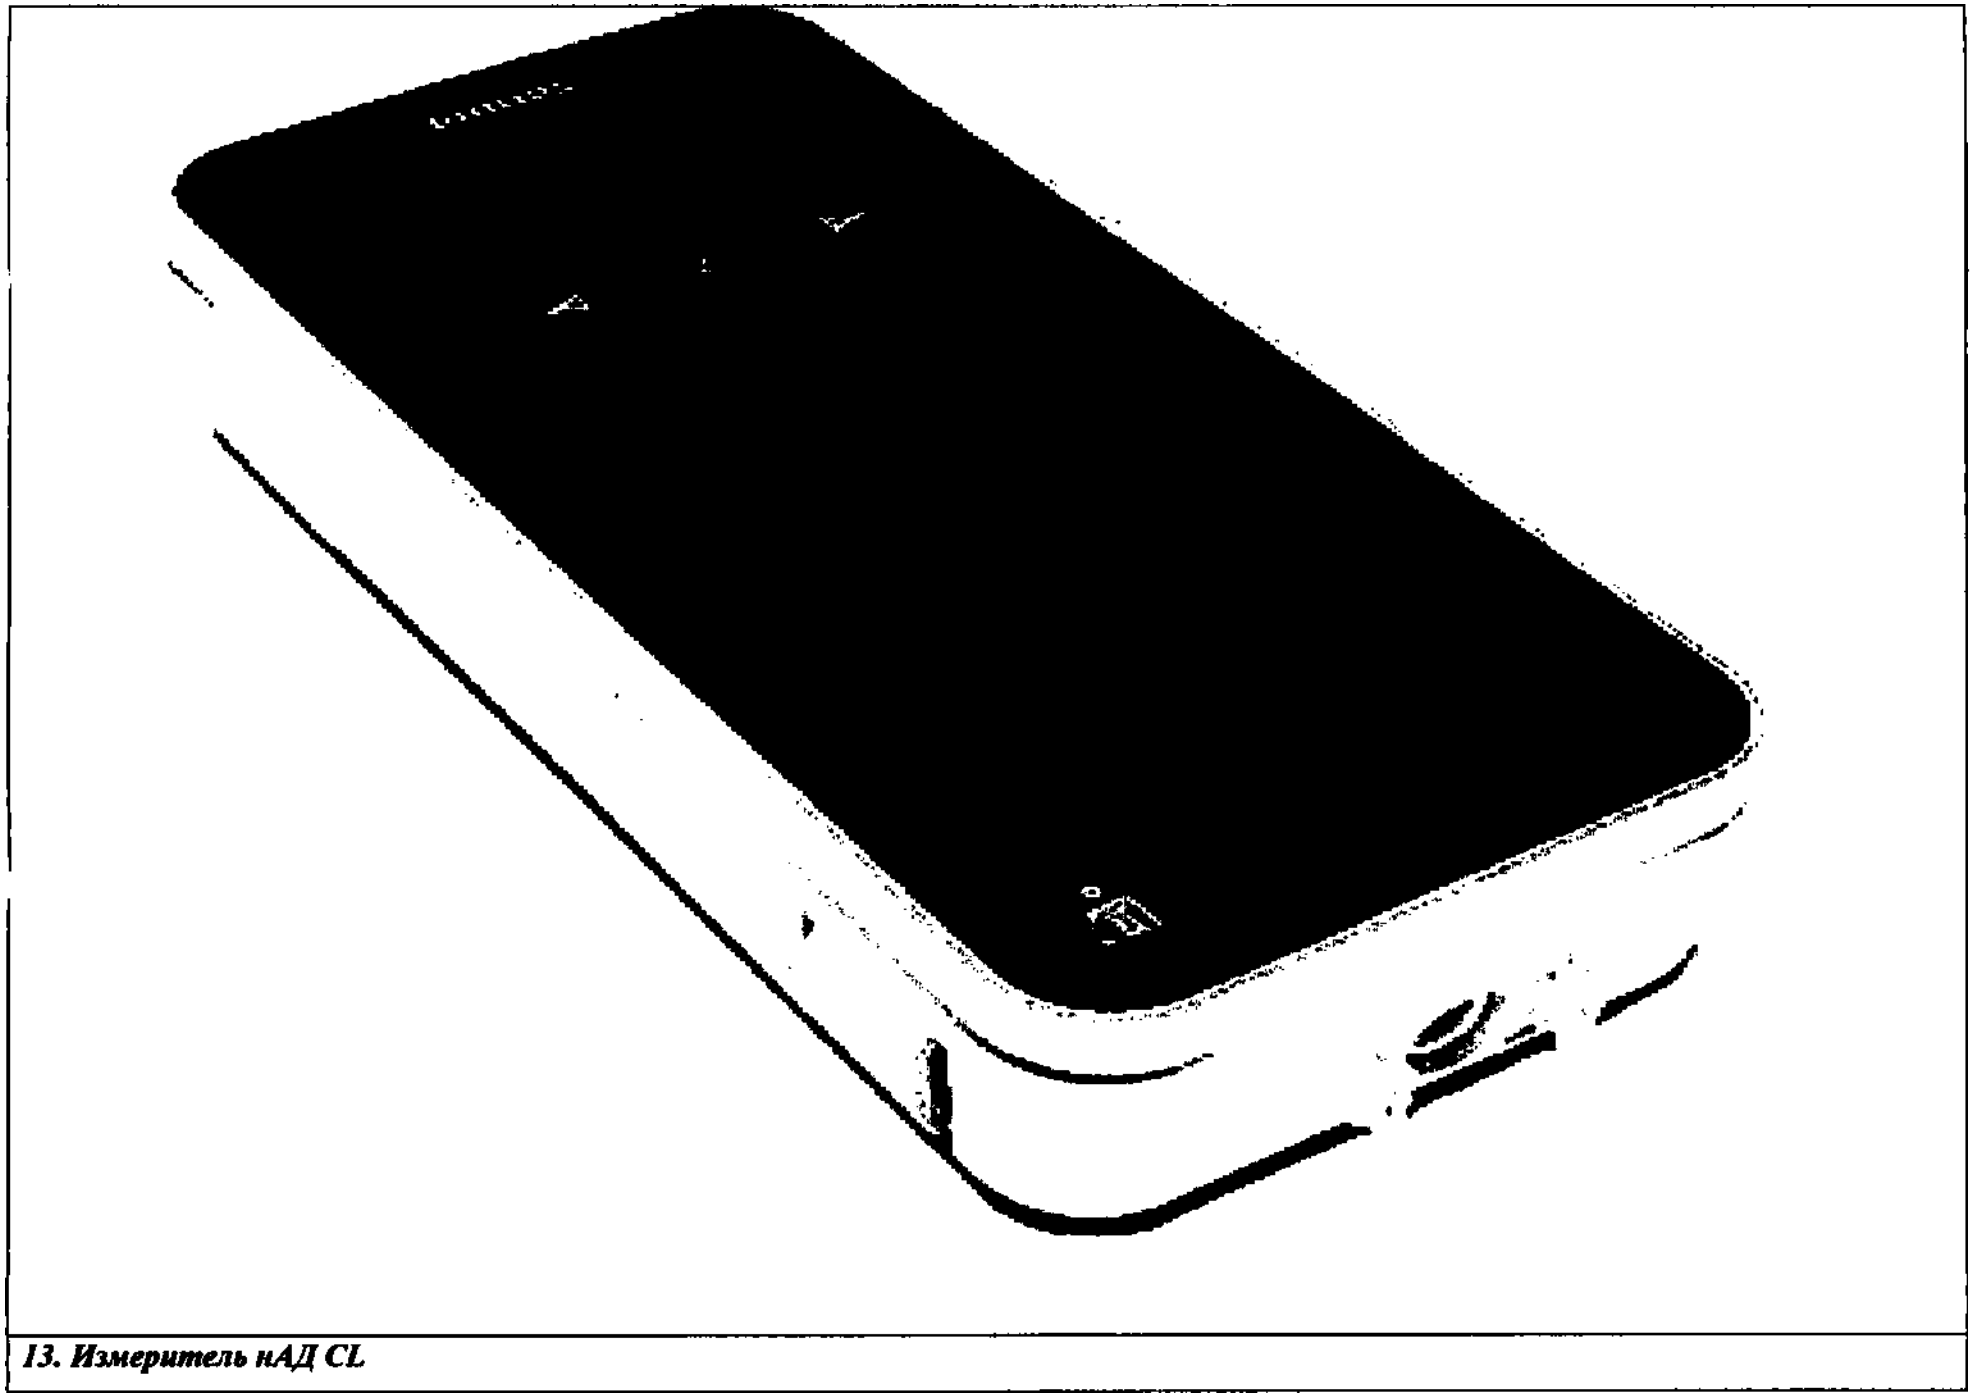

*13. Измеритель нАД CL*

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

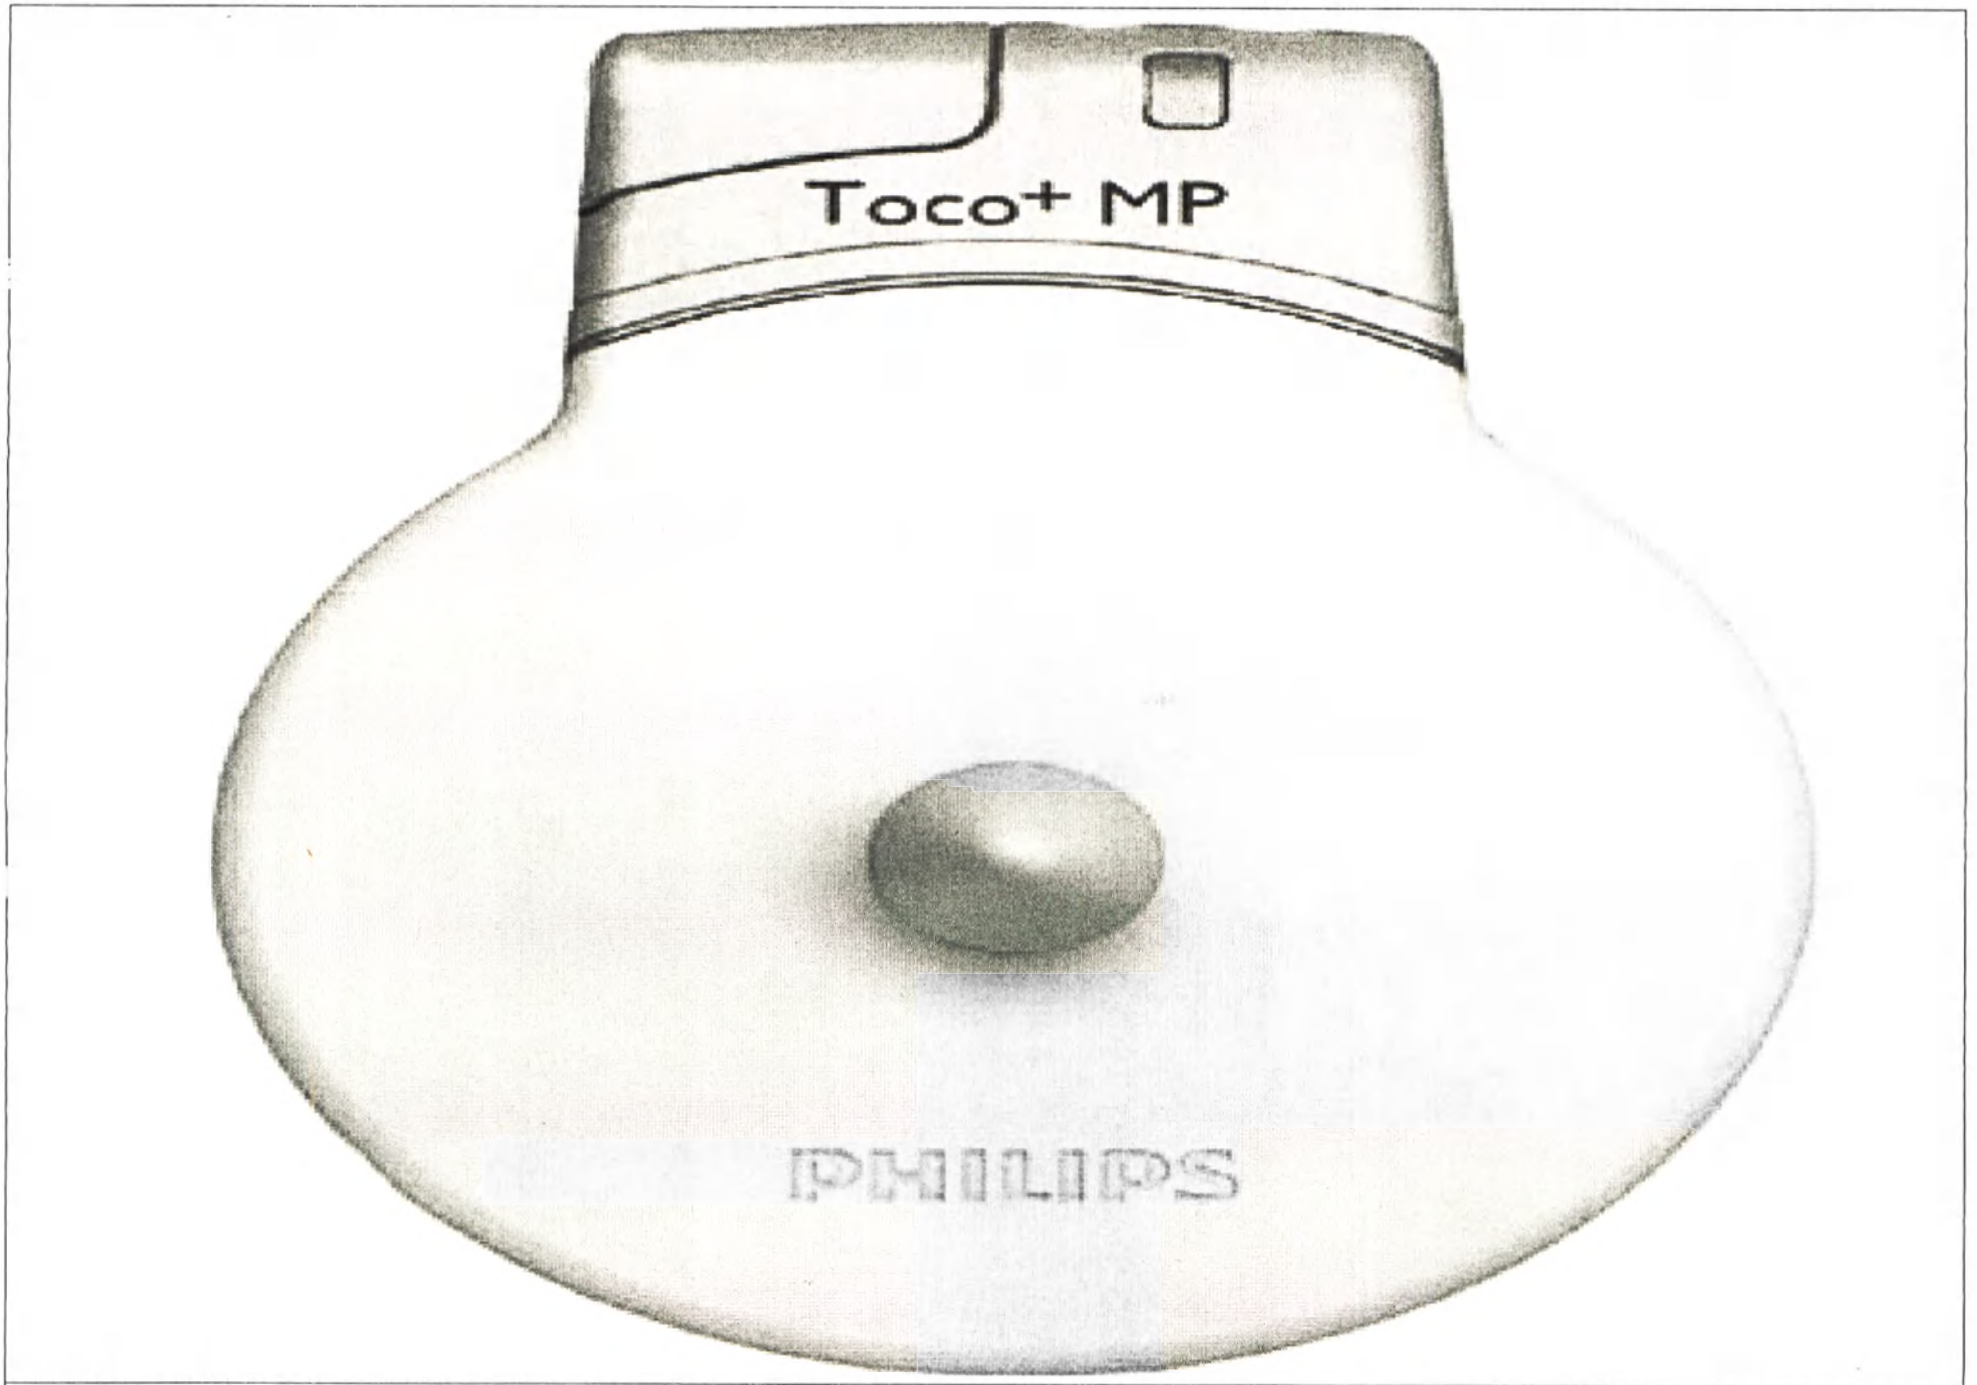


*14.1 Крышки для разъемов бескабельных датчиков Smart Avalon CL*

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

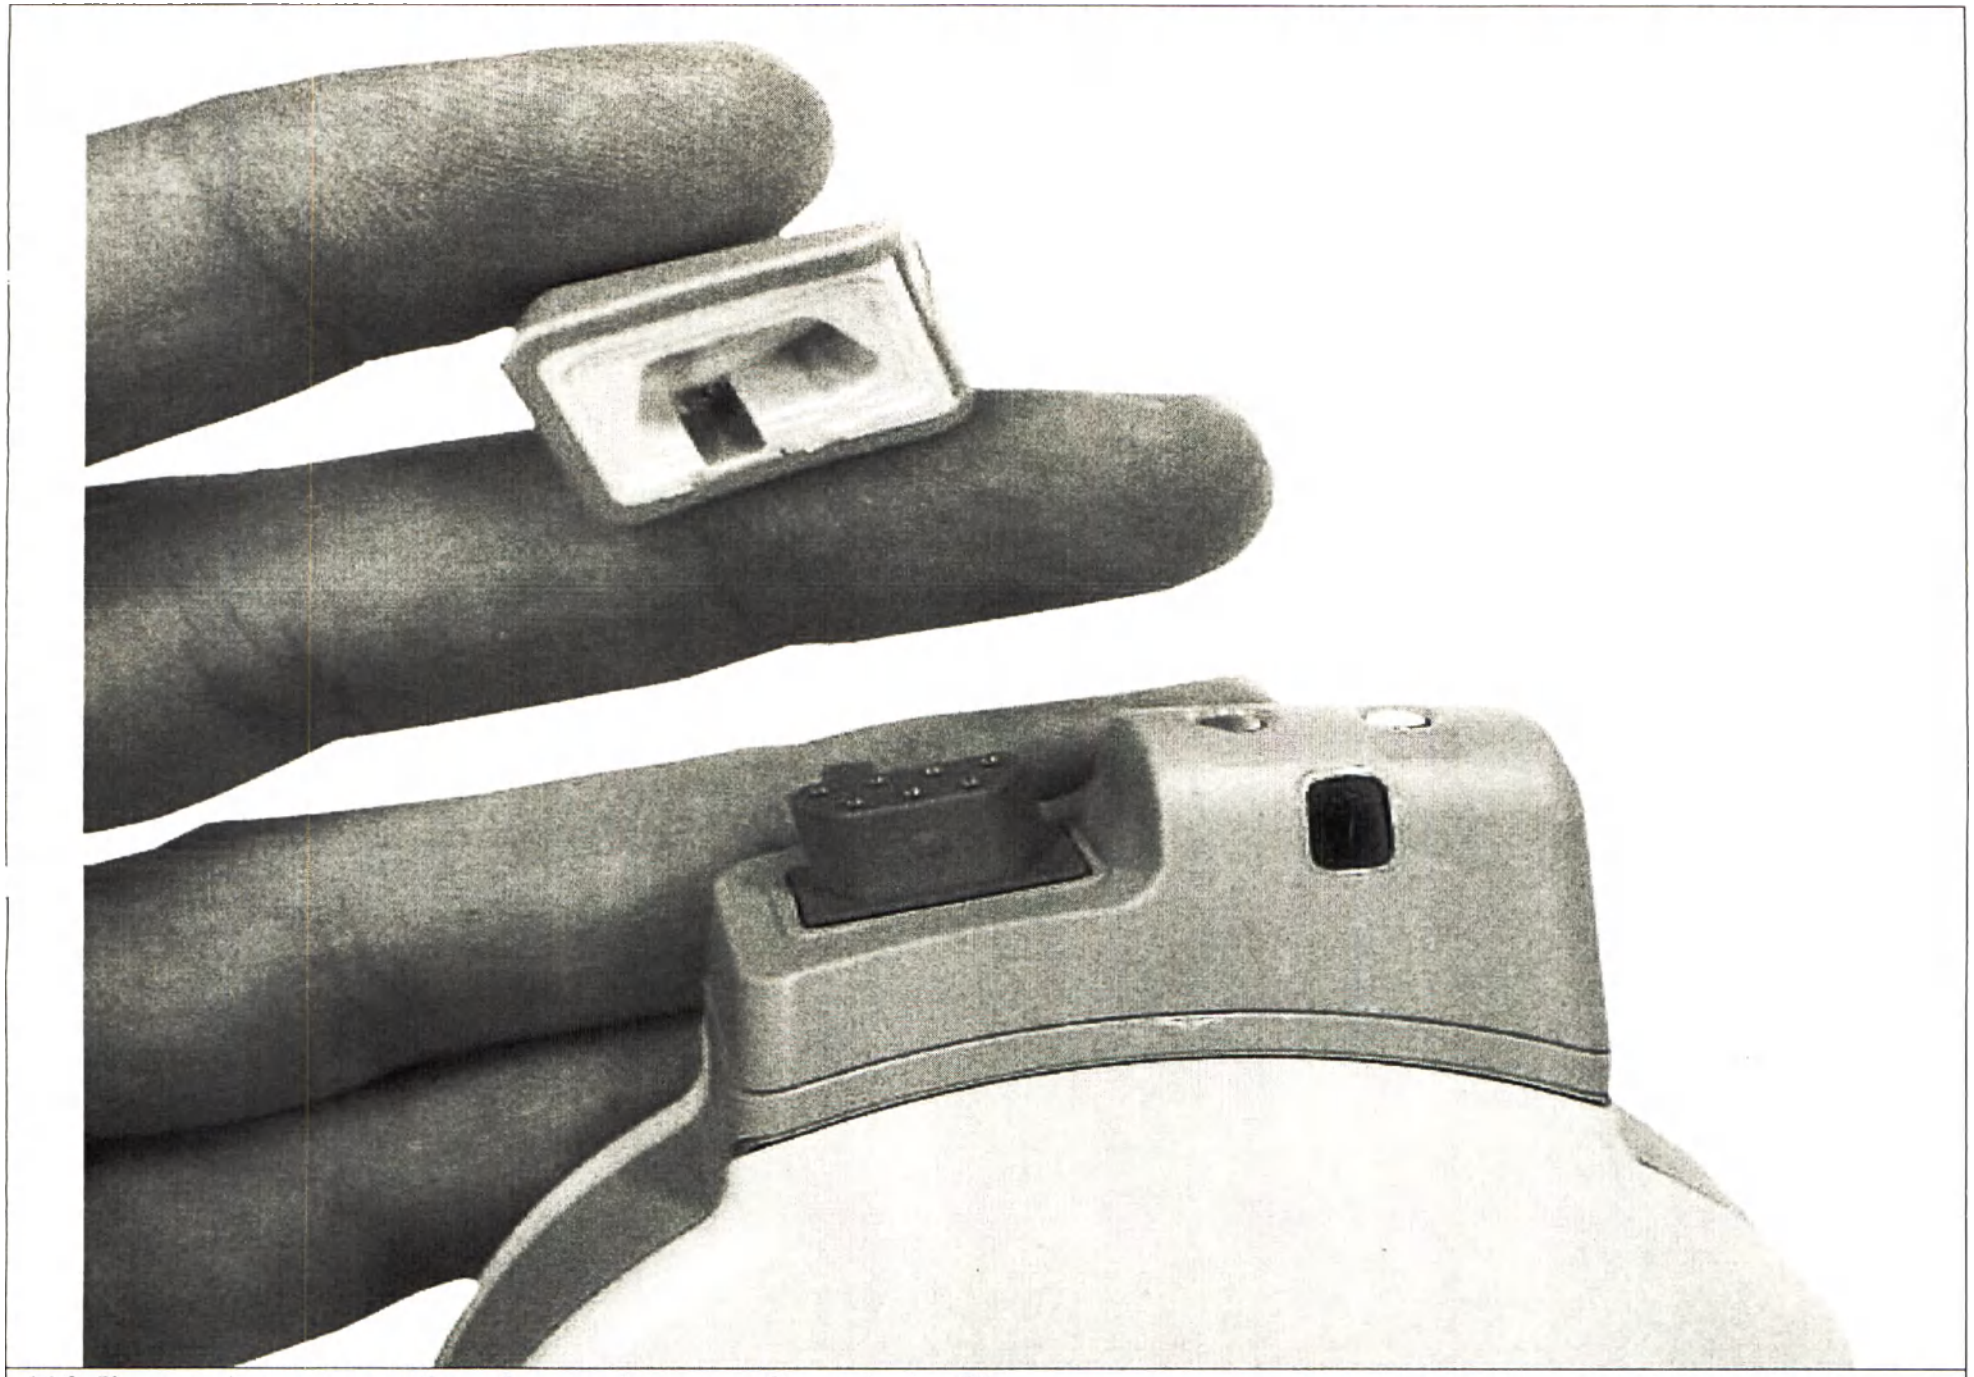

*14.2 Крышки для разъемов бескабельных датчиков Smart Avalon CL*

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

*15. Модуль пациента для прямой ЭКГ плода, ЭКГ матери и внутриматочного давления*

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

*16. Маркер событий*

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

*17.1 Ремни многоразовые*

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

*17.2 Ремни многоразовые*

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

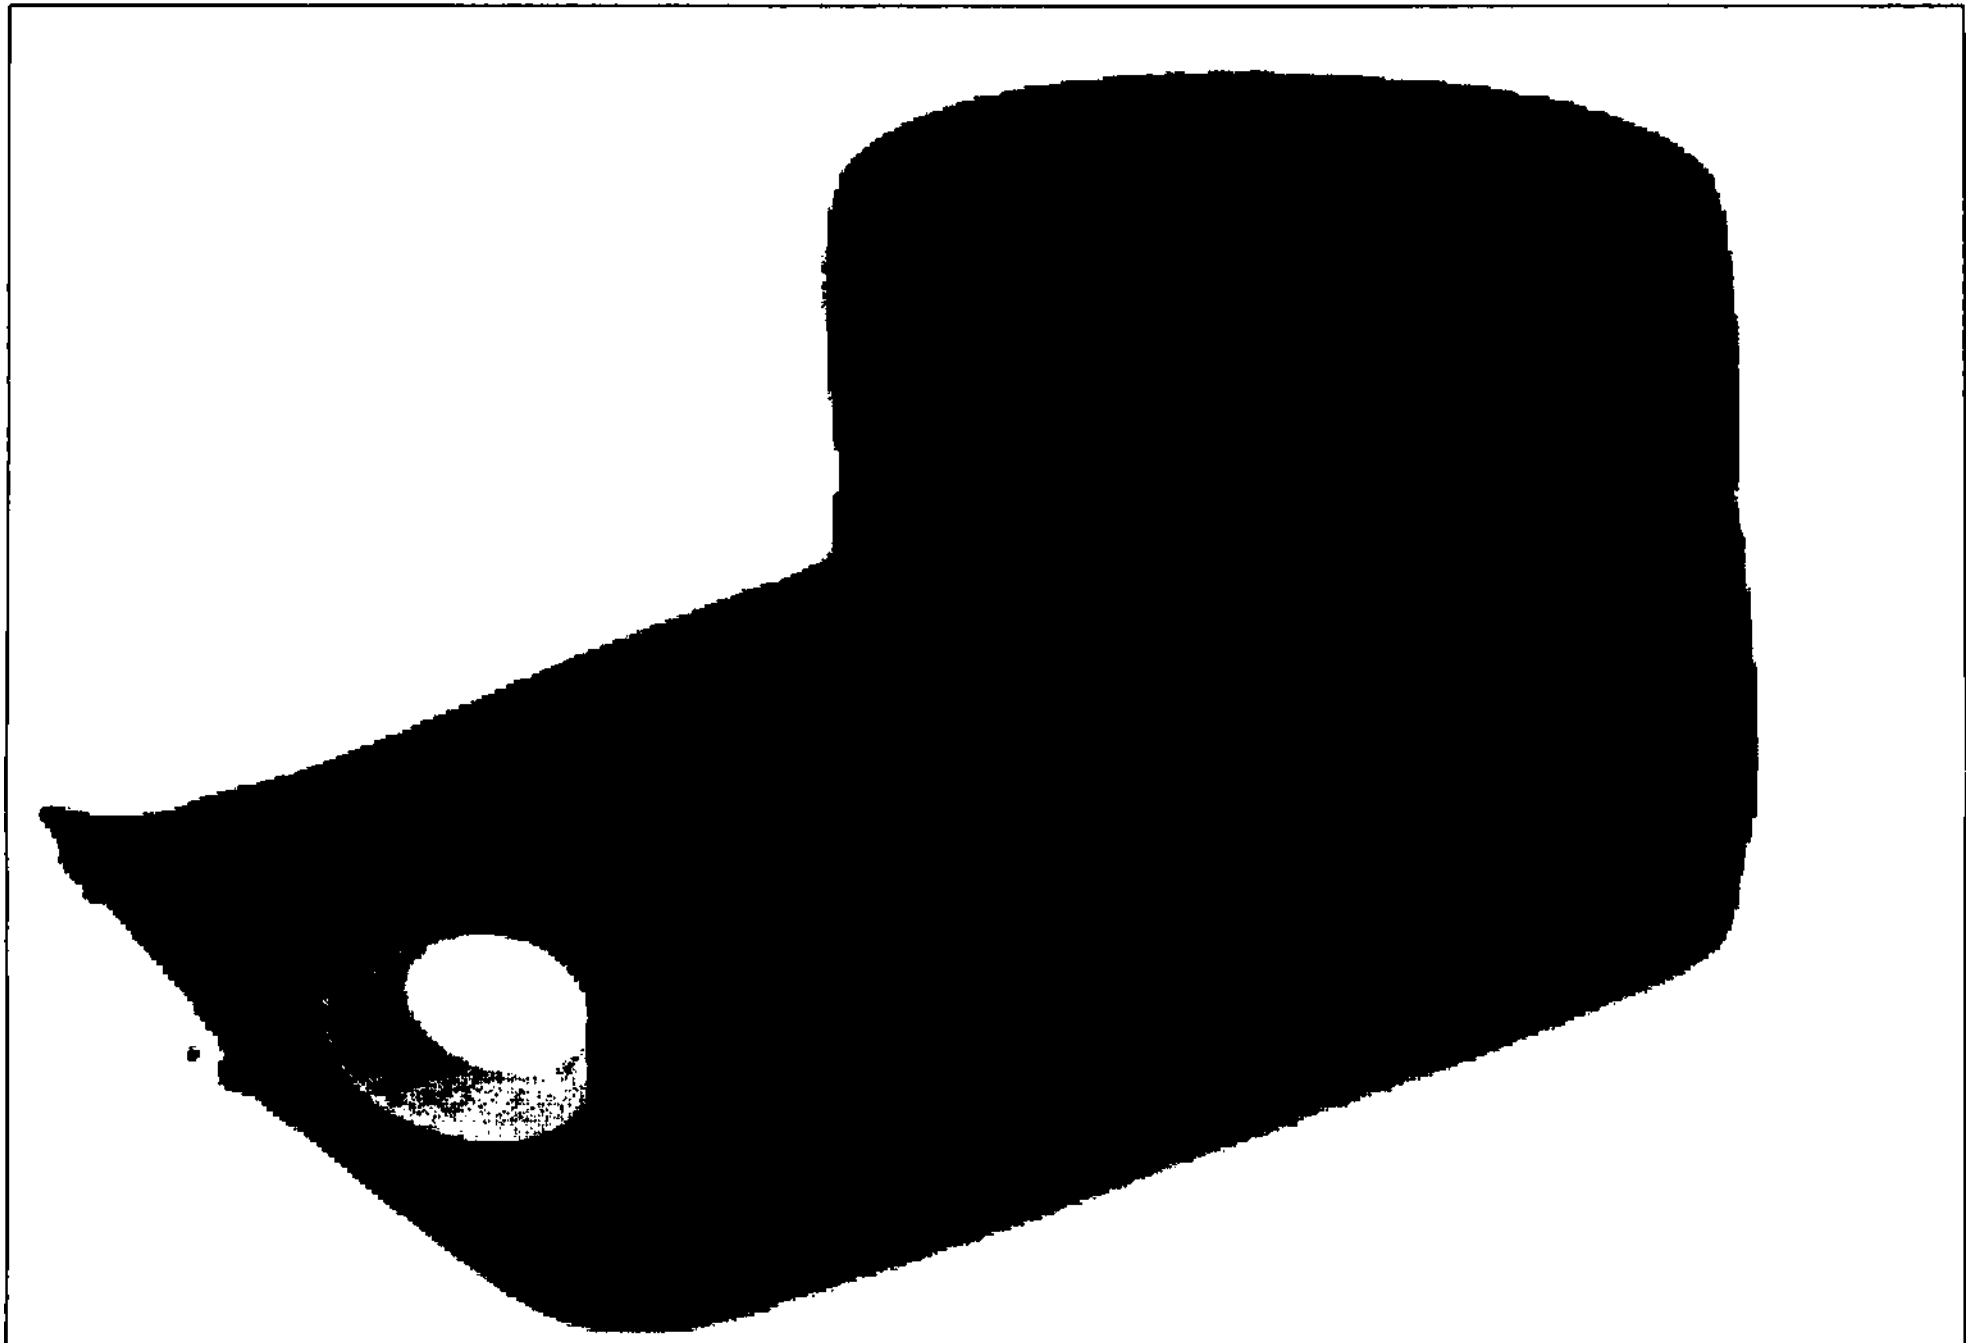

*17.3 Ремни многоразовые*

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

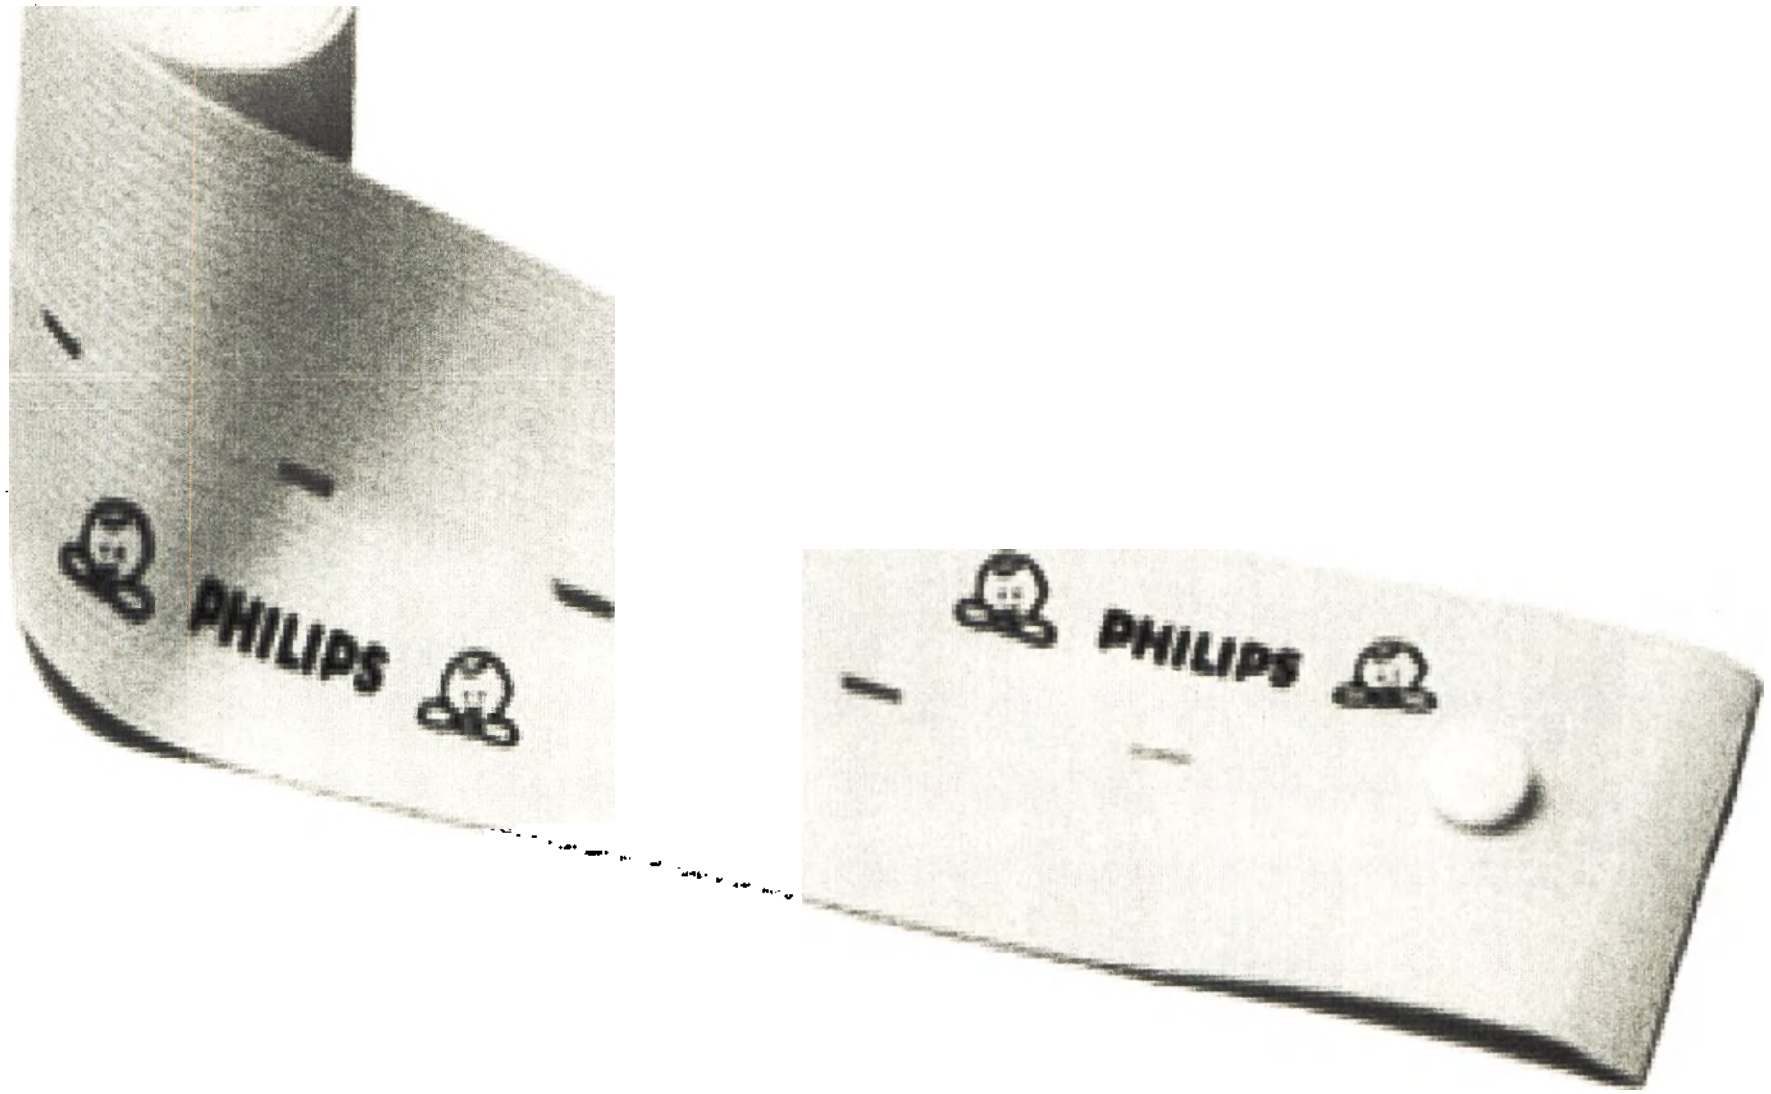


*18. Ремни одноразовые содержащие латекс*

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

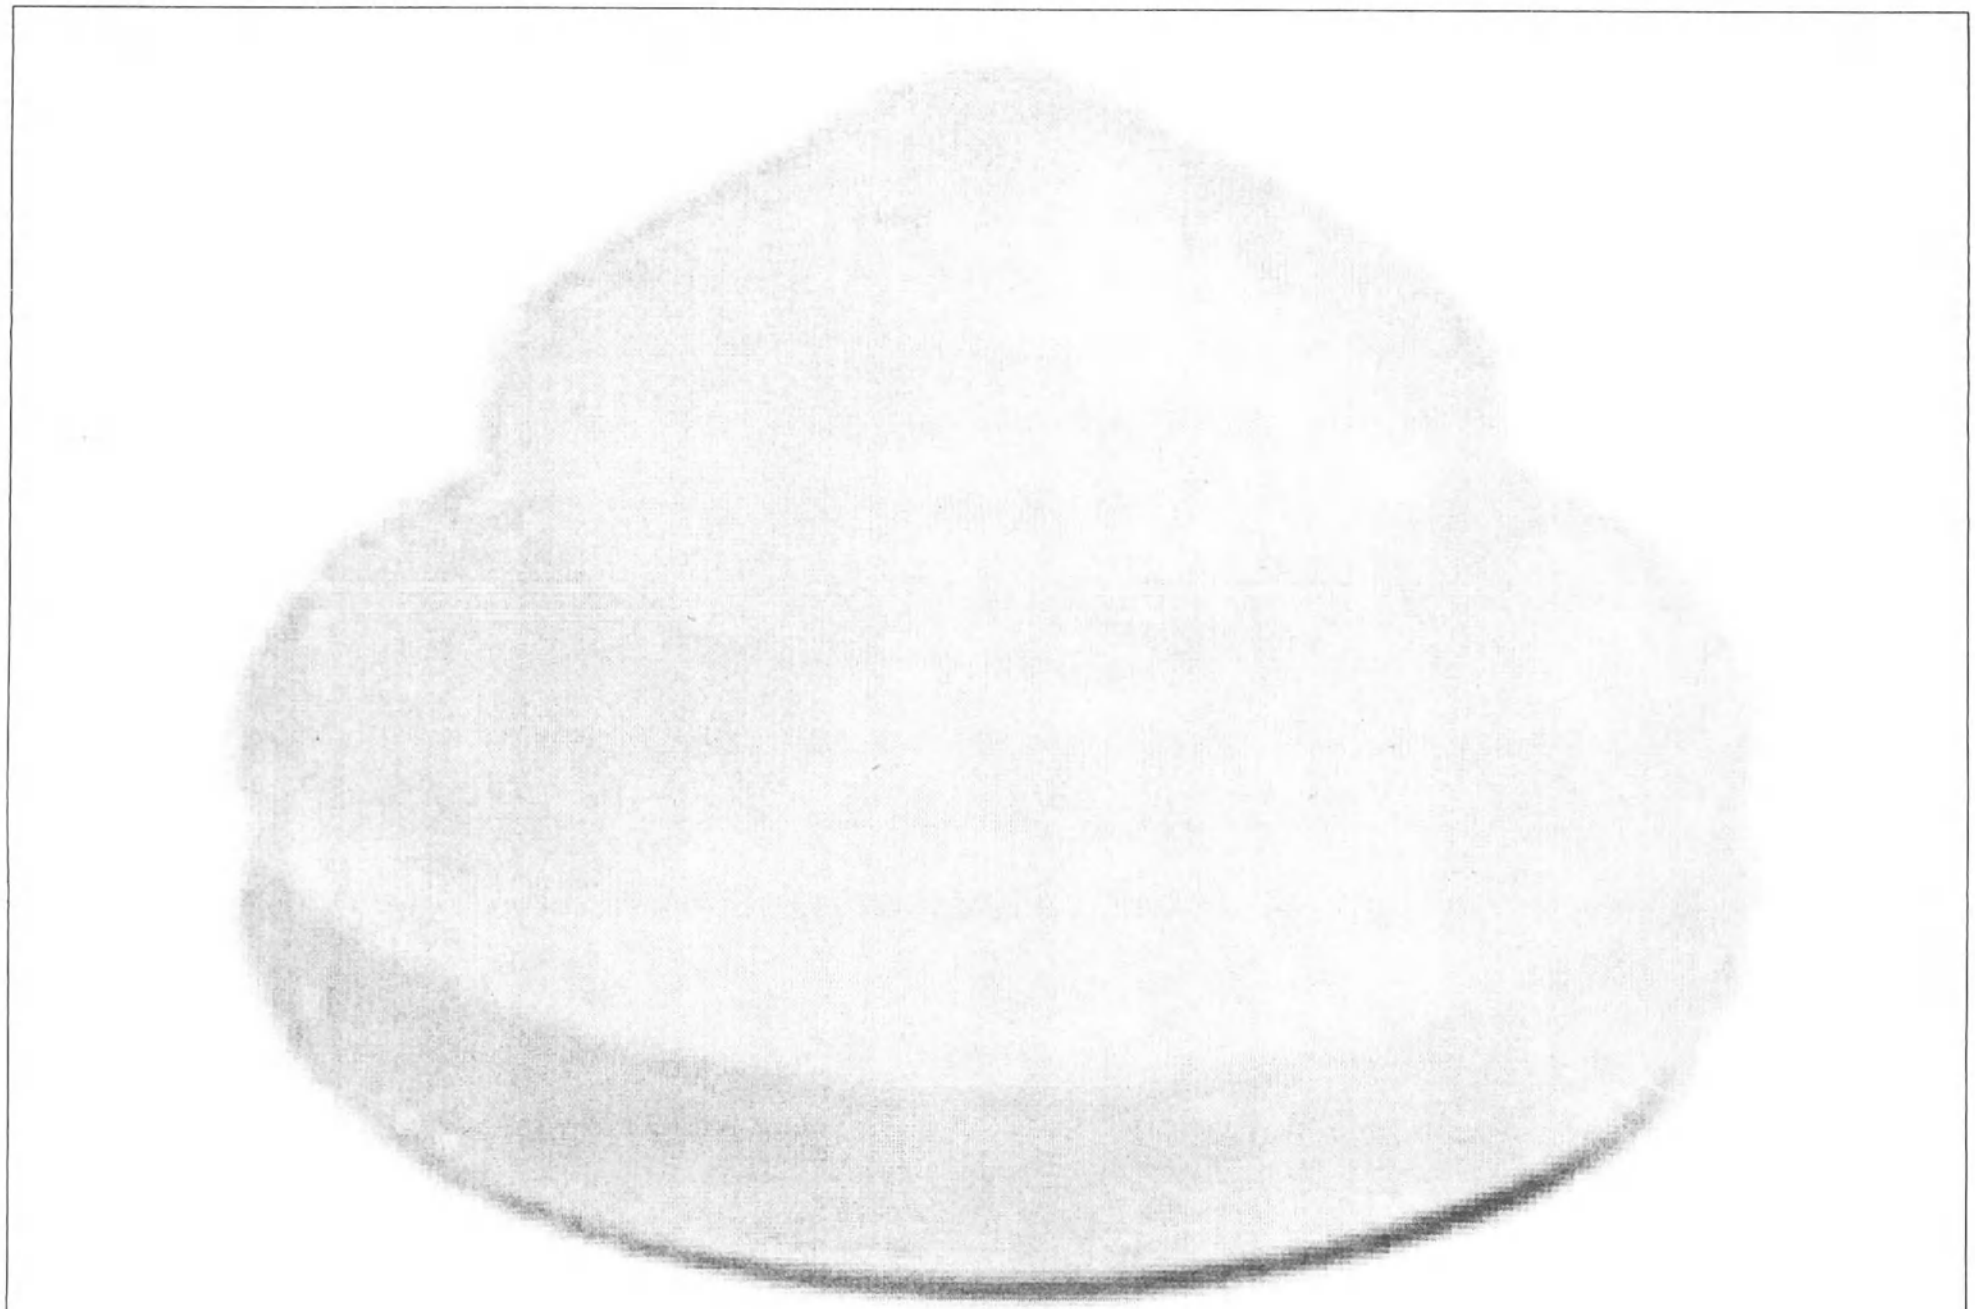

*19. Кнопки для закрепления на ремне, для проводных датчиков*

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

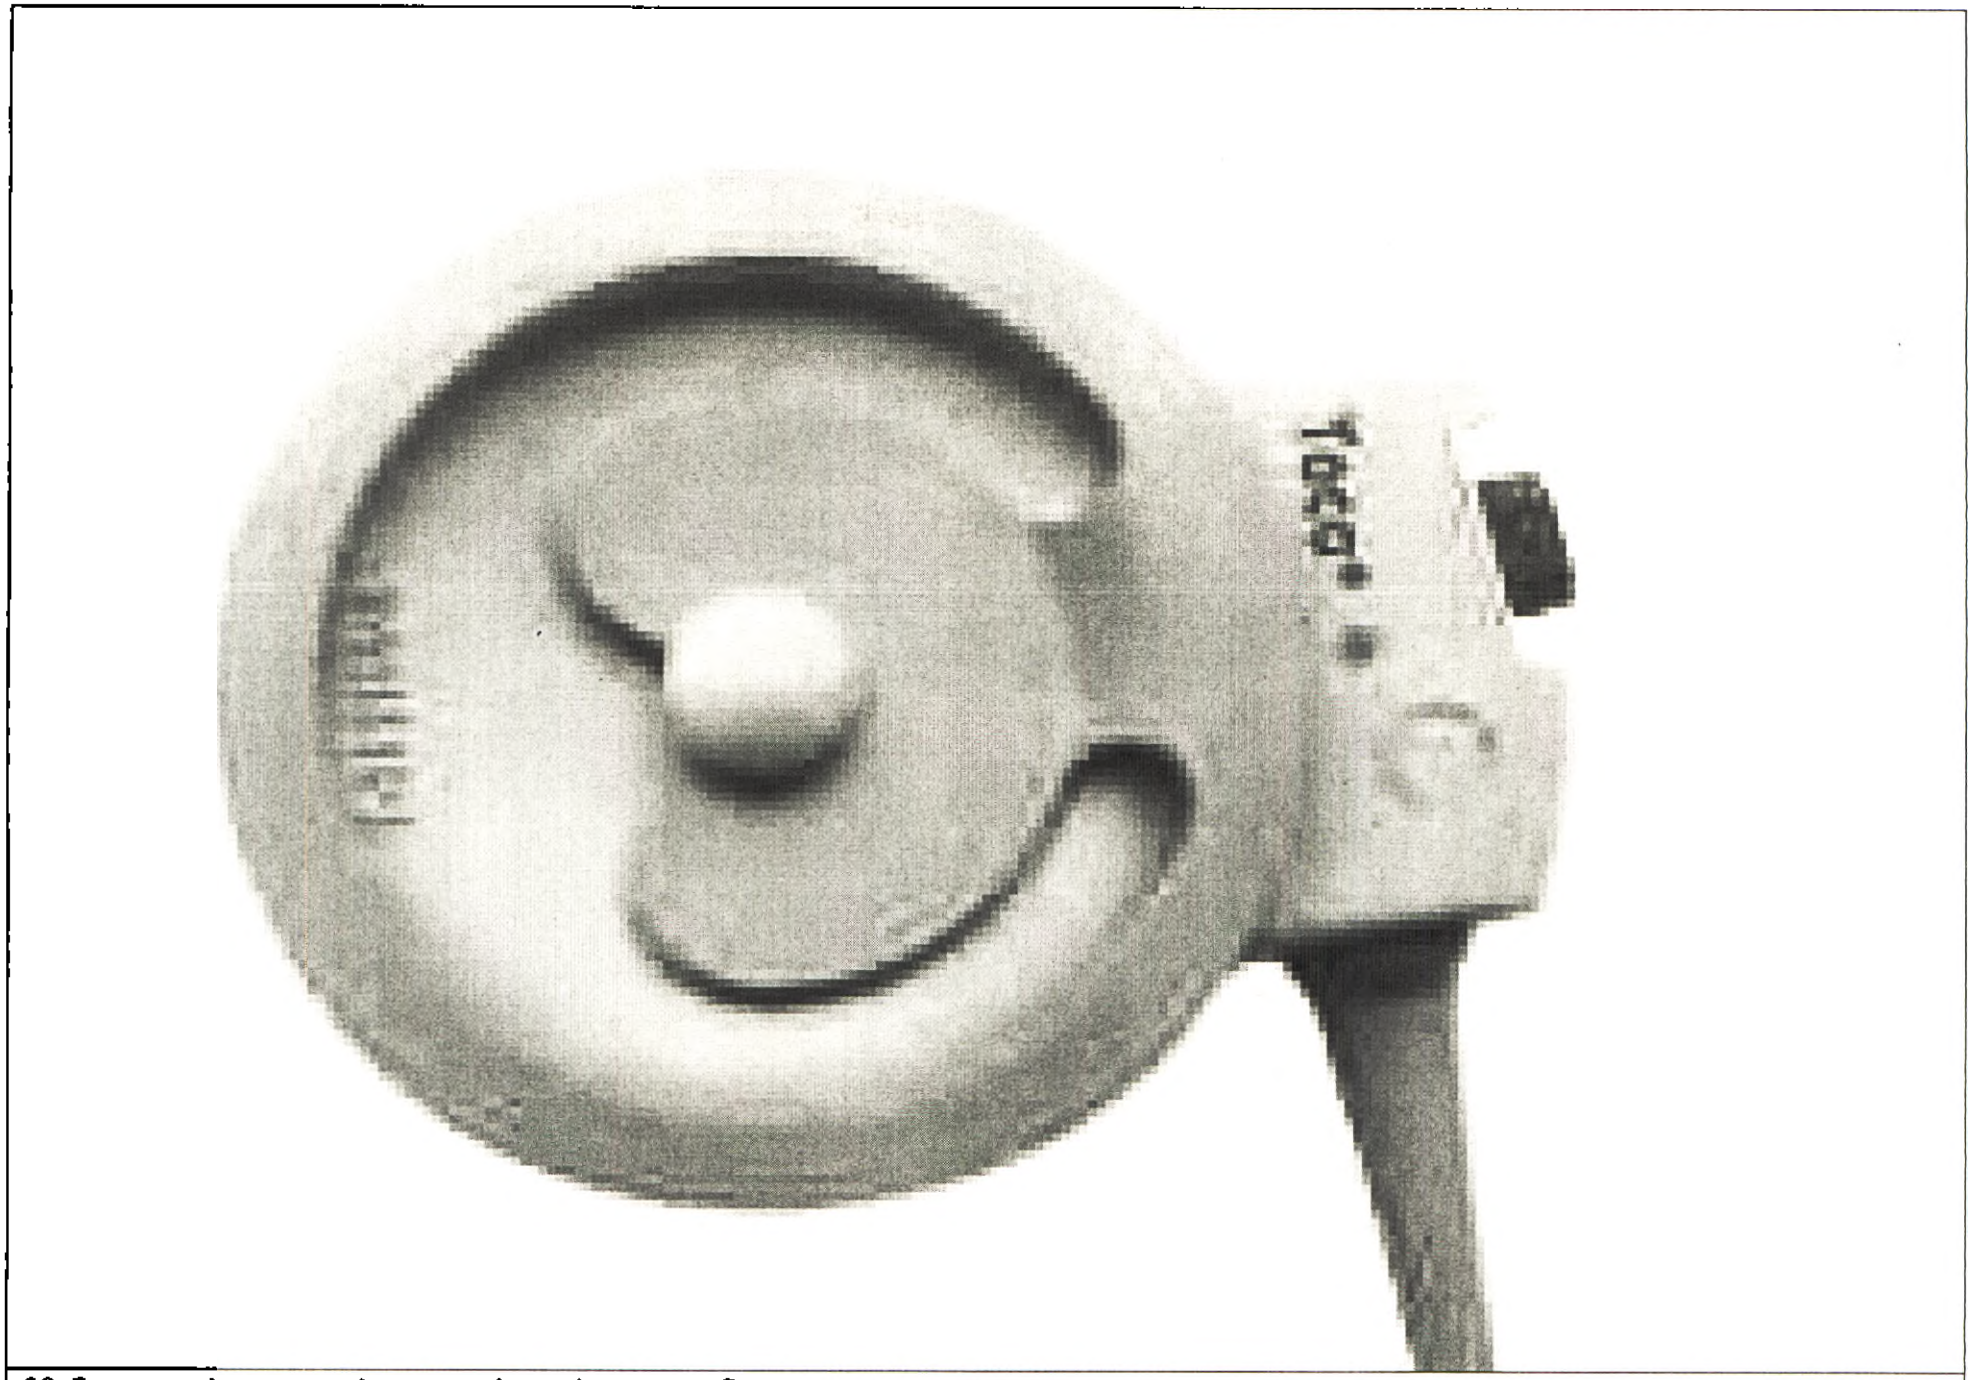


*20. Зажимы для ремня для проводных датчиков Smart*

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

*21. Ультразвуковой гель во флаконах*

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

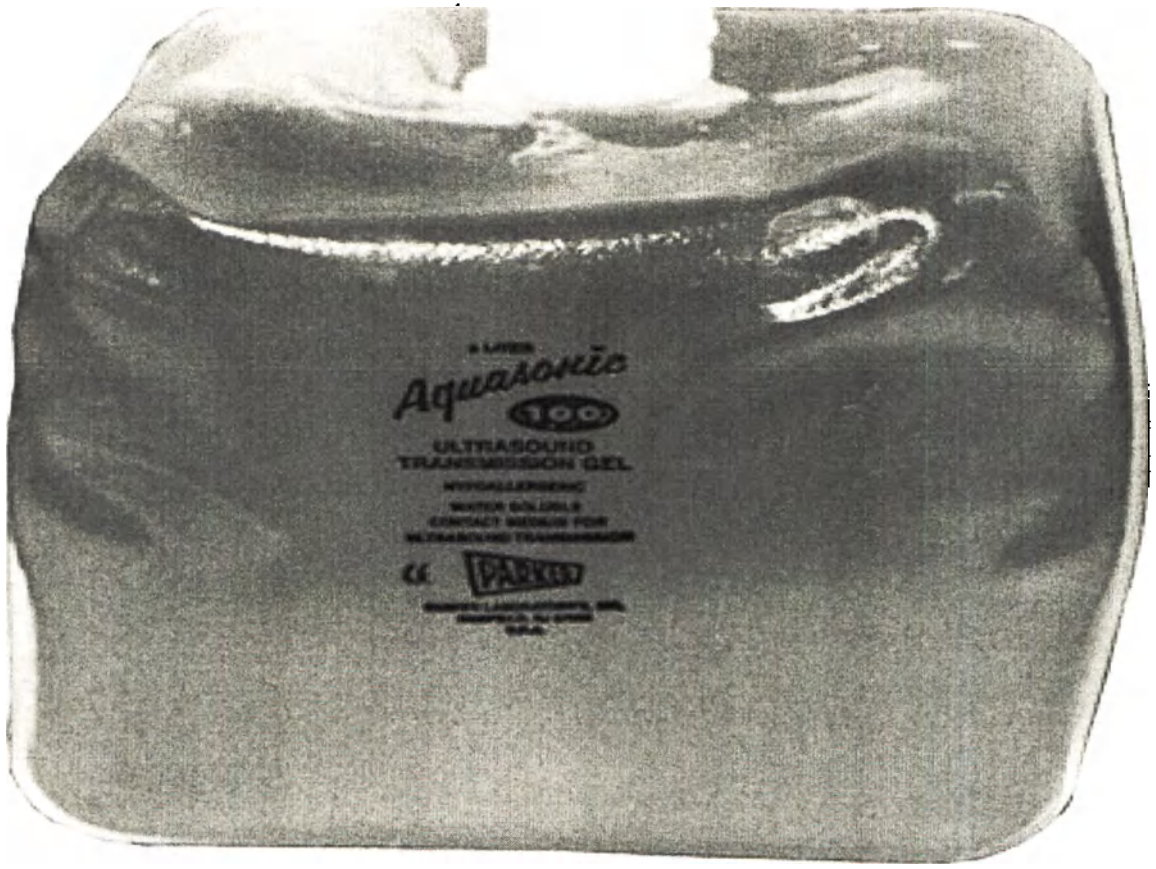


*22. Ультразвуковой гель в контейнерах*

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

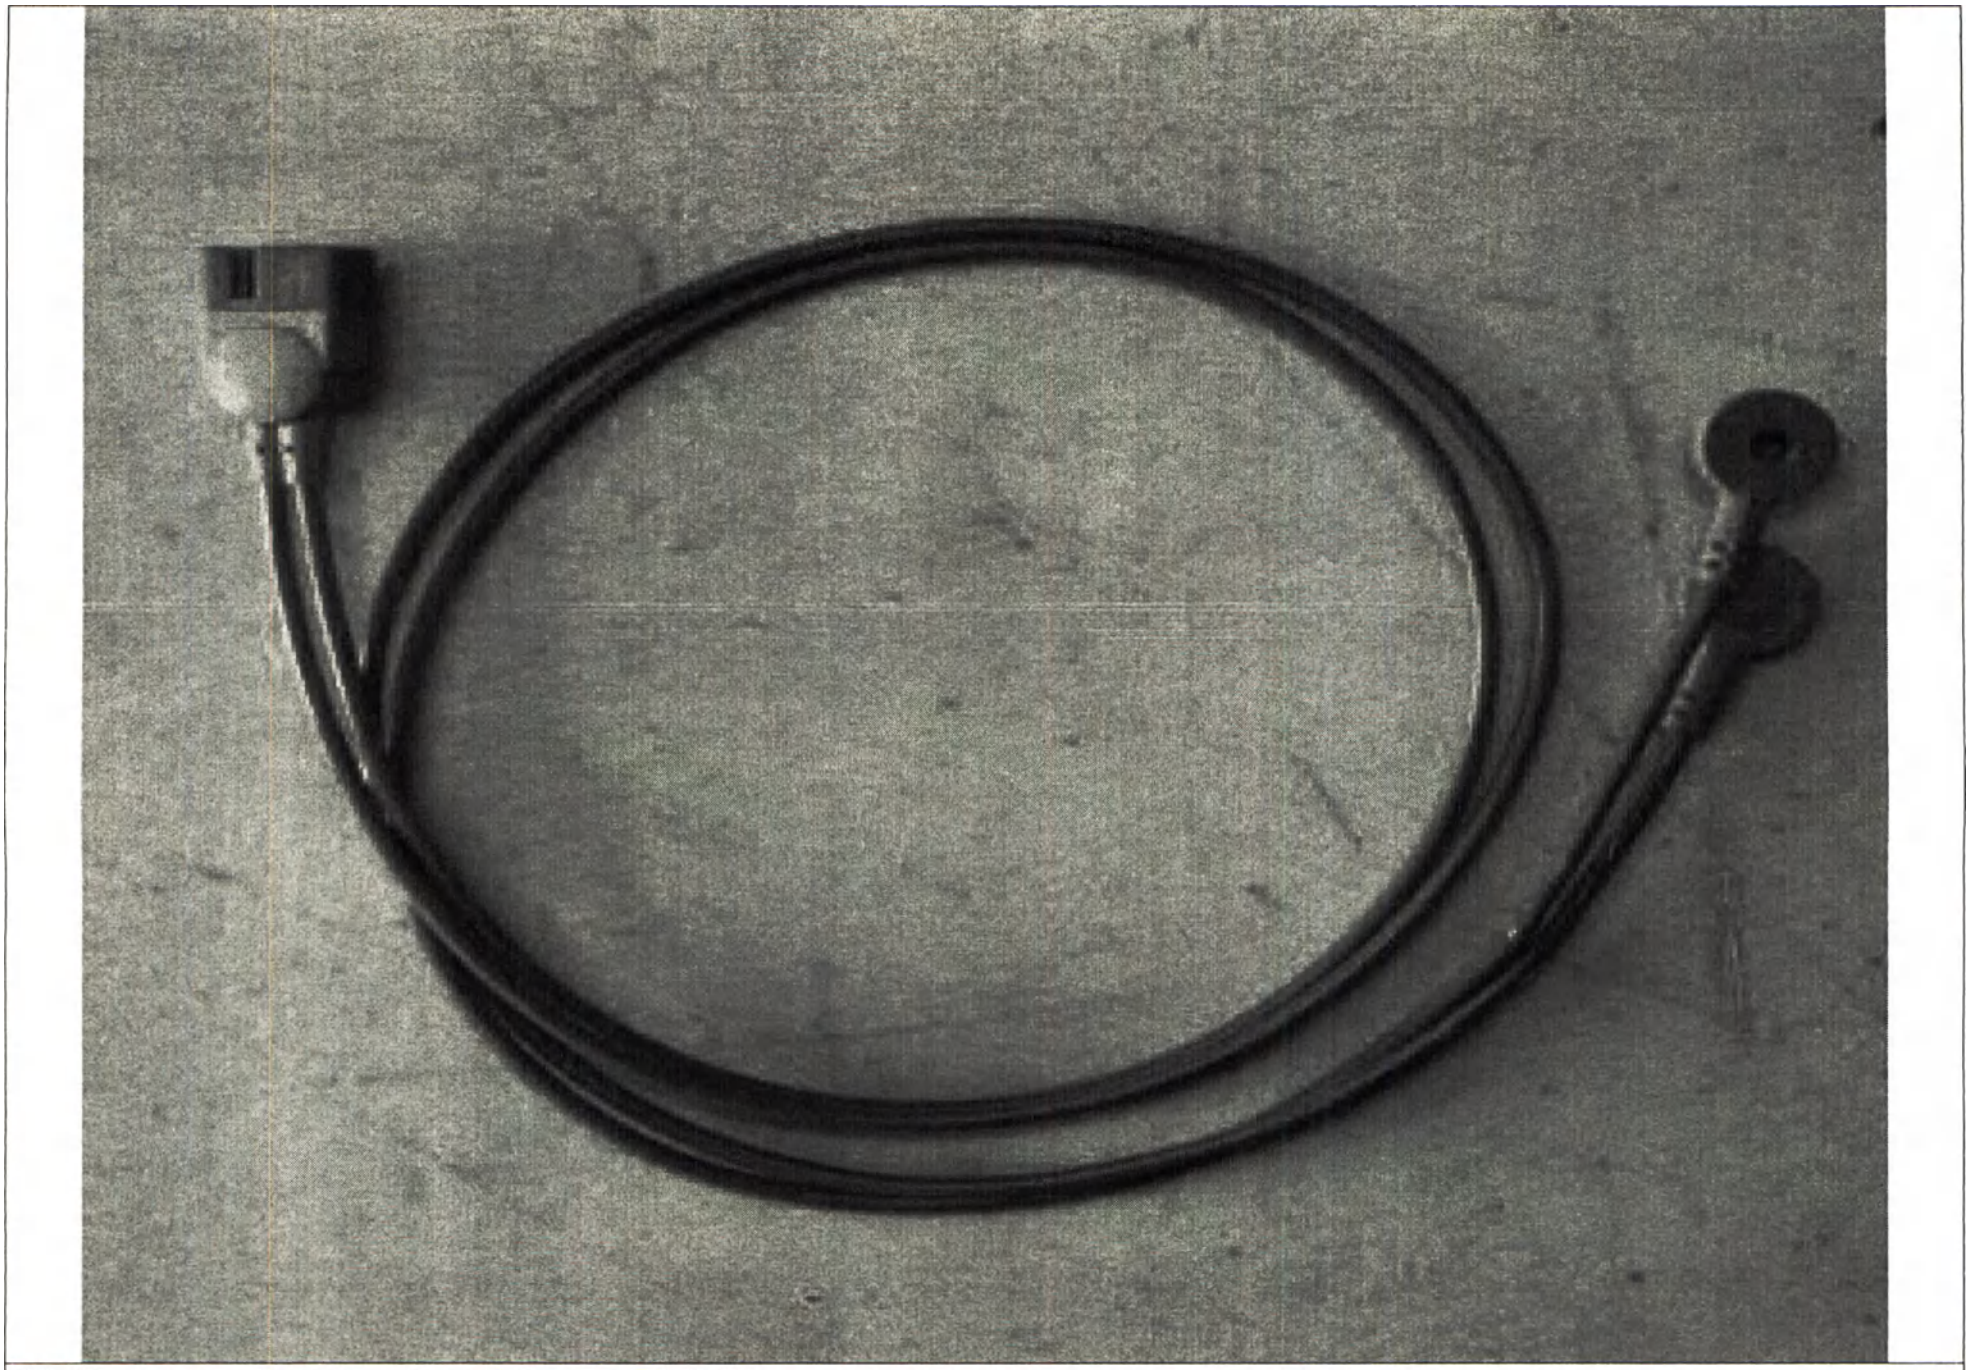

*23. Многоразовый кабель-адаптер для прямой ЭКГ*

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

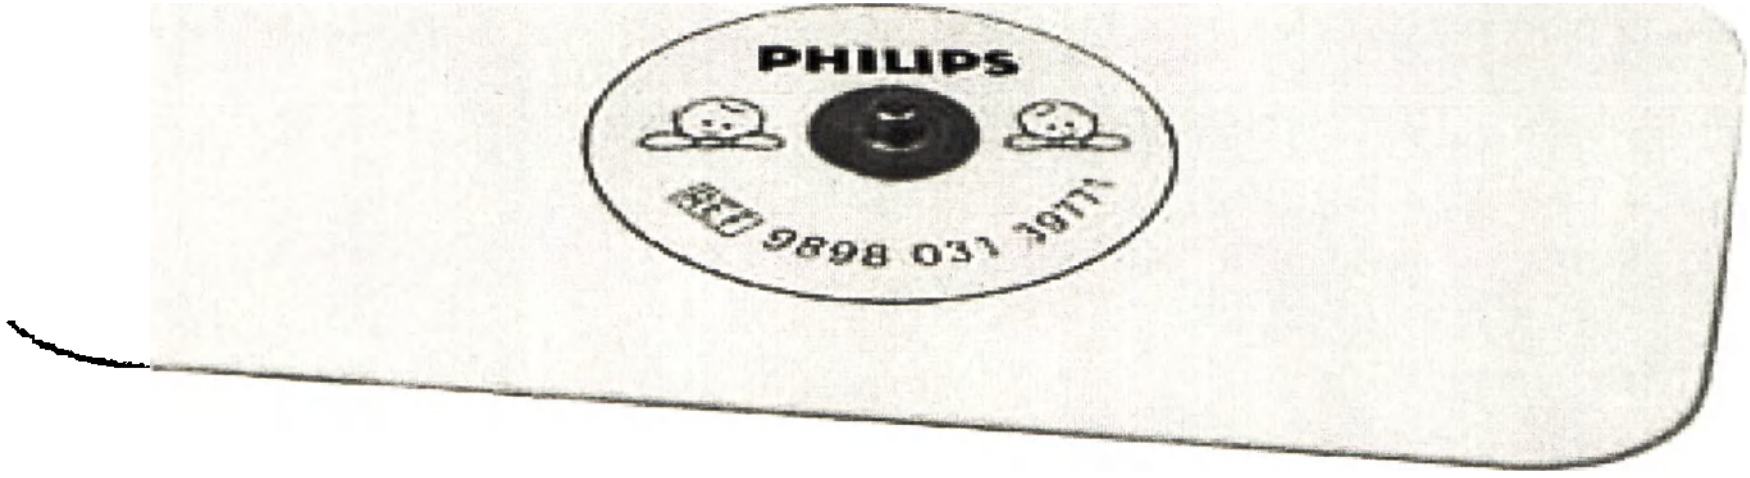


*24. Вспомогательные электроды для прямой ЭКГ для кабеля-адаптера*

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

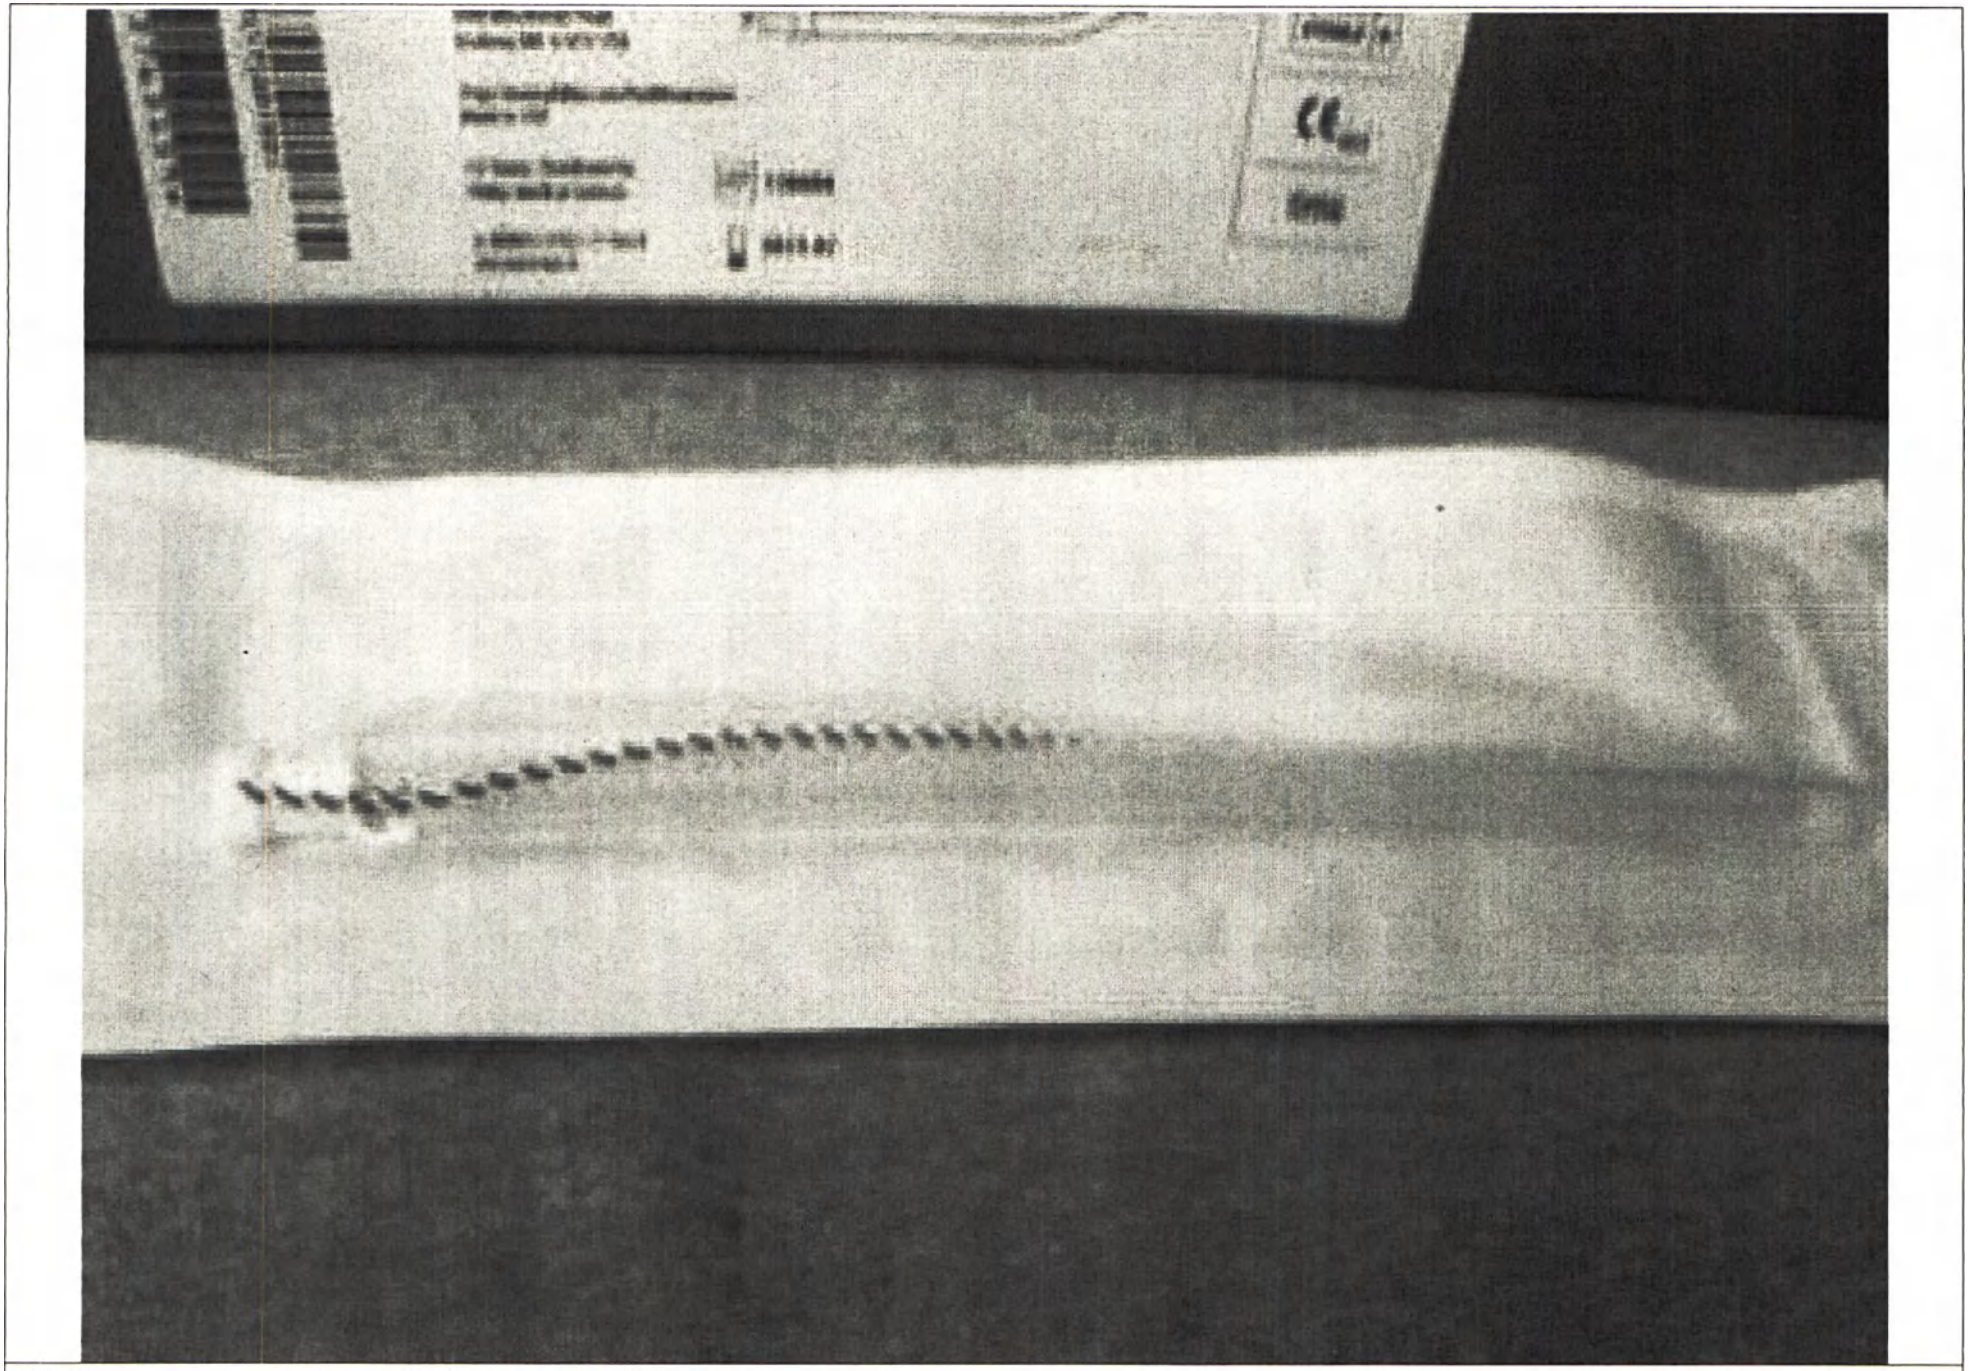

*25. Скальп- электроды плода для прямой ЭКГ*

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

*26. Катетеры для измерения внутриматочного давления*

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

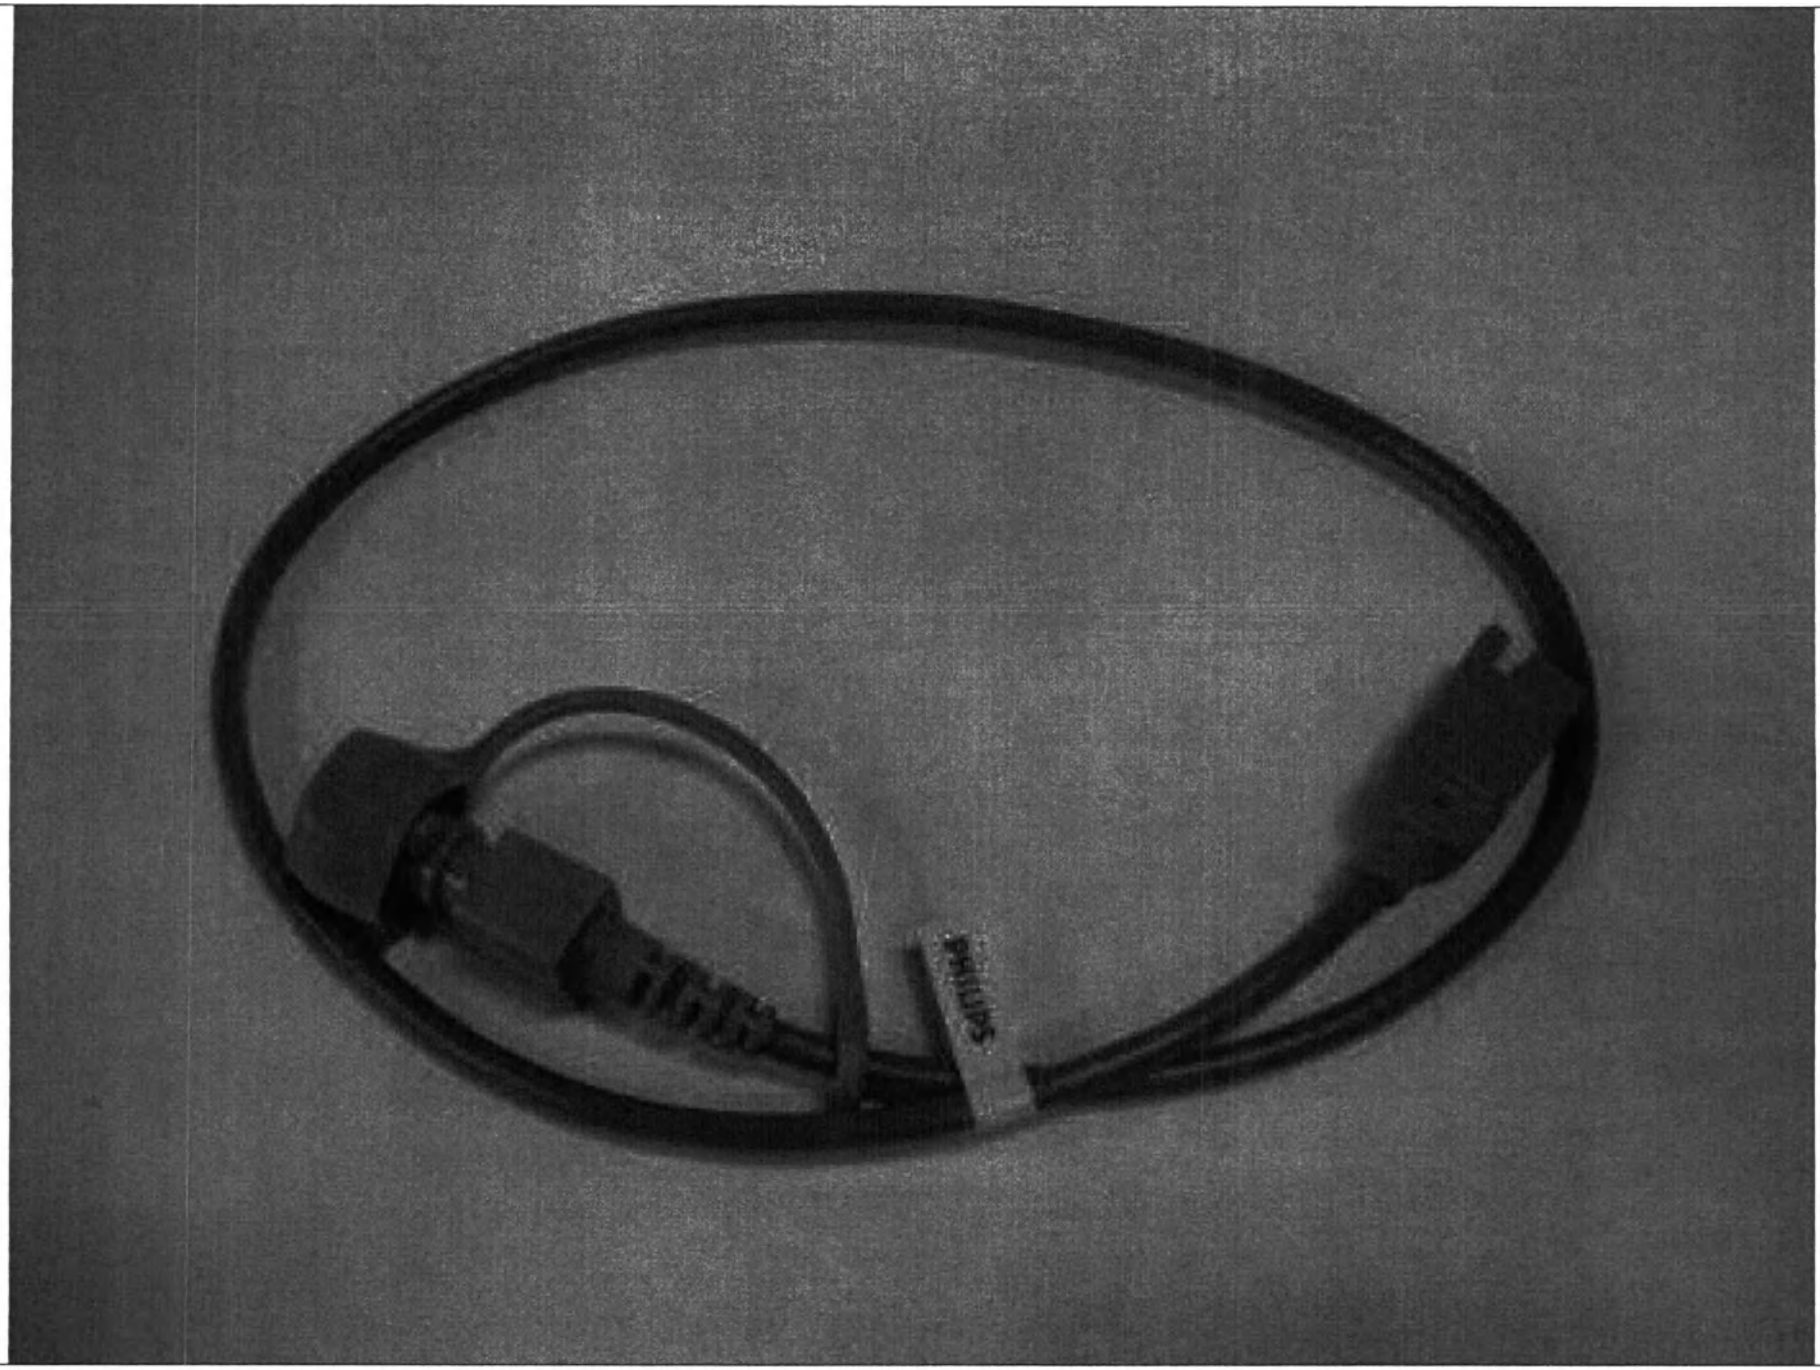


*27. Кабель адаптер для катетера внутриматочного давления*

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

*28. Кабели-адаптеры ЭКГ матери*

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

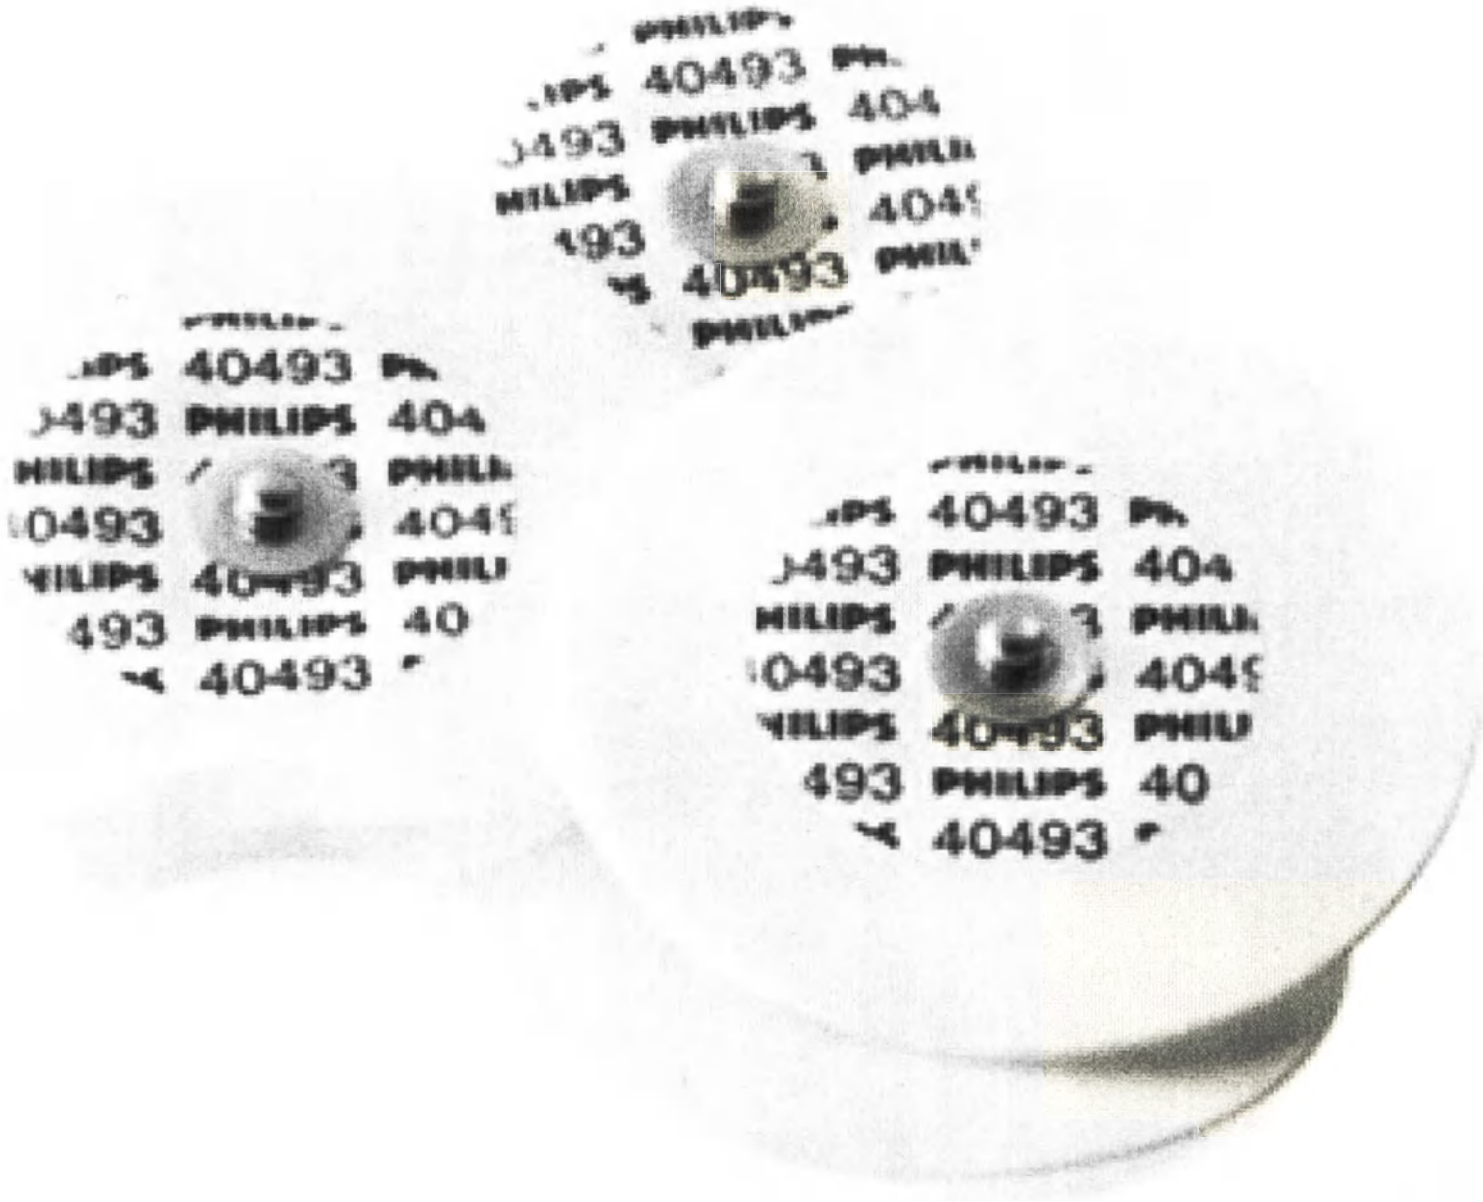


*29. ЭКГ электроды*

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

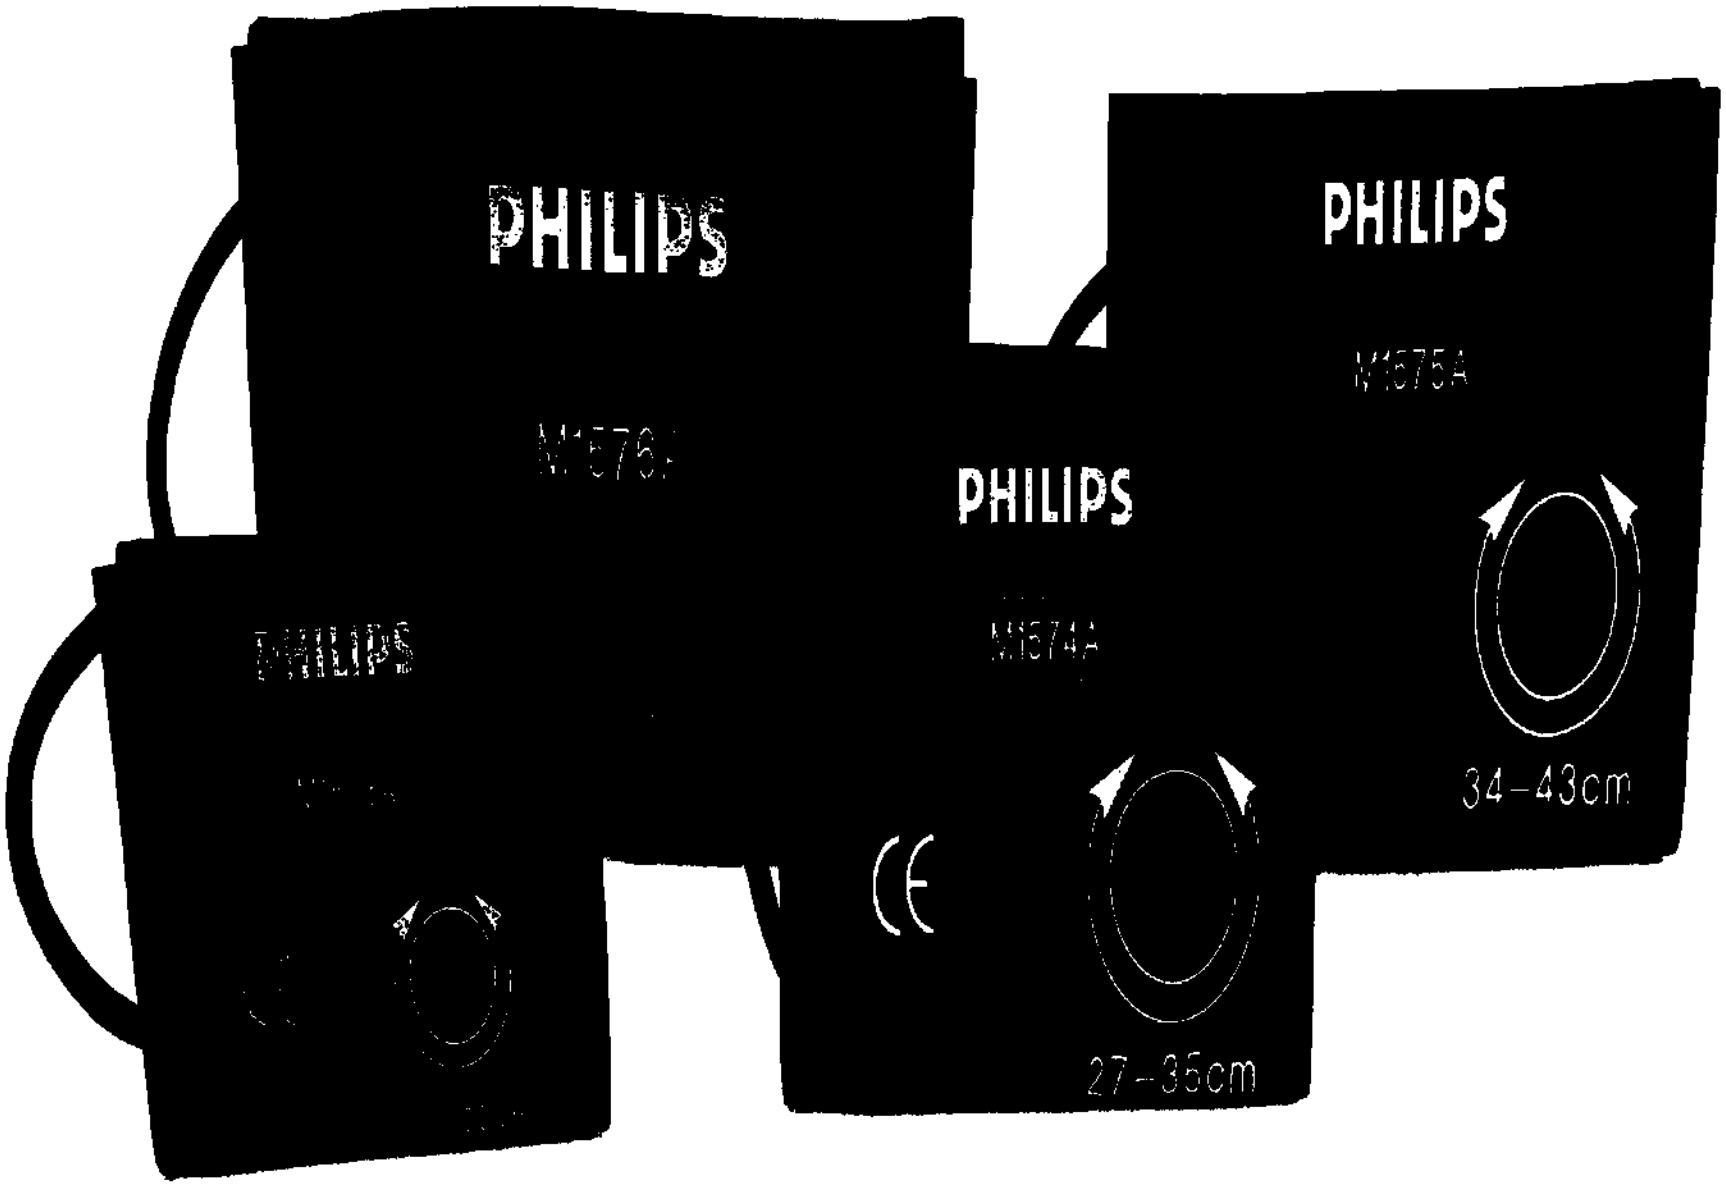


***30.1 Манжеты для неинвазивного измерения АД***

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

***30.2 Манжеты для неинвазивного измерения АД***

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

*30.3 Манжеты для неинвазивного измерения АД*

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

*30.4 Манжеты для неинвазивного измерения АД*

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

*31. Трубки для манжет для неинвазивного измерения АД*

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

*32.1 Датчики пульсоксиметрические*

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

*32.2 Датчики пульсоксиметрические*

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

*33. Кабели удлинительные пульсоксиметрических датчиков*

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

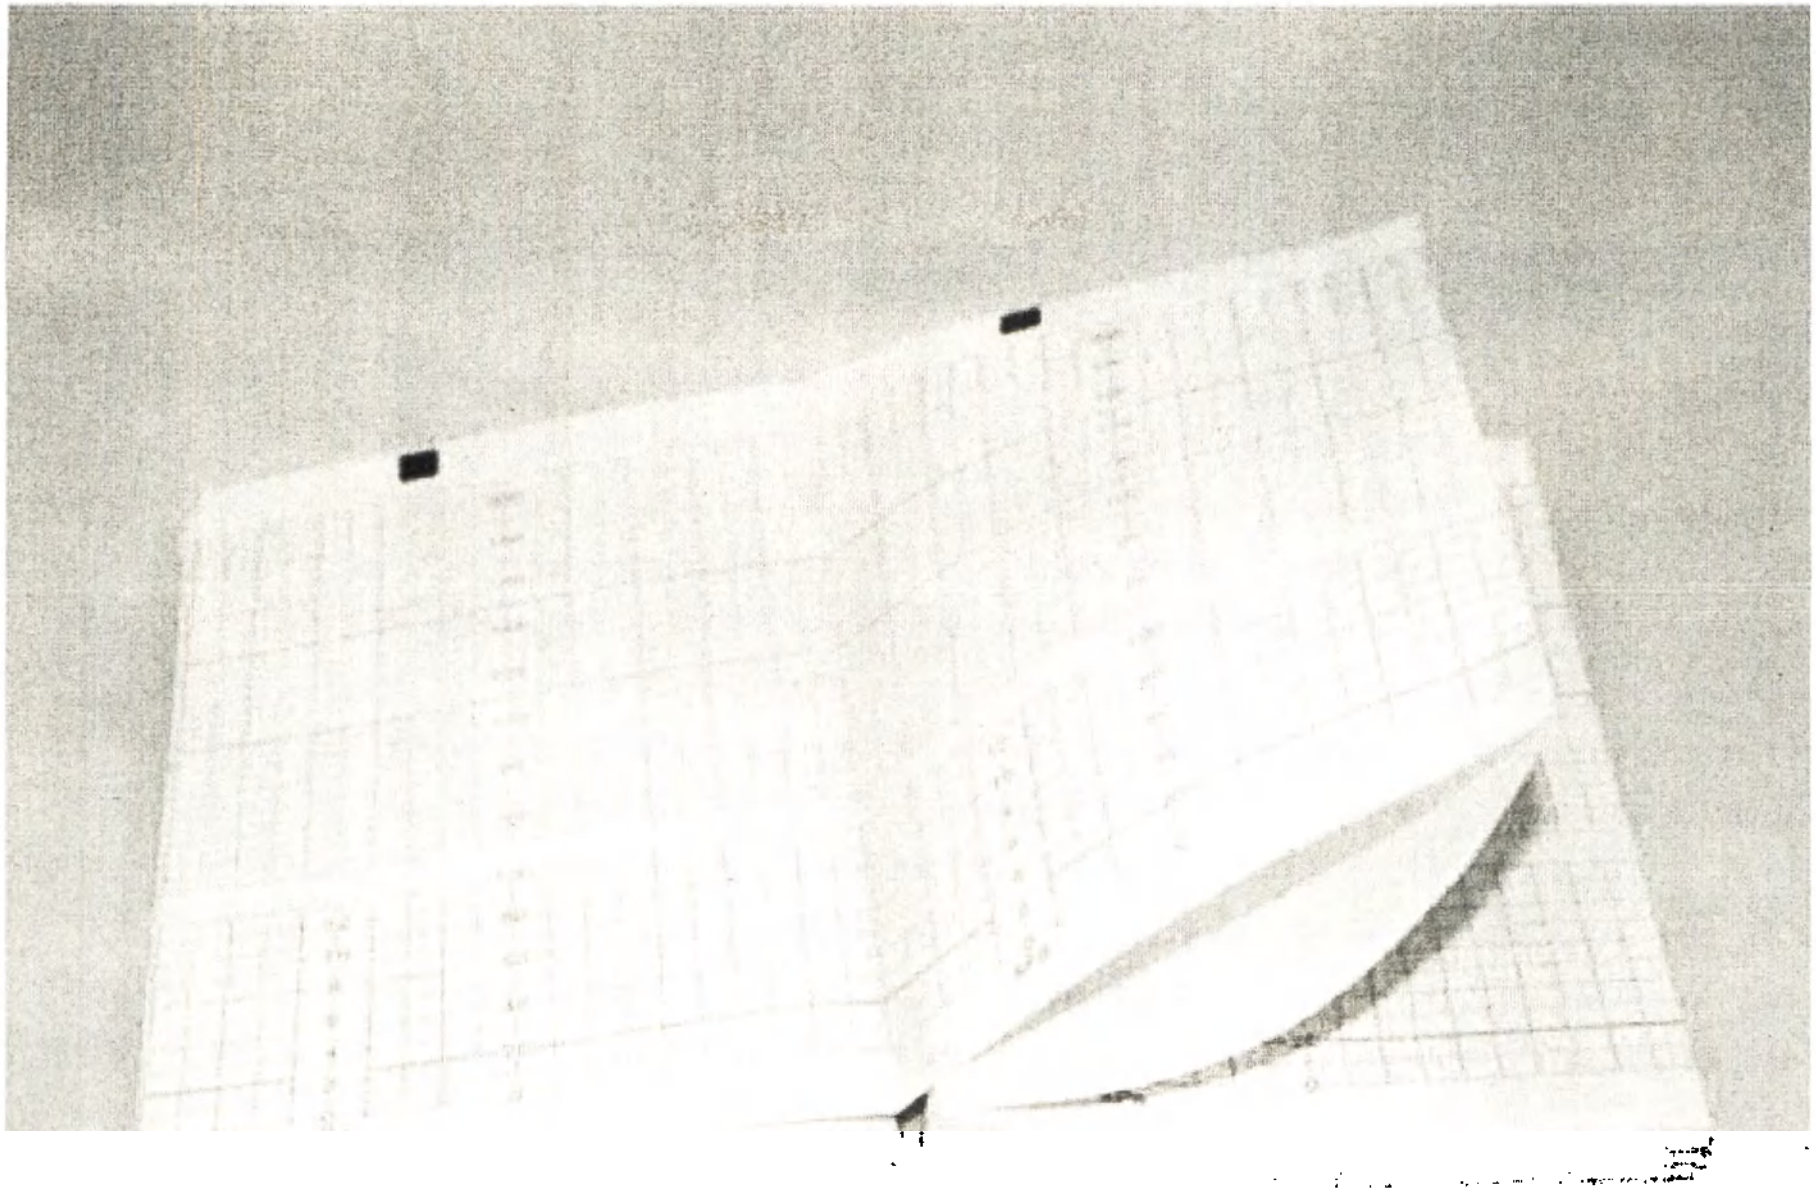

*34. Бумага для принтера*

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

*35. Настенный кронштейн для крепления со стенным каналом*

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

*36. Тележка*

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

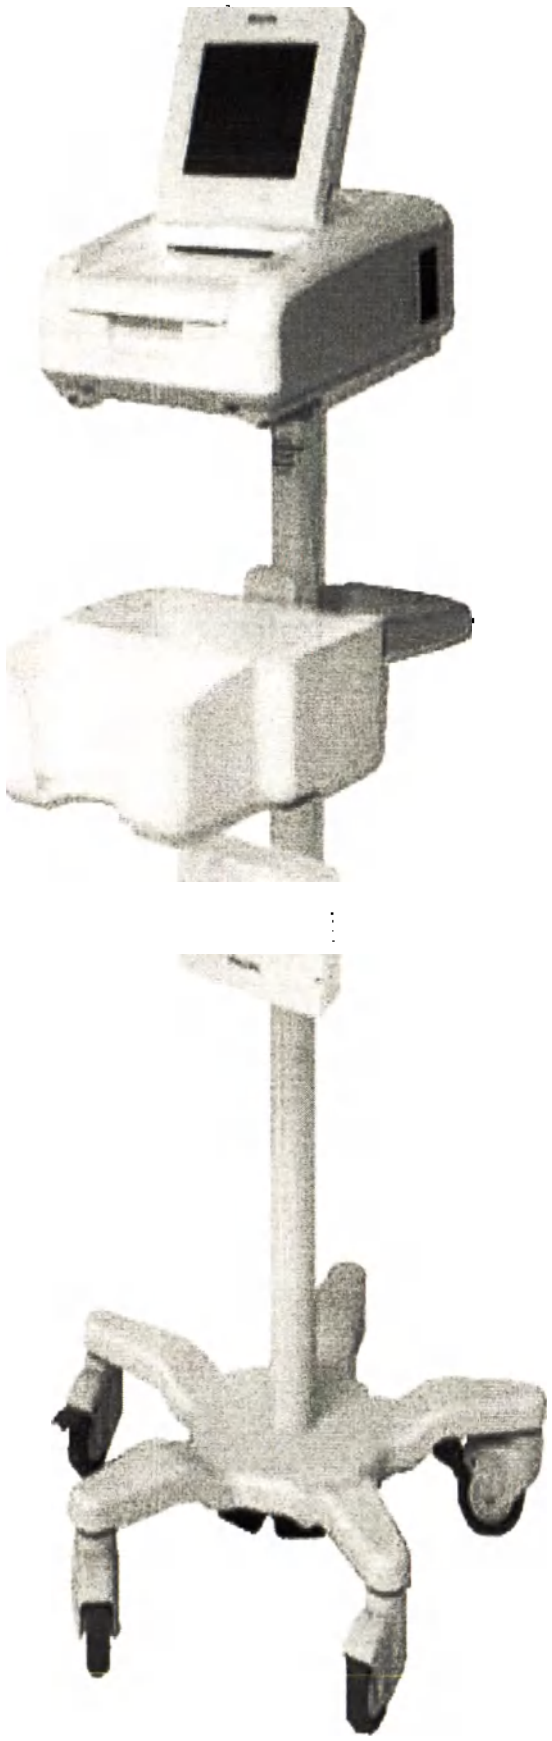

*37. Стойка на колесах*

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

***38. Кабели синхронизации, адаптера LAN, коммутационные, сетевые***

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

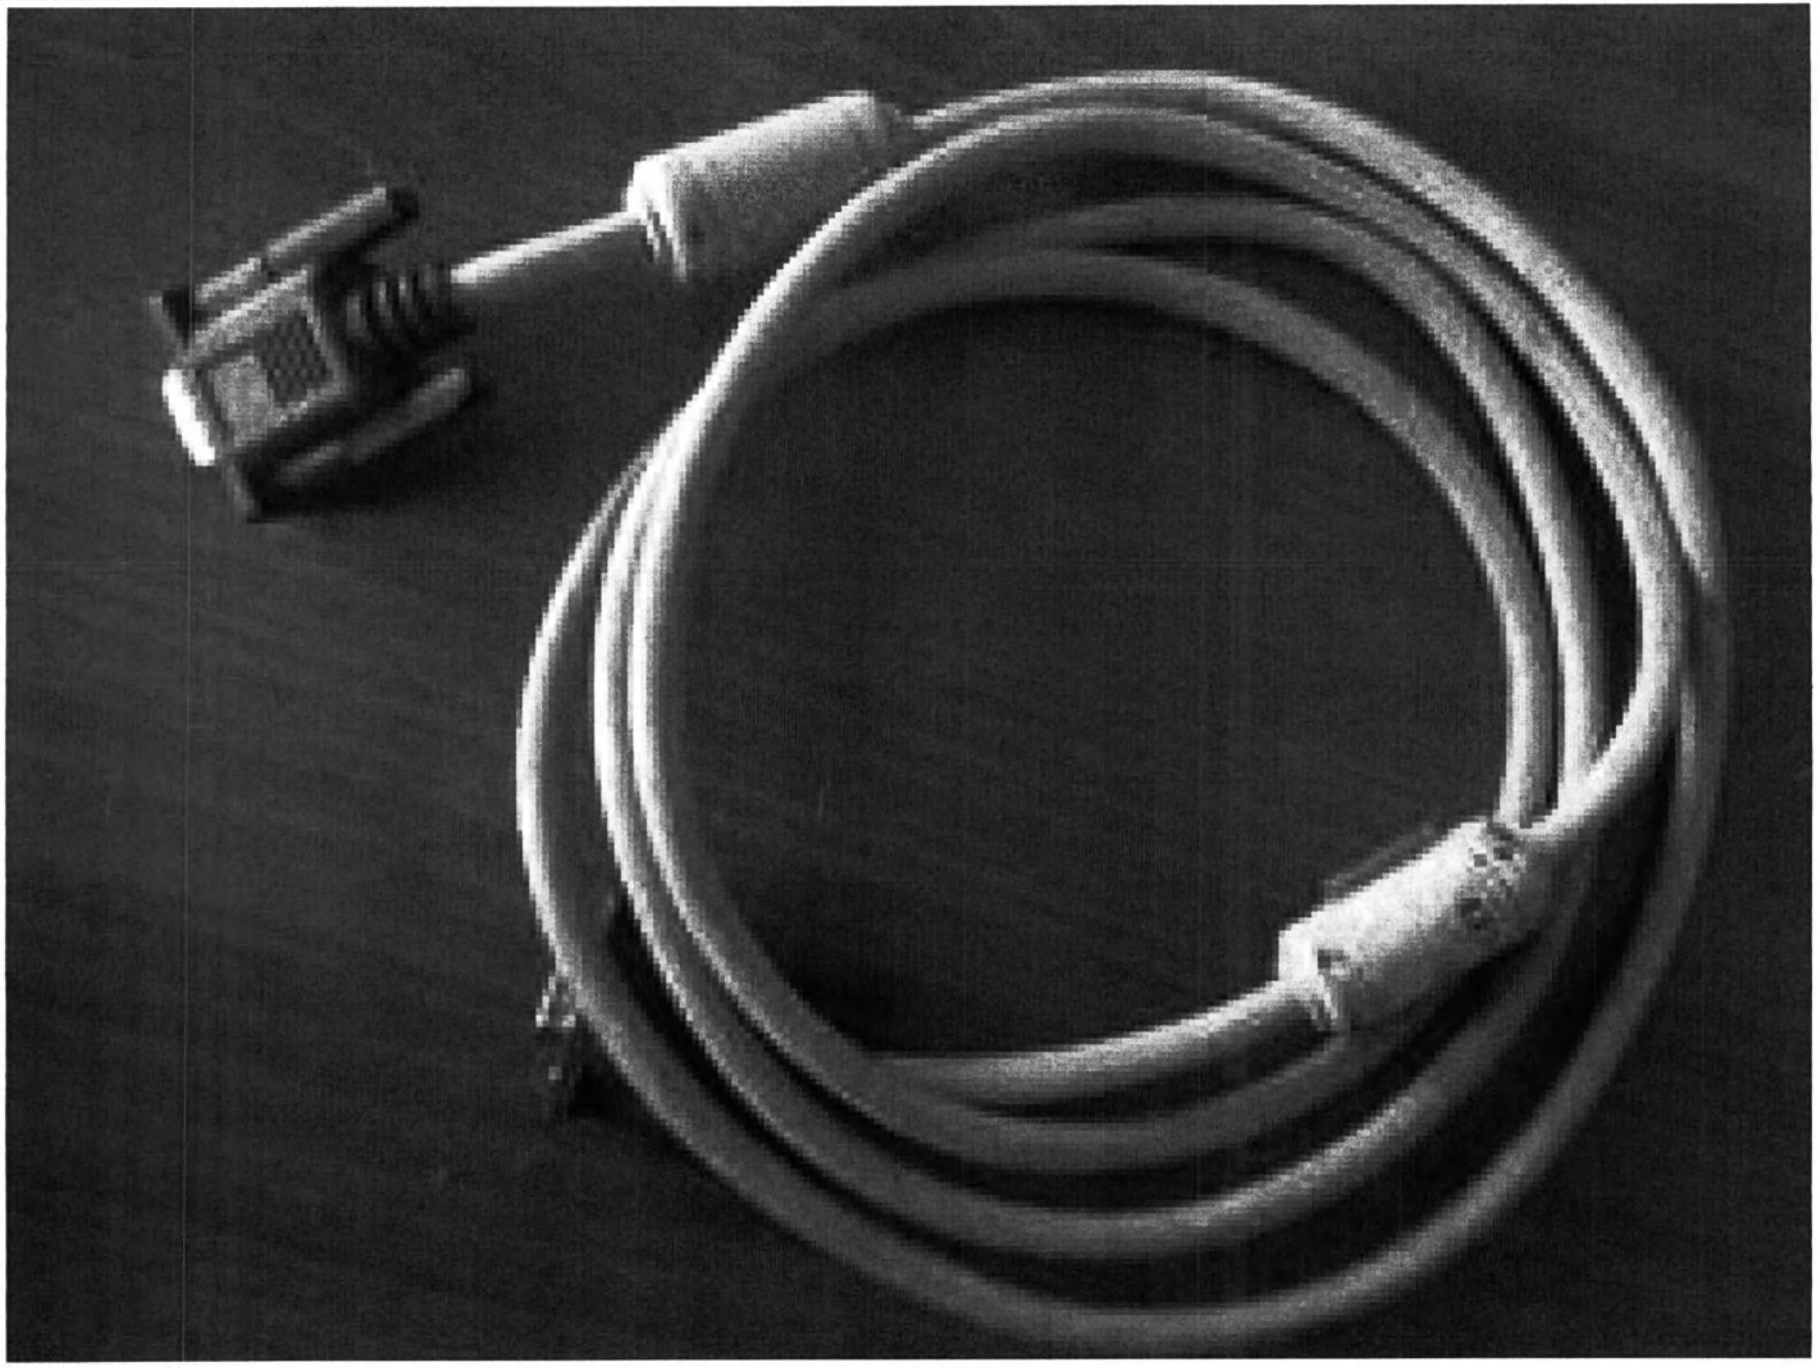

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

*40. Регистратор-принтер*

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

42. Интерфейс PS/2

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

*го тока*

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

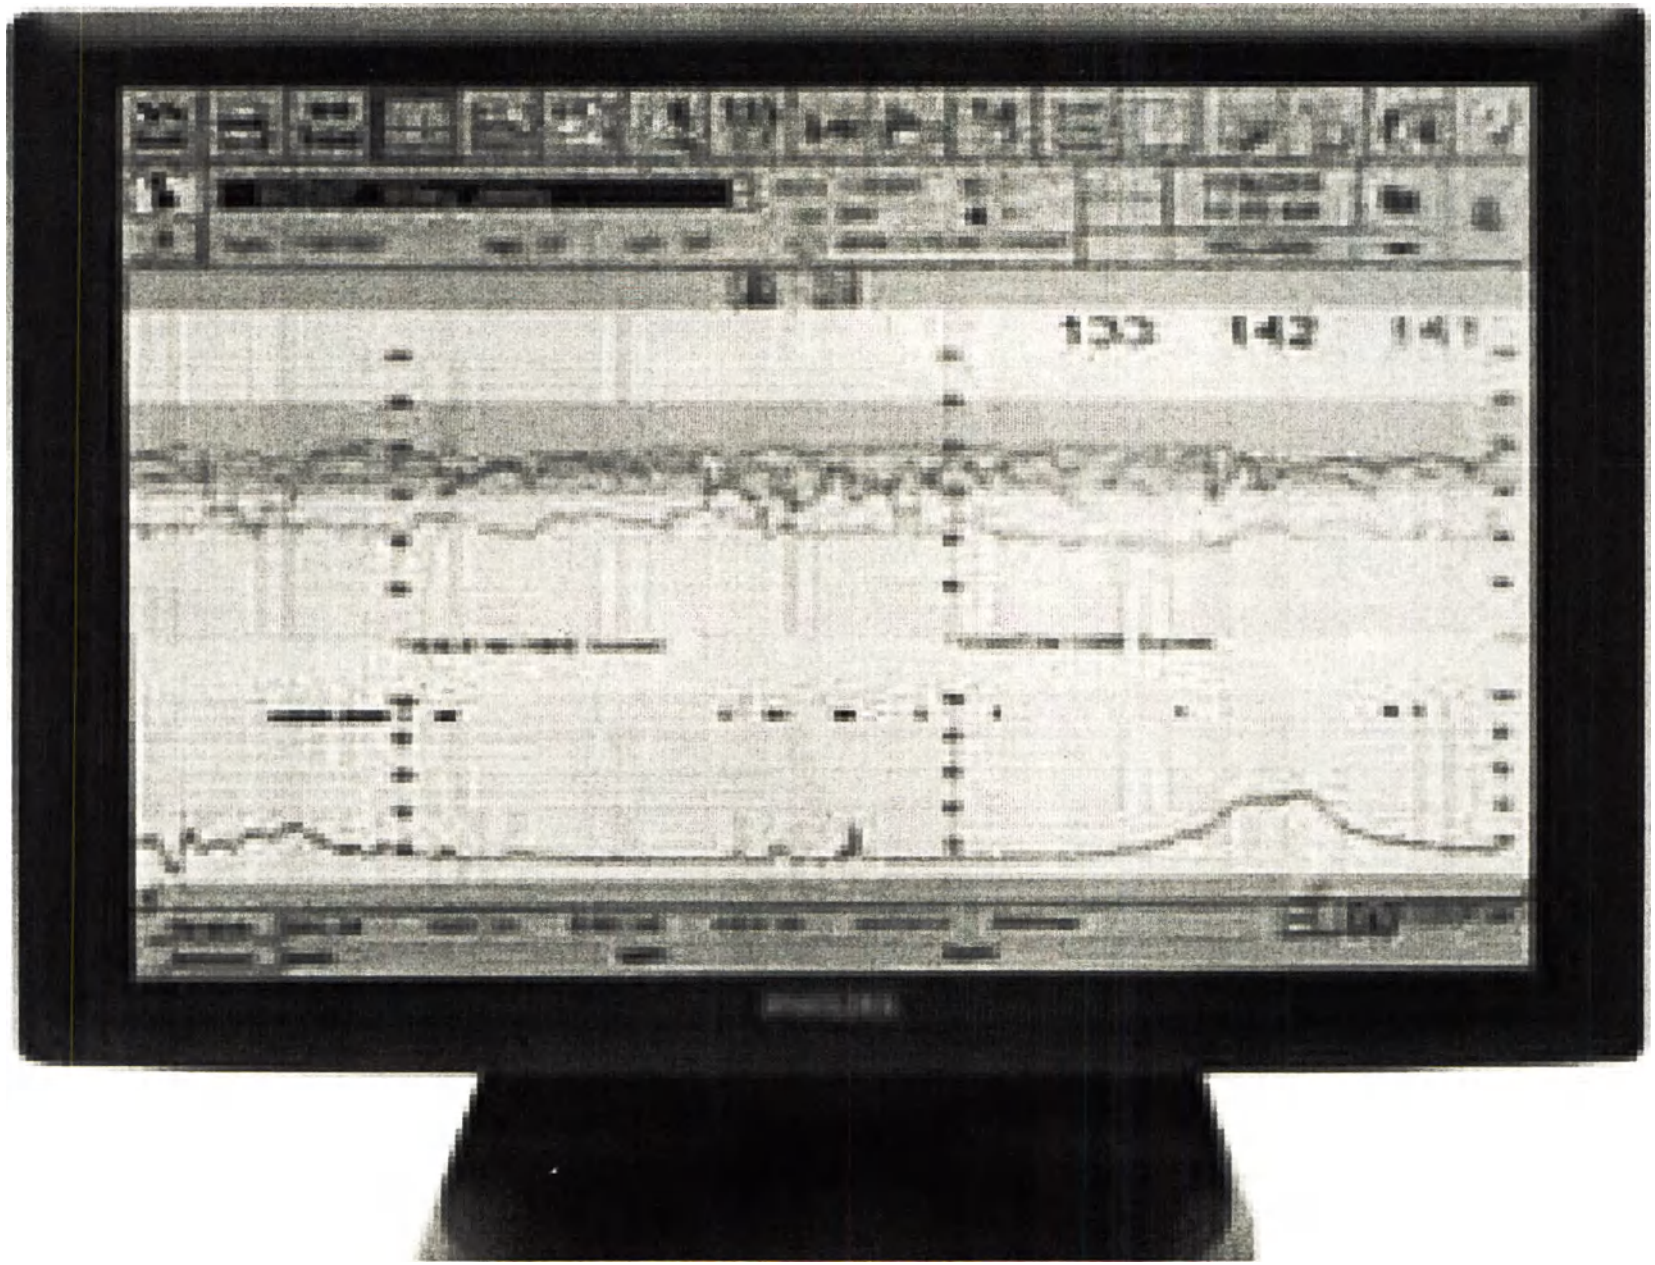


*44. Станция центрального наблюдения IntelliSpace Perinatal*

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

*46.1 Клавиатура, мышь*

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

*46.2 Кардиоматка – малая*

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

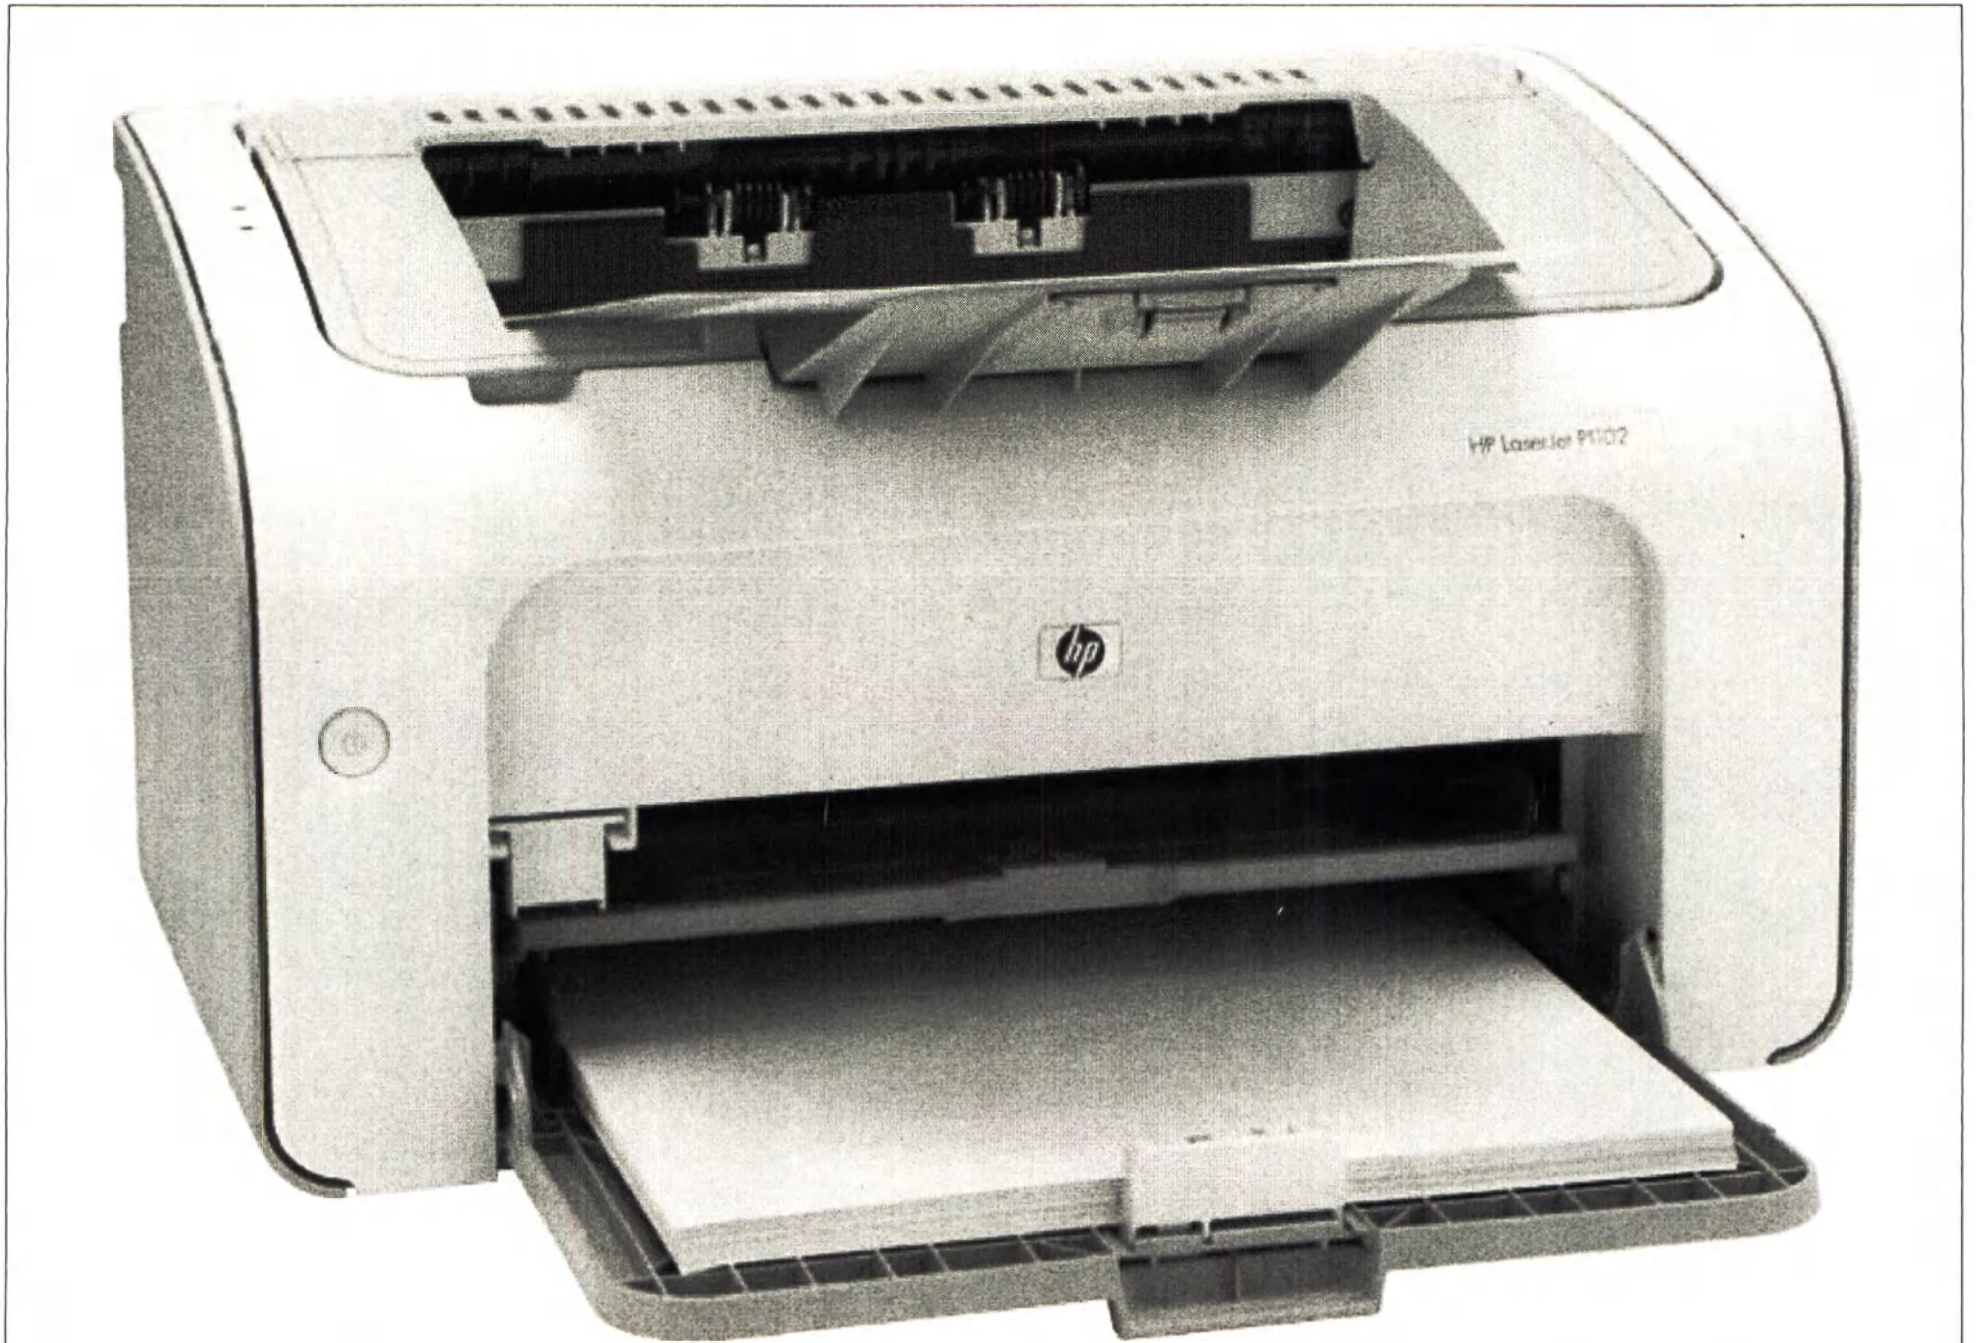


47. Принтер

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

*49. Сетевой маршрутизатор LAN*

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

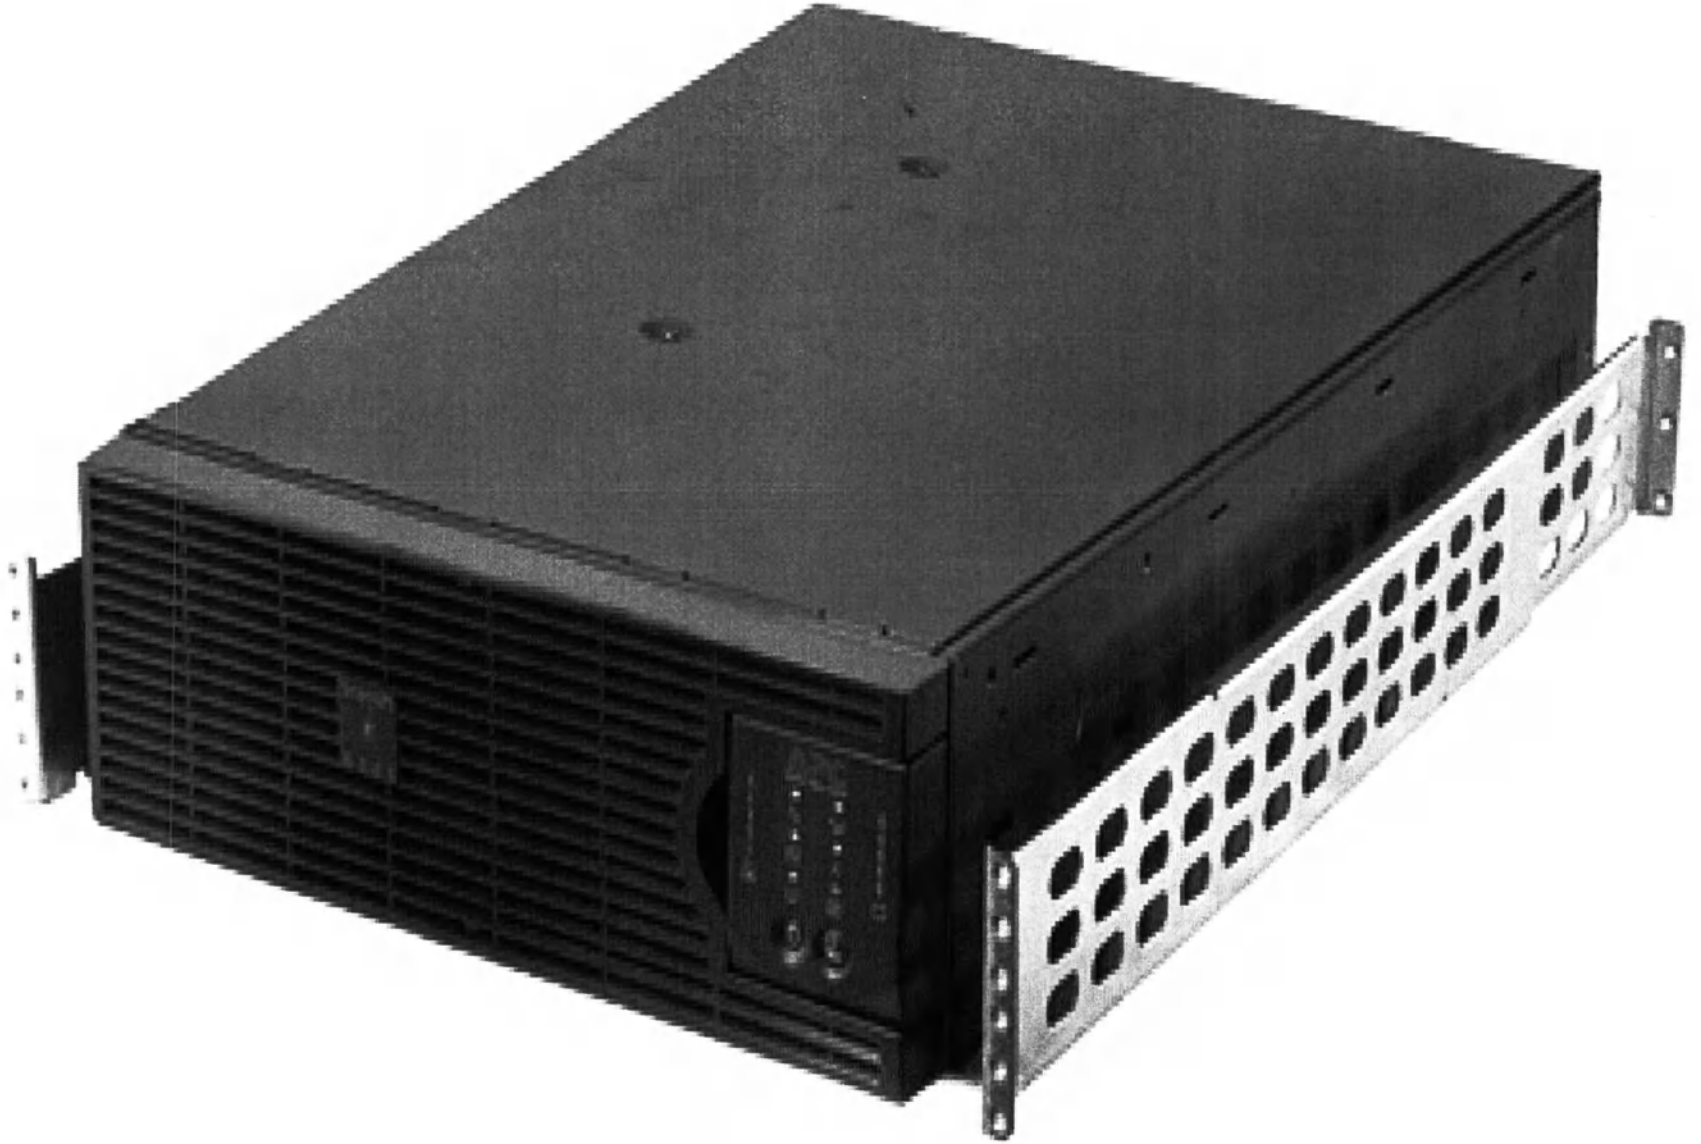

*51. Источник бесперебойного питания.*

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Инструкция по эксплуатации

# Фетальный монитор Avalon

## FM20/30, FM40/50, Avalon CL

**Редакция L.3, версия ПО L.3x.xx**

**Мониторинг пациентов**

PHILIPS



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

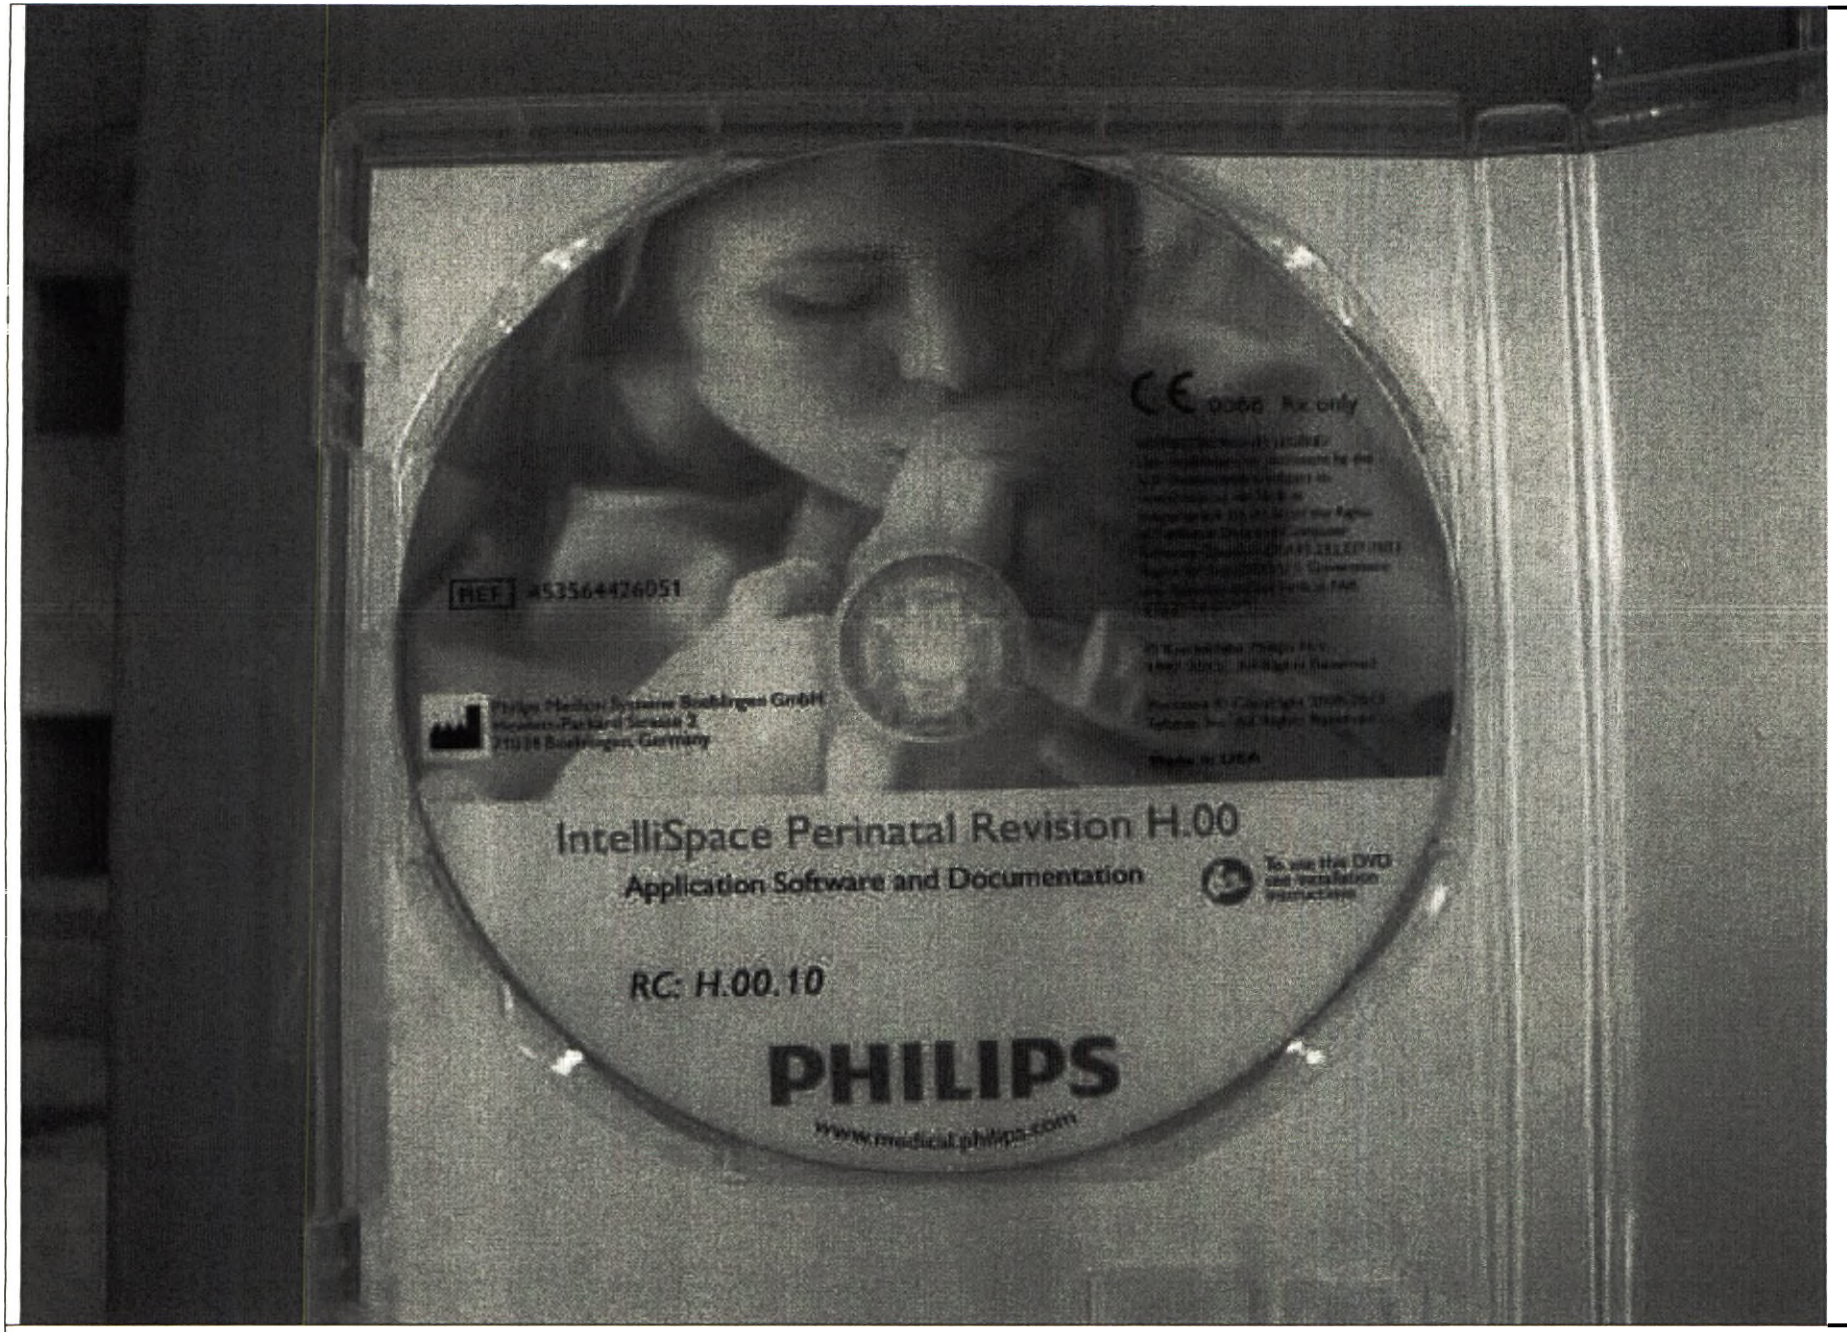


***53. Программное обеспечение медицинское на электронных носителях***

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

*54.1 Широкодиапазонный передатчик Avalon CL*

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

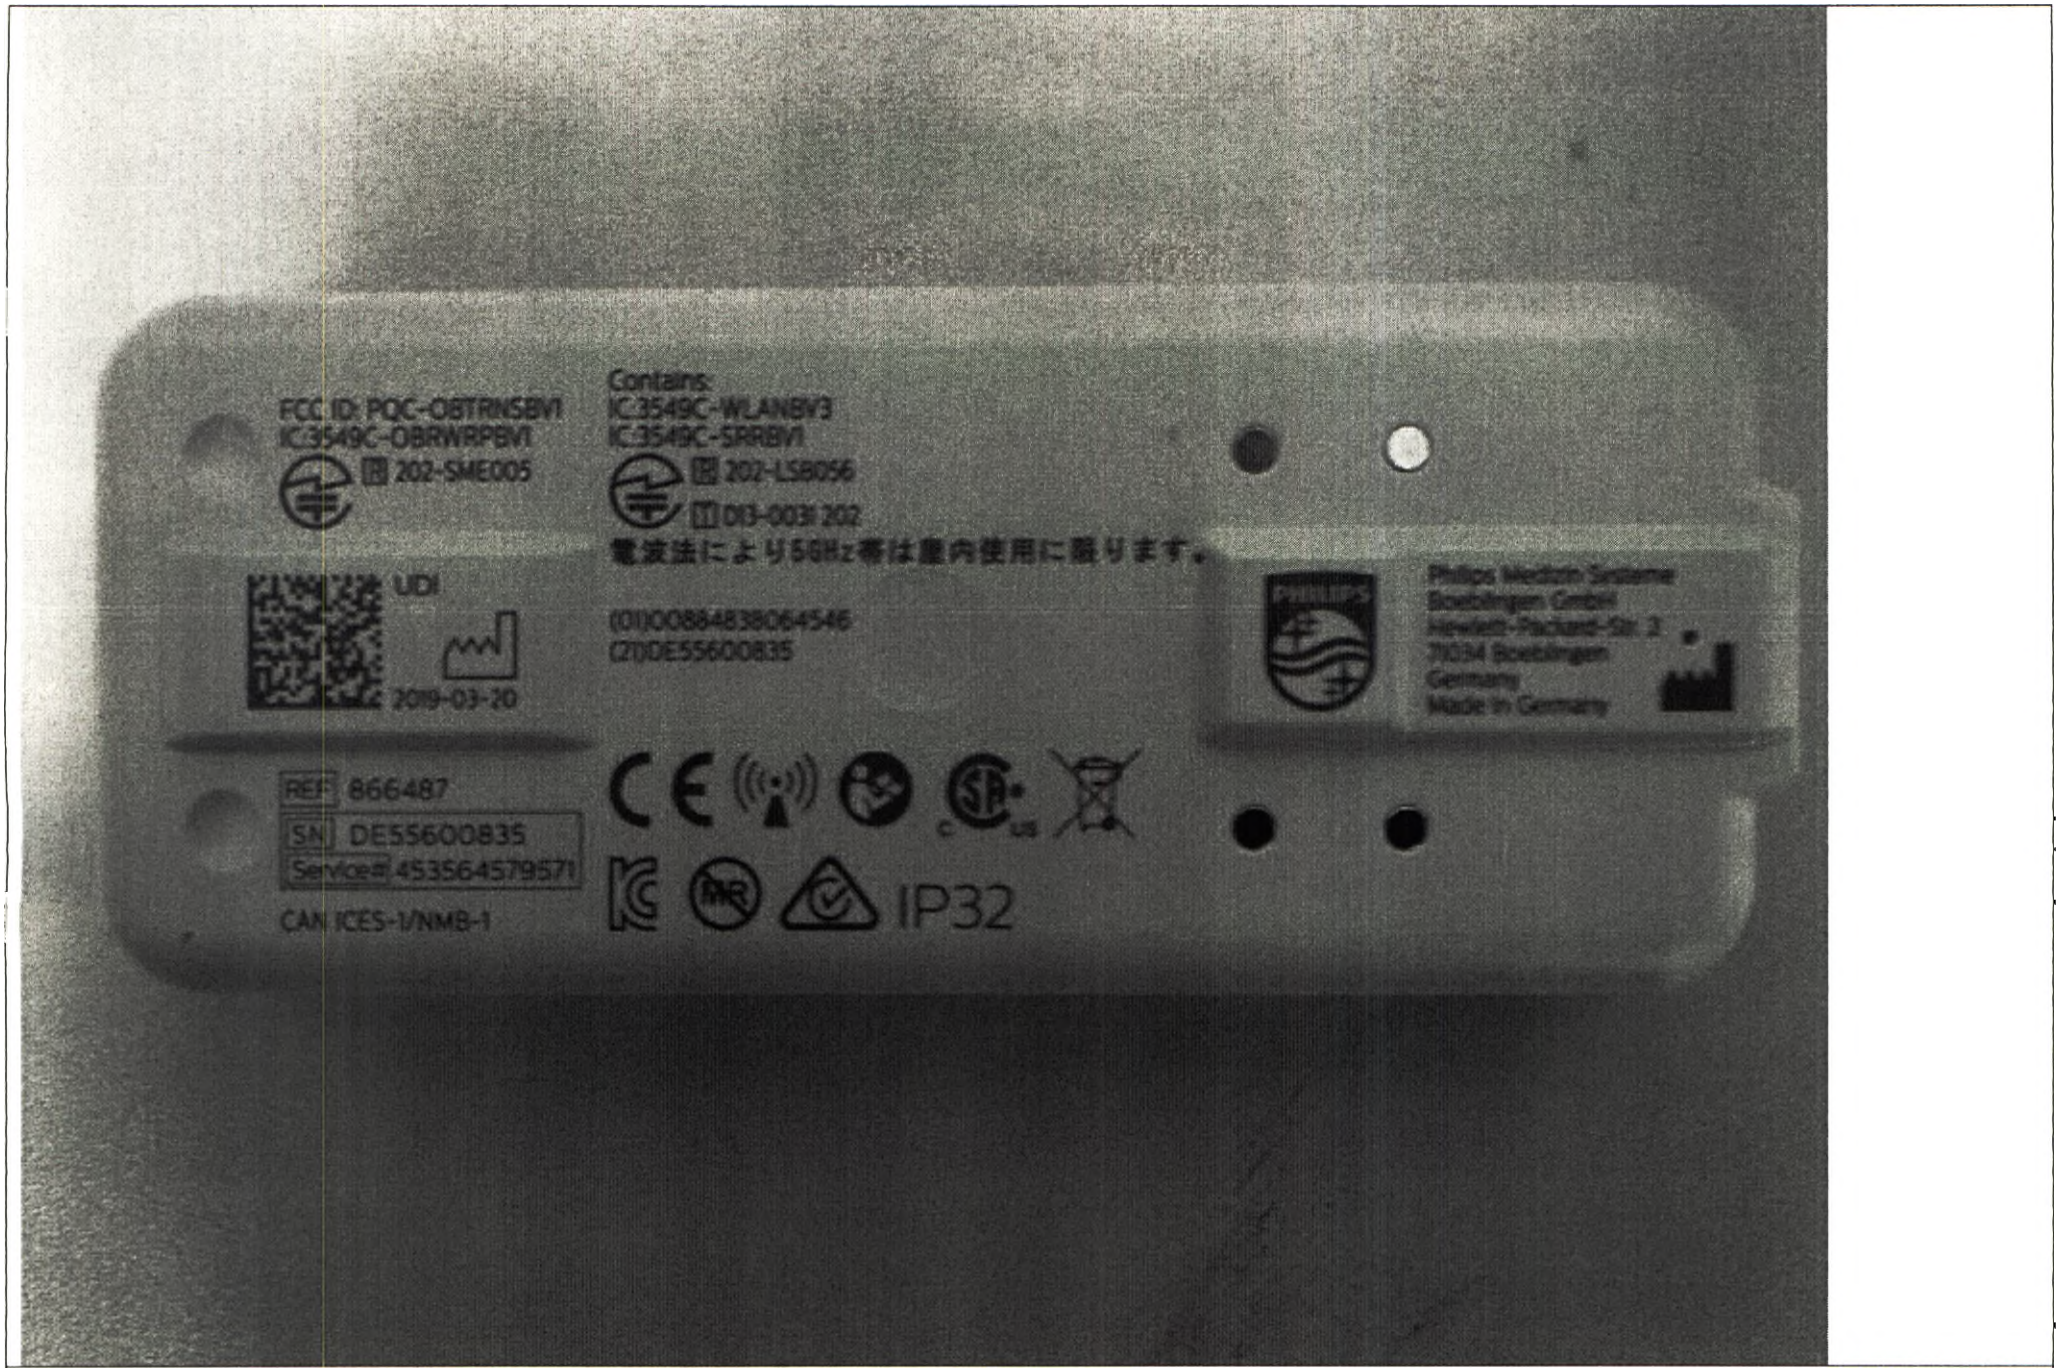


***54.2 Широкодиапазонный передатчик Avalon CL***

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

**Производитель: [в соответствии с Регистрационным Удостоверением]**

**Место производства: [в соответствии с Регистрационным Удостоверением]**

**Медицинское Изделие:**
**[в соответствии с Регистрационным Удостоверением]**

**Вариант исполнения/Модель: [в соответствии с Регистрационным Удостоверением]**

**Серийный номер/номер партии:**
**см. на основной маркировке**

**Дата изготовления: см. на основной маркировке**

**Номинальный режим работы: см.**

**Предупреждения и знаки опасности: см.**

**Регистрационное удостоверение: [в соответствии с Регистрационным Удостоверением]**

*Макет русскоязычной маркировки*

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU