



ООО «МедТестКонсалтинг»
MedTestConsulting Ltd.

Генеральный директор
ООО «МедТестКонсалтинг»
Бунзя В.К.



Фотографии на медицинское изделие
«Аппарат автоматический AUTO spin для сверления отверстий под штифты с лазерным позиционированием с принадлежностями»
производства «Ренферт ГмбХ», Германия
(Renfert GmbH, Germany)

2020 г.



REF: 18600000

CE



S/N: A1299720 Bj.: 2018





U: 230 V ~

f: 50/60 Hz


P: 75 W

Renfert GmbH | www.renfert.com | Made in Germany

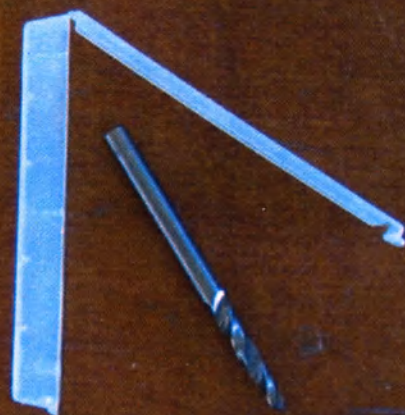

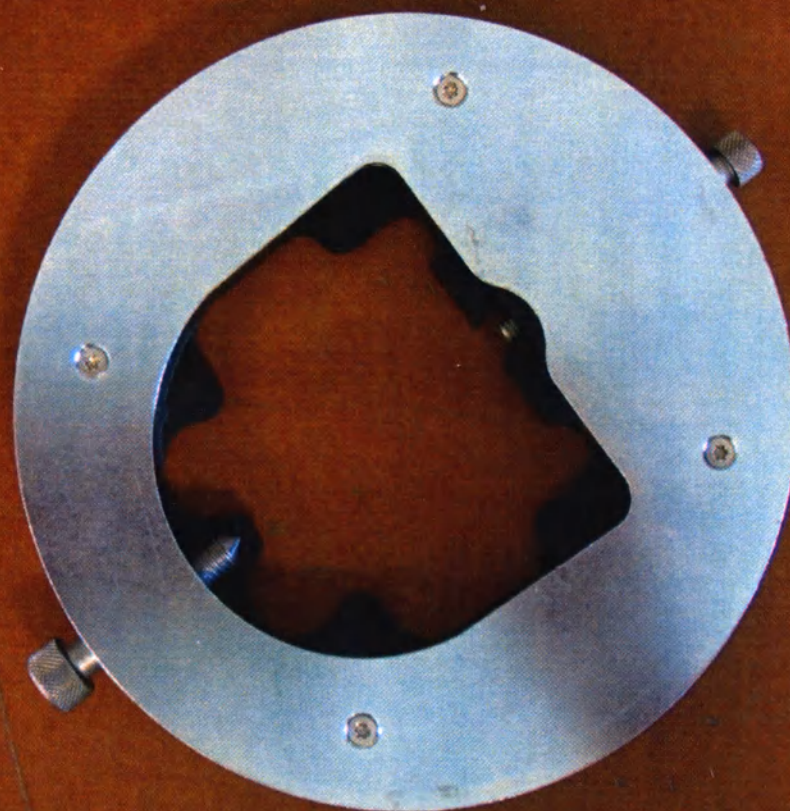

Универсальный
держатель для пластин

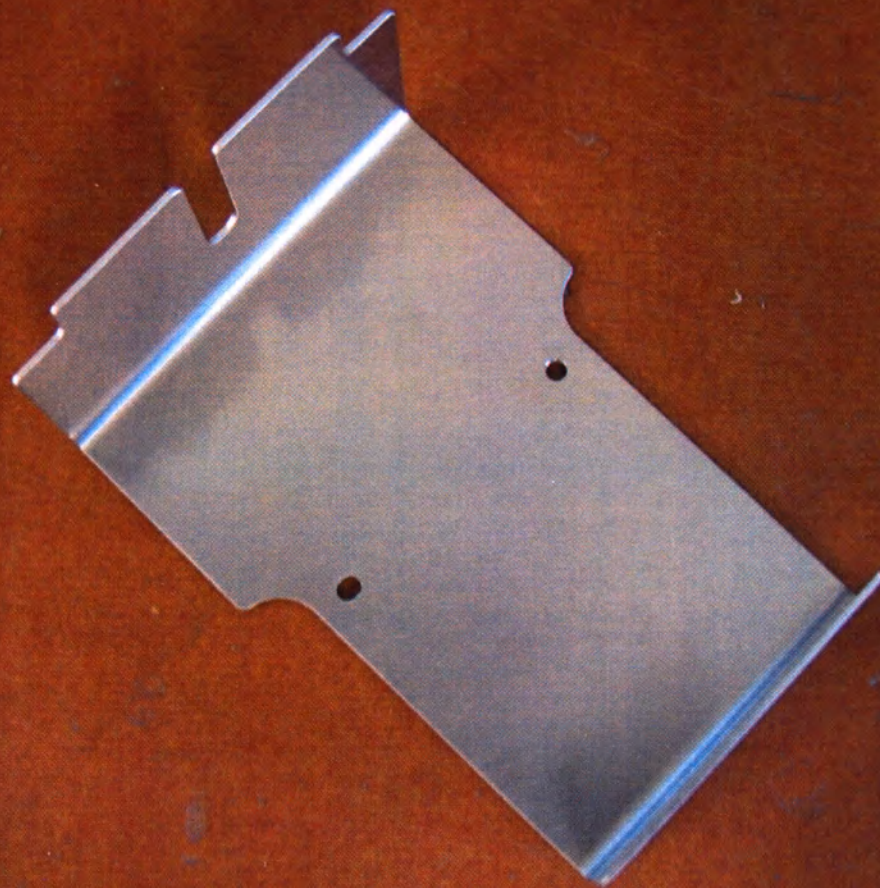

Универсальный
держатель для слепка




Инструмент для проверки
уровня слепка Level Controller




Инструмент для настройки глубины
сверления (отвёртка Torx T5)



Инструмент для фиксации сверла
(угловой ключ Torgx T10)

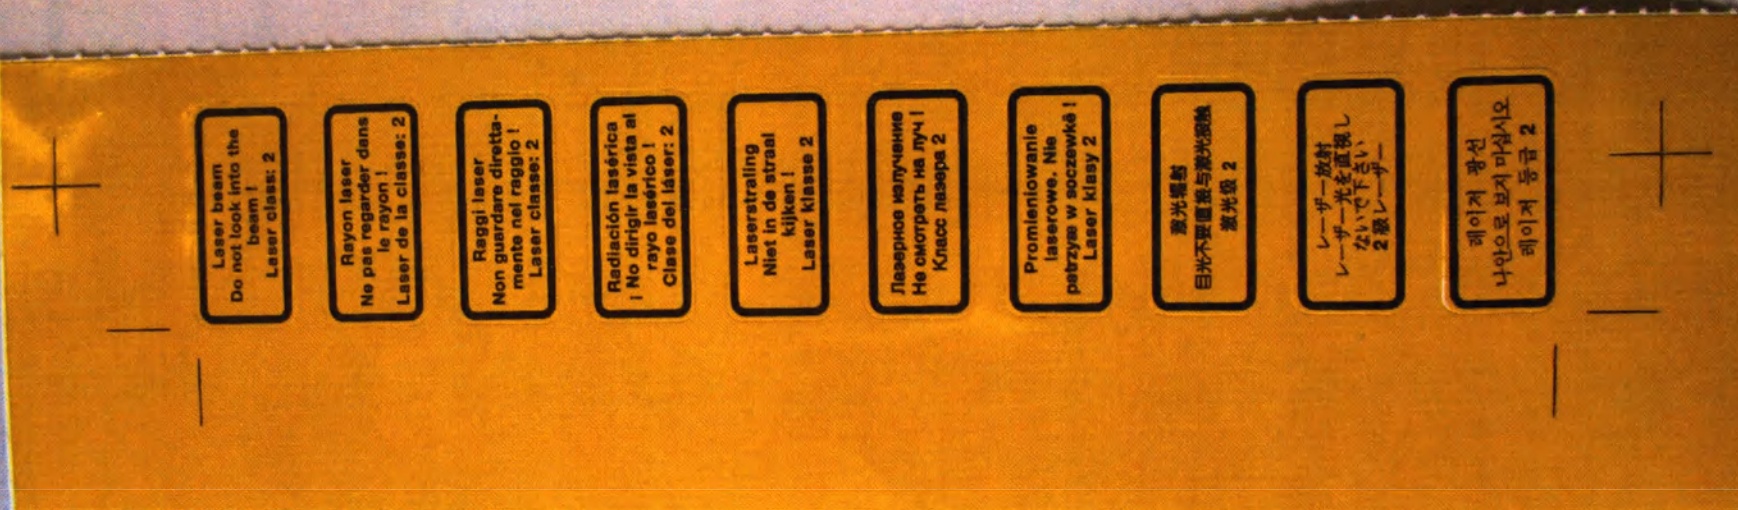

Набор предупреждающих наклеек
 для лазера

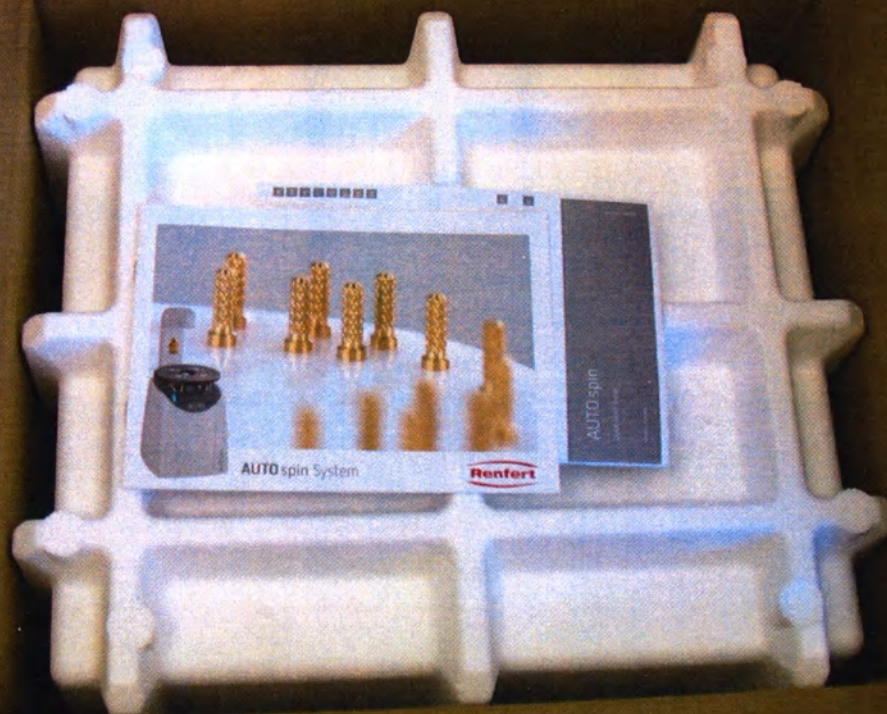

Краткое руководство
Инструкция по эксплуатации









AUTO spin putty

No. 1860 0400

Silikonknetmasse

Silicone putty

Silicona putty

Силиконовая базовая масса


Putty de silicone

ラボシリコーン

Silikon hamur

معجون سيليكوني

Renfert

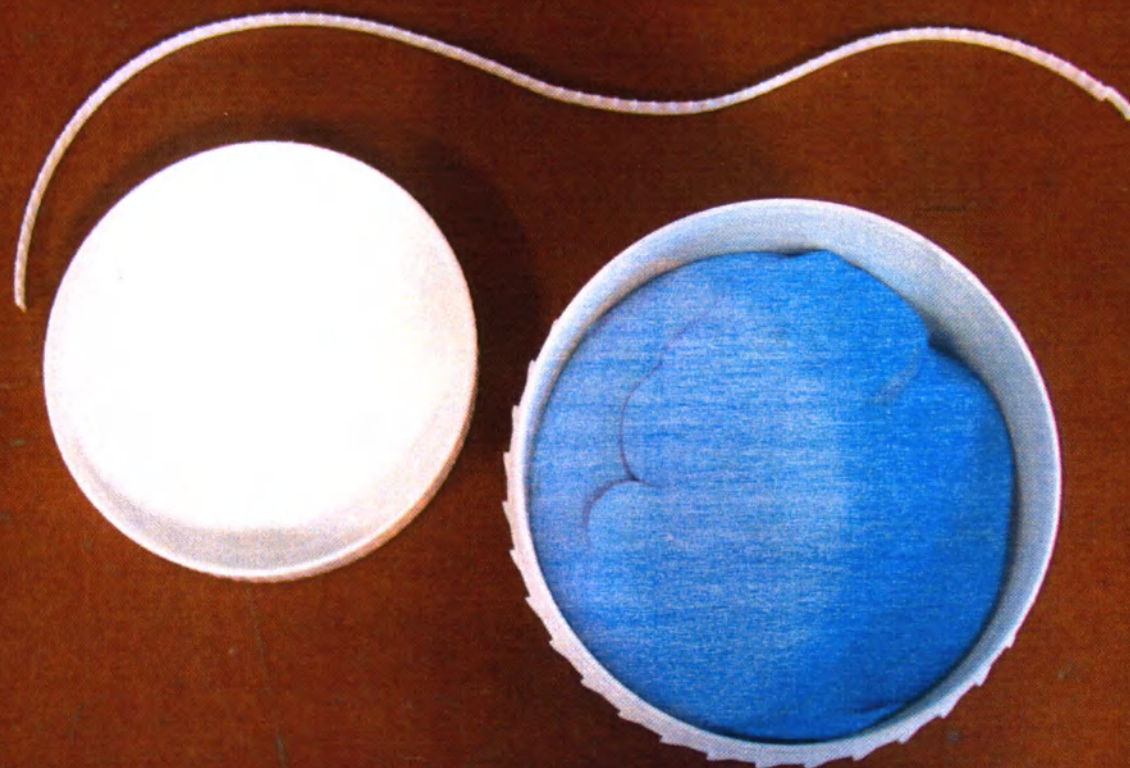



REF: 18600000



Auto spin



S/N: A1299720

U: 230 V ~

f: 50/60 Hz



+J009186000000/\$A1299720V

PA229209

Renfert GmbH
www.renfert.com

Made in Germany



REF: 18600000



Renfert

AUTO spin 220-240B



Утилизировать в соответствии с
требованиями законодательства РФ

Хранить в сухом месте.

Изготовитель: "Ренферт ГмбХ",
Германия, Renfert GmbH, 78247
Hilzingen, Untere Giesswiesen 2,
Germany

Изготовлено в Германии

Условия хранения, применения и
утилизации см. в инструкции или
паспорте безопасности

Импортер/Дистрибьютор:

ООО Рокада-Дент

Россия, 420107, Казань - ул.
Петербургская д. 26

т. +7(843)294 59 70 ф. +7(843)294 59 72

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

18 лист(ов)

Генеральный директор
ООО "МедТестКонсалтинг"

