

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ОРЛАНД»

Хайруллина А.А.

2021 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Перчатки смотровые виниловые, неопудренные, нестерильные

Перчатки смотровые виниловые, неопудренные, нестерильные,

Варианты исполнения:

- Перчатки смотровые виниловые, неопудренные, нестерильные, цвет: бесцветный (прозрачный), размер: XS;
- Перчатки смотровые виниловые, неопудренные, нестерильные, цвет: бесцветный (прозрачный), размер: S;
- Перчатки смотровые виниловые, неопудренные, нестерильные, цвет: бесцветный (прозрачный), размер: M;
- Перчатки смотровые виниловые, неопудренные, нестерильные, цвет: бесцветный (прозрачный), размер: L;
- Перчатки смотровые виниловые, неопудренные, нестерильные, цвет: бесцветный (прозрачный), размер: XL.



Перчатки смотровые виниловые неопудренные, нестерильные
Размер XL, цвет бесцветный (прозрачный), 50 пар.

Производитель: Zhonghong Pulin Medical Products Co., Ltd West Industrial Park, Luannan County
Tangshan City, 063502, Hebei, China

LOT

ZH181102



2018-11-02



2023-11-01

Перчатки предназначены для одноразового использования при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур с целью защиты пациента и исследователя от взаимного заражения, а также для использования при работе с зараженными медицинскими материалами.

Инструкция по применению: перед применением перчаток убедиться в целостности упаковки. Необходимо применение правильной техники снятия и надевания перчаток, которая предотвращает контаминацию рук медицинских работников. Если целостность перчатки нарушена (например, если она проколота), ее следует заменить как можно быстрее и провести гигиеническую антисептику рук. **Обязательно обработайте руки после снятия перчаток!** Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик перчаток в течение всего срока годности при условии целостности упаковки, соблюдении условий хранения и эксплуатации в соответствии с инструкцией. Хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей и высокой влажности, при температуре от 10 °C до 30 °C.

Made in China

Маркировка

прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 3 (три) лист(ов)



Генеральный директор

Хайруллина А.А.

Хайруллина А.А.

«18» января 2022

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ОРЛАНД»

Хайруллина А.А.


29 марта 2021 г.



Дополнение к
ФОТОГРАФИЧЕСКИМ ИЗОБРАЖЕНИЯМ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Перчатки смотровые виниловые, неопудренные, нестерильные

Упаковка медицинского изделия, в которой планируется поставлять его потребителю:

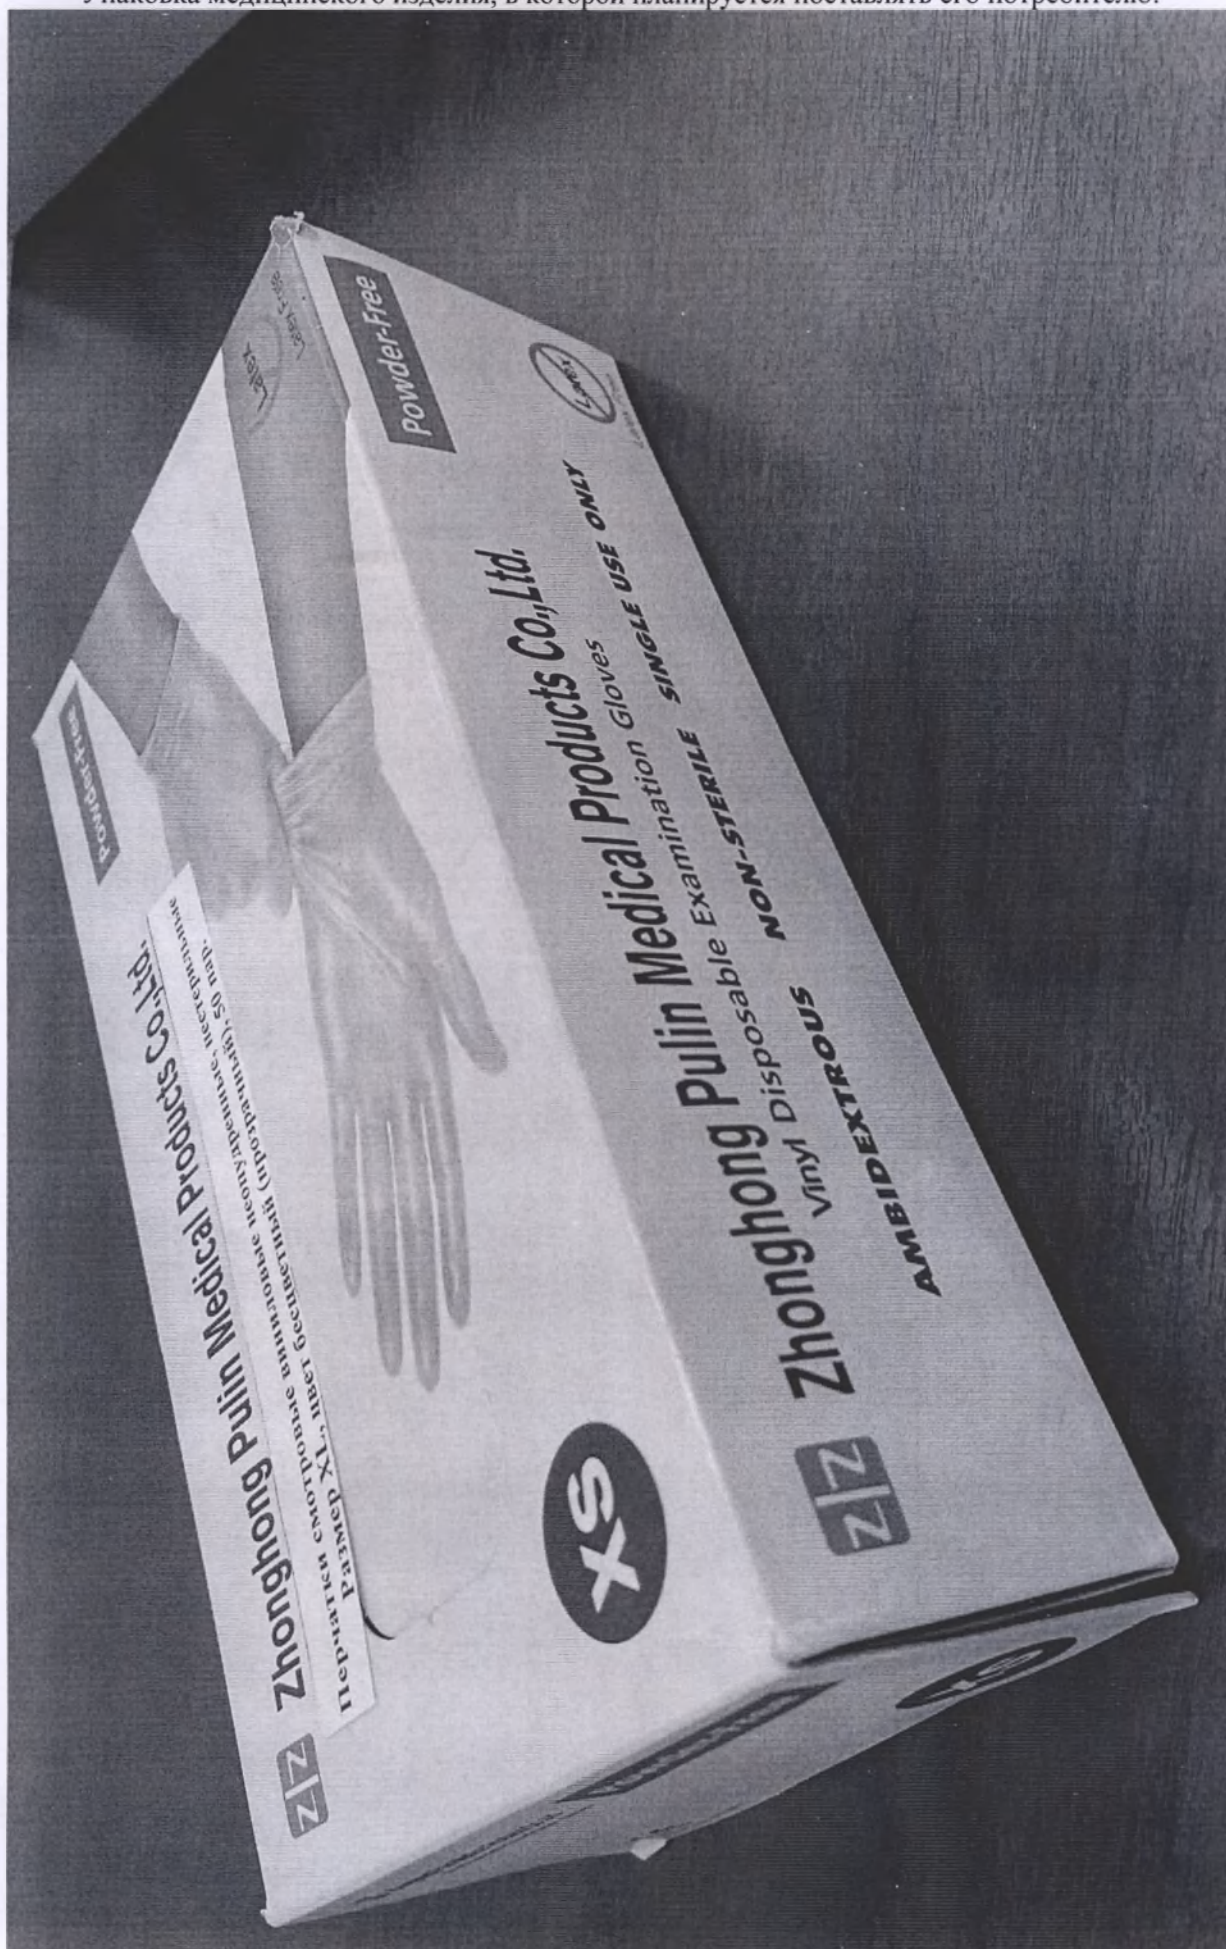

Перчатки смотровые виниловые неопудренные, нестерильные
Размер XL, цвет бесцветный (прозрачный), 50 пар.

Производитель: Zhonghong Pulin Medical Products Co., Ltd West Industrial Park, Luannan County
Tangshan City, 063500, Hebei, China

LOT

ZH181102



2018-11-02



2023-11-01

Перчатки предназначены для одноразового использования при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур с целью защиты пациента и исследователя от взаимного заражения, а также для использования при работе с зараженными медицинскими материалами.

Инструкция по применению: перед применением перчаток убедиться в целостности упаковки. Необходимо применение правильной техники снятия и надевания перчаток, которая предотвращает контаминацию рук медицинских работников. Если целостность перчатки нарушена (например, если она проколота), ее следует заменить как можно быстрее и провести гигиеническую антисептику рук. **Обязательно обработайте руки после снятия перчаток!** Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик перчаток в течение всего срока годности при условии целостности упаковки, соблюдении условий хранения и эксплуатации в соответствии с инструкцией. Хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей и высокой влажности, при температуре от 10 °C до 30 °C.

Made in China

прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 3 (три) лист(ов)

Генеральный директор
ООО «ОРЛАНД»

Ха Хайруллина А.А.
23 » июня 2021 г.

