


ФОТОГРАФИИ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Набор реагентов для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 в мазках из носоглотки и ротоглотки человека COVID-19 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold), LOT 3720201203»



**COVID-19 Antigen Rapid Test Kit
(Colloidal Gold)**

For in vitro qualitative detection of the antigen of novel corona virus in human throat swabs or nasal swabs

Contents:

- 1) Nasopharyngeal swab 1 × 25 pieces
- 2) Antigen extraction tube 1 × 25 pieces
- 3) Antigen extract R1 5mL × 2 bottles
- 4) Test card 1 × 25 pieces
- 5) Instruction for Use 1 × 1 piece


LOT 3720201203

EXP 2022.06.19

REF CG01Ag-25

EC REP

SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076 DE Amsterdam, Netherlands



«Набор реагентов для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 в мазках из носоглотки и ротоглотки человека COVID-19 Антиген Rapid Test Kit (Colloidal Gold), LOT 3720201203». Внешняя упаковка.

11 см (± 1 см)	
Набор реагентов для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 в мазках из носоглотки и ротоглотки человека COVID-19 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold)	
Состав: 1. Тестовая кассета (в индивидуальной упаковке из фольги в комплекте с осушителем) - 25 шт. 2. Пробирка для экстрагирования биологического образца - 25 шт. 3. Зонд для забора биоматериала (в индивидуальной упаковке) - 25 шт. 4. Насадка-капельница - 25 шт. 5. Буфер для экстрагирования - 2 флакона по 5 мл. 6. Инструкция по применению - 1 шт.	LOT 3720201203 ⌚ 2022.06.19 REF CG01Ag-25
Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации: ООО «МедТех»/ 108814, г. Москва, километр Калужское шоссе 24-й (п. Сосенское), владение 1, строение 1, помещение XIV/эт. 7/ком. 43 Тел: +7 (495) 101-62-12, e-mail: info@medtehltd.com	
Регистрационное удостоверение № _____ от _____ Только для профессионального применения	

Макет маркировки



Xiamen AmonMed Biotechnology Co.,Ltd.

TEL: +86-592-6519307

Fax: +86-592-6081739


Service hotline: +86 400-877-1929

E-mail: info@amonmed.com

Web: www.amonmed.com

Registered address: 120 Xinyuan Road, Haicang District, Xiamen, China

«Набор реагентов для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 в мазках из носоглотки и ротоглотки человека COVID-19 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold), LOT 3720201203». Вид сбоку 1.



«Набор реагентов для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 в мазках из носоглотки и ротоглотки человека COVID-19 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold), LOT 3720201203». Вид сбоку 2.



For in-vitro diagnosis use only



25 Tests

«Набор реагентов для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 в мазках из носоглотки и ротоглотки человека COVID-19 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold), LOT 3720201203». Вид сбоку 3.



«Набор реагентов для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 в мазках из носоглотки и ротоглотки человека COVID-19 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold), LOT 3720201203». **Общий вид состава.**



Тестовая кассета

COVID-19 Antigen Rapid Test Kit
(Colloidal gold)
LOT: 3720201203 EXP: 2022.06.19


Тестовая кассета (в индивидуальной упаковке из фольги в комплекте с осушителем)



Пробирка для экстрагирования биологического образца



Пробирка для экстрагирования биологического образца - 25 шт.

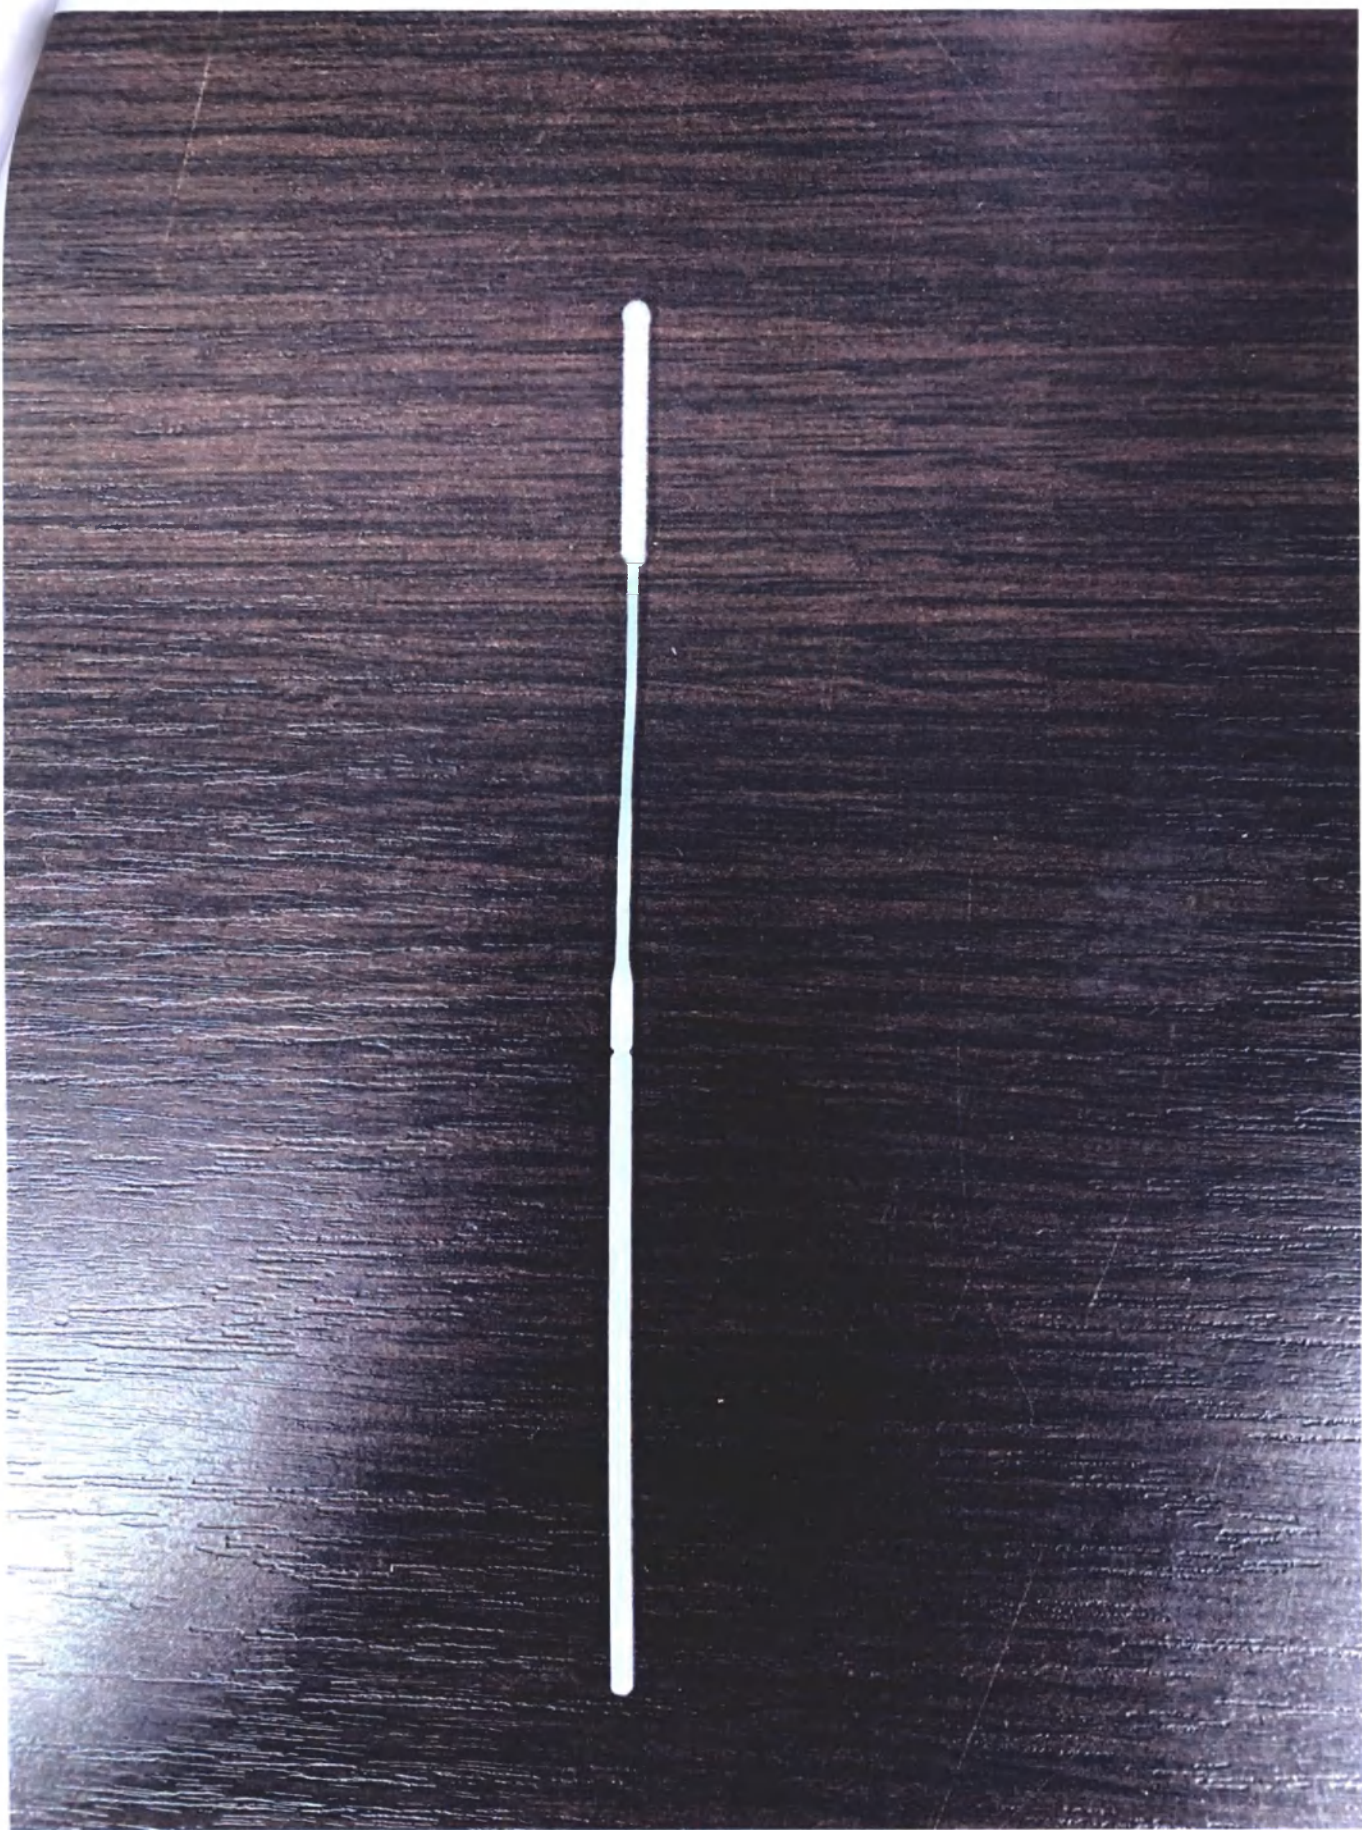

Зонд для забора биоматериала



Зонд для забора биоматериала (в индивидуальной упаковке)



Насадка-капельница



Насадка-капельница - 25 шт (в упаковке)



Буфер для экстрагирования - 2 флакона по 5 мл

ВСЕГО ПРОШИТО И СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ 17 ЛИСТ(ОВ)