



Директор

ООО «Медика Продакт»

Михалева Е.М.

2021 г.

Фотографические изображения медицинского изделия


«Устройство для окрашивания стеклопрепаратов V-Chromer III (В-Хромер 3)»

производства «West Medica Produktions- und Handels- GmbH», Австрия


(«West Medica Produktions- und Handels- GmbH», Brown-Boveri-Straße 6, B17-1, 2351

Wiener Neudorf, Austria; Тел.: + 43 (0) 2236 892465.

Факс: + 43 (0) 2236 892464, E-mail: vienna@westmedica.com).

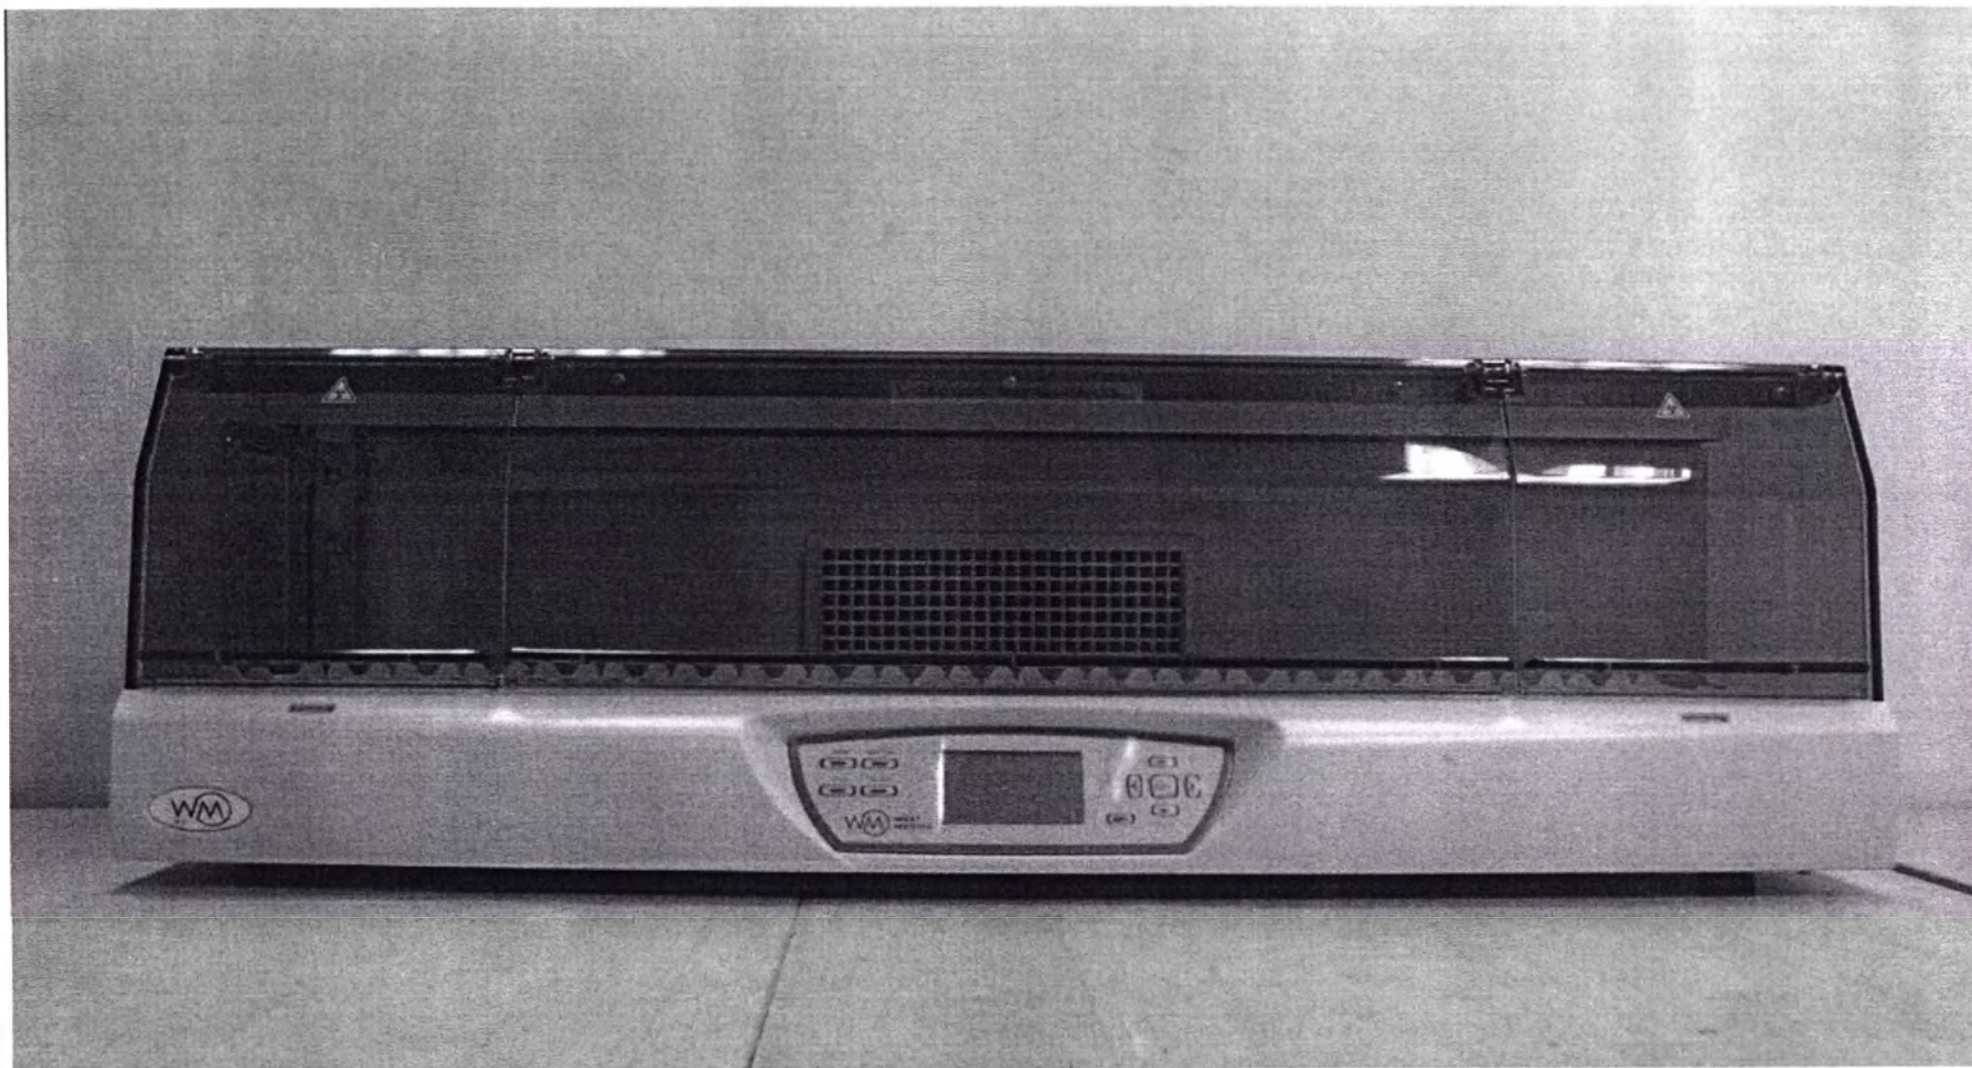


Устройство для окрашивания стеклослайдов V-Chromer III (В-Хромер 3)

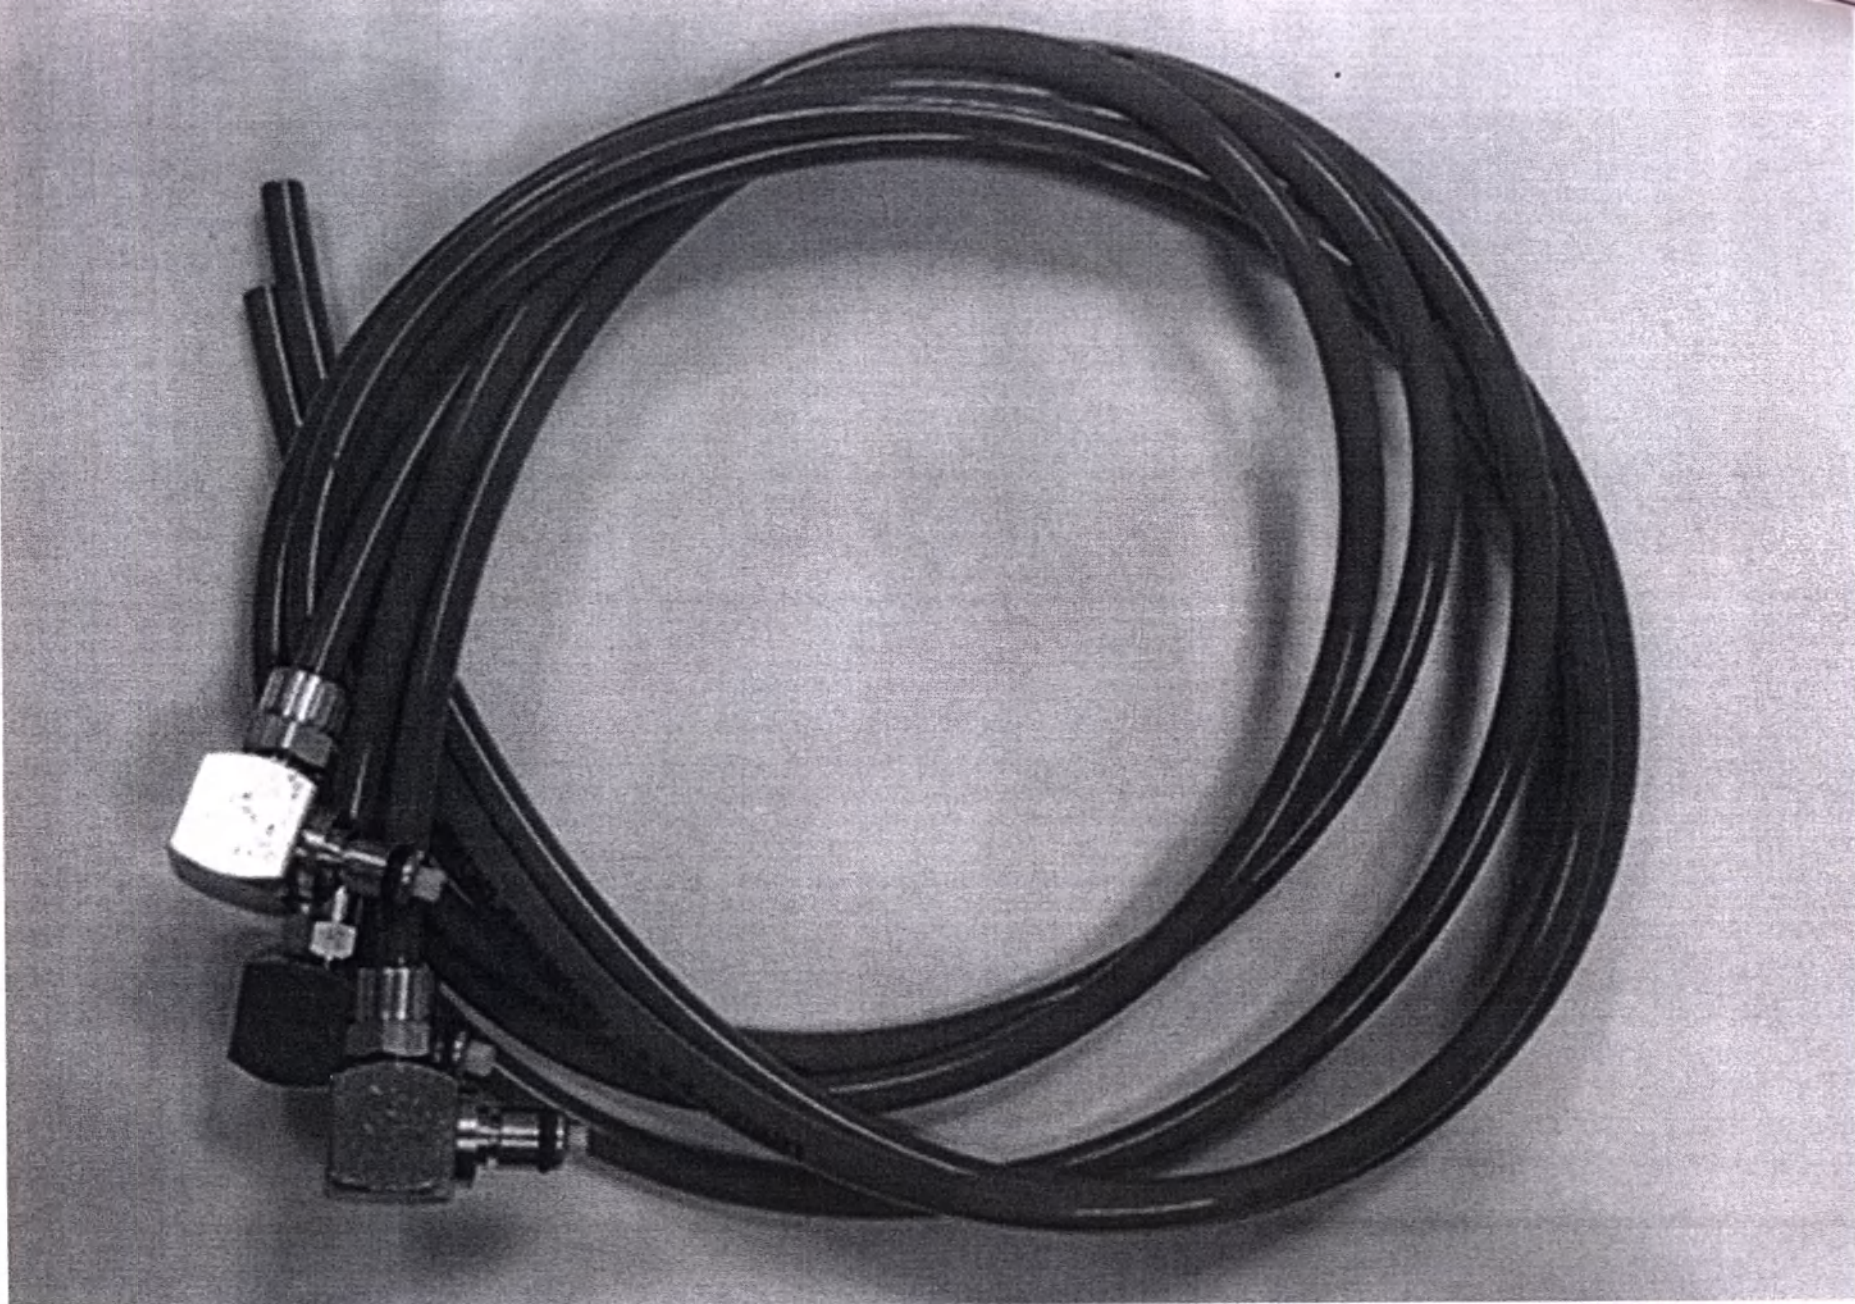


Трубки подачи воды

Источник питания 12В, 12.5А




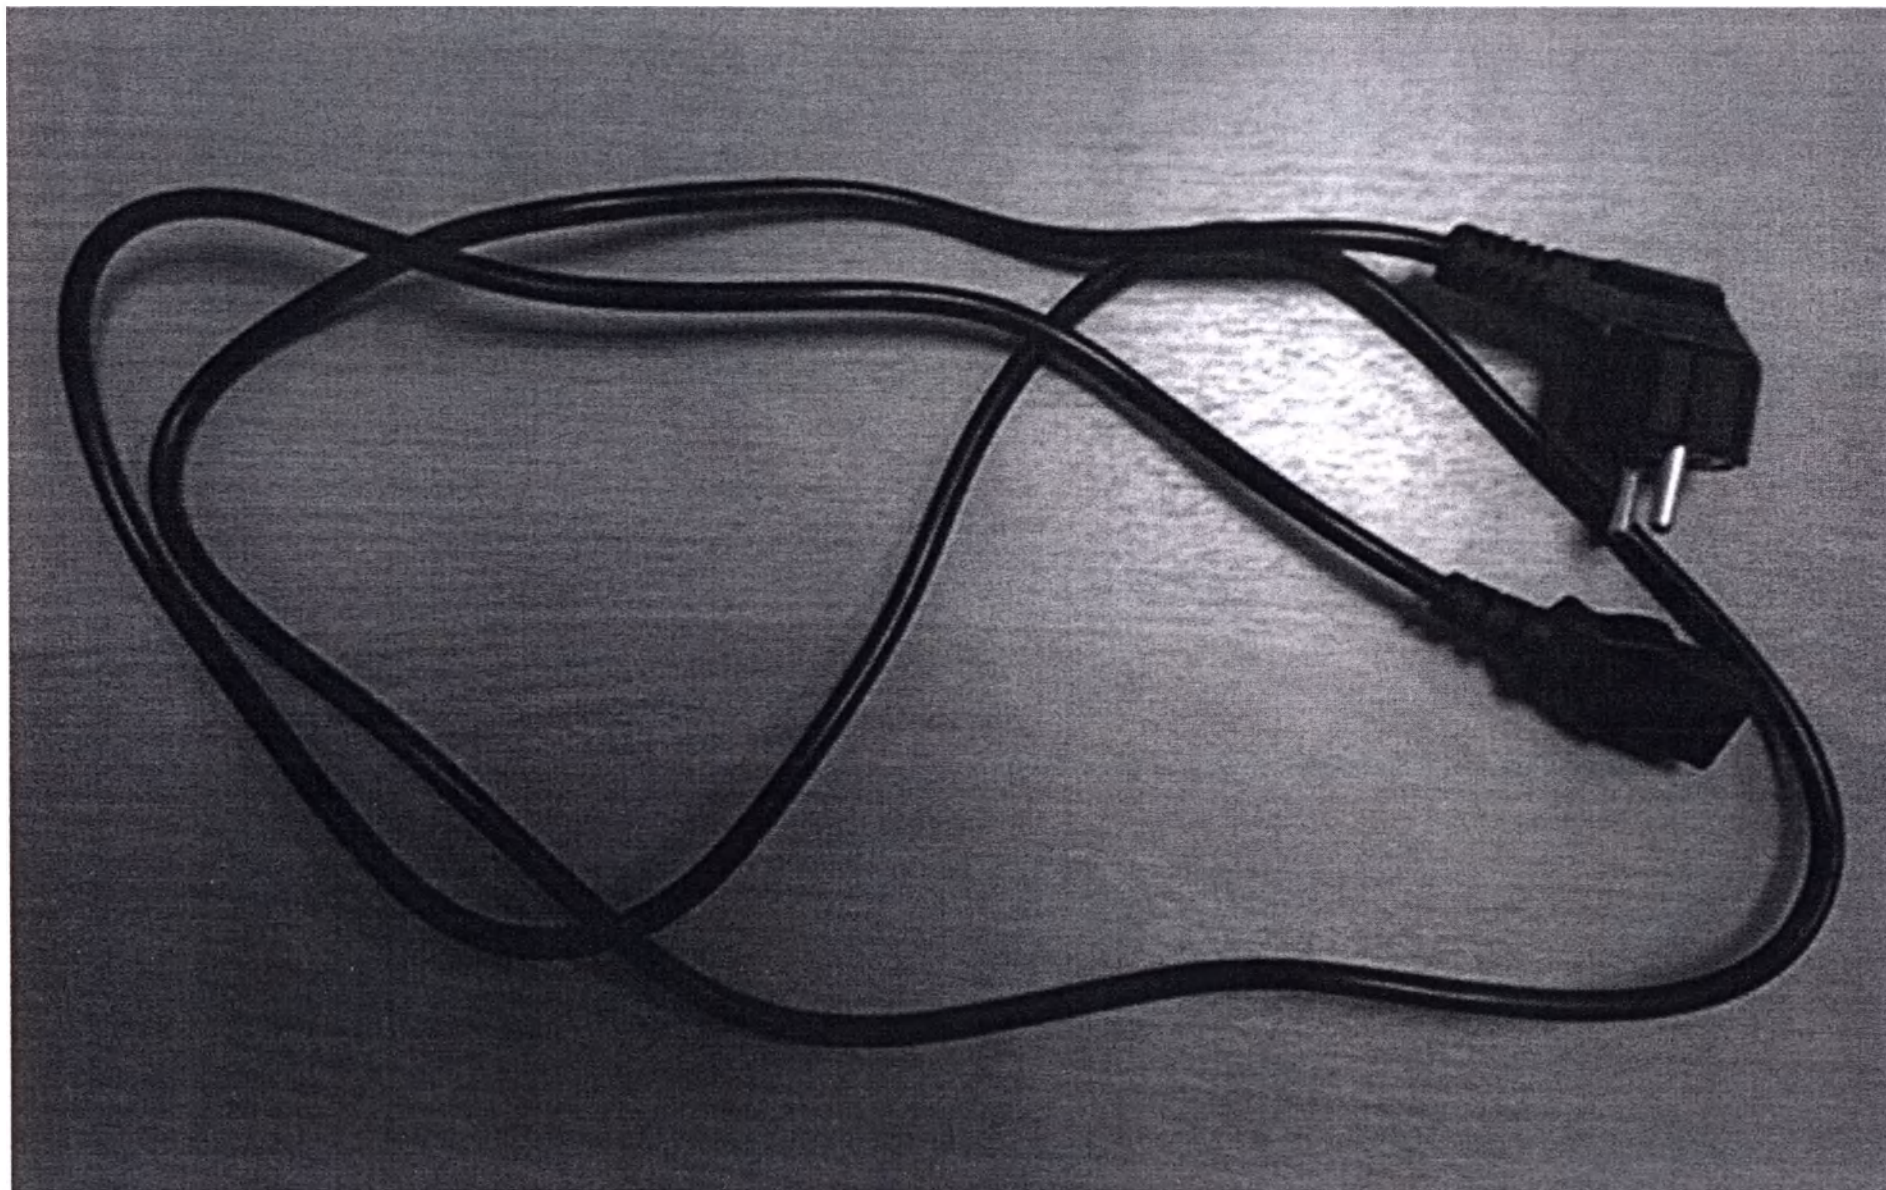


Кабель питания

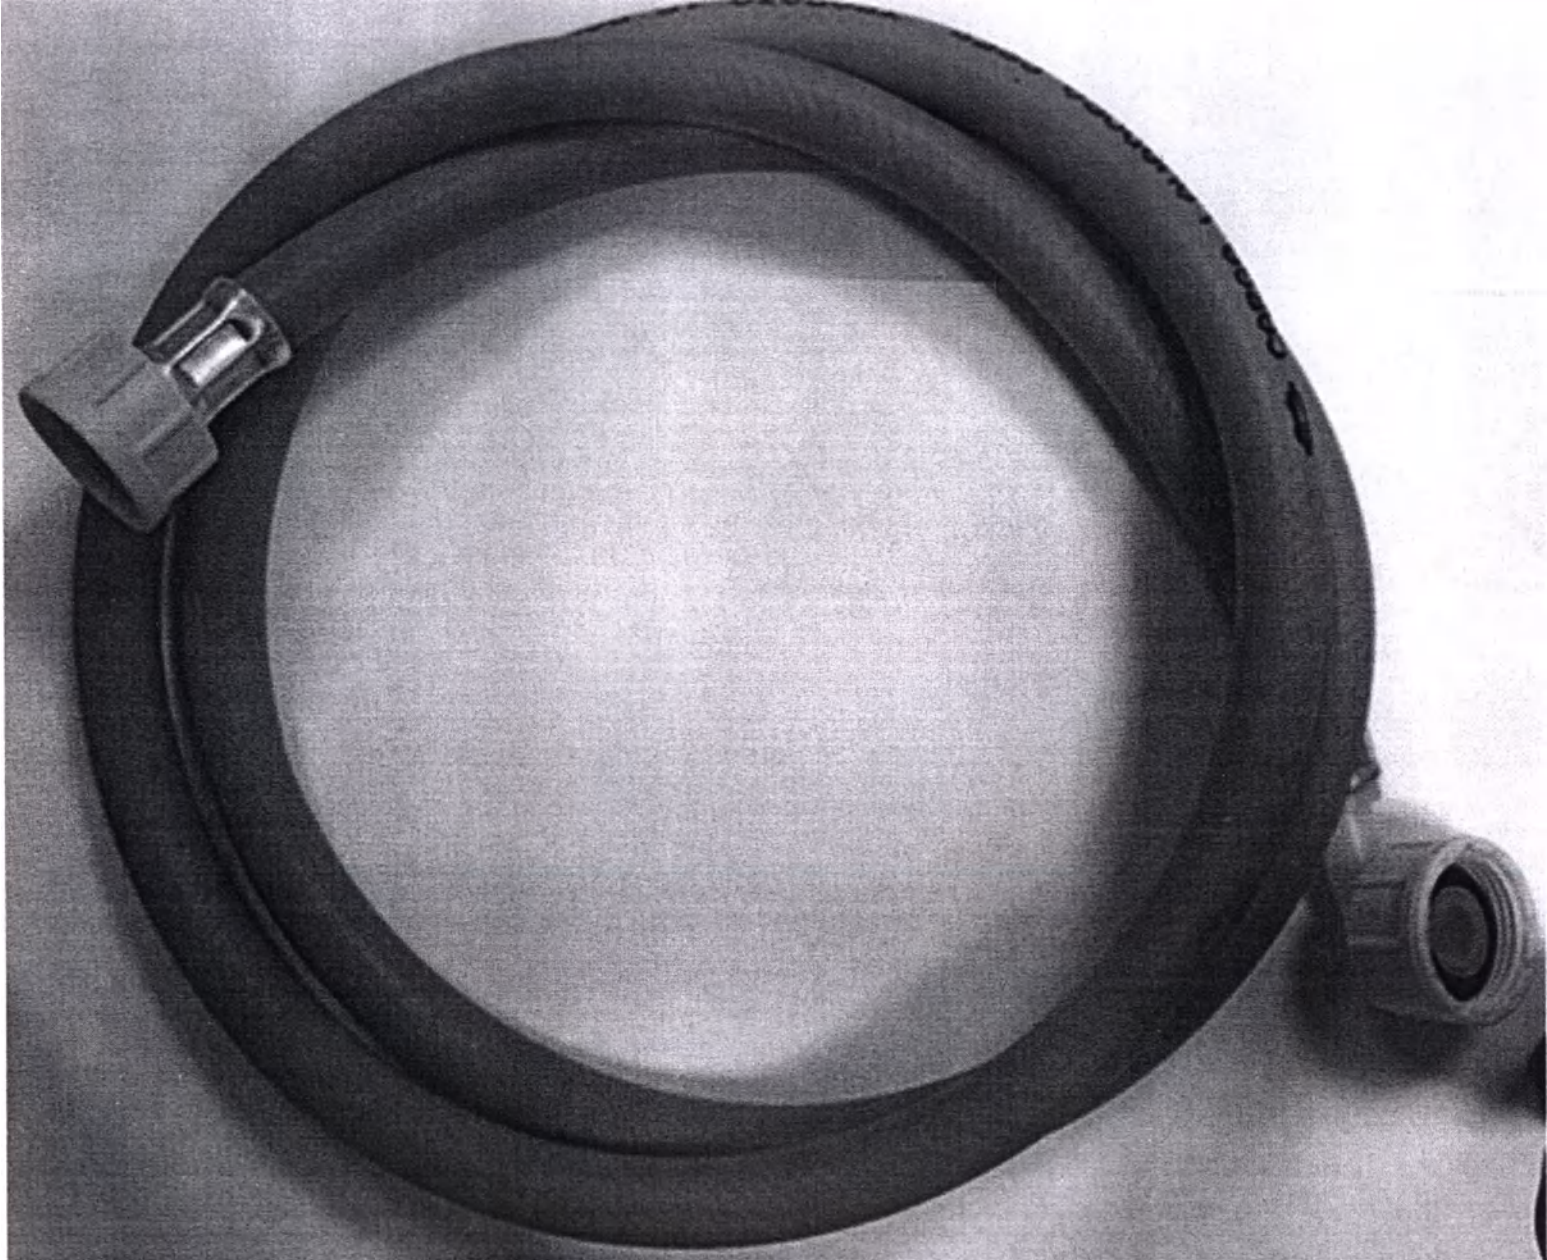


Шланг подачи воды с фитингами

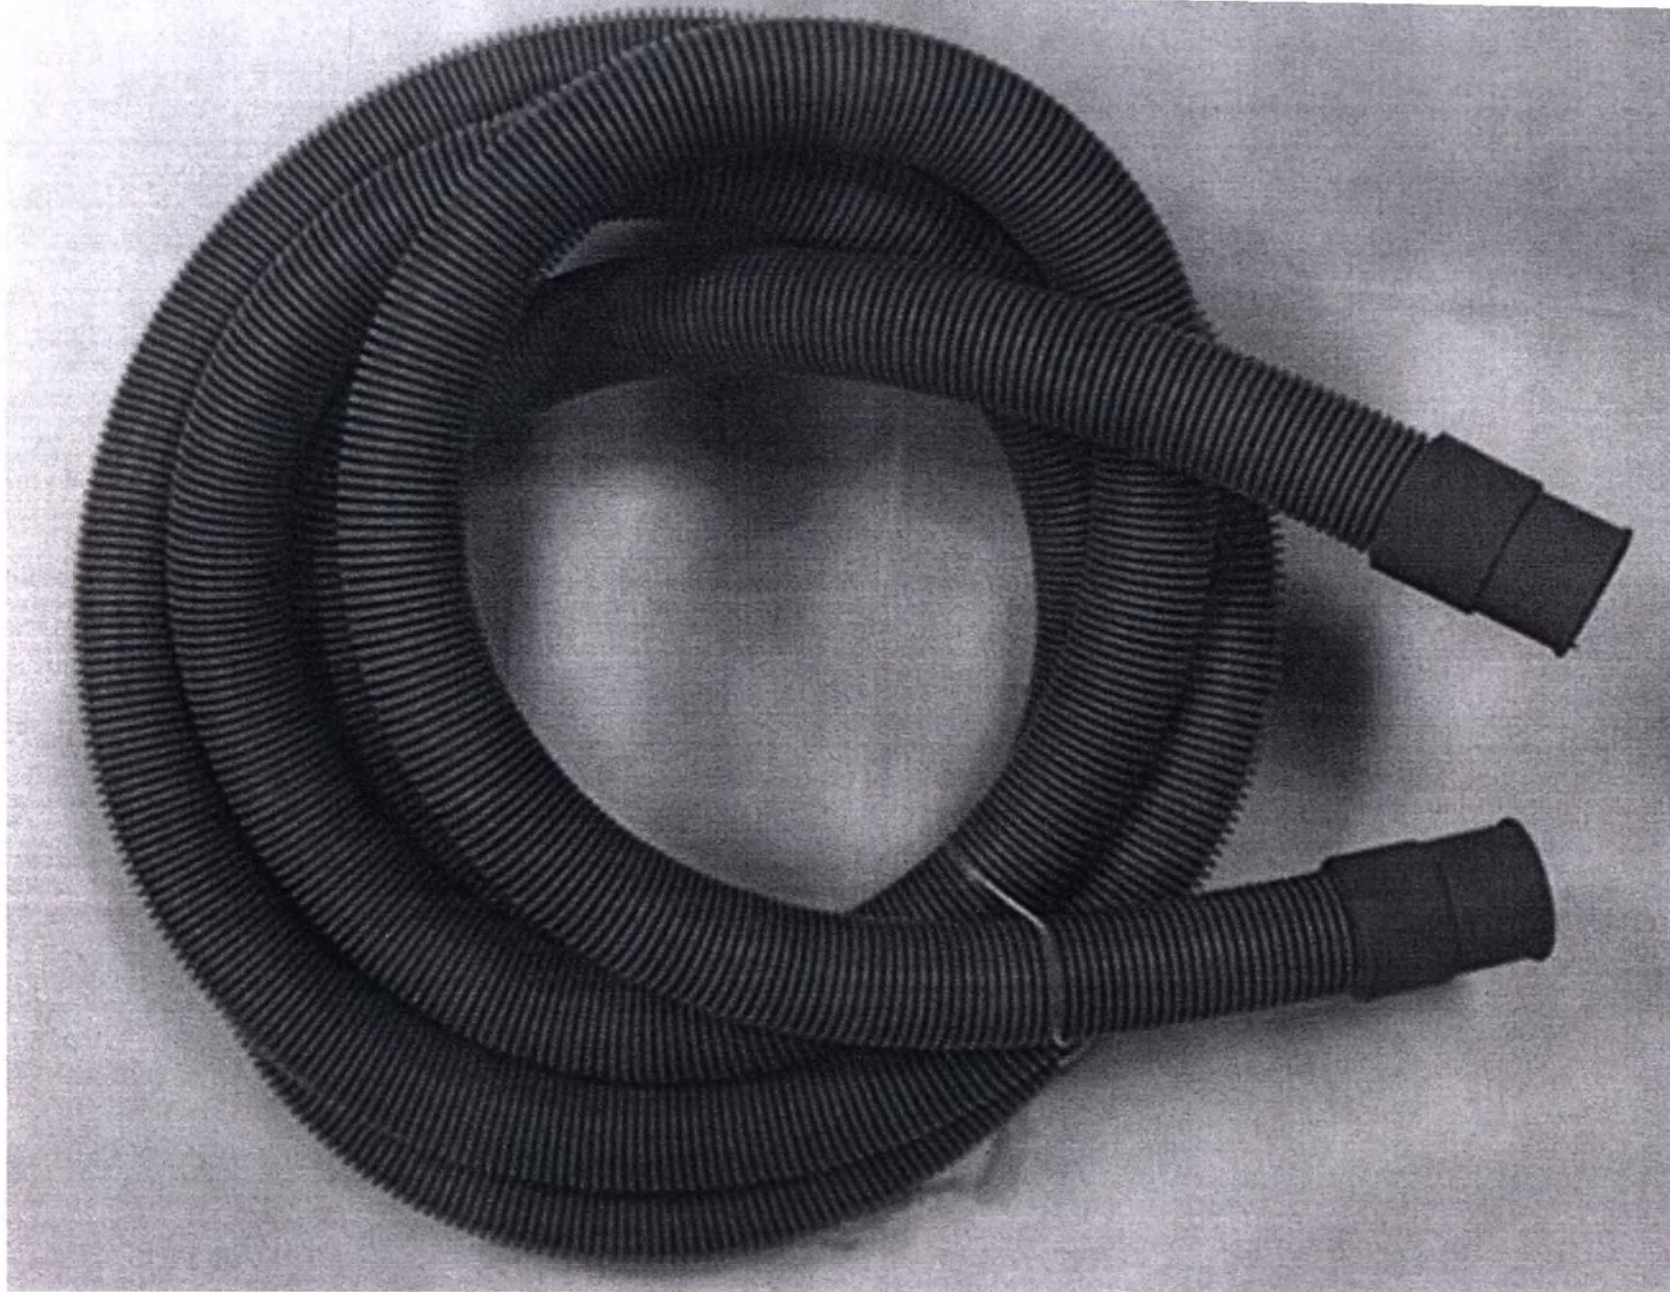


Гофрированный сливной шланг

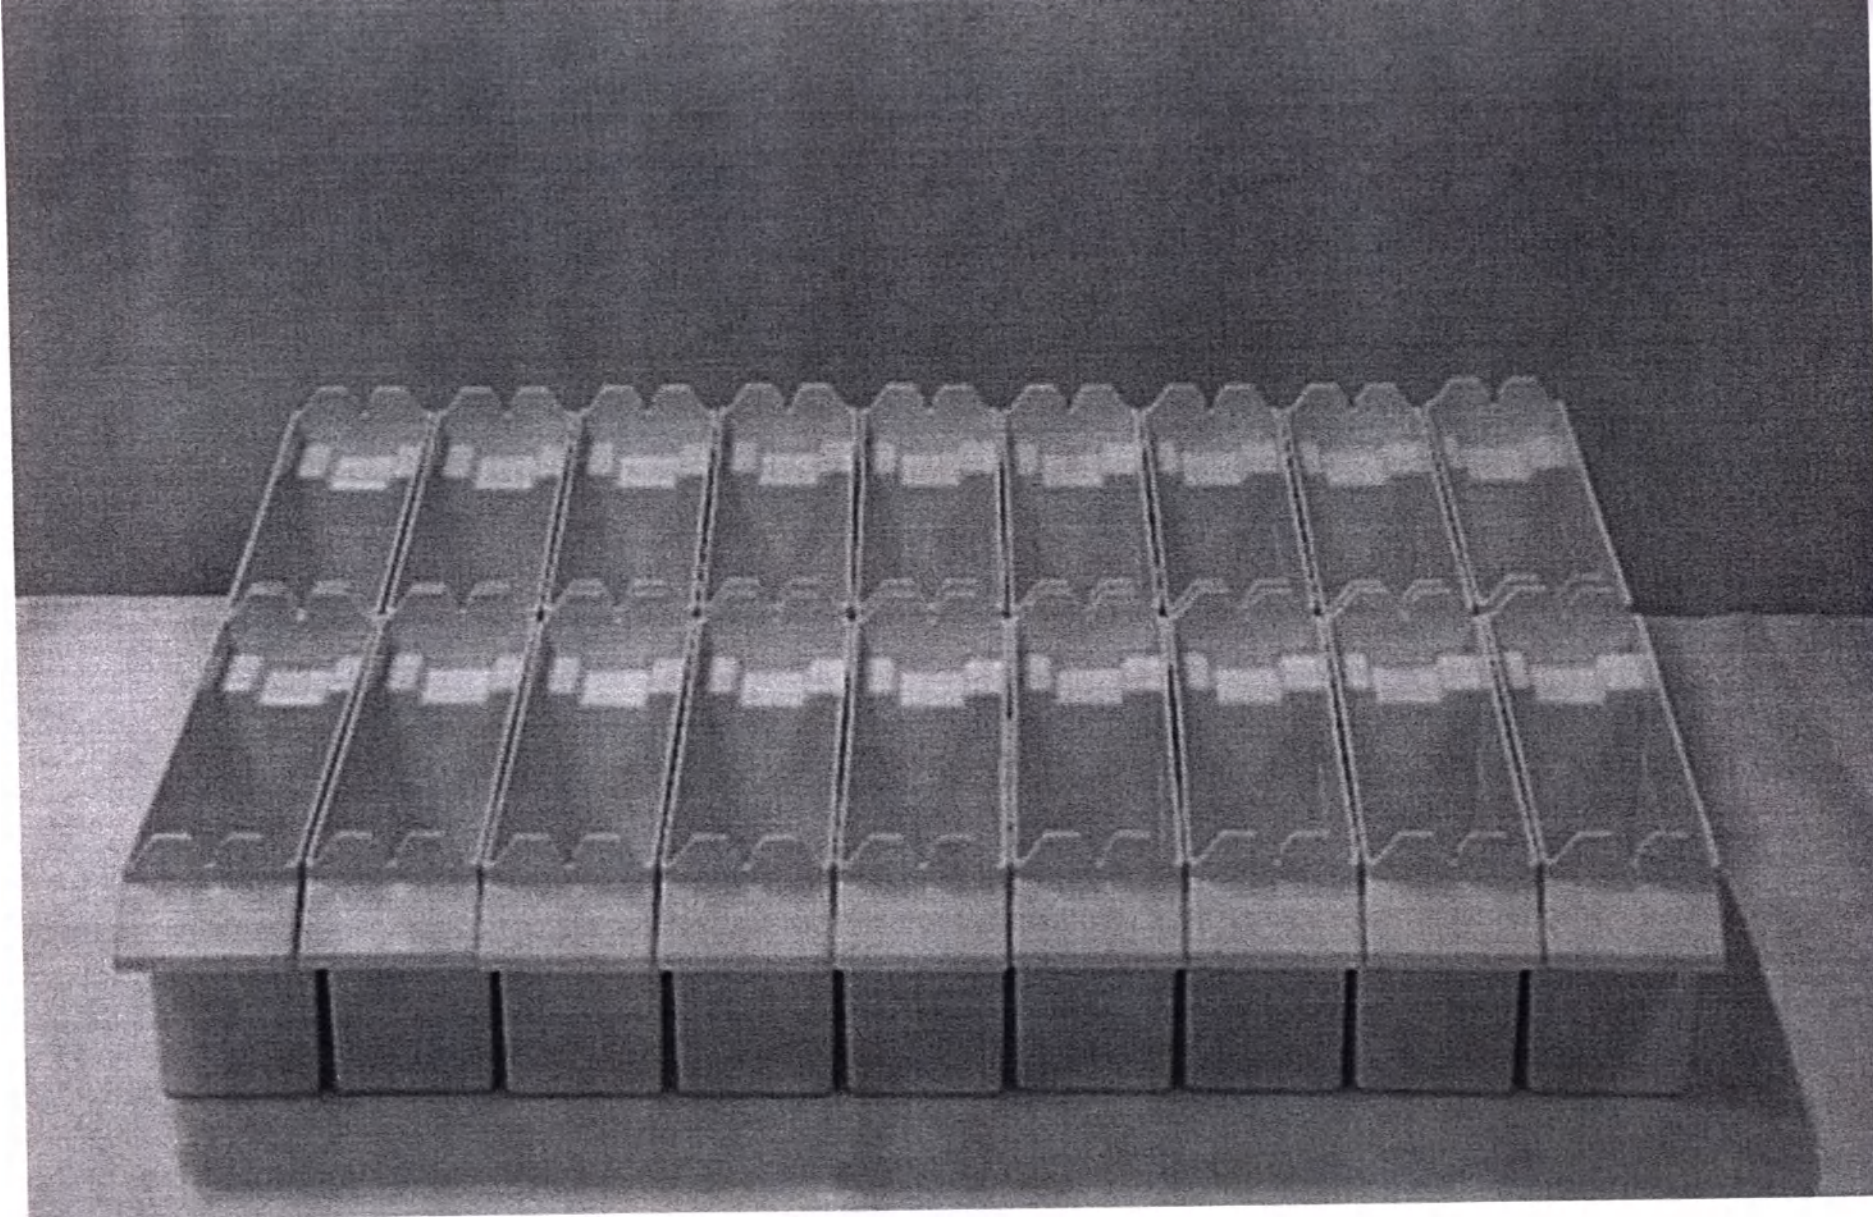


Ванночки для реагента

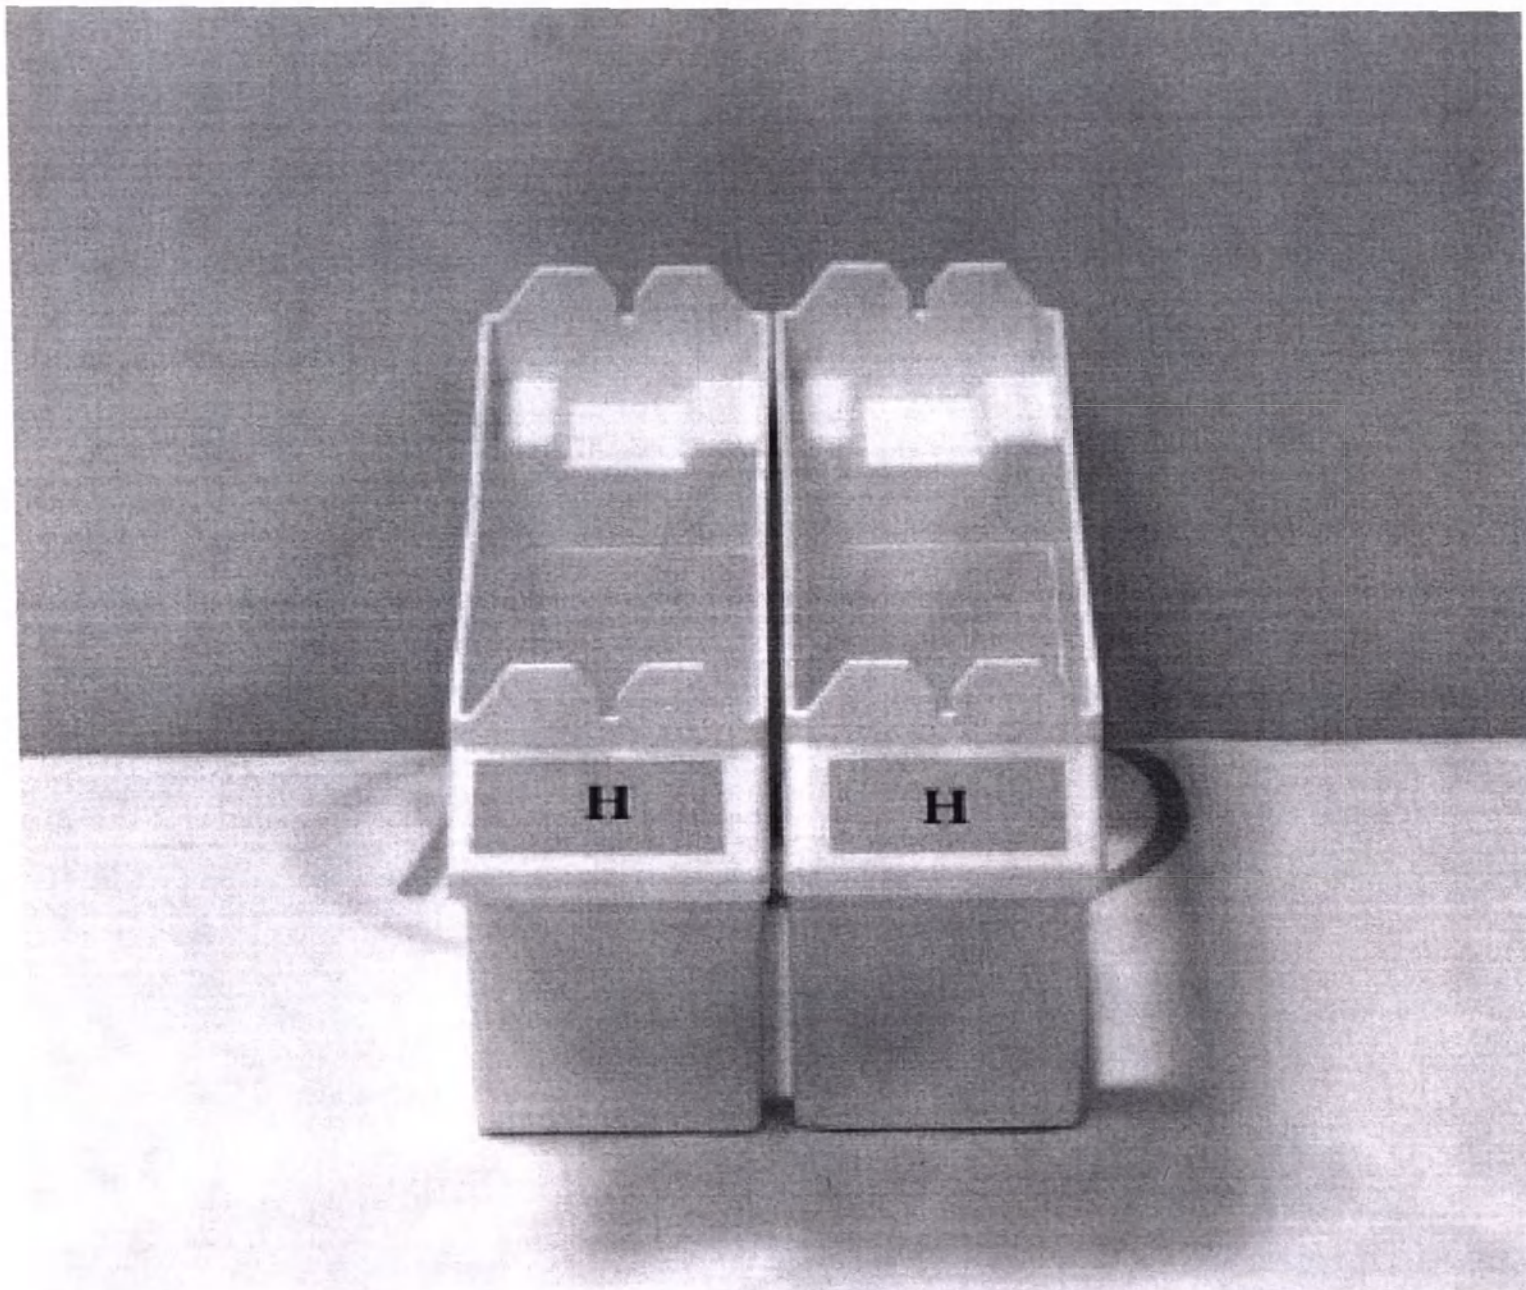


Ванночки для просушки

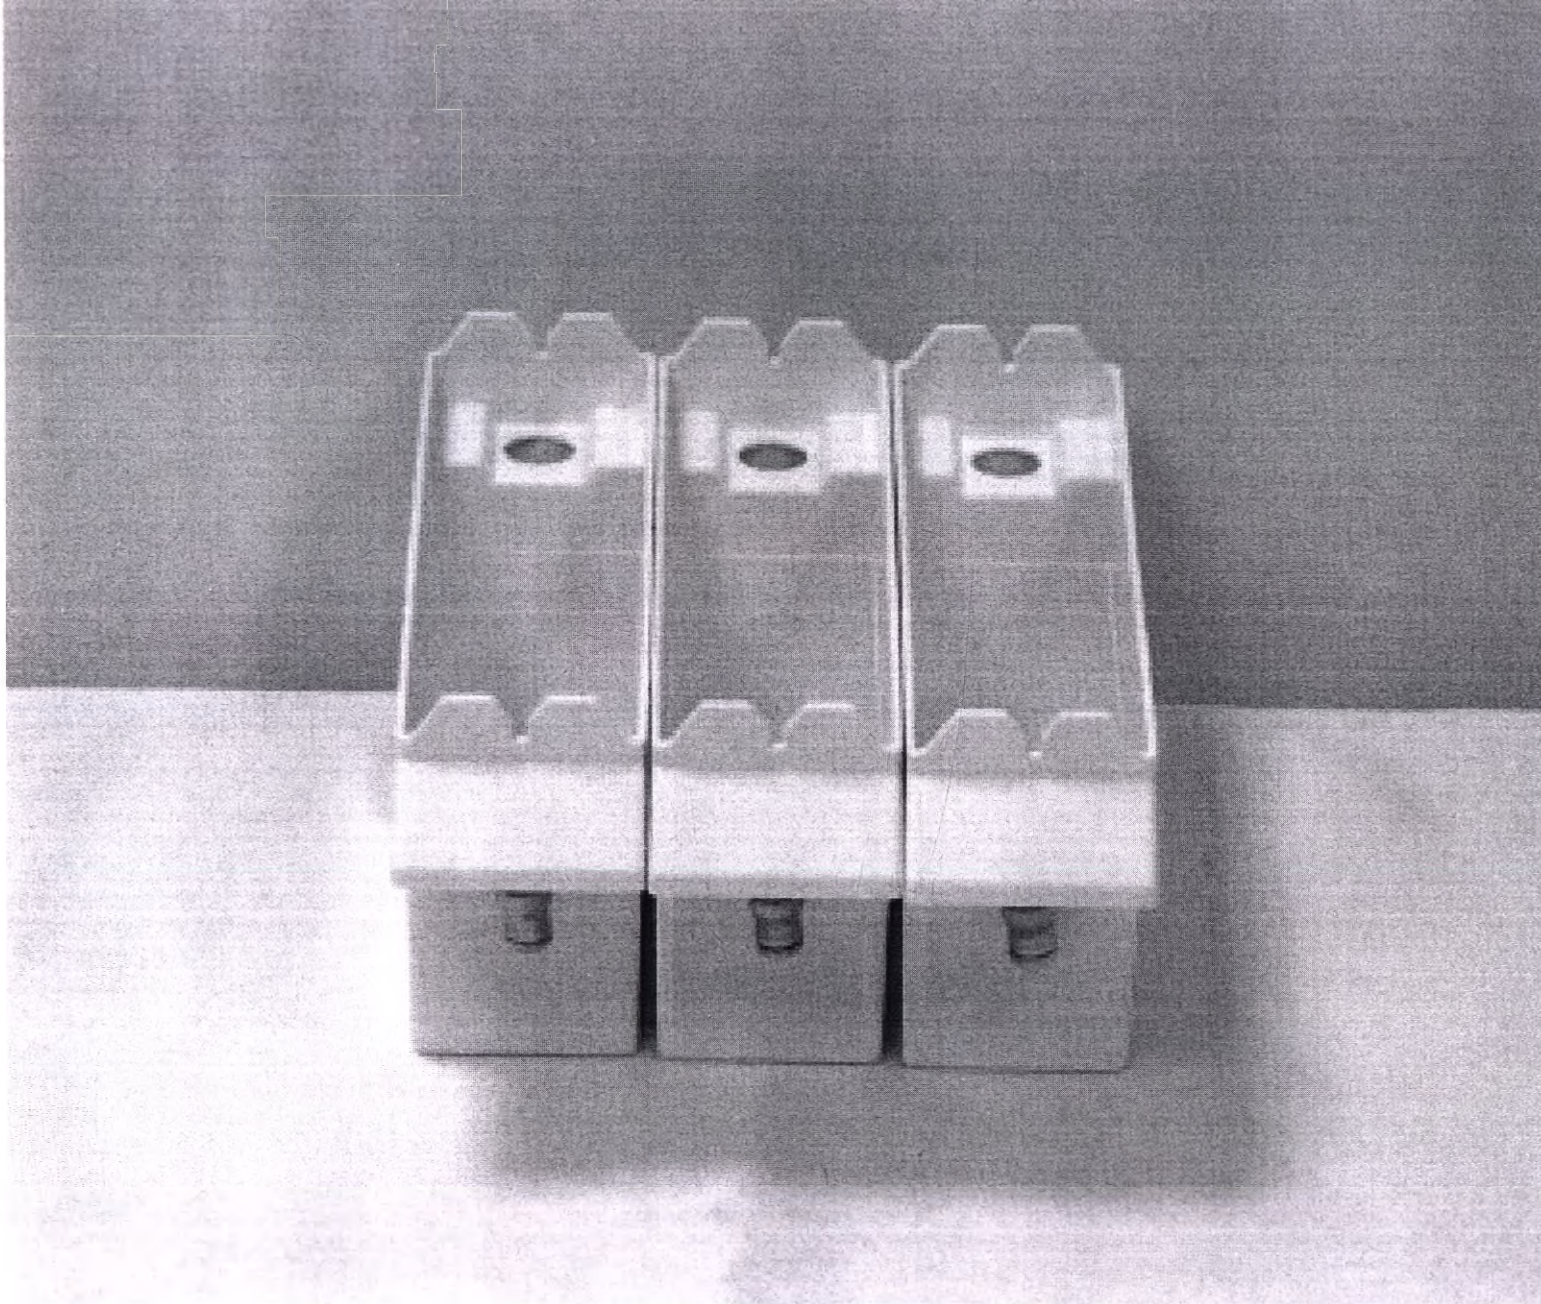


Ванночки для промывки

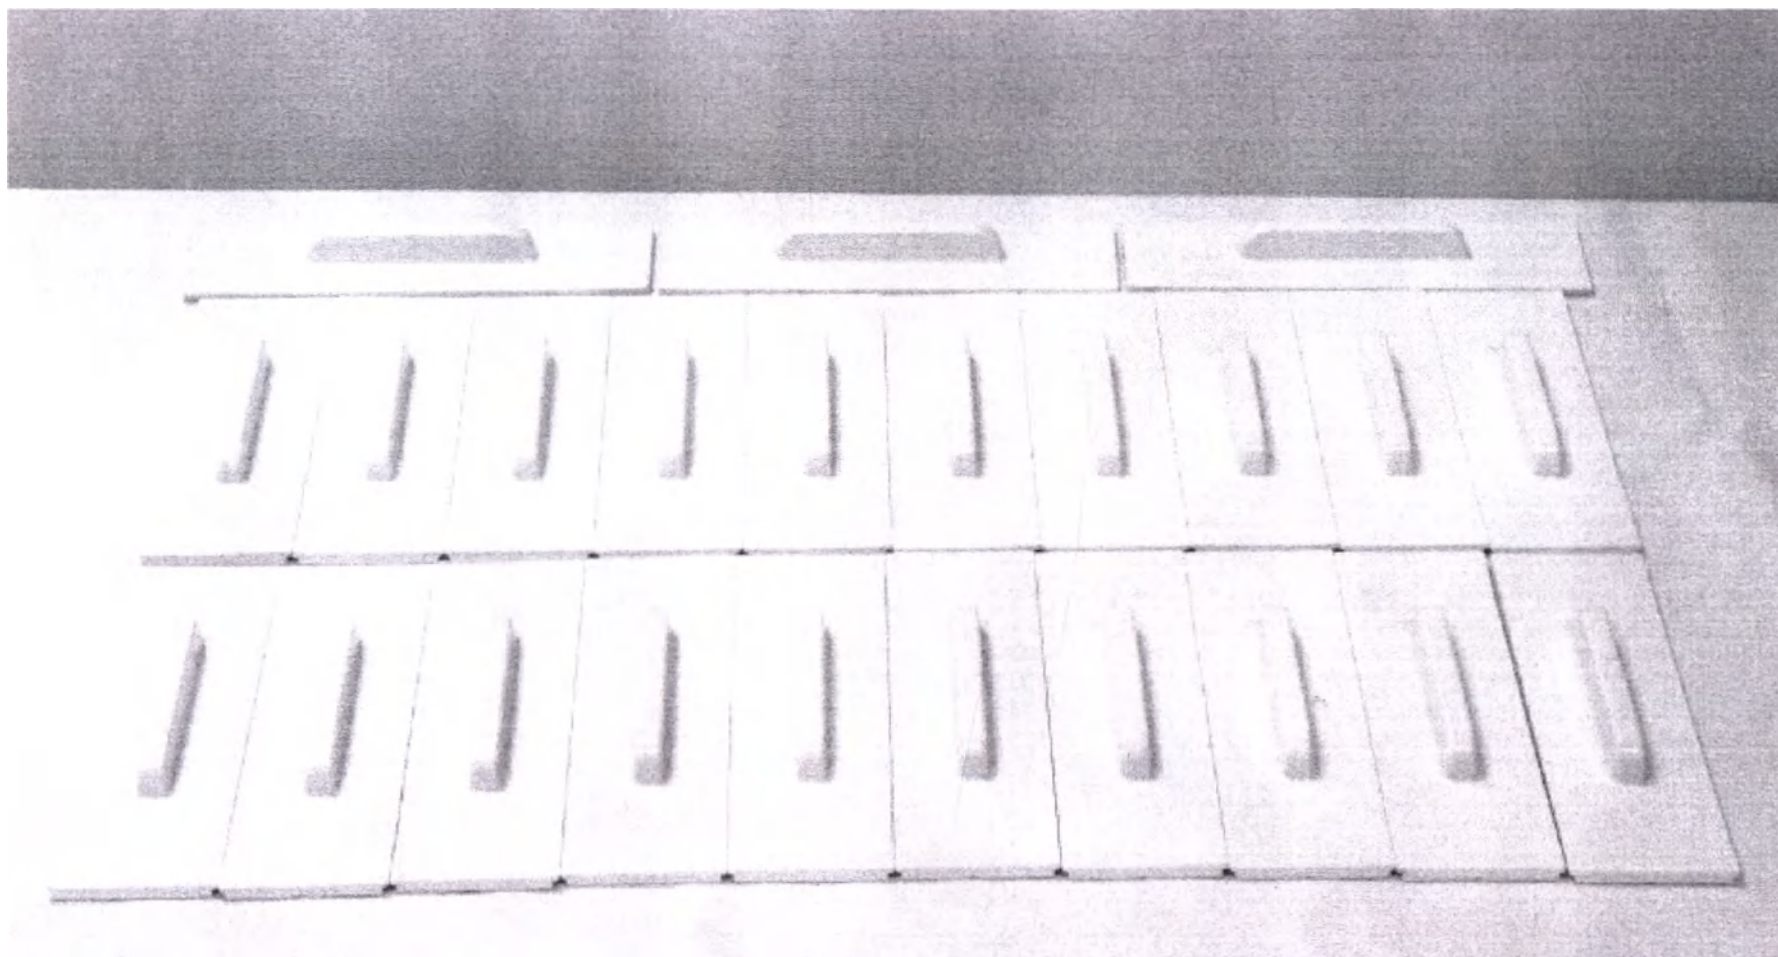


Крышки для ванночек

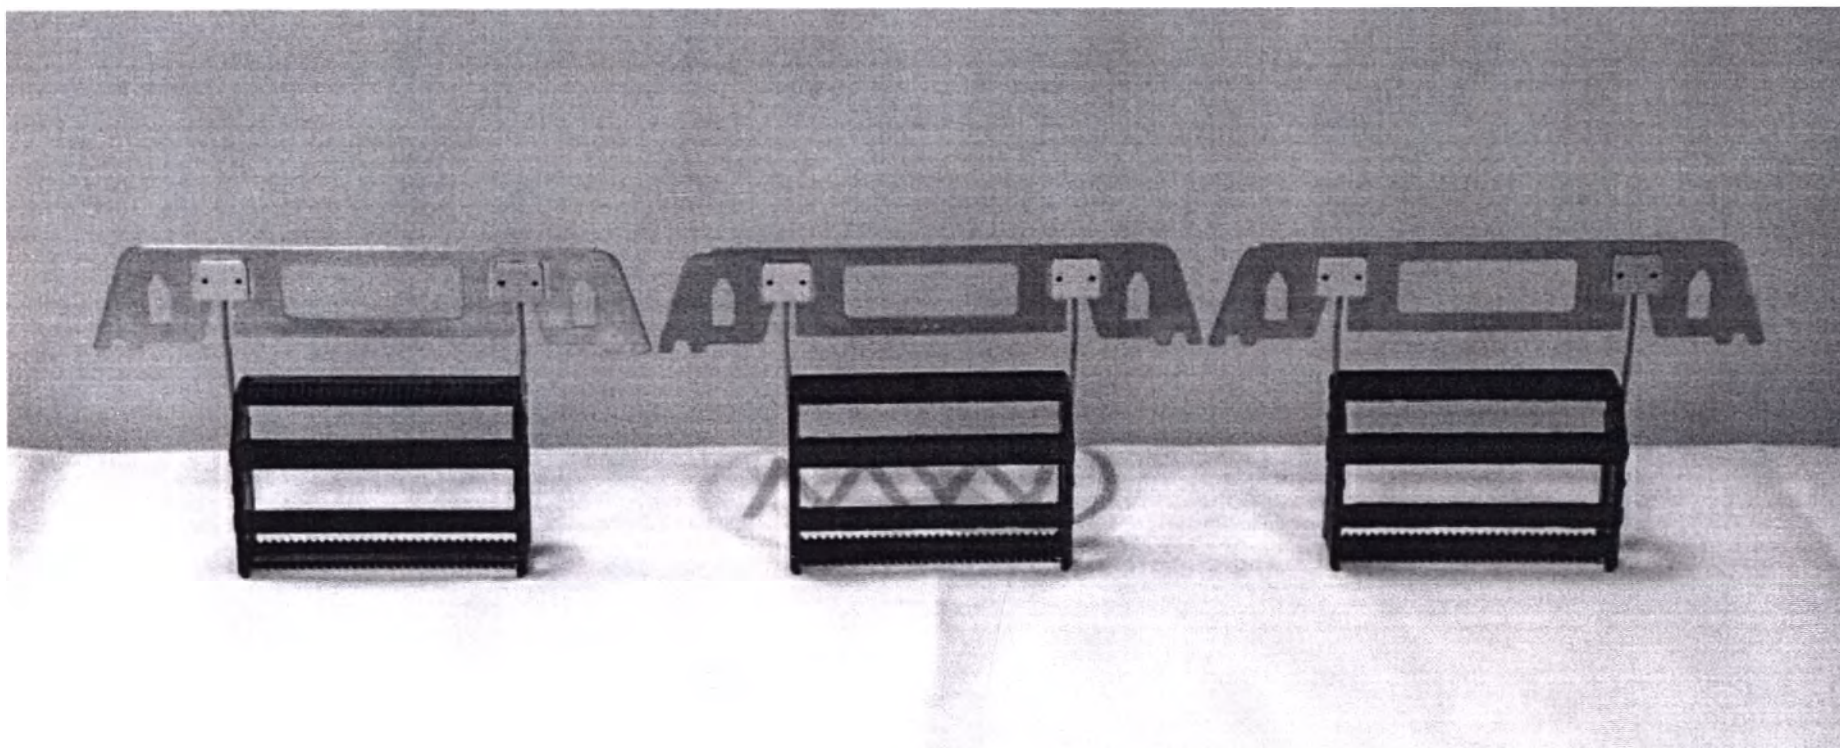


Штатив для предметных стекол

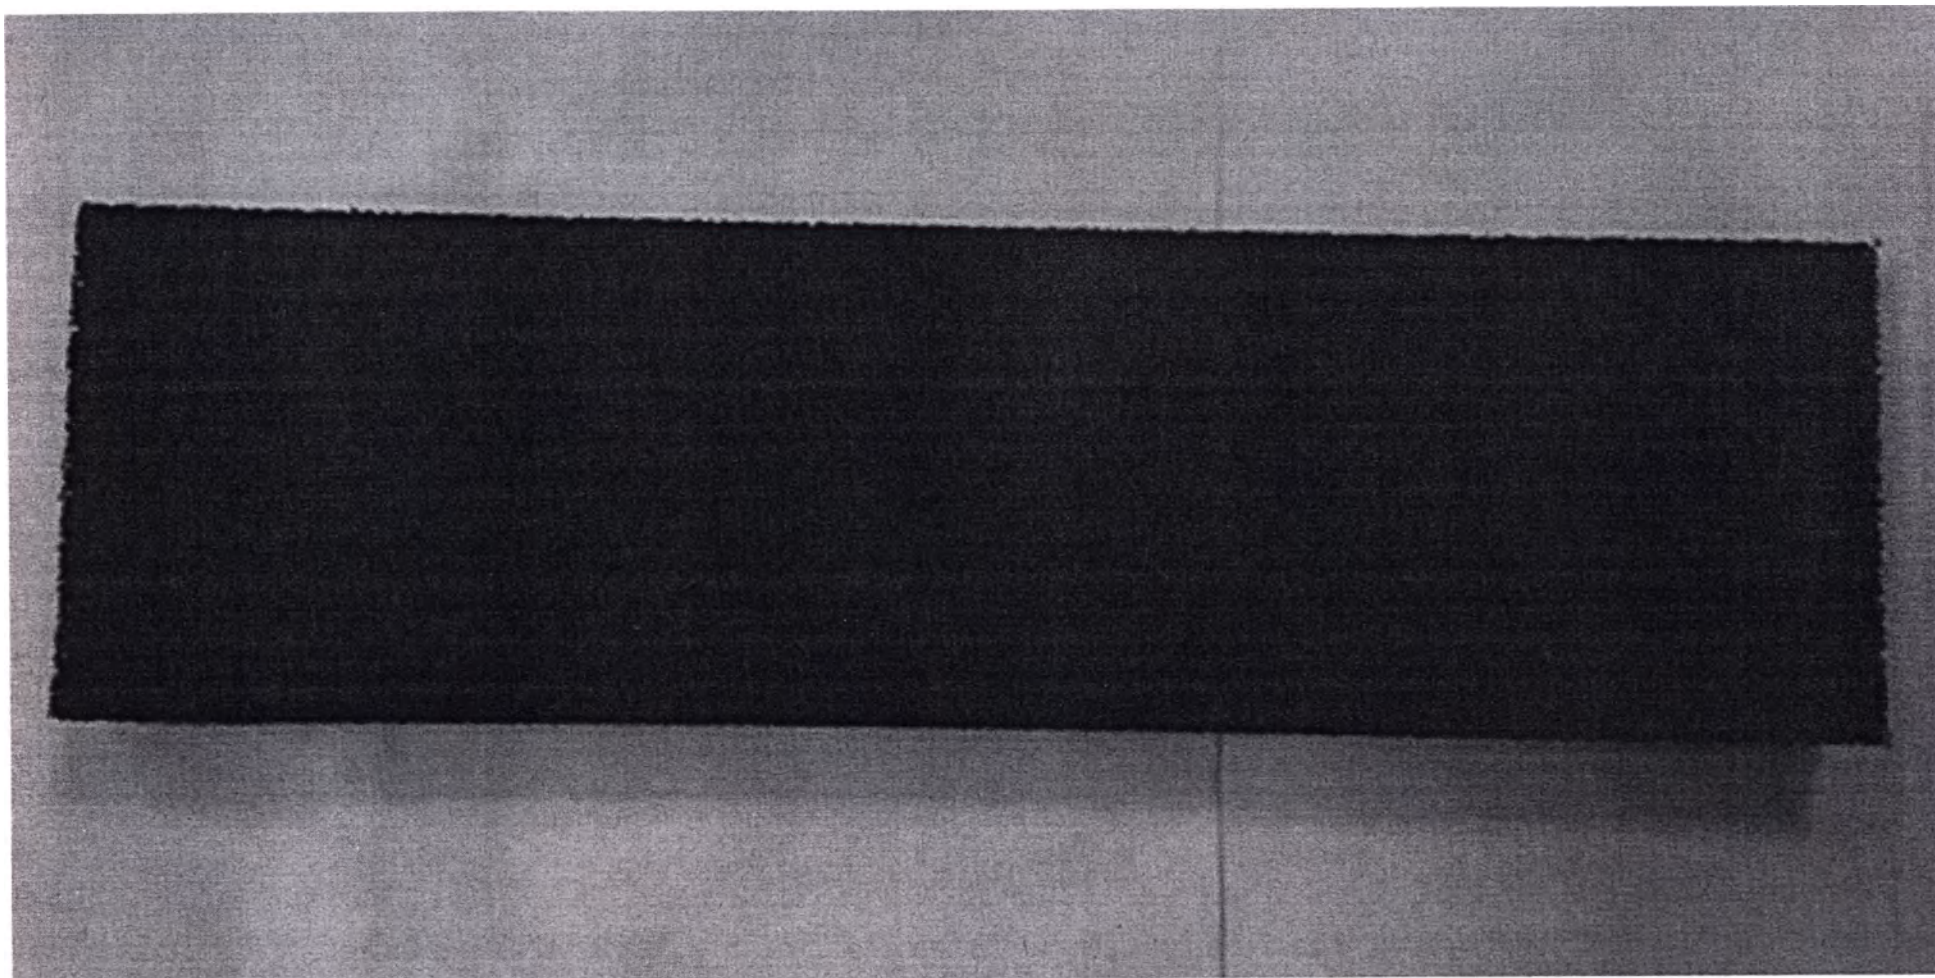


Угольный фильтр

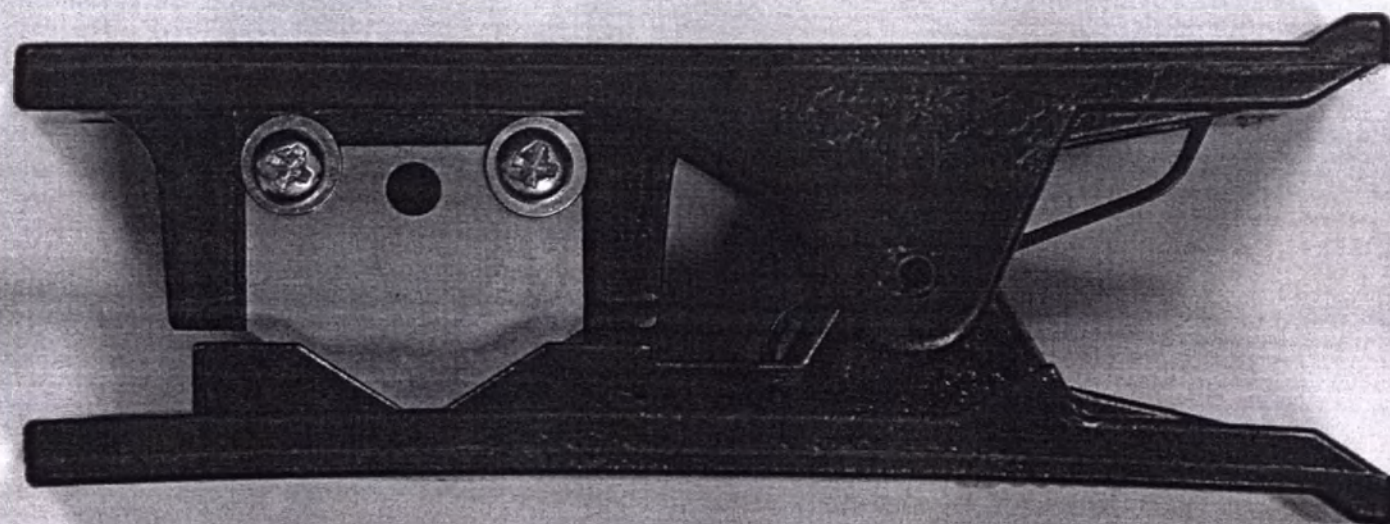

Устройство для резки трубок

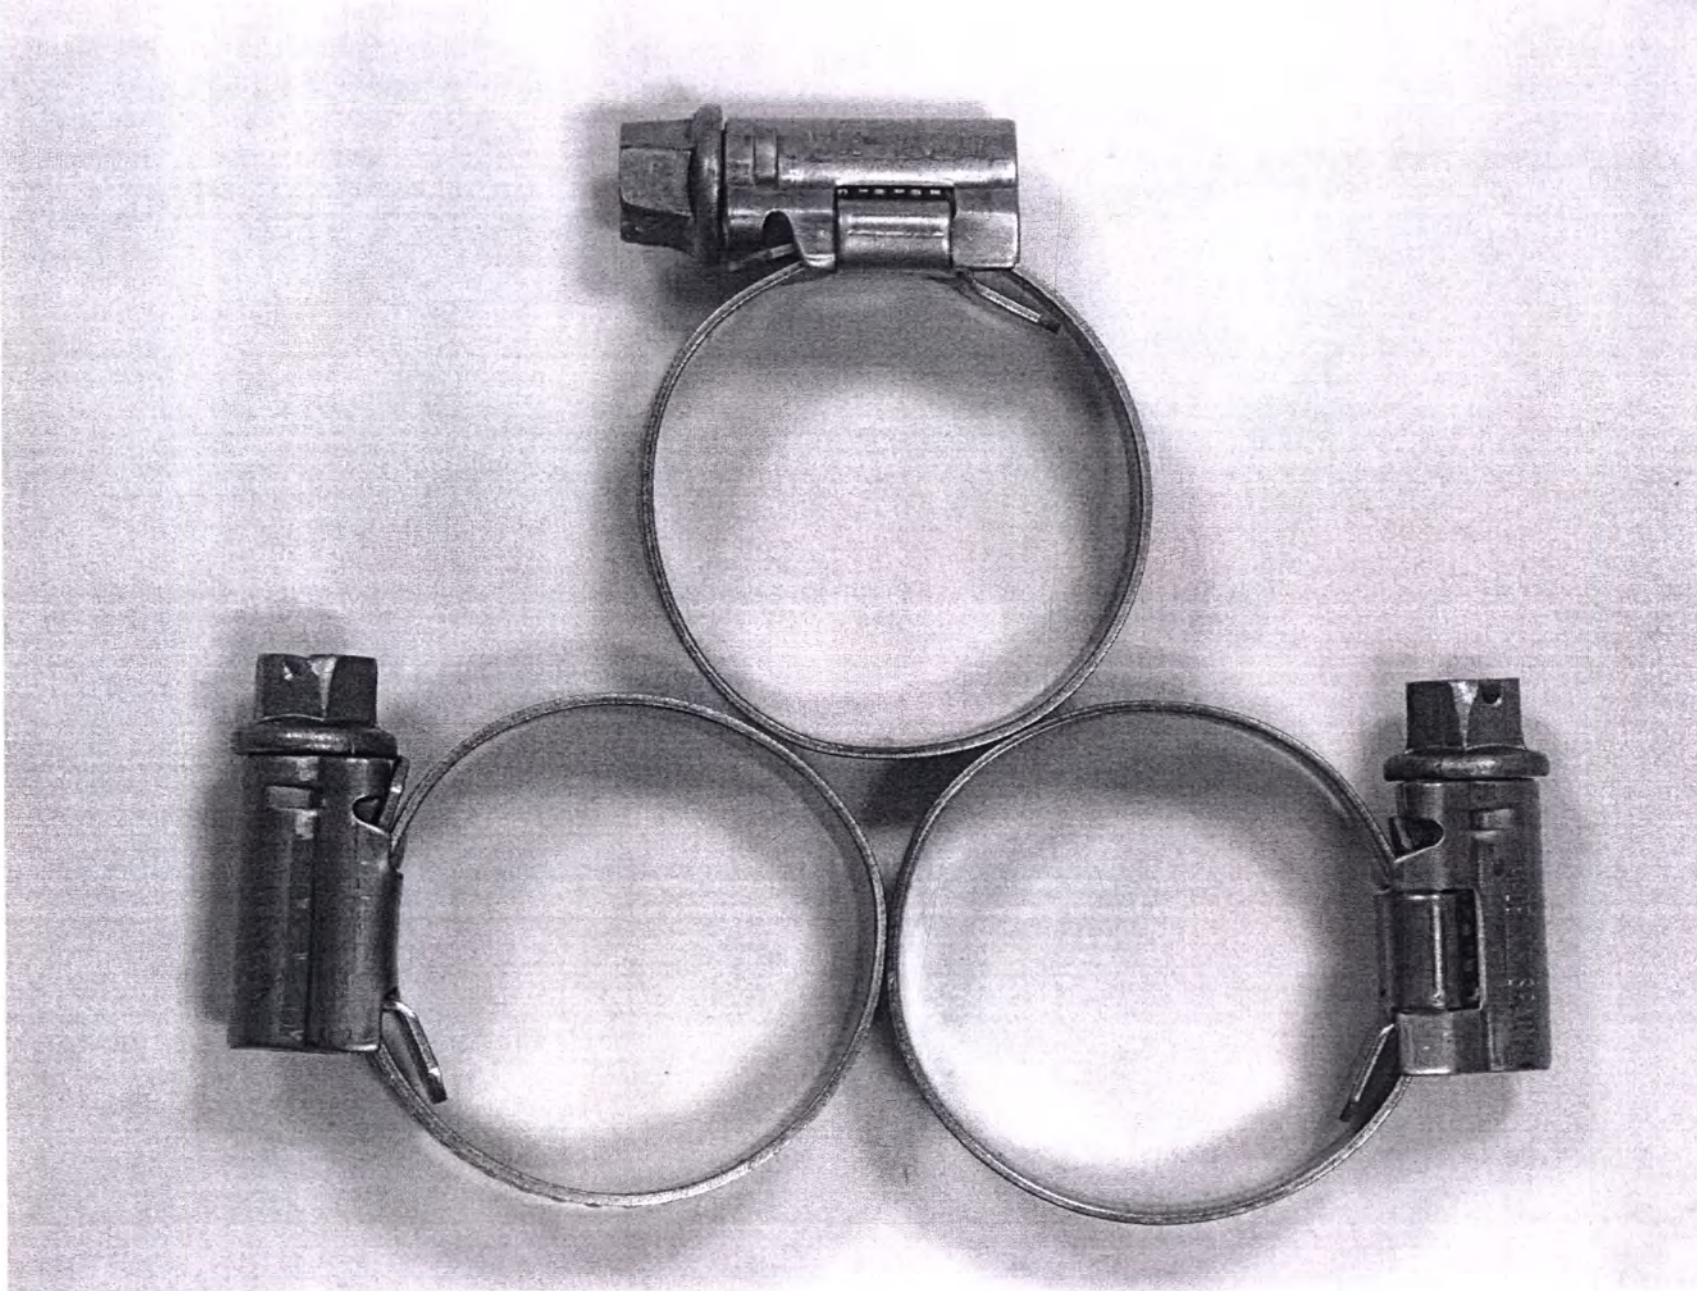

Зажим для сливного шланга

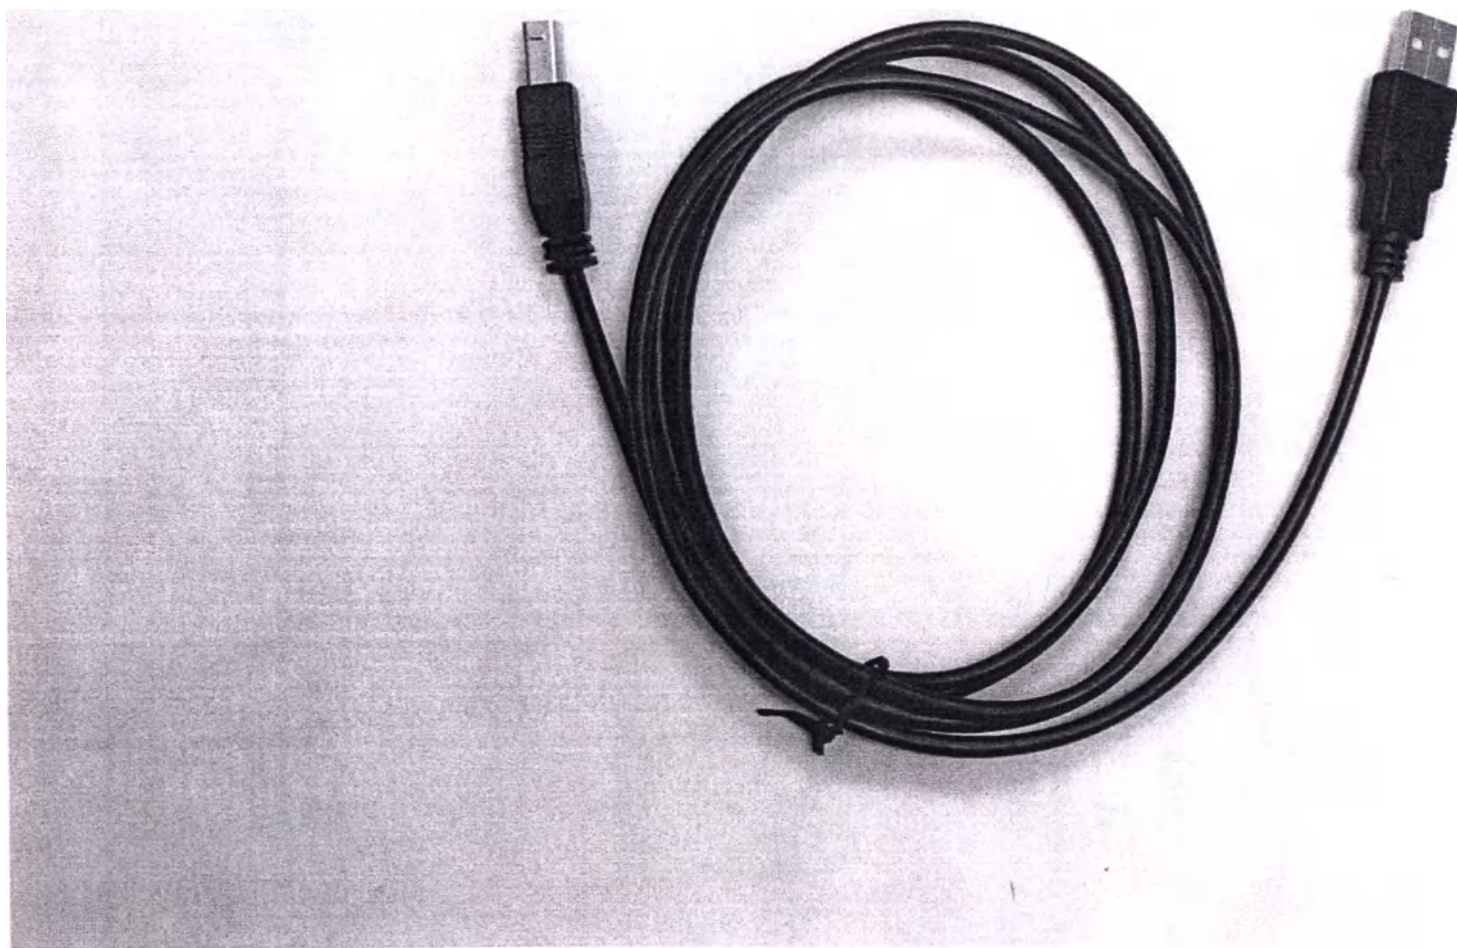

USB - кабель



«УТВЕРЖДАЮ»/ "APPROVE"

«West Medica Produktions- und Handels- GmbH»

Руководитель / Prokurist

Алексей Маслов / Aleksey Maslov

(подпись/signature)

Вена, «09» 06 2021 г. / Vienna, «09» 06 2021

М.П. / Stamp

West Medica

Produktions- und Handels-GmbH

Brown-Boven-Strasse 6, B17-1, 1030 Wien, Austria

Phone: +43 (0) 2236 082463


Fax: +43 (0) 2236 082464

www.westmedica.com

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ «УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ

СТЕКЛОПРЕПАРАТОВ V-CHROMER III (В-ХРОМЕР 3)»

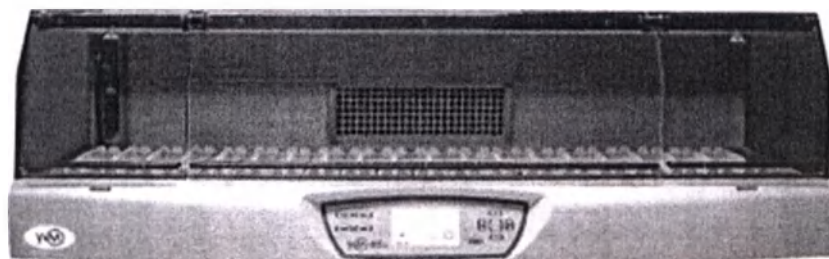

Руководство пользователя

Версия:


1 – Первое составление на русском языке

2 – Внесение изменений в соответствии с Уведомлением о предоставлении материалов и сведений № 10-19499/21 от 09.04.2021

V-Chromer III

Устройство для окрашивания
стеклопрепаратов V-Chromer III (В-Хромер 3)

QR

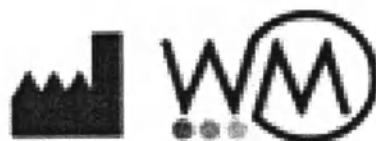

**West Medica Produktions- und
Handels-GmbH**
Brown-Boveri-Straße 6, B17-1,
2351 Wiener Neudorf, Austria

Официальный представитель в России:

ООО «Медика Продакт»


614000, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27

+7 (342) 270-08-02

perm@westmedica.com

МАССА НЕТТО _____ КГ

МАССА БРУТТО _____ КГ



серийный номер




РУ №

Макет маркировки упаковки V-Chromer III (В-Хромер 3)

V-Chromer III

Устройство для окрашивания
стеклопрепаратов V-Chromer III (В-Хромер 3)

QR

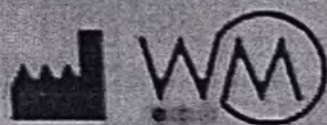

West Medica Produktions- und
Handels-GmbH
Brown-Boveri-Straße 6, B17-1,
2351 Wiener Neudorf, Austria

Официальный представитель в России:

ООО «Медика Продакт»


614000, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27

+7 (342) 270-08-02

perm@westmedica.com

МАССА НЕТТО 61,3 КГ

МАССА БРУТТО 92,0 КГ



серийный номер SS30H-0217-1806

серийный номер

01.2020



РУ №

Фотографическое изображение маркировки упаковки V-Chromer III (В-Хромер 3)

V-Chromer III

QR

Устройство для окрашивания
стеклопрепаратов V-Chromer III (В-Хромер 3)



West Medica Produktions- und
Handels-GmbH
Brown-Boveri-Straße 6, B17-1,
2351 Wiener Neudorf, Austria

Официальный представитель в России:

ООО «Медика Продакт»

614000, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27

+7 (342) 270-08-02

perm@westmedica.com

Вход:

~ 100-240В - 2,5А,

47-63 Гц,

Выход: 12В - 12,5А



серийный номер




ру №

Макет маркировки устройства V-Chromer III (В-Хромер 3)

V-Chromer III

Устройство для окрашивания
стеклопрепаратов V-Chromer III (В-Хромер 3)

QR

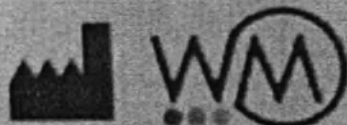

West Medica Produktions- und
Handels-GmbH
Brown-Boveri-Straße 6, B17-1,
2351 Wiener Neudorf, Austria

Официальный представитель в России:

ООО «Медика Продакт»

614000, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27

+7 (342) 270-08-02

perm@westmedica.com

Вход:

~100-240В - 2,5А,

47-63 Гц,


Выход: 12В - 12,5А



SS30H-0217-1806

серийный номер

01.2020



РУ №

Фотографическое изображение маркировки устройства V-Chromer III (В-Хромер 3)

В данном документе прошнуровано,
пронумеровано и скреплено печатью

21 лист(-ах/-е) бумаги

Михалева Е. М., Директор

