


### **Фотографические изображения**

**«Набор контрольных материалов для контроля качества количественного определения эверолимуса иммунохемилюминесцентным методом в цельной крови человека для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (PreciControl Everolimus Elecsys and cobas e analyzers)»**

иммунохемилюминесцентным методом в цельной крови человека для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e  
(PeciControl Everolimus Elecsys and cobas e analyzers)

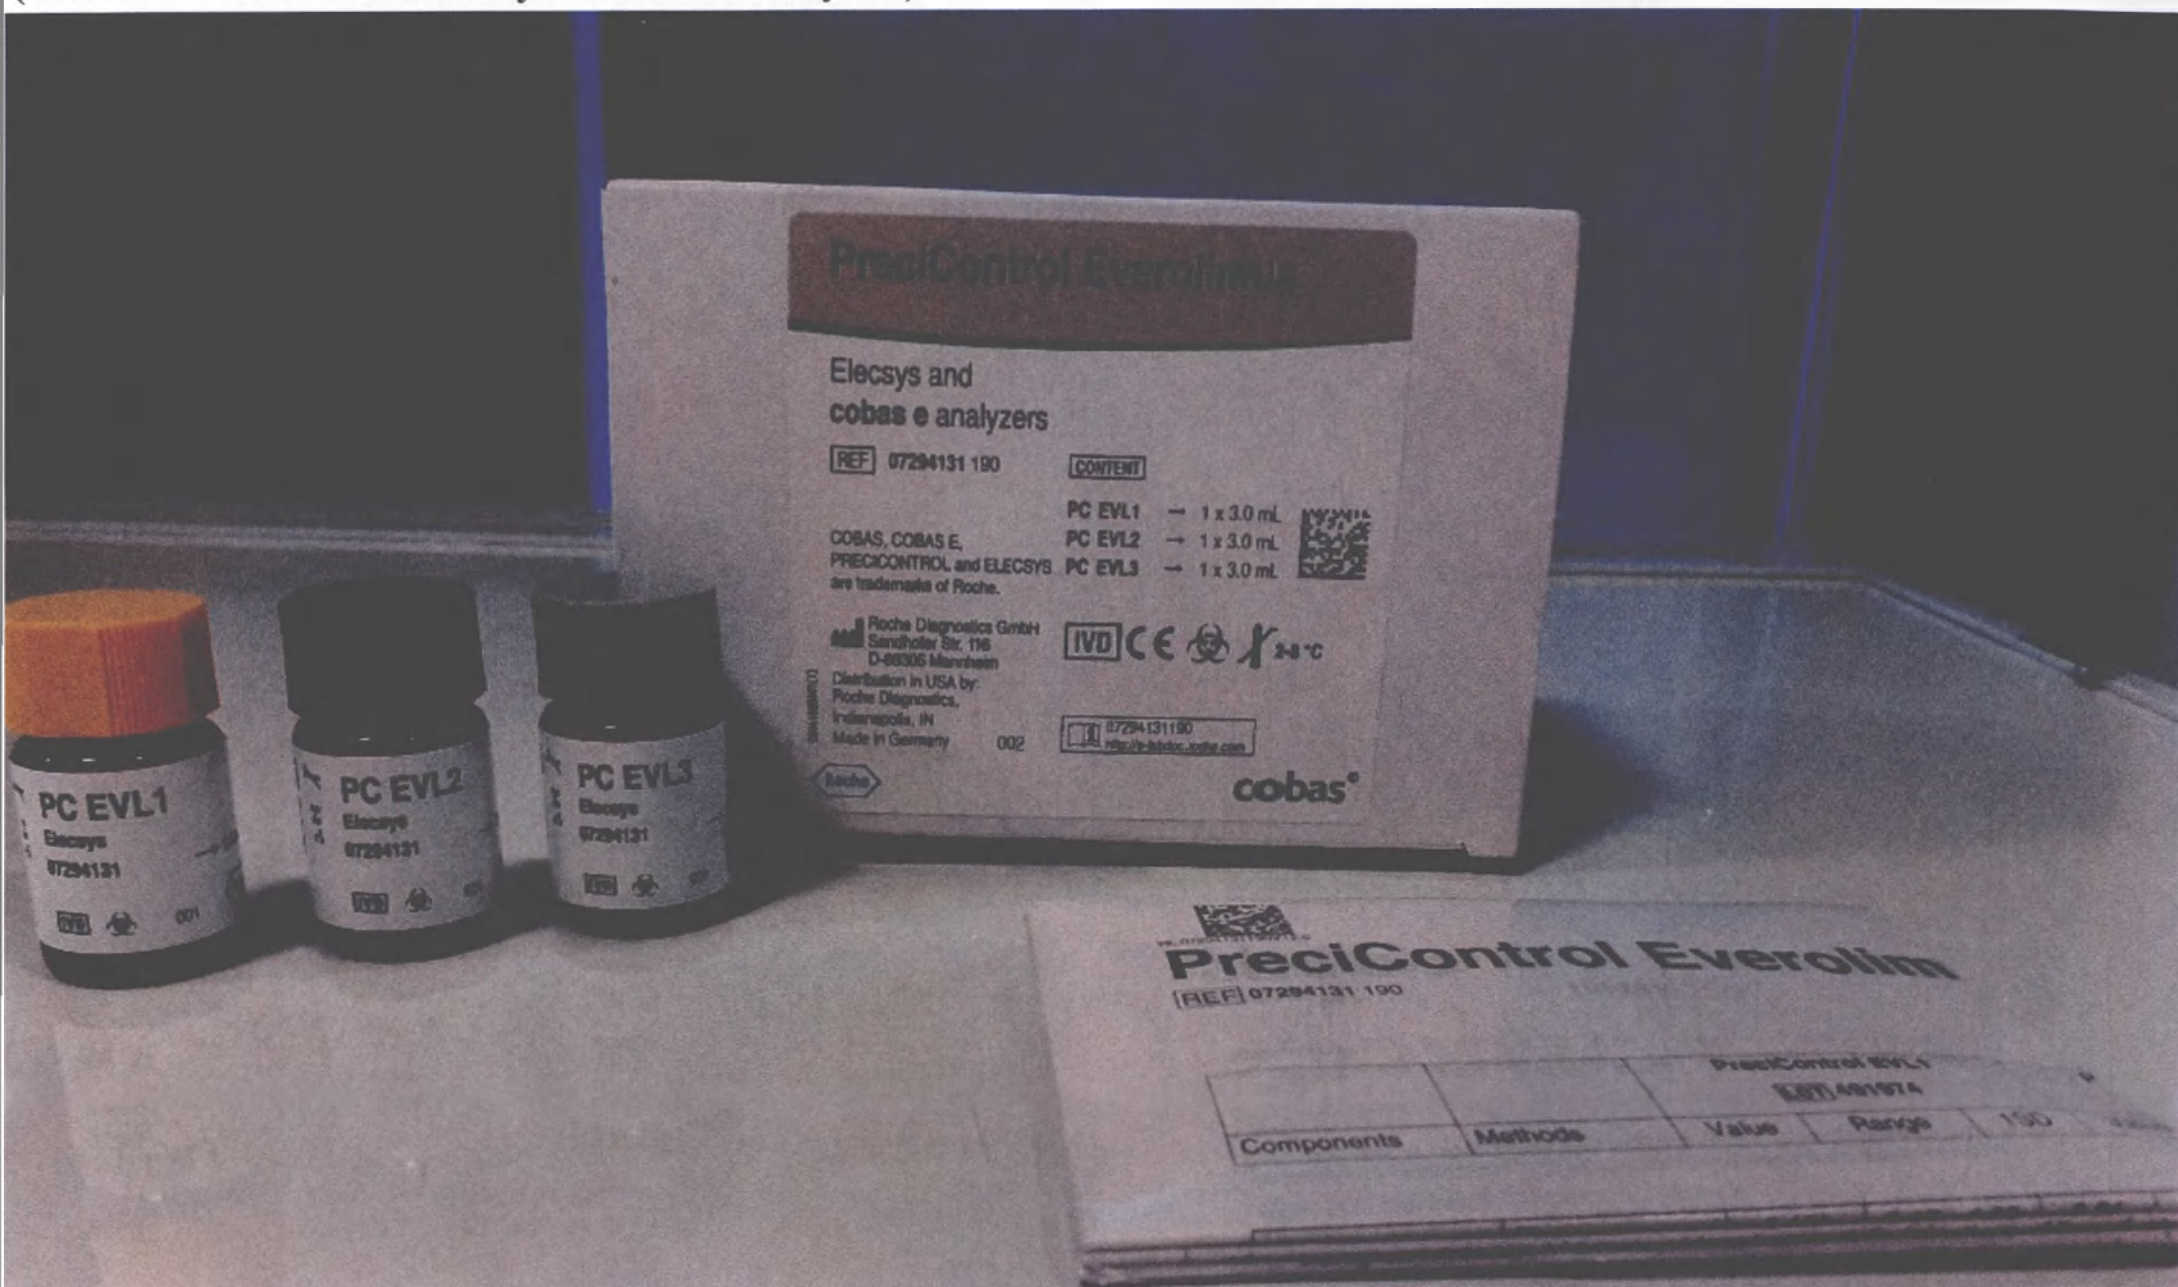

Набор контрольных материалов для контроля качества лабораторного определения эверолимуса иммунохемилюминесцентным методом в цельной крови человека для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (PreciControl Everolimus Elecsys and cobas e analyzers), в состав:

1. Контрольная сыворотка 1 (PC EVL1), флакон объем 3,0 мл. (1 шт.)
2. Контрольная сыворотка 2 (PC EVL2), флакон объем 3,0 мл. (1 шт.)
3. Контрольная сыворотка 3 (PC EVL3) флакон объем 3,0 мл. (1 шт.)
4. Этикетки для флаконов (30 шт)
5. Инструкция по применению
6. Паспорт присвоенных значений

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10848 от \_\_\_\_\_

Срок годности см. на упаковке

Дата изготовления см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностика ГмбХ"),  
Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in-vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус»  
(ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2.

Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64.

E-mail: moscow.reception\_dia@roche.com

Кат. номер 07294131190



иммунохемилюминесцентным методом в цельной крови человека для анализаторов и модулей immuнохимического анализа  
(PreciControl Everolimus Elecsys and cobas e analyzers)



# PreciControl Everolimus

REF 07204131 130




LOT 493421

| Components | Methods            | PreciControl EVL1 |             |      | PreciControl EVL2 |             |      | PreciControl EVL3 |             |      |
|------------|--------------------|-------------------|-------------|------|-------------------|-------------|------|-------------------|-------------|------|
|            |                    | Value             | Range       | ISO  | Value             | Range       | ISO  | Value             | Range       | ISO  |
| EVL        | Elecsys Everolimus | 3.10*             | 2.17 - 4.03 | 0.31 | 9.75*             | 6.83 - 12.7 | 0.86 | 16.9*             | 11.8 - 24.2 | 1.00 |
|            | 06633188           | 3.24*             | 2.27 - 4.21 | 0.32 | 10.2*             | 7.14 - 13.3 | 1.02 | 17.2*             | 12.0 - 24.2 | 1.00 |
| EVL        | Elecsys Everolimus | 3.28*             | 2.30 - 4.26 | 0.33 | 9.75*             | 6.83 - 12.7 | 0.86 | 16.9*             | 11.8 - 24.2 | 1.00 |
|            | 06633188           | 3.42*             | 2.39 - 4.45 | 0.34 | 10.2*             | 7.14 - 13.3 | 1.02 | 17.2*             | 12.0 - 24.2 | 1.00 |
| EVL        | Elecsys Everolimus | 3.29*             | 2.30 - 4.26 | 0.33 | 9.75*             | 6.83 - 12.7 | 0.86 | 16.9*             | 11.8 - 24.2 | 1.00 |
|            | 06633188           | 3.43*             | 2.40 - 4.46 | 0.34 | 10.2*             | 7.14 - 13.3 | 1.02 | 17.2*             | 12.0 - 24.2 | 1.00 |

|     |                    |       |             |      |       |             |      |       |             |      |
|-----|--------------------|-------|-------------|------|-------|-------------|------|-------|-------------|------|
| EVL | Elecsys Everolimus | 3.21* | 2.25 - 4.17 | 0.32 | 9.75* | 6.83 - 12.7 | 0.86 | 16.9* | 11.8 - 24.2 | 1.00 |
|     | 06633188           | 3.35* | 2.30 - 4.30 | 0.34 | 10.2* | 7.14 - 13.3 | 1.02 | 17.2* | 12.0 - 24.2 | 1.00 |
| EVL | Elecsys Everolimus | 3.21* | 2.25 - 4.17 | 0.32 | 9.75* | 6.83 - 12.7 | 0.86 | 16.9* | 11.8 - 24.2 | 1.00 |
|     | 06633188           | 3.35* | 2.30 - 4.30 | 0.34 | 10.2* | 7.14 - 13.3 | 1.02 | 17.2* | 12.0 - 24.2 | 1.00 |
| EVL | Elecsys Everolimus | 3.26* | 2.25 - 4.17 | 0.32 | 9.75* | 6.83 - 12.7 | 0.86 | 16.9* | 11.8 - 24.2 | 1.00 |
|     | 06633188           | 3.51* | 2.35 - 4.30 | 0.34 | 10.2* | 7.14 - 13.3 | 1.02 | 17.2* | 12.0 - 24.2 | 1.00 |

|     |                    |       |             |      |       |             |      |       |             |      |
|-----|--------------------|-------|-------------|------|-------|-------------|------|-------|-------------|------|
| EVL | Elecsys Everolimus | 3.21* | 2.25 - 4.17 | 0.32 | 9.75* | 6.83 - 12.7 | 0.86 | 16.9* | 11.8 - 24.2 | 1.00 |
|     | 06633188           | 3.35* | 2.30 - 4.30 | 0.34 | 10.2* | 7.14 - 13.3 | 1.02 | 17.2* | 12.0 - 24.2 | 1.00 |
| EVL | Elecsys Everolimus | 3.21* | 2.25 - 4.17 | 0.32 | 9.75* | 6.83 - 12.7 | 0.86 | 16.9* | 11.8 - 24.2 | 1.00 |
|     | 06633188           | 3.30* | 2.35 - 4.30 | 0.34 | 10.2* | 7.14 - 13.3 | 1.02 | 17.2* | 12.0 - 24.2 | 1.00 |

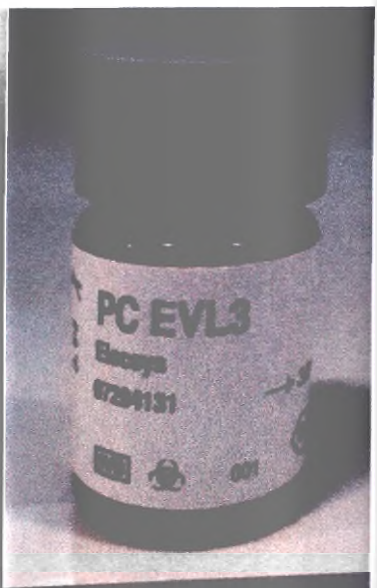

## PreciControl Everolimus

For USA:

**CONTENT**

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| PC EVL1 | Everolimus in human blood |
| PC EVL2 | Everolimus in human blood |
| PC EVL3 | Everolimus in human blood |

**REF** 07294131190

**LOT** 40342101

 2021-07-31

 2020-06-04

**GTIN** 04015630946495



Rx only

02





*Лучина И. А.*

Всего пронумеровано,  
прошнуровано и  
скреплено печатью  
5 листа (ов)

Лучина И. А.  
Руководитель отдела Логистики  
и качества по доверенности от:

02 июля 2018