

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «Бизнес Технологии»



Н.К. Назарова

2021 г.

МАРКИРОВКА
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

**Система ультразвуковая диагностическая E-CUBE 8 в составе с
принадлежностями в вариантах исполнения**

2021

Система ультразвуковая диагностическая E-CUBE 8 в составе с принадлежностями в варианте исполнения с сенсорным экраном	
Производитель ALPINION MEDICAL SYSTEMS Co., Ltd. Алпинион Медикал Системс Ко., Лтд. 5FL, I Dong, 77, Heungan-daero 81 beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea	
Уполномоченный представитель производителя Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Технологии» (ООО «Бизнес Технологии») 117198, Российская Федерация, г. Москва, ул.Саморы Машела, д. 8, стр.2 тел.: 8(495)232-02-13, эл.почта: info@intermedica.ru	
Перед использованием прочитайте инструкцию по применению/руководство пользователя	
Утилизация согласно руководству пользователя и требованиям местного законодательства	
Электропитание: 100-120/200-240В~, 450ВА/450ВА, 50/60Гц	Вес: 55 кг
Регистрационное удостоверение № *** ***/**** Дата ** * 20** **	

Система ультразвуковая диагностическая E-CUBE 8 в составе с принадлежностями в варианте исполнения без сенсорного экрана	
Производитель ALPINION MEDICAL SYSTEMS Co., Ltd. Алпинион Медикал Системс Ко., Лтд. 5FL, I Dong, 77, Heungan-daero 81 beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea	
Уполномоченный представитель производителя Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Технологии» (ООО «Бизнес Технологии») 117198, Российская Федерация, г. Москва, ул.Саморы Машела, д. 8, стр.2 тел.: 8(495)232-02-13, эл.почта: info@intermedica.ru	
Перед использованием прочитайте инструкцию по применению/руководство пользователя	
Утилизация согласно руководству пользователя и требованиям местного законодательства	
Электропитание: 100-120/200-240В~, 450ВА/450ВА, 50/60Гц	Вес: 50 кг
Регистрационное удостоверение № *** ***/**** Дата ** * 20** **	

Маркировка на задней части сканера

Система ультразвуковая диагностическая E-CUBE 8 в составе с принадлежностями в варианте исполнения с сенсорным экраном

ALPINION MEDICAL SYSTEMS Co., Ltd.



Алпинион Медикал Системс Ко., Лтд.

5FL, 1 Dong, 77, Heungan-daero 81 beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si,
Gyeonggi-do, Republic of Korea

Модель: E-Cube 8

Вес: 55 кг

Электропитание: 100-120/200-240В~, 450ВА/450ВА, 50/60Гц





ГГГГ.ММ



Во избежание электрического удара, не разбирайте
самостоятельно данный разъем

СДЕЛАНО В КОРЕЕ

Система ультразвуковая диагностическая E-CUBE 8 в составе с принадлежностями в варианте исполнения без сенсорного экрана

ALPINION MEDICAL SYSTEMS Co., Ltd.



Алпинион Медикал Системс Ко., Лтд.

5FL, 1 Dong, 77, Heungan-daero 81 beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si,
Gyeonggi-do, Republic of Korea

Модель: E-Cube 8

Вес: 50 кг

Электропитание: 100-120/200-240В~, 450ВА/450ВА, 50/60Гц





ГГГГ.ММ




Во избежание электрического удара, не разбирайте
самостоятельно данный разъем

СДЕЛАНО В КОРЕЕ

Маркировка на задней части монитора



Маркировка датчиков

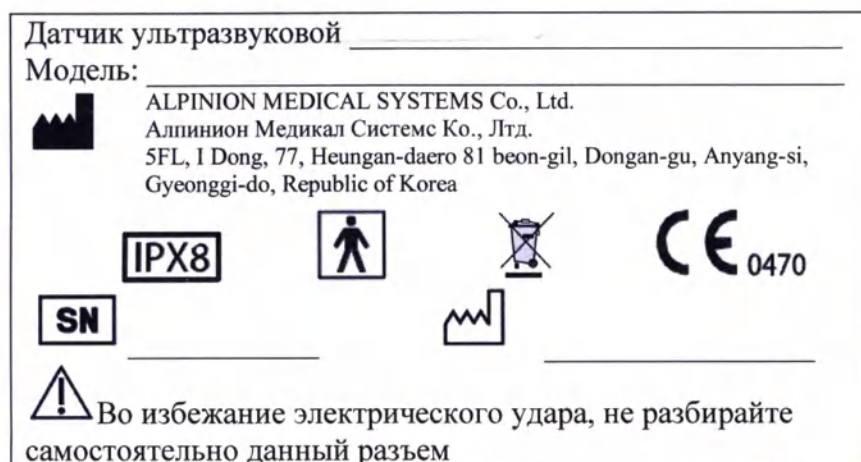

Маркировка на задней части монитора



Маркировка на задней части сканера





Прошнуровано,
пронумеровано и скреплено печатью
на _____ листах
"Директор _____ Н.К. Назарова"

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «Бизнес Технологии»




Н.К. Назарова

01 2021 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

**Система ультразвуковая диагностическая E-CUBE 8 в составе с
принадлежностями в вариантах исполнения**

2021

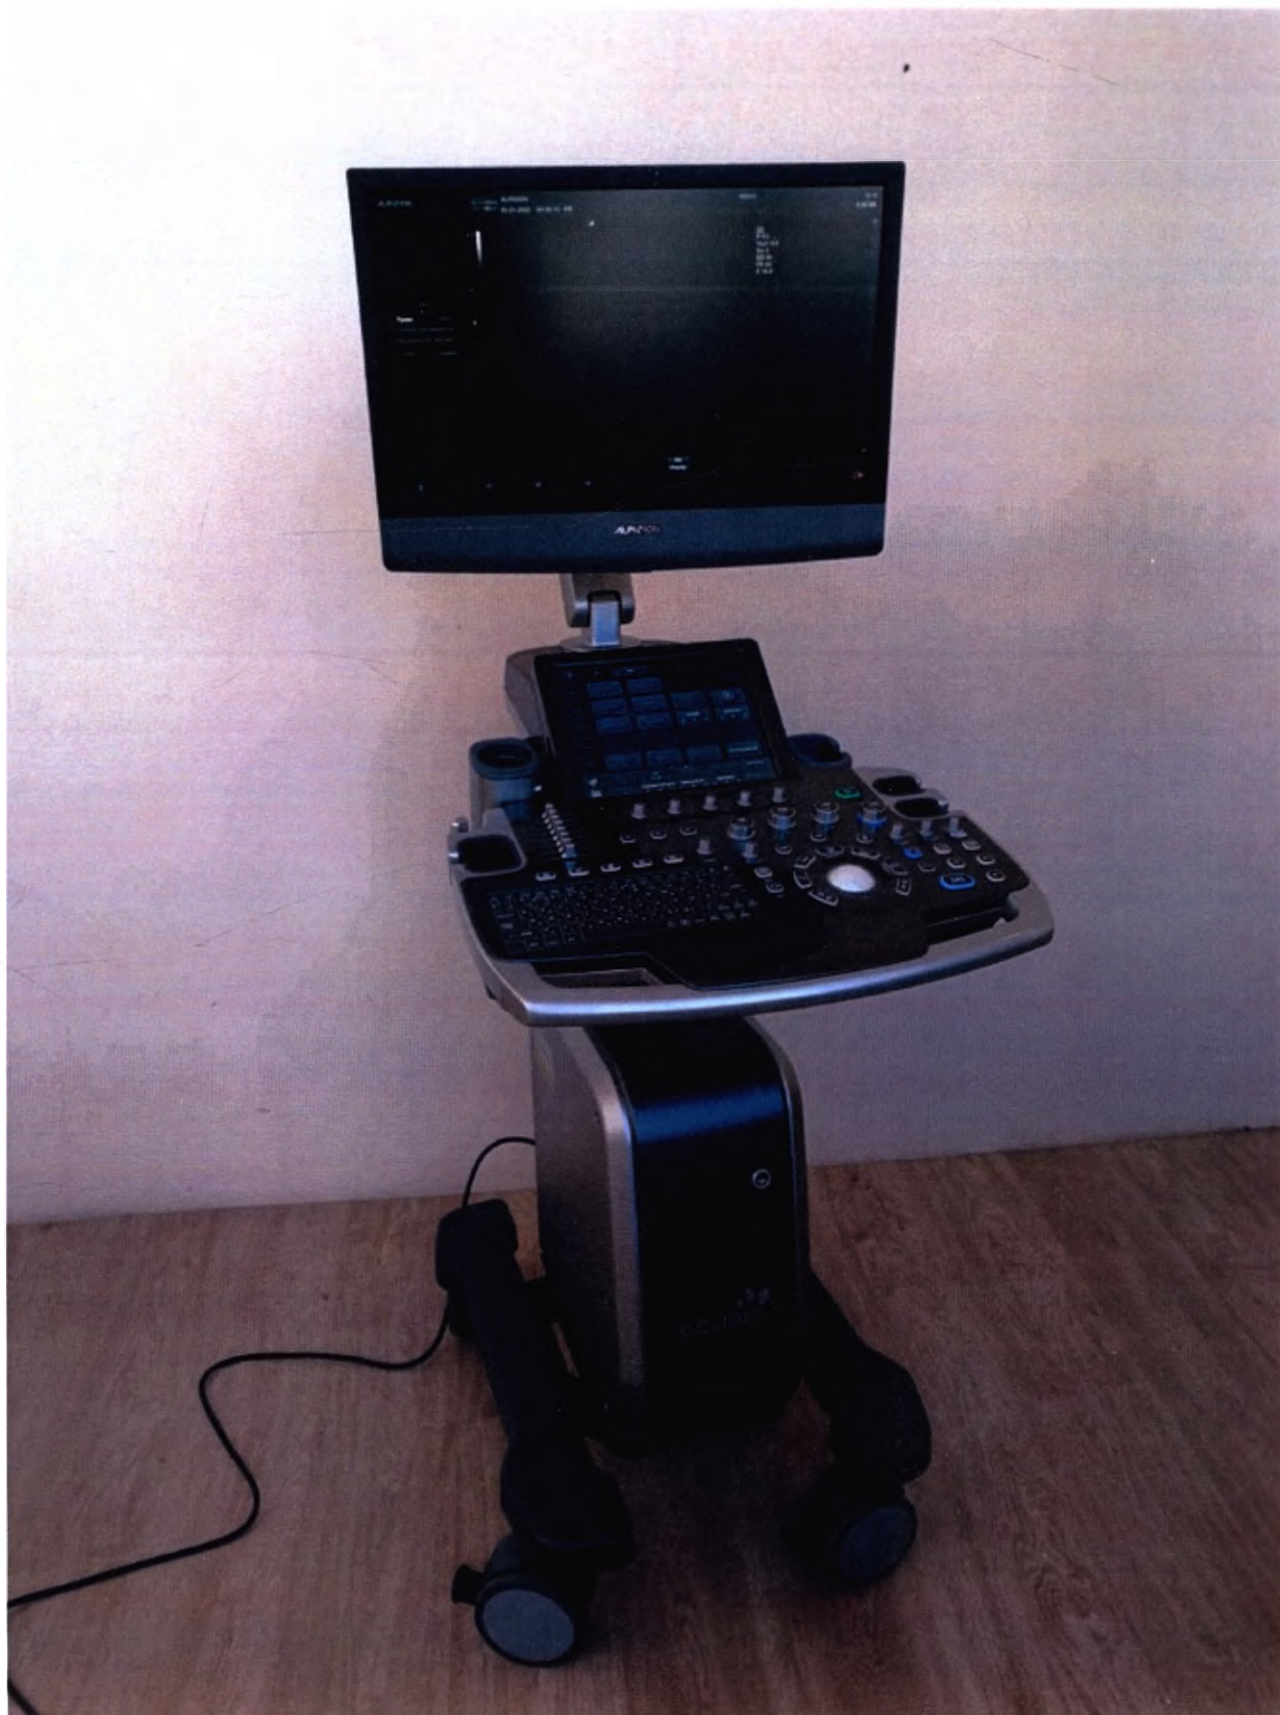

Система ультразвуковая диагностическая E-CUBE 8 (вид спереди)



Система ультразвуковая диагностическая E-CUBE 8 (вид сбоку)



Система ультразвуковая диагностическая E-CUBE 8 (вид сзади)



Сетевой кабель с креплением



Устройство подогрева геля



Краткая инструкция пользователя на бумажном носителе



ECUBE8

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Rev. 2 (RUS)

ALPINION
MEDICAL SYSTEMS

www.alpinion.com

Руководство по эксплуатации на бумажном носителе



Аккумуляторная батарея



Предохранители



Датчики



Датчики



Датчики



Датчики



Датчики



Датчики



Датчики



Датчики



Датчики



Одноразовая направляющая для иглы

REF 610-958
QTY 1

LOT A091407


Needle Guide

Sterile endocavity needle guide for use with ALPINION E3-10, BK Medical 8819 and E10C4, Carestream E10C4, Hitachi Aloka Medical UST-679, Philips Bp10-5ec, C9-4ec, and Samsung Medison NEV4-9ES, NER4-9ES transducers

[DA] Nåleguide
[NL] Naaldvoerder
[FI] Neulaohjain
[FR] Guide-aiguille
[DE] Nadelführung
[EL] Οδηγός Βελόνας

[IT] Guida dell'ago
[JA] 注射針ガイド
[KO] 니들 가이드
[NO] Nålstyring
[PT-PT] Guia de agulhas
[RU] Проводчик иглы

[ZH-CN] 针导引器
[ES] Guía de aguja
[SV] Nålguide
[ZH-TW] 針針導引器
[TR] İğne Kılavuzu



STERILE EO

Sterilization using
ethylene oxide

Rx ONLY

WARNING: Cancer
and Reproductive Harm -
www.P65Warnings.ca.gov



(01)10841436104608
(10)A091407
(11)151101
(17)221101



Do not use
if package is
damaged



Do not
reuse



52°F (11°C)
85°F (29°C)
Temperature
limitation



Keep away
from
sunlight



Consult
instructions
for use



1639

Guide made in Mexico



Date of Manufacture:
2019.11.01



Use By:
2022.11.01



102 First Street South

Kalona, IA 52247 USA

319.248.6757

WWW.CIVCO.COM



M3566109380L

610-958-MV REV G

Одноразовая направляющая для иглы



Многоразовая направляющая для иглы




Биопсийный набор



Устройство записи данных DVD-RW



Кронштейн для устройства записи данных

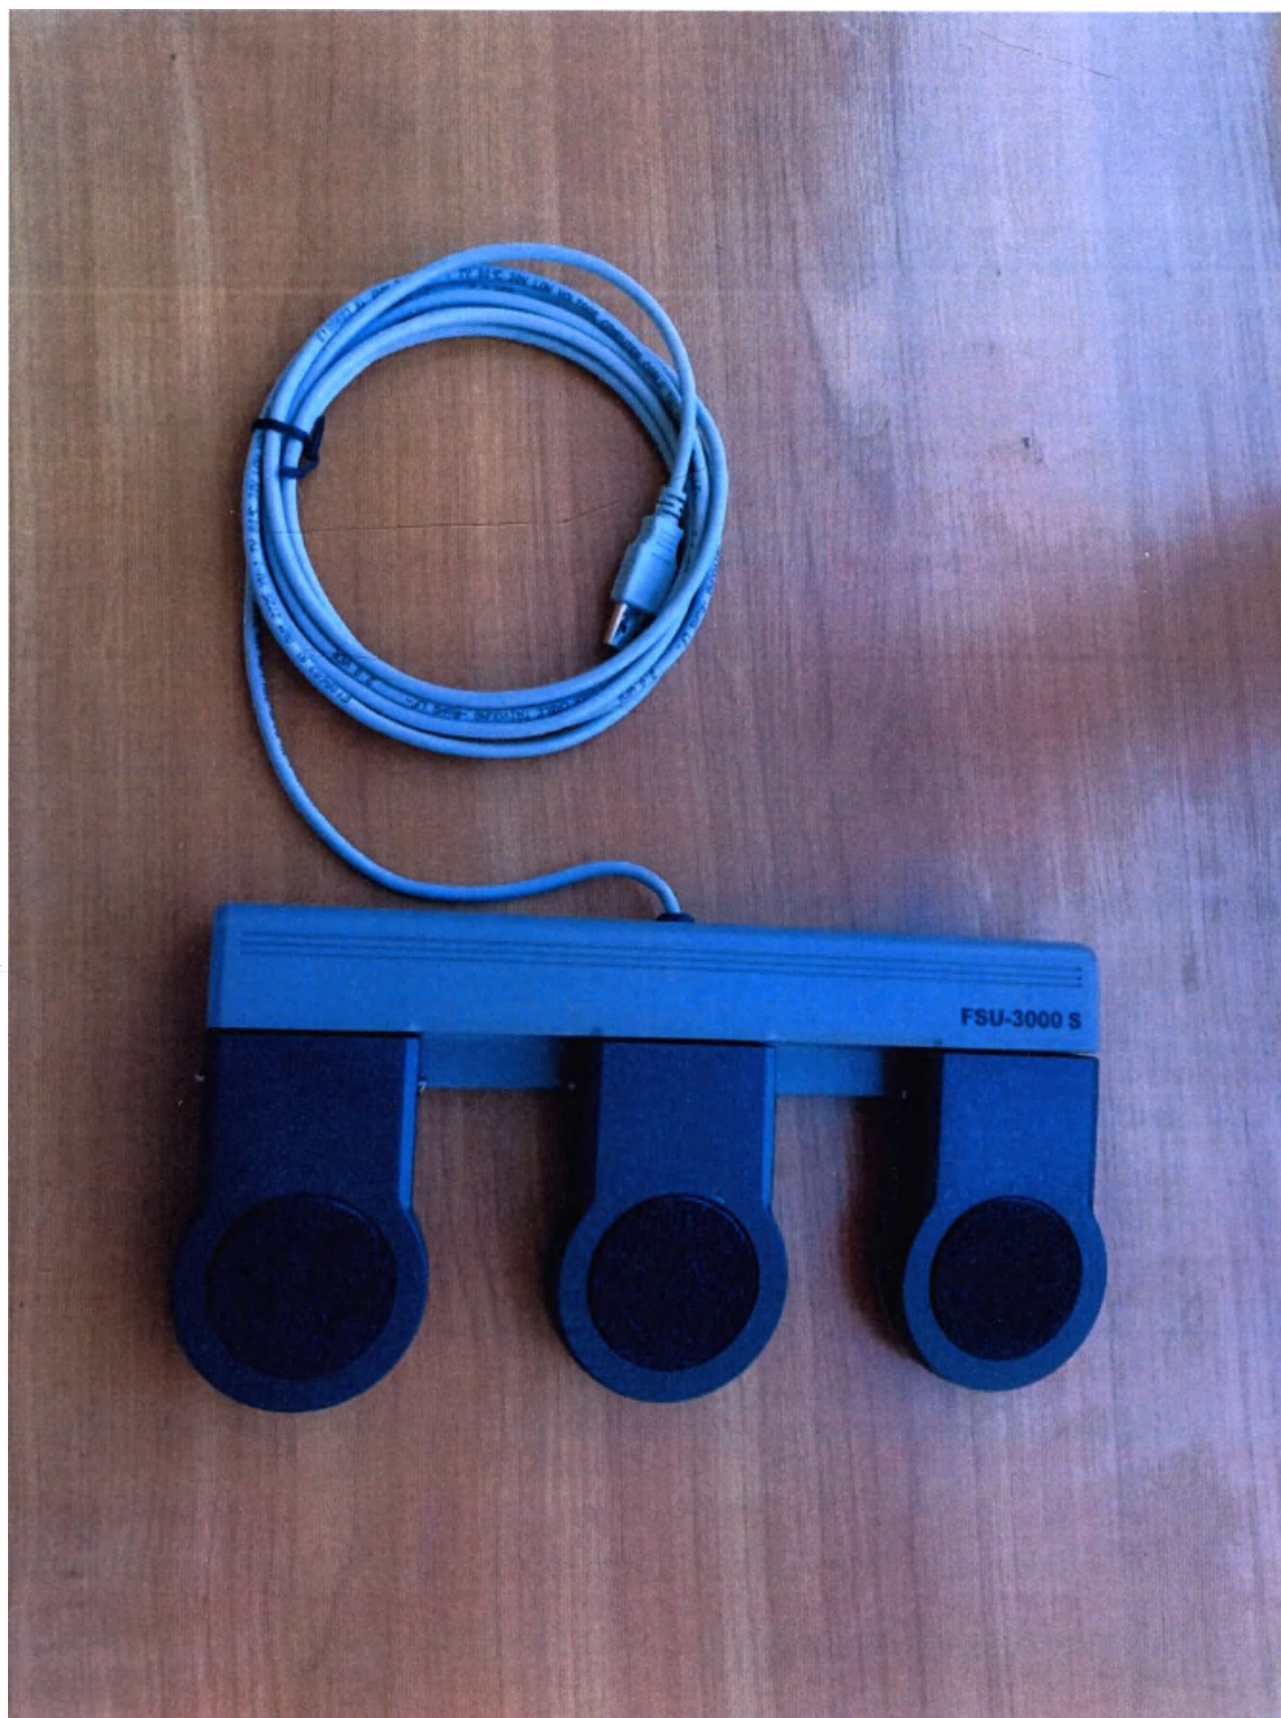

Ножной переключатель (педаль) FSU-3000S



Адаптер Wi-Fi TP-Link T4U



ЭКГ-кабель



Руководства по эксплуатации на электронных носителях и модули




Кронштейн для принтера



Принтер



Порт для подключения ЭКГ датчиков

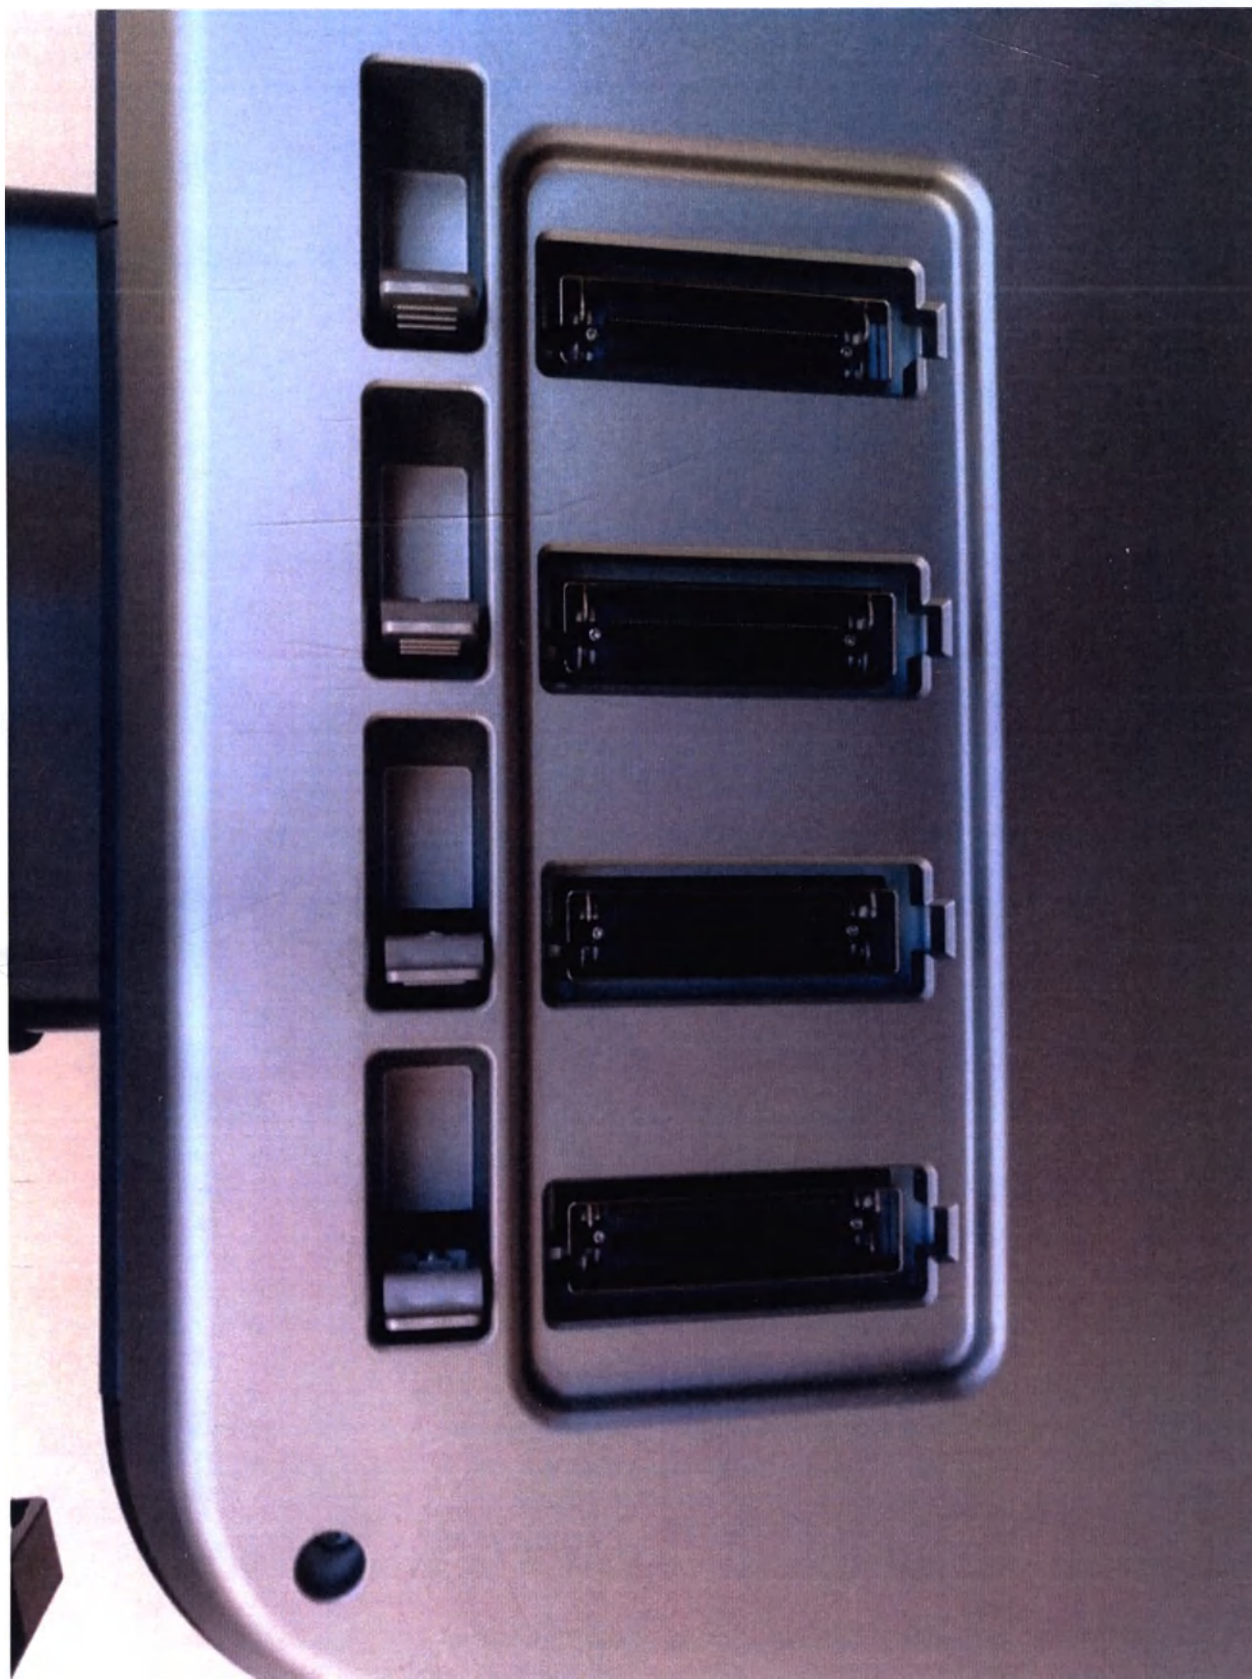

Порт для подключения ультразвуковых датчиков

Прошнуровано,
пронумеровано и скреплено печатью
на 33 листах
Директор Н.К. Назарова

