



Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

Набор калибраторов для обеспечения правильности качественного определения антител класса IgM к вирусу SARS-CoV-2 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах ARCHITECT «SARS-CoV-2 IgM Калибратор для ARCHITECT (SARS-CoV-2 IgM Calibrator Kit)»

(серия (партия) 23502FN00)

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)

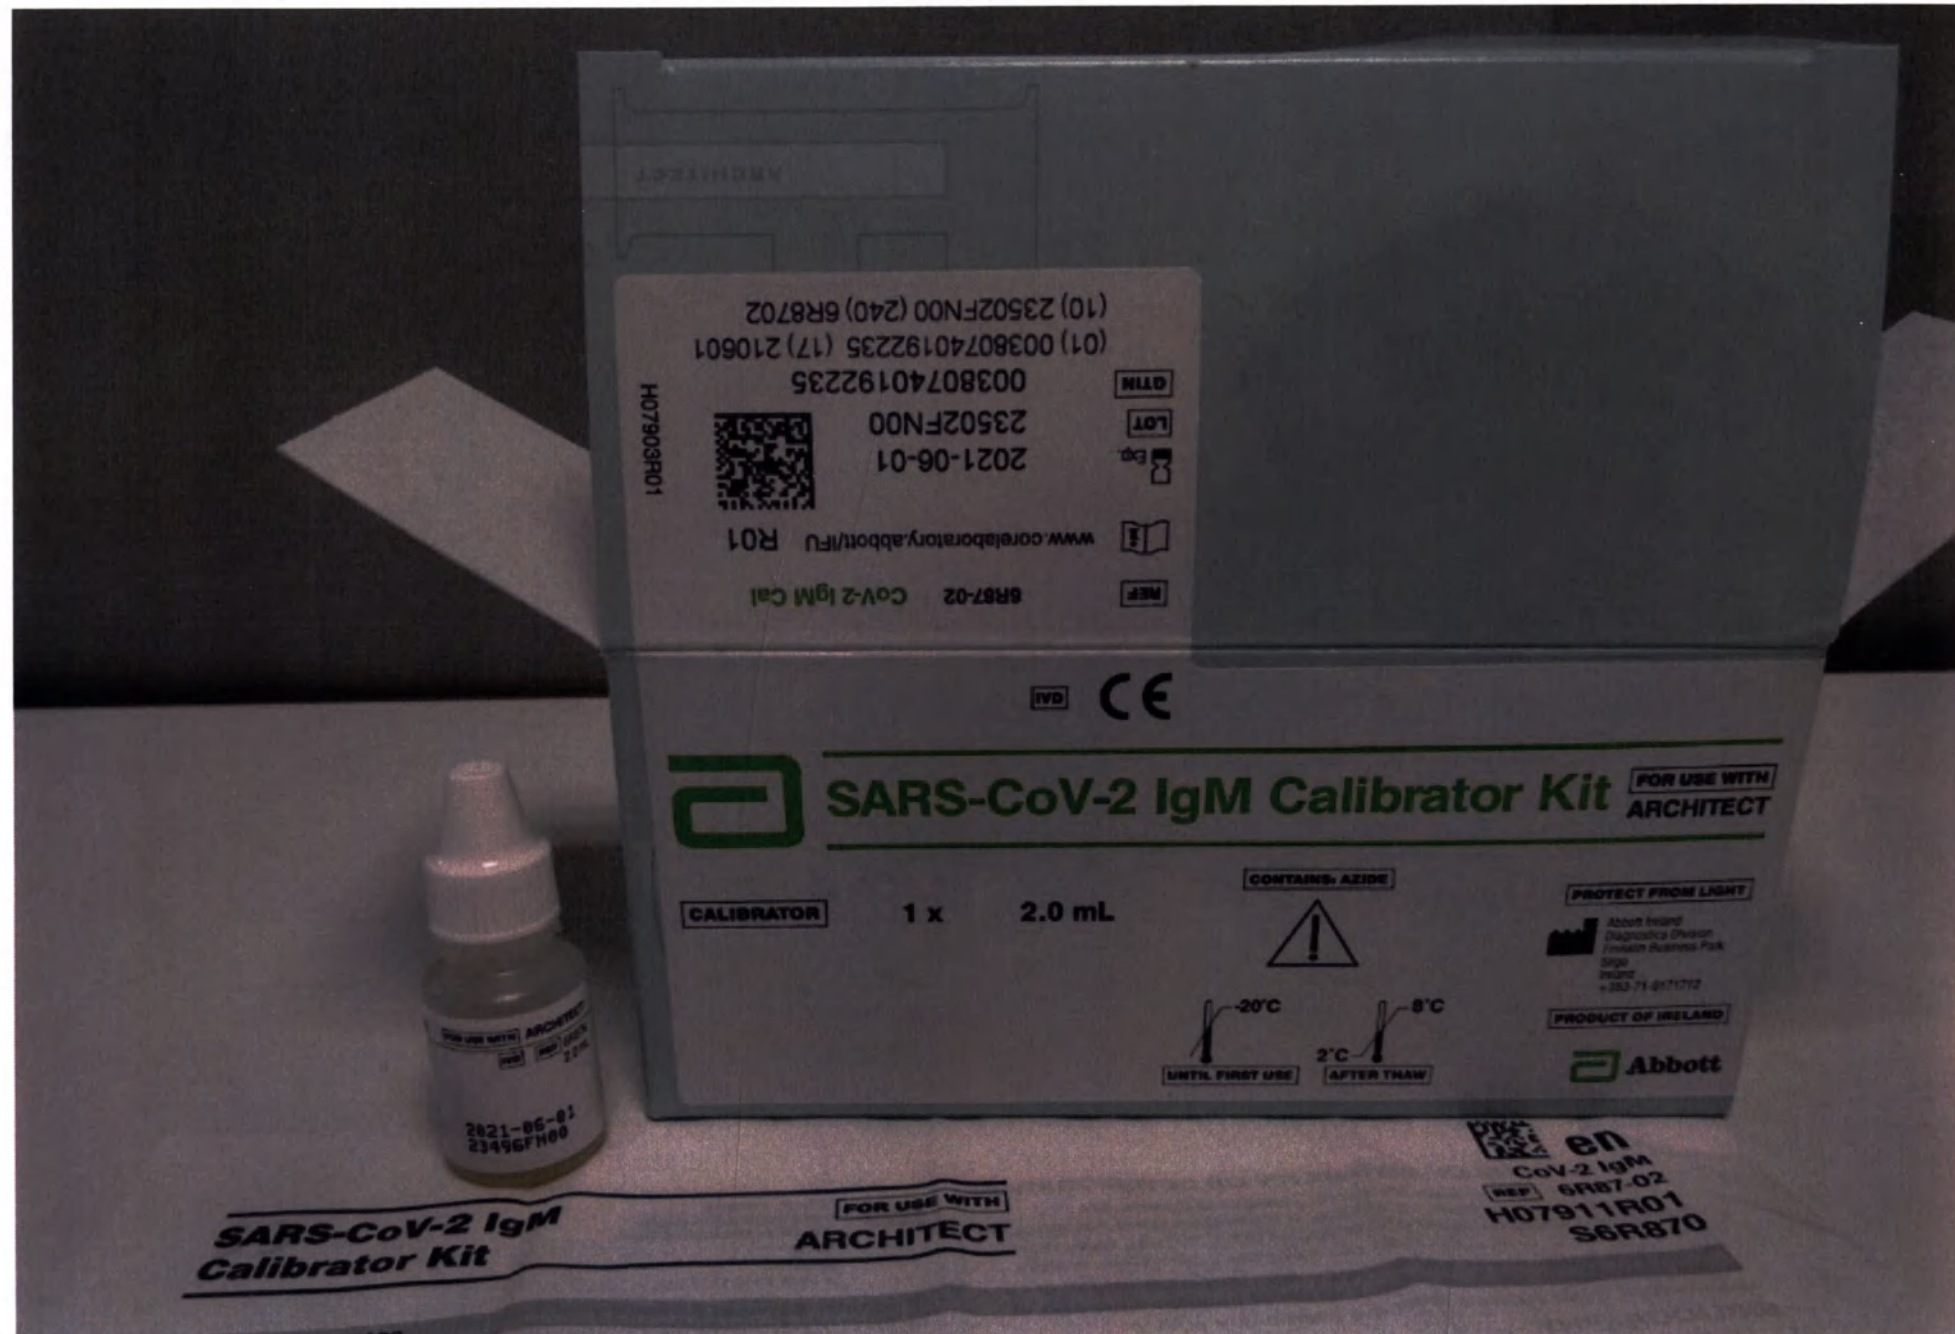

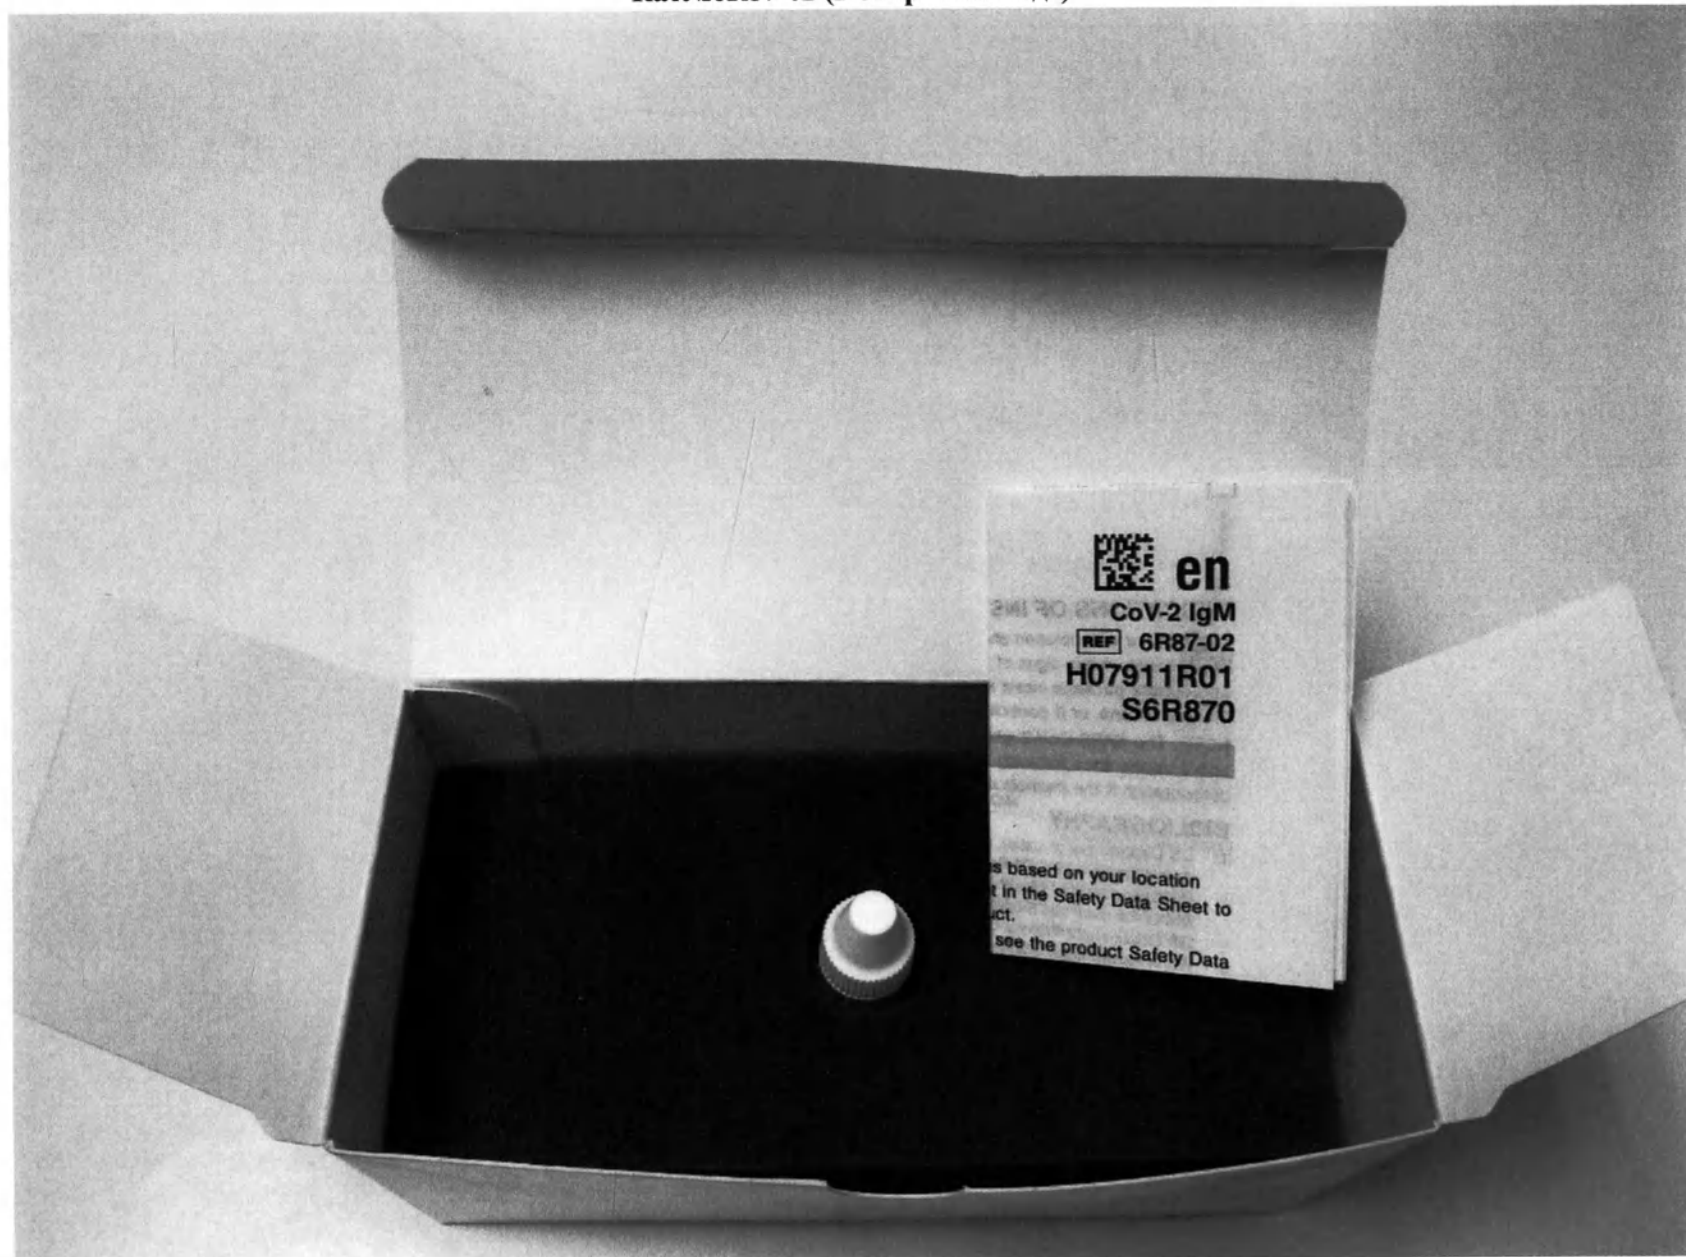



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

_____ листов

Подпись _____



Макет маркировки на медицинское изделие

Набор калибраторов для обеспечения правильности качественного определения антител класса IgM к вирусу SARS-CoV-2 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах ARCHITECT «SARS-CoV-2 IgM Калибратор для ARCHITECT (SARS-CoV-2 IgM Calibrator Kit)» (серия (партия) 23502FN00)



6R87-02




Набор калибраторов для обеспечения правильности качественного определения антител класса IgM к вирусу SARS-CoV-2 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах ARCHITECT «SARS-CoV-2 IgM Калибратор для ARCHITECT (SARS-CoV-2 IgM Calibrator Kit)» (серия (партия) 23502FN00)

в составе: Калибратор (SARS-CoV-2 IgM Calibrator) - 1 флакон х 2,0 мл.; Инструкция по применению / Производитель: Abbott Ireland Diagnostics Division Finisklin Business Park, Sligo, Ireland/ Место производства: Abbott Ireland Diagnostics Division Finisklin Business Park, Sligo, Ireland/ Страна происхождения: Ирландия / РУ № ____/____ от ____/____ / Инструкция по применению на русском языке: www.abbottdiagnostics.com/IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции/Данный продукт содержит полученные от человека и/или потенциально инфекционные компоненты


Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:
Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия,
г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,
Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Макет оригинальной маркировки медицинского изделия SARS-CoV-2 IgM Калибратор для ARCHITECT (SARS-CoV-2 IgM Calibrator Kit), Кат. №6R87-02

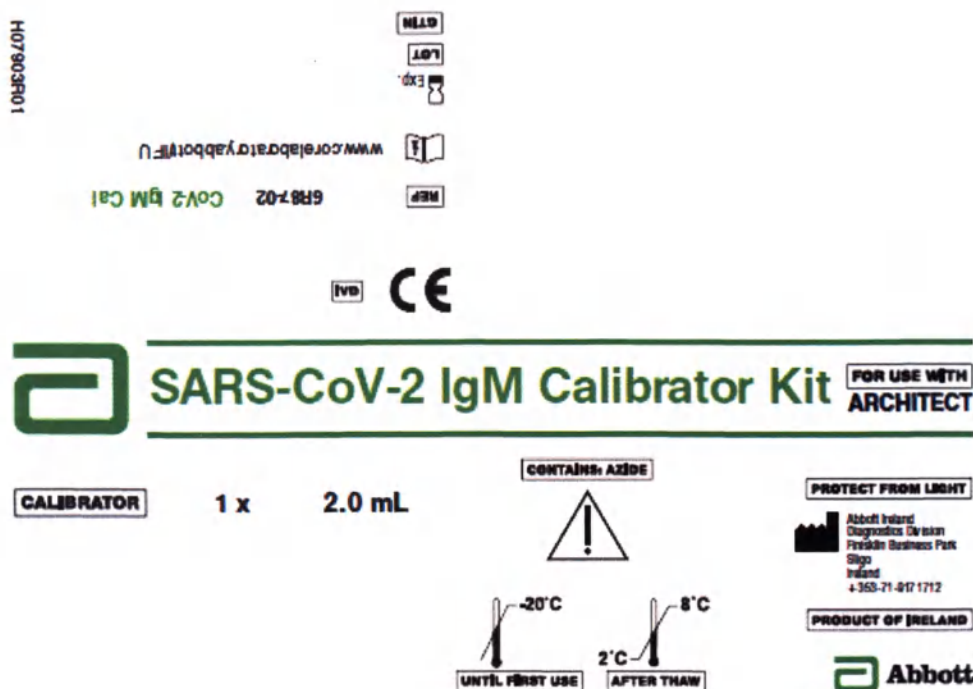

Макет маркировки компонентов медицинского изделия SARS-CoV-2 IgM Калибратор для ARCHITECT (SARS-CoV-2 IgM Calibrator Kit), Кат. №6R87-02

- Калибратор (SARS-CoV-2 IgM Calibrator)

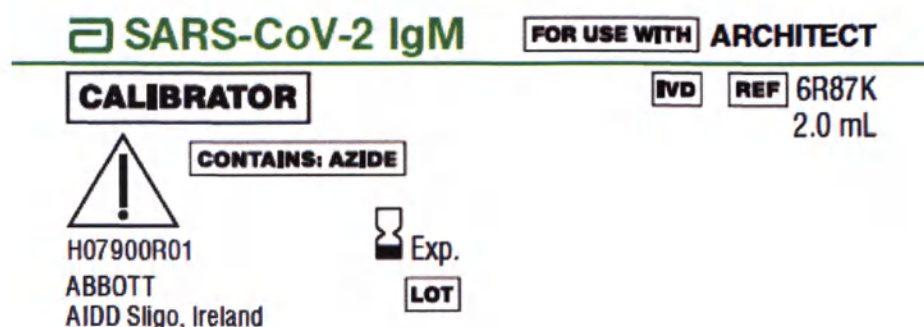

Расшифровка символов представлена в инструкции.

ЛИСТОВ

Подпись

