



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Рош Диабетес Кеа Рус»

Карпухин В.В.

«12» июля 2021 г.

Сыленко М.И.
директор отдела качества,
регуляторных вопросов
и поддержки пользователей
по доверенности 1375-20 от 17.08.2020

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор для введения инсулина «Акку-Чек® Соло» (Accu-Chek® Solo)
в различных вариантах исполнения


Набор для введения инсулина «Акку-Чек® Соло» (Accu-Chek® Solo), 6 мм, в составе:




ACCU-CHEK® Solo

Supply kit

6 mm

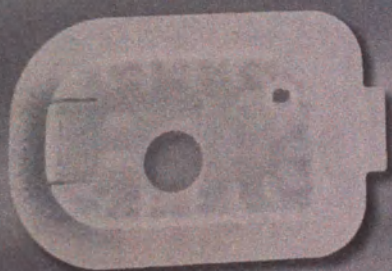



ACCU-CHEK® Solo supply kit

6mm

Supply kit / Verbrauchsset / Kit de consommables / Kit di materiali di consumo /
Kit de consumibles / Kit de consumíveis / Kit de insumos / Toebehorensset / Tilbehørskit /
Tilbehørssett / Tillbehørskit / Tarvikepakkaus / Πακέτο αναλωσίμων / ערכת מתכלים /
Zestaw produktów wymiennych / Sada spotřebního materiálu / Súprava spotrebných častí /
Egyszerhasználatos készlet / Komplet s potrošnim materialom / Набор расходных материалов /
消費品套装 / 軟管組件 / 消耗品セット / 소모품 키트 / علبة المستلزمات

REF

07858825001

GTIN

(01)04015630881666

LOT

(10) 20028801




2020-12-10



4 015630 881666

Made in: Finland

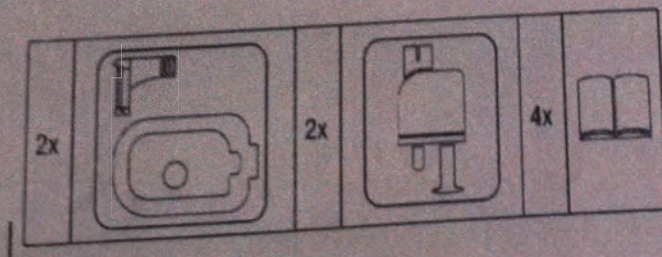



НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ
Купи этот продукт только
по телефону 8-800-200-40-40

* На территории Российской Федерации будет обращаться медицинское изделие «Набор для введения инсулина «Акку-Чек® Соло» (Accu-Chek® Solo)» в блистере и потребительской упаковке, макеты которых представлены в документе «Макет потребительской упаковки, блистера и дополнительной маркировки на потребительскую упаковку медицинского изделия»



1. Модуль канюли «Акку-Чек® Соло» (Accu-Chek® Solo), длина канюли 6 мм – 2 шт.
2. Фиксатор помпы «Акку-Чек® Соло» (Accu-Chek® Solo) - 2 шт.

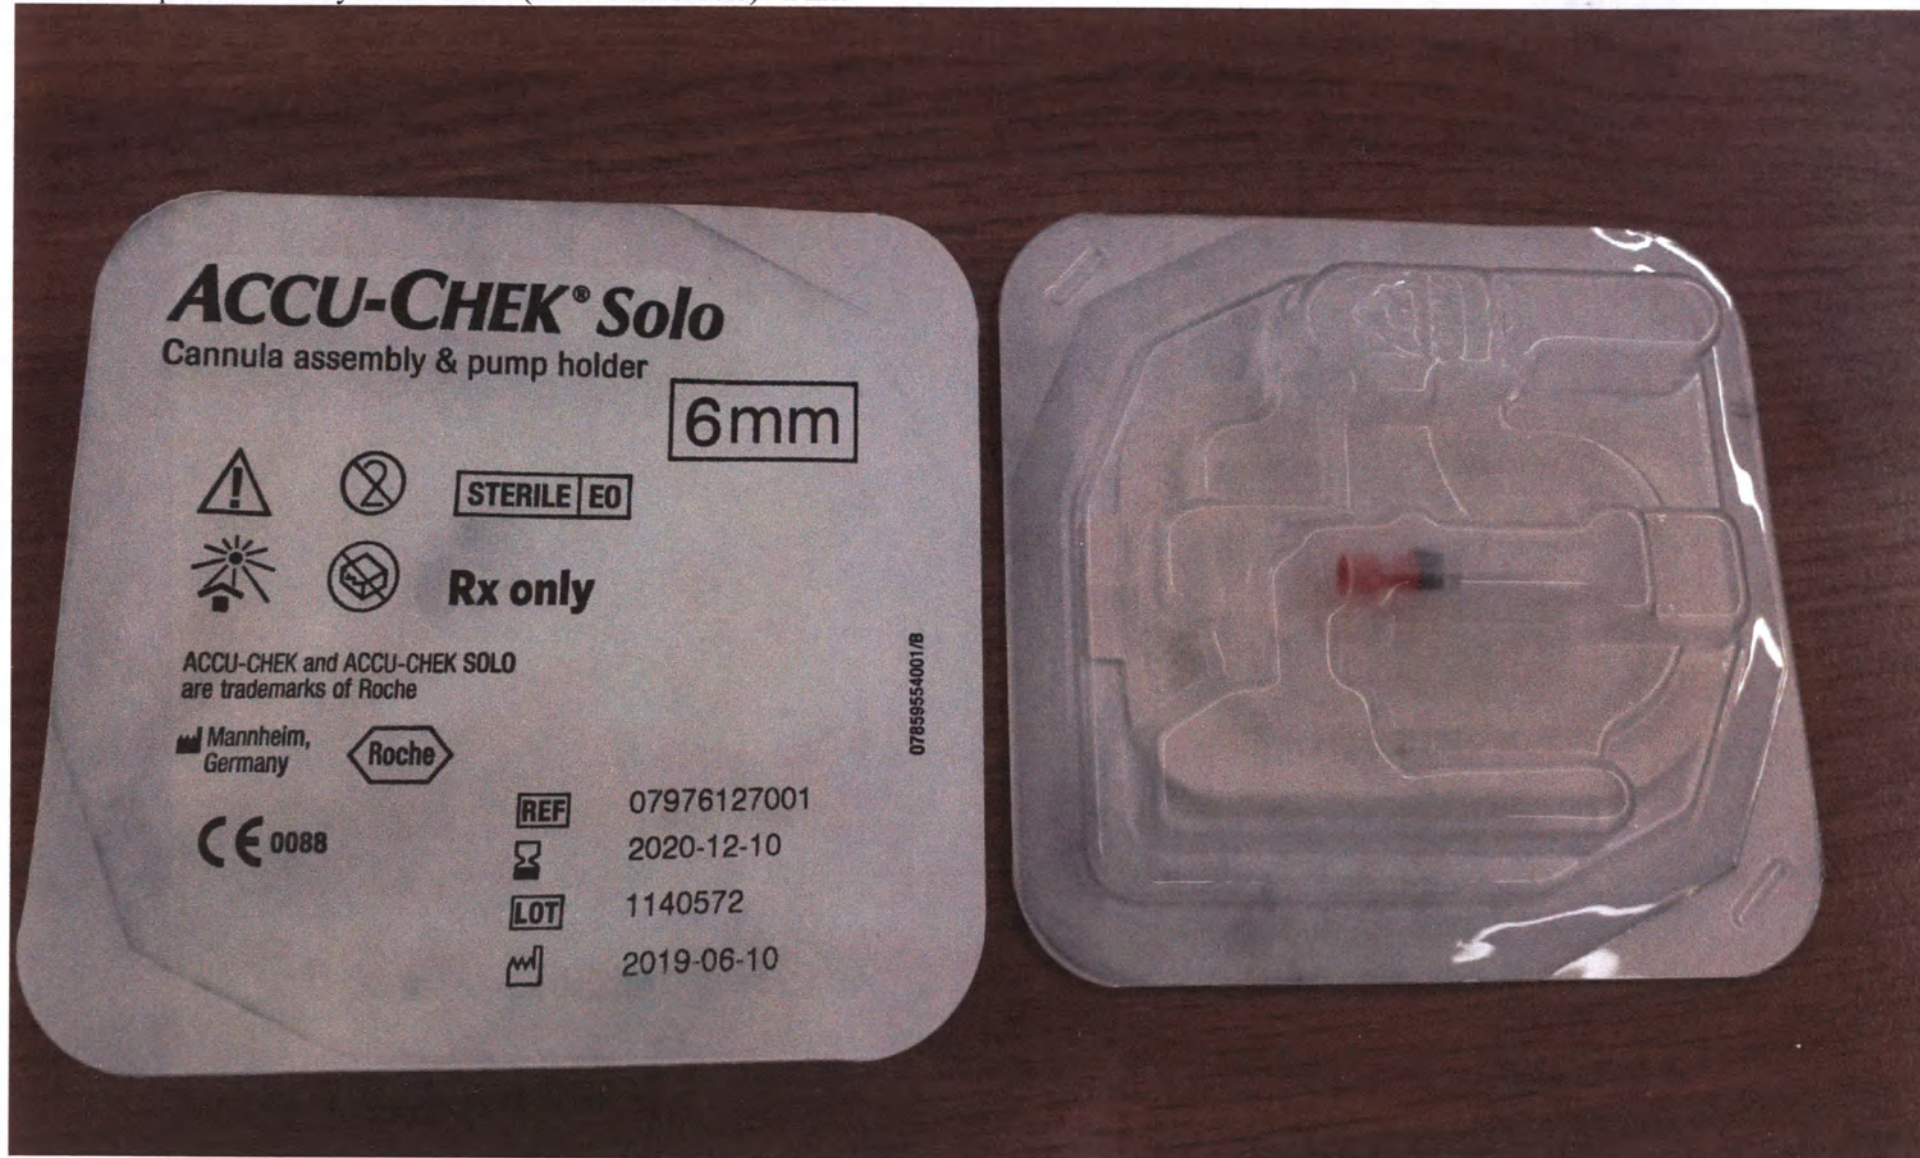

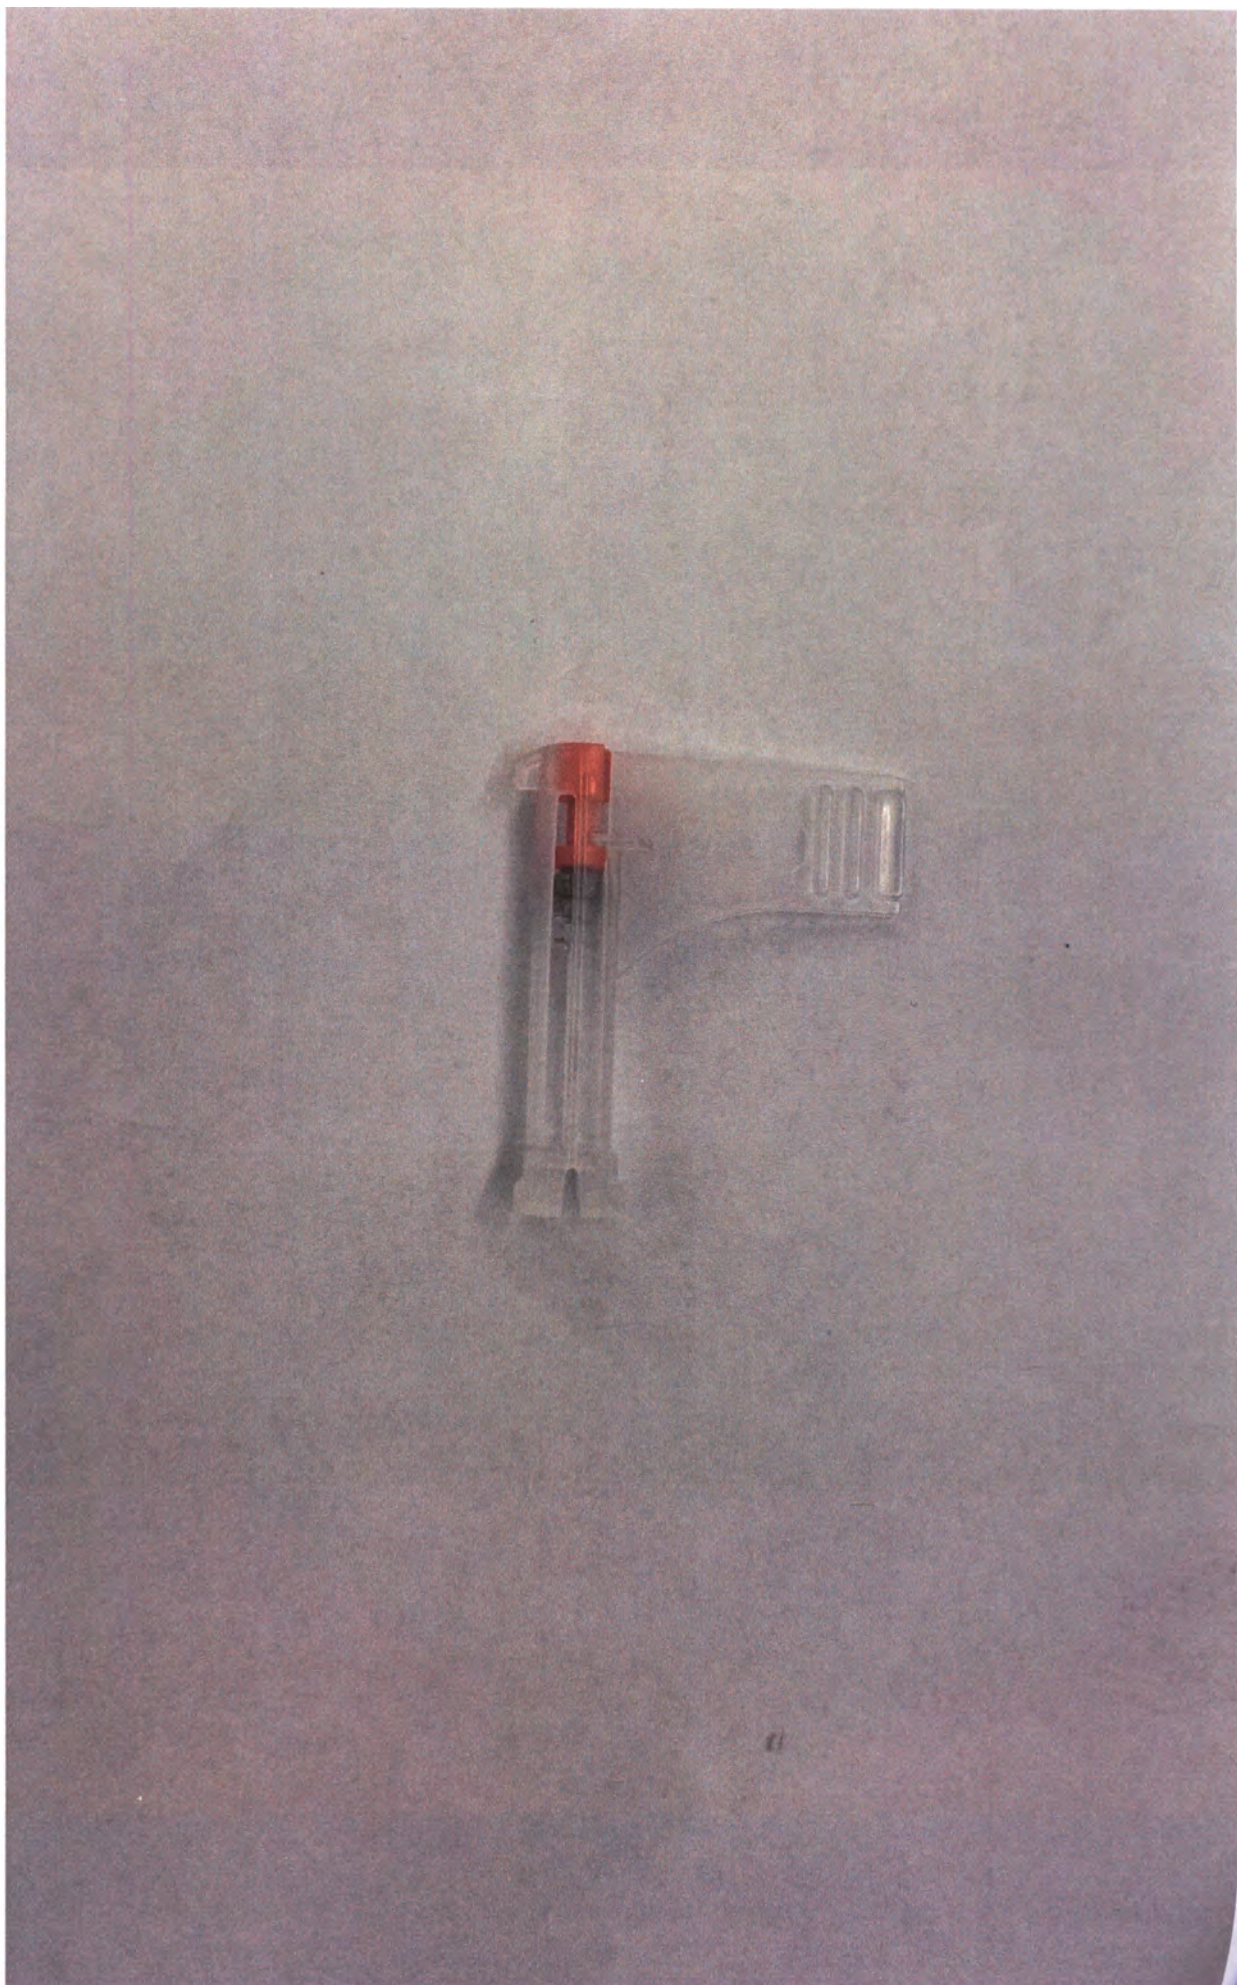



3. Модуль резервуара «Акку-Чек® Соло» (Accu-Chek® Solo) - 2 шт.



ACCU-CHEK® Solo
Reservoir

REF 07976089001



STERILE EO



Rx only

ACCU-CHEK and ACCU-CHEK SOLO are trademarks of Roche

 Mannheim,
Germany

 Roche

 0088


07859562001/C

 2021-01-09

 1141002

 2019-07-09



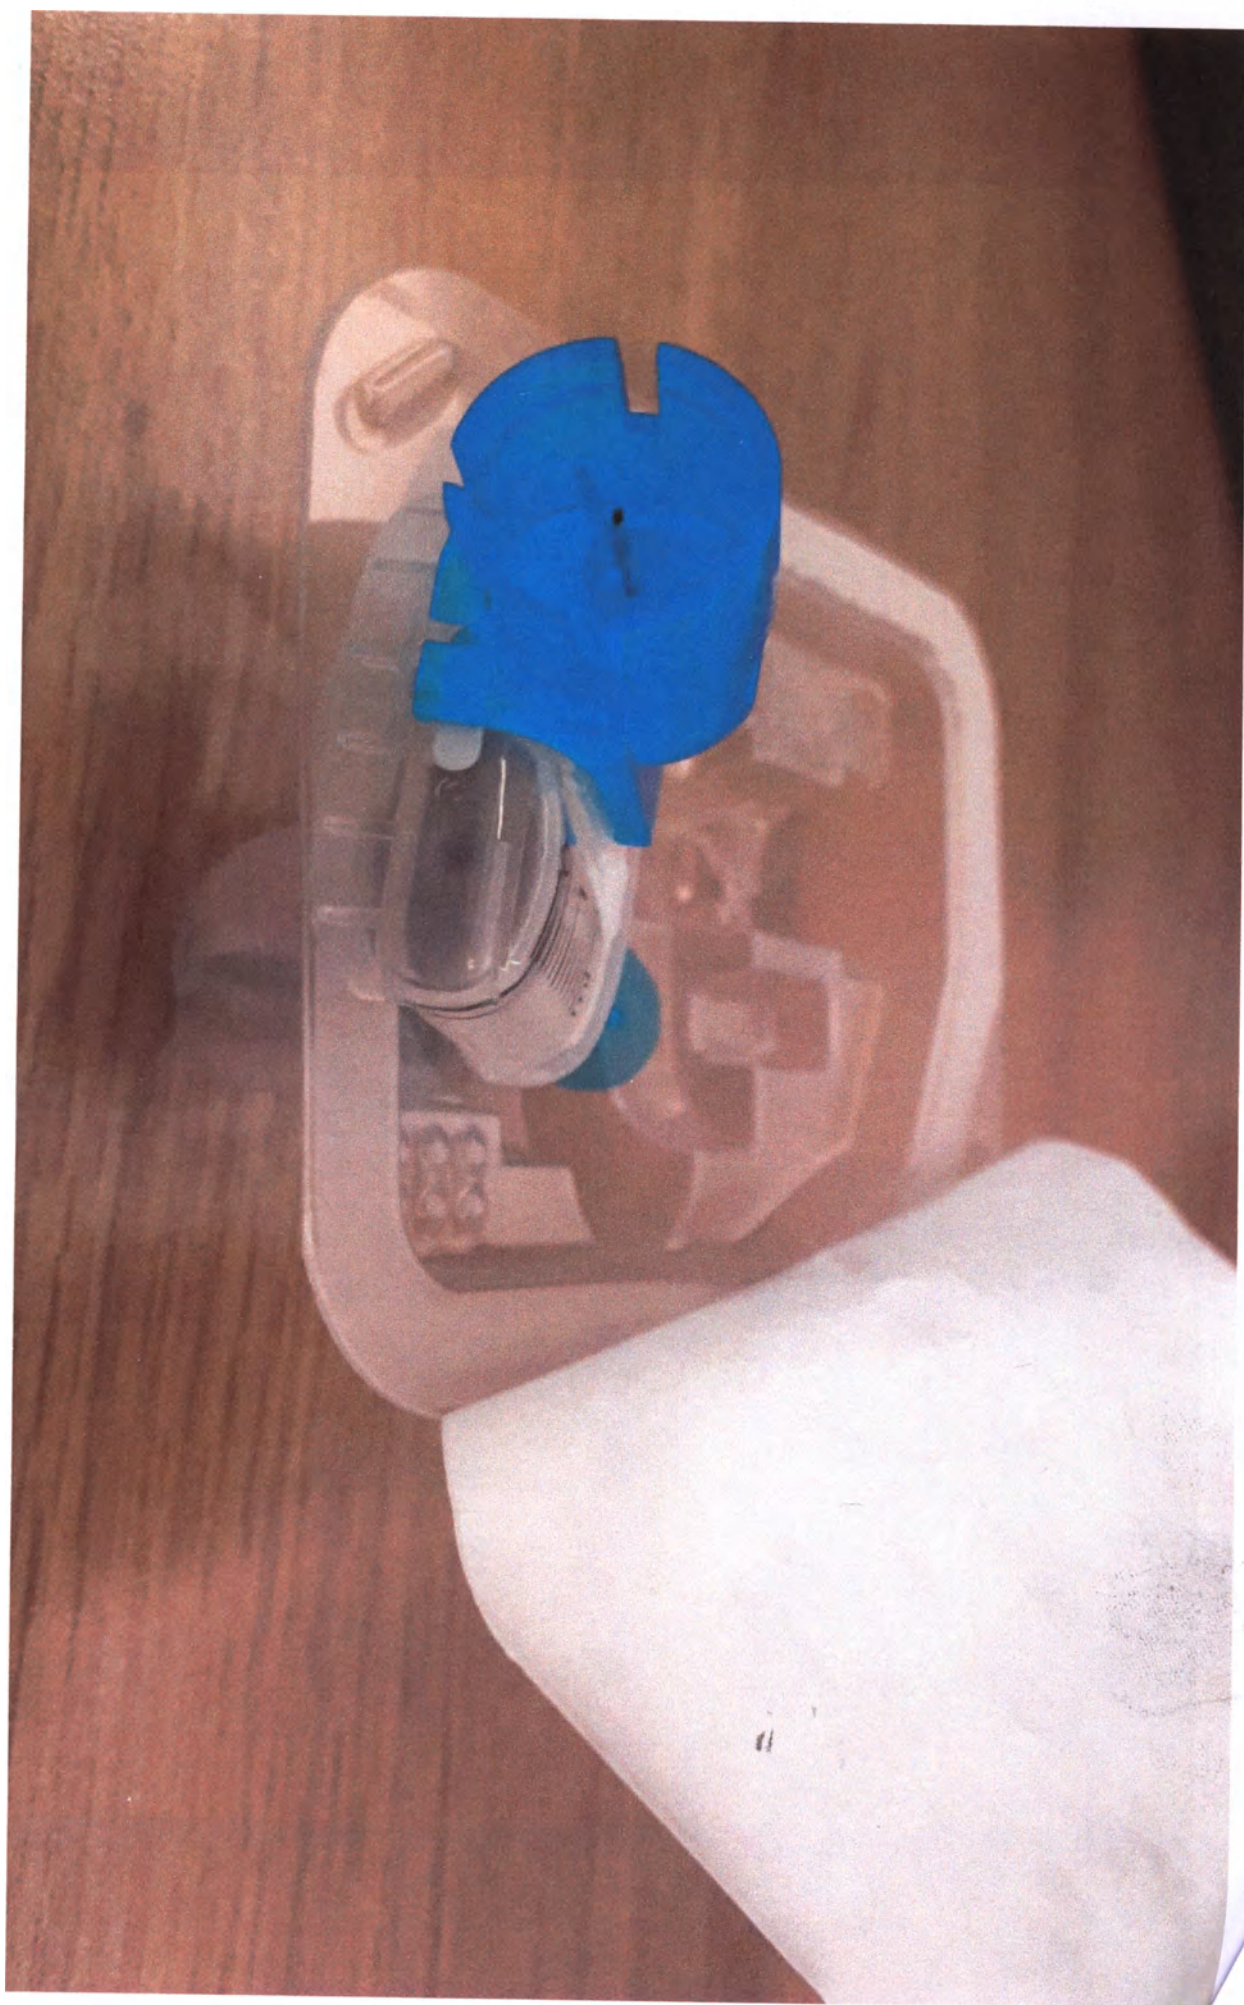


Набор для введения инсулина «Акку-Чек® Соло» (Accu-Chek® Solo), 9 мм, в составе:






ACCU-CHEK® Solo

Supply kit

9 mm

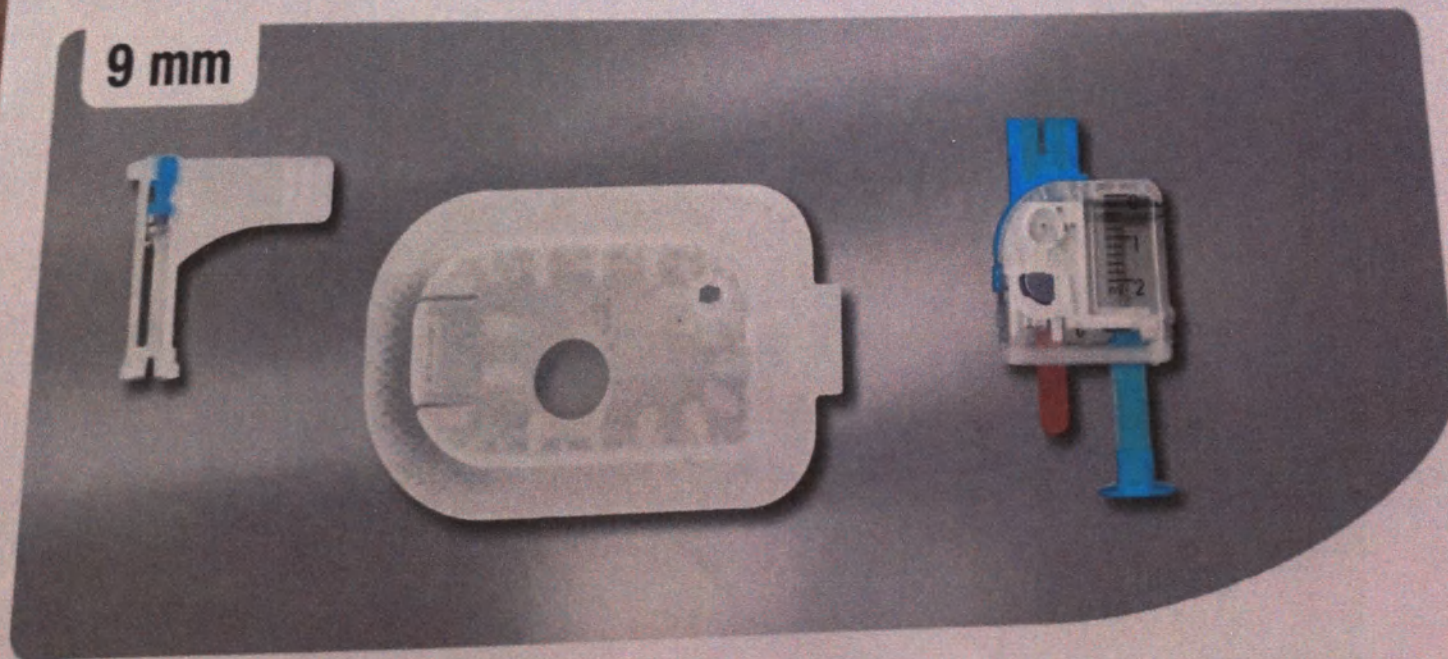

НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ
ЕСЛИ ВАМ ПРОДАЛИ ЭТОТ ПРОДУКТ, СООБЩИТЕ
ПО ТЕЛЕФОНУ 8-800-200-88-88



Rx only

ACCU-CHEK and ACCU-CHEK SOLO are
trademarks of Roche.

© 2017 Roche Diabetes Care



Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-check.com

ACCU-CHEK® Solo supply kit

9mm

Supply kit / Verbrauchssset / Kit de consommables / Kit di materiali di consumo /
Kit de consumibles / Kit de consumíveis / Kit de insumos / Toebehorensset / Tilbehørskit /
Tilbehørssett / Tillbehörskit / Tarvikepakkaus / Πακέτο αναλωσίμων / ערכת מתכלים /
Zestaw produktów wymiennych / Sada spotřebního materiálu / Súprava spotrebných častí /
Egyszerhasználatos készlet / Komplet s potrošnim materialom / Набор расходных материалов /
消費品套装 / 軟管組件 / 消耗品セット / 소모품 키트 / علبة المستلزمات

REF

07858817001

GTIN

(01) 04015630881673




4 015630 881673

LOT

(10) 20028953



2020-12-05

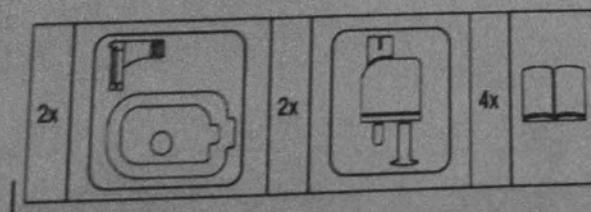



Made in: Finland

*На территории Российской Федерации будет обращаться медицинское изделие «Набор для введения инсулина «Акку-Чек® Соло» (Accu-Chek® Solo)» в блистере и потребительской упаковке, макеты которых представлены в документе «Макет потребительской упаковки, блистера и дополнительной маркировки на потребительскую упаковку медицинского изделия»




1. Модуль каниюли «Акку-Чек® Соло» (Accu-Chek® Solo), длина каниюли 9 мм – 2 шт.
2. Фиксатор помпы «Акку-Чек® Соло» (Accu-Chek® Solo) - 2 шт.

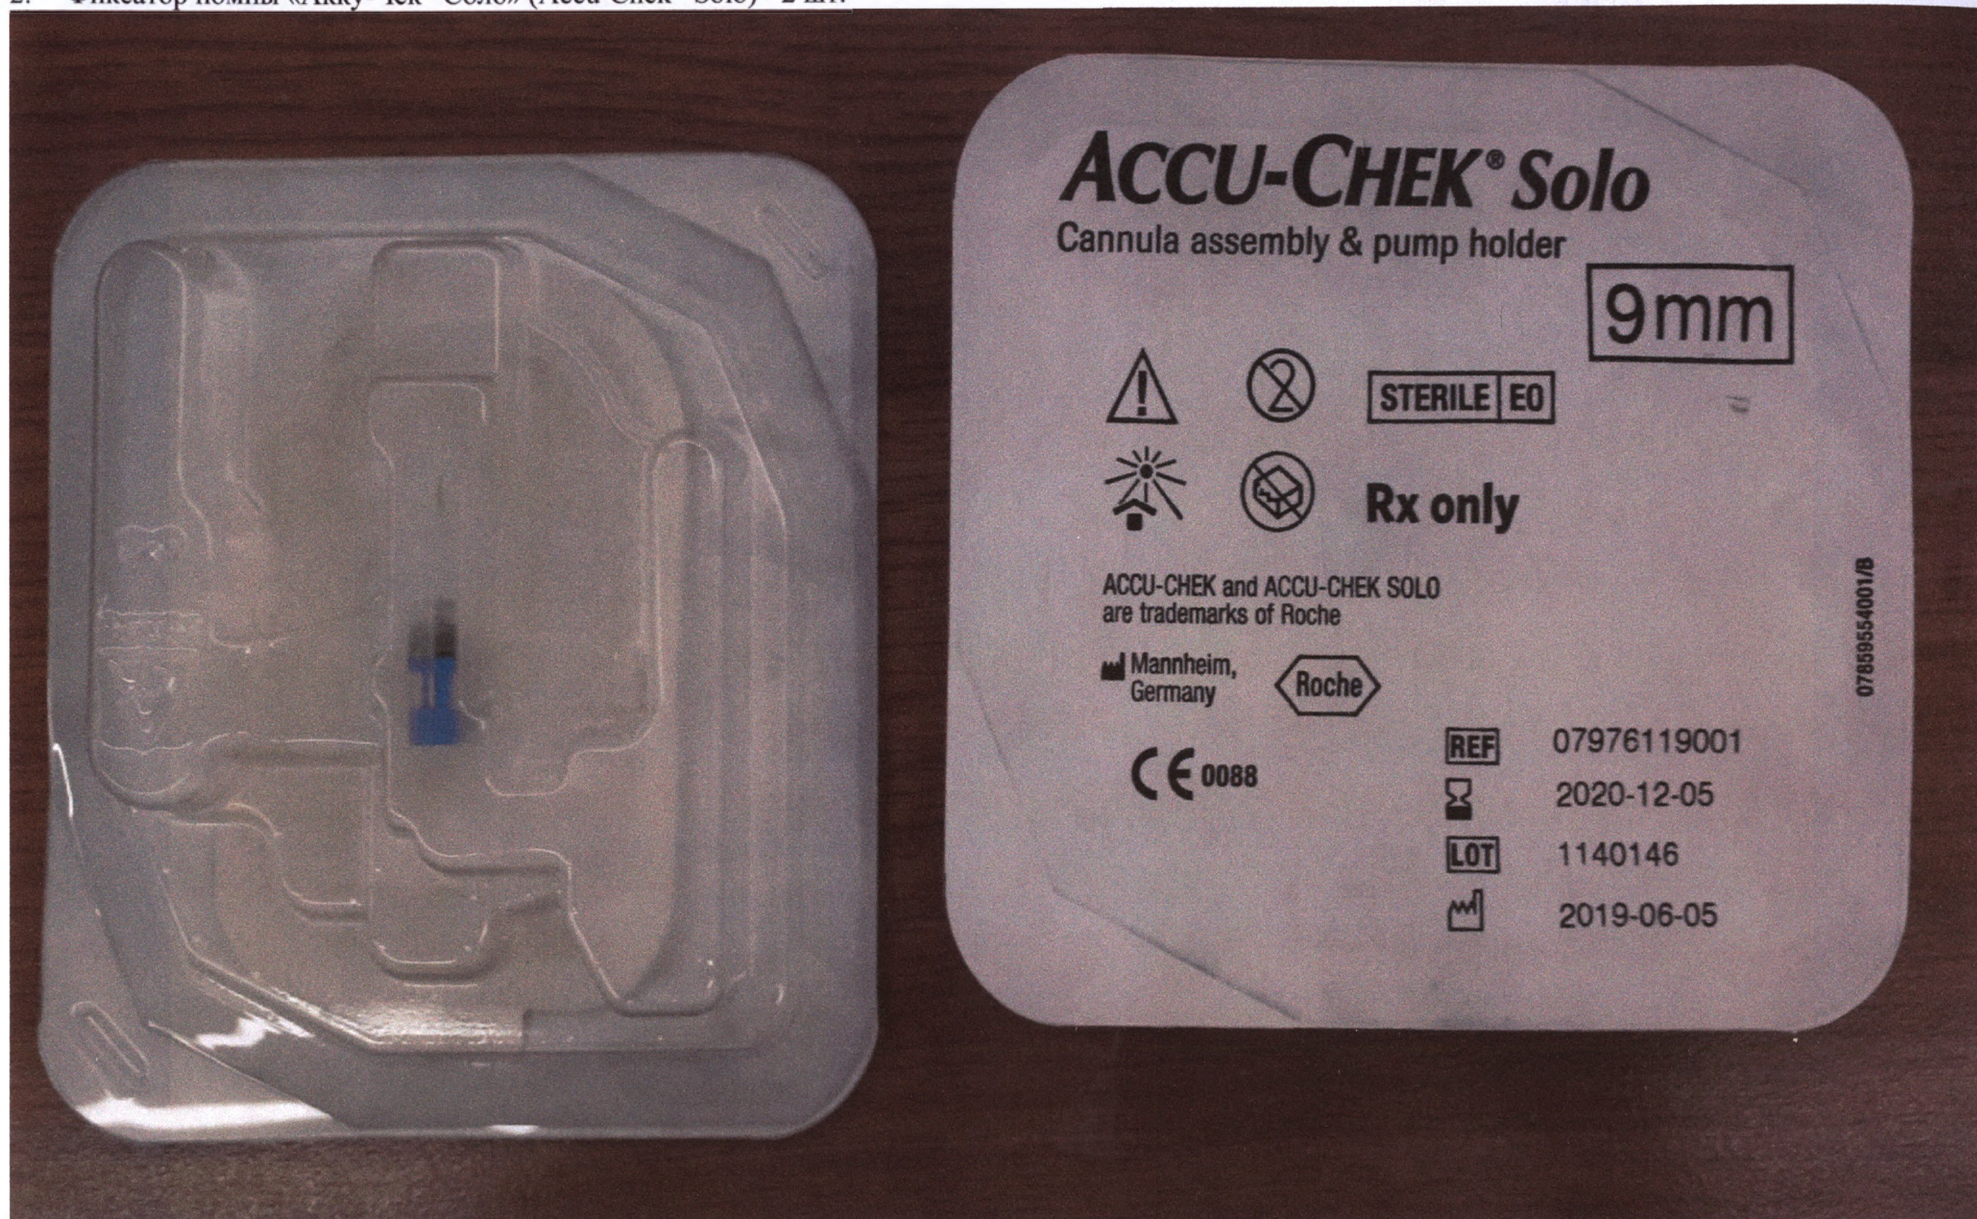

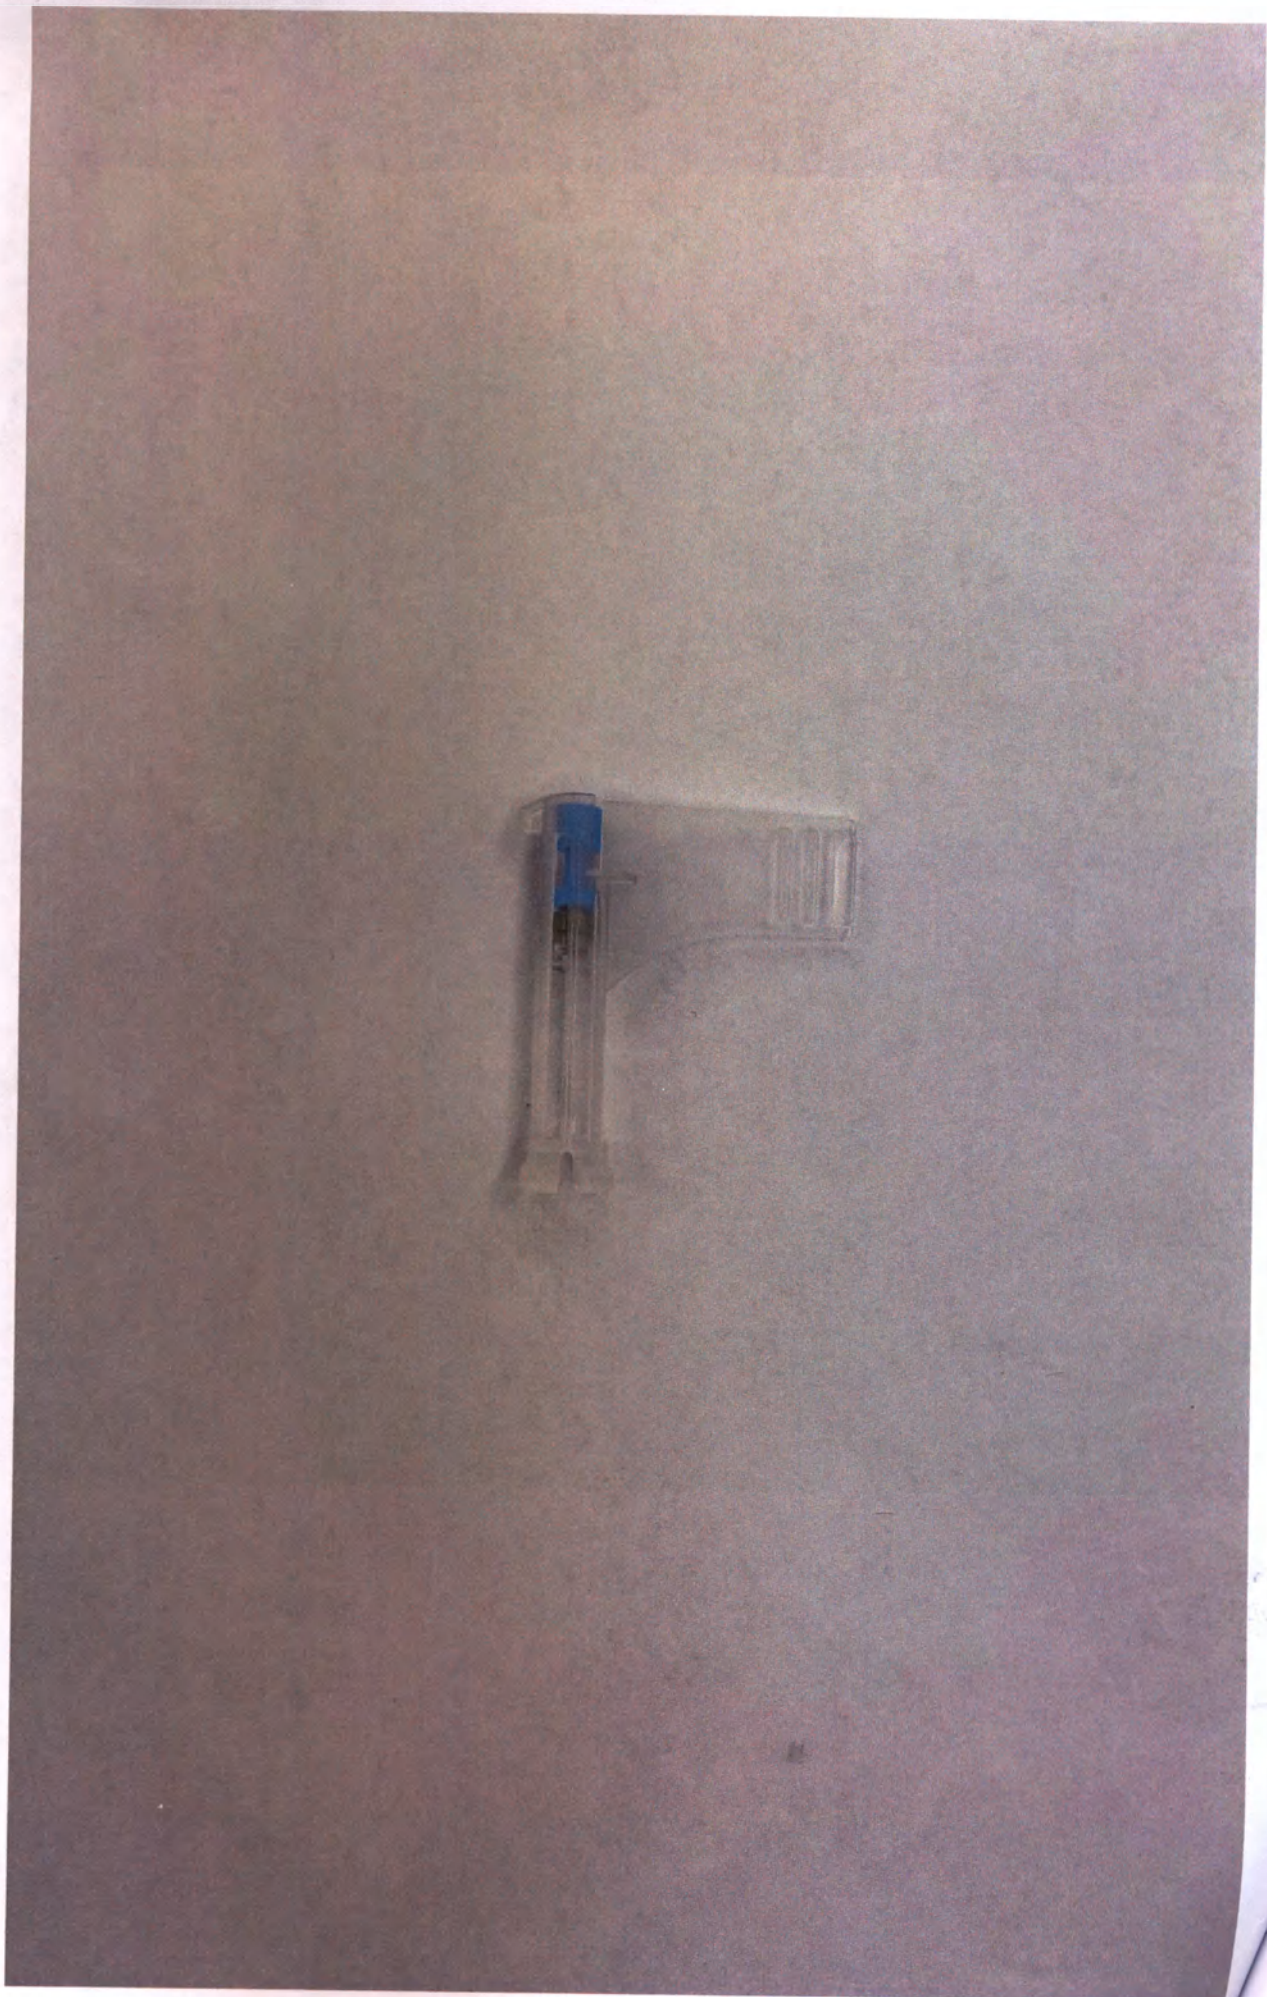



3. Модуль резервуара «Акку-Чек® Соло» (Accu-Chek® Solo) - 2 шт.

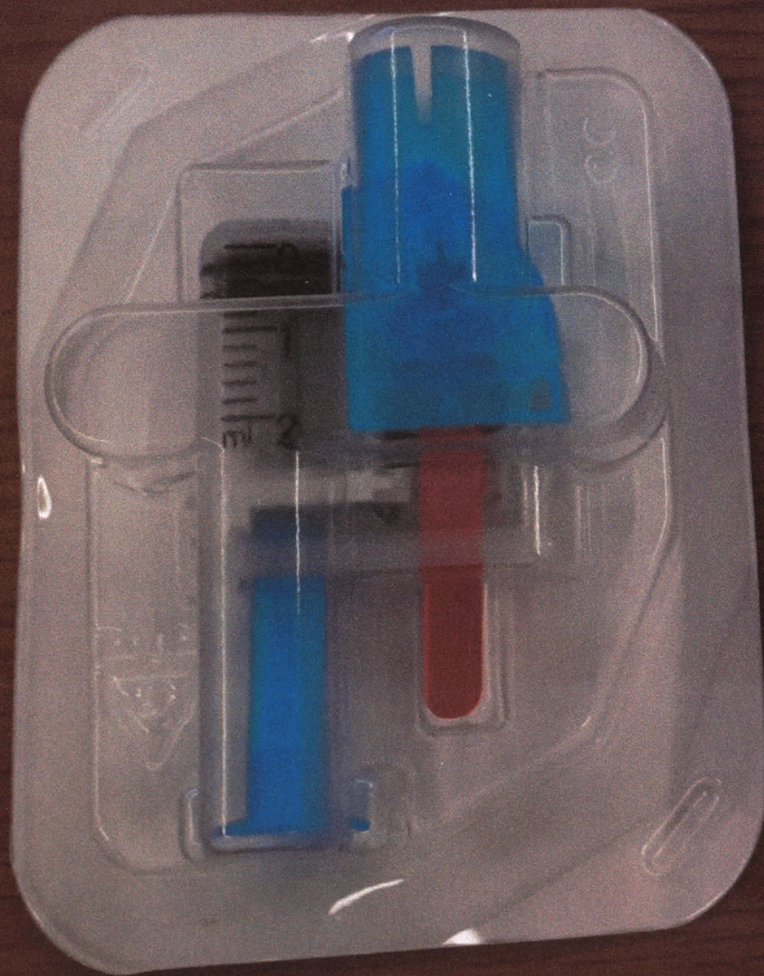

ACCU-CHEK® Solo
Reservoir

REF 07976089001



STERILE EO



Rx only

ACCU-CHEK and ACCU-CHEK SOLO are trademarks of Roche

Mannheim,
Germany



CE 0088



2021-01-09

LOT


1141002



2019-07-09

07959562001/C



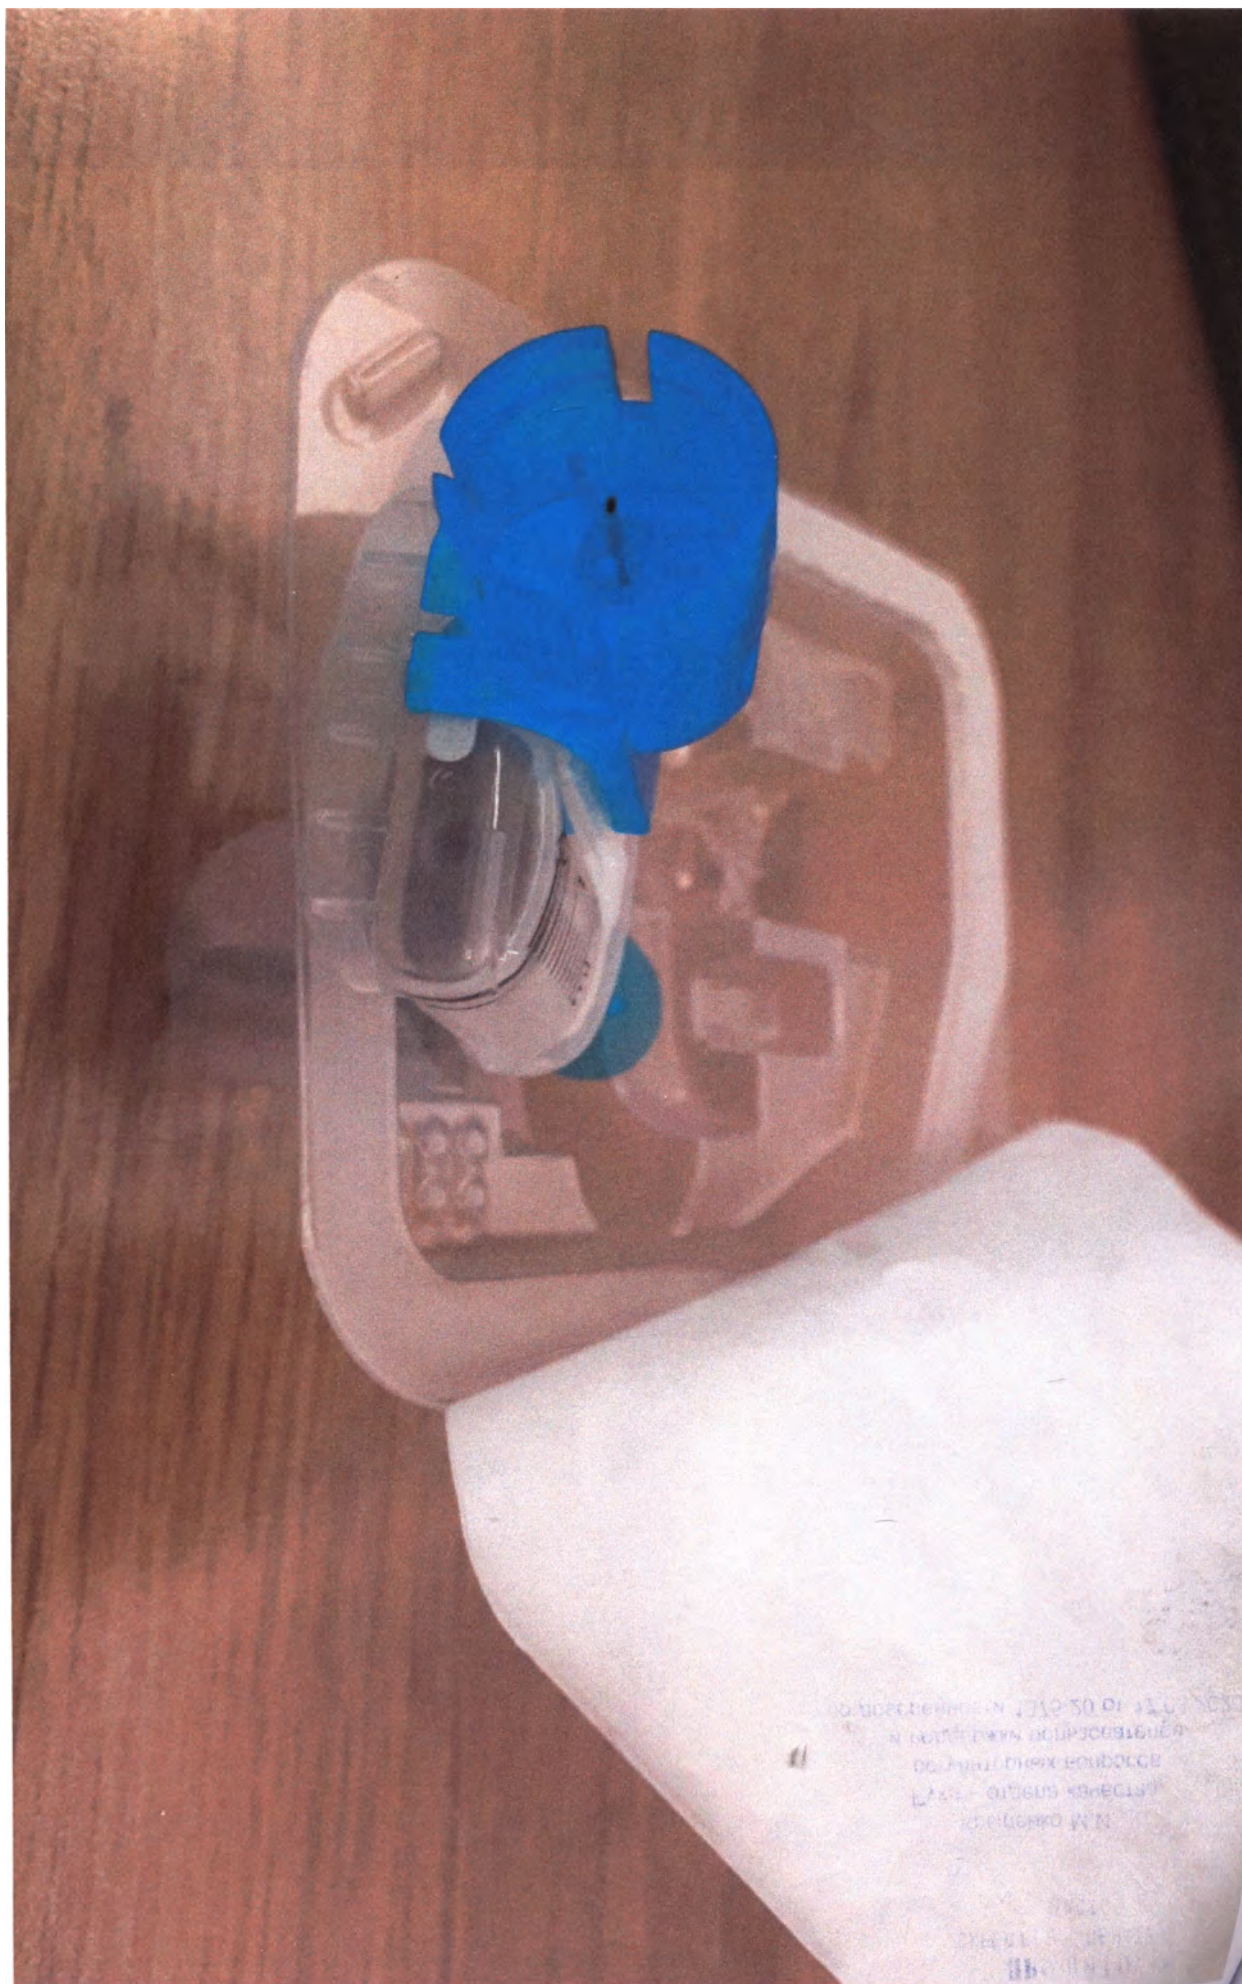



Крыленко М.И.
Рук-ль отдела качества
регуляторных вопросов
и поддержки пользователей
по доверенности 1375-20 от 17.08.2020



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Рош Диабетес Кеа Рус»

Карпухин В.В.

«12» июля 2021 г.

Руководитель отдела качества,
регуляторных вопросов
и поддержки пользователей
по доверенности 1375-20 от 17.08.2020

**МАКЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКИ, БЛИСТЕРА
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКИ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ УПАКОВКУ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Набор для введения инсулина «Акку-Чек® Соло» (Accu-Chek® Solo)
в различных вариантах исполнения

Макет потребительской упаковки
Набор для введения инсулина «Акку-Чек® Соло» (Accu-Chek® Solo), 6 мм





Roche

07858728001/C

183x057x099 A

markings

MD



CE 0123 Rx only 

ACCU-CHEK and ACCU-CHEK SOLO are trademarks of Roche.

© 2019 Roche Diabetes Care




Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com

DLF


ACCU-CHEK® Solo

Supply kit

6 mm

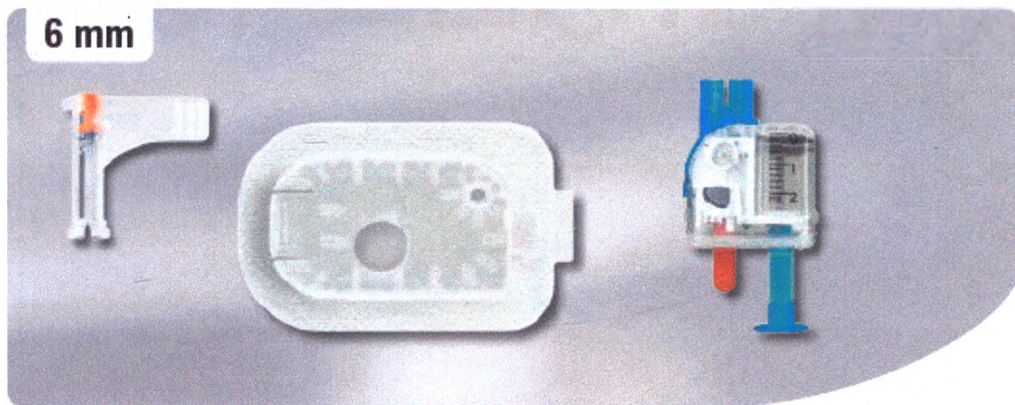

Roche

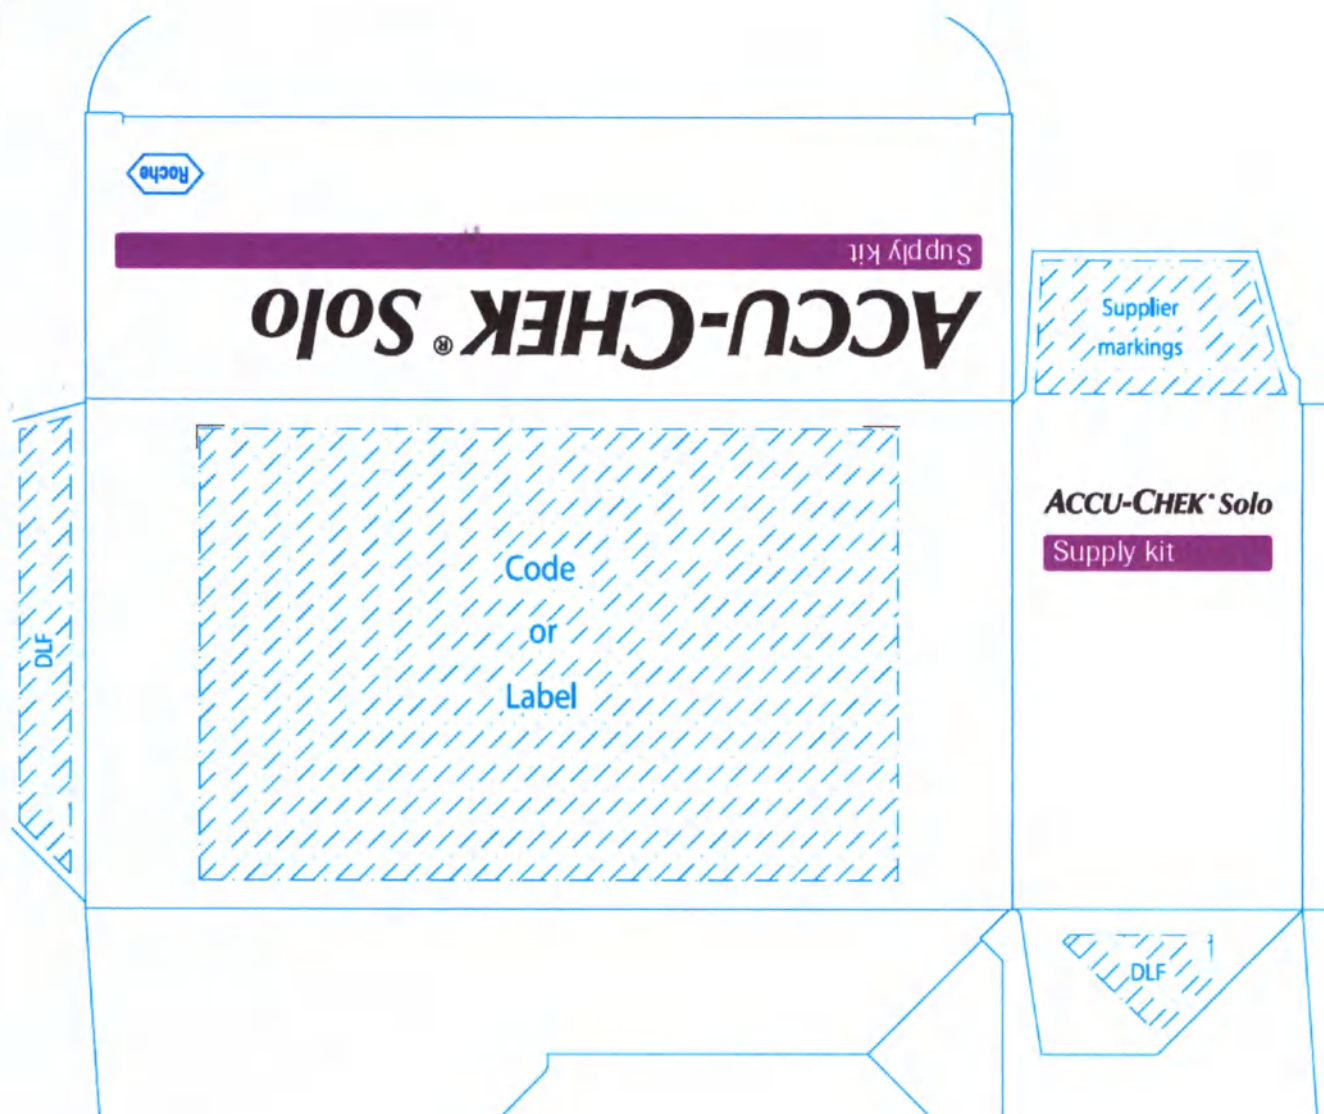

ACCU-CHEK® Solo supply kit

6mm

07860676001/G

Supply kit / Verbrauchsset / Kit de consommables / Kit di materiali di consumo /
Kit de consumibles / Kit de consumíveis / Kit de insumos / Toebehorensset / Tilbehørskit /
Tilbehørssett / Tillbehörskit / Tarvikepakkaus / Πακέτο αναλωσίμων / Zestaw produktów
wymennych / Sada spotřebního materiálu / Súprava spotrebných častí / Egyszerhasználatos
készlet / Komplet s potrošnim materialom / набор для введения инсулина / 消费品套装 /
軟管組件 / 消耗品セット / 소모품 키트 / ชุดอุปกรณ์ที่ใช้แล้วทิ้ง / Kit bekalan / علبة المستلزمات

REF 1111111111


LOT 1234567890

2020-04-03



UDI

(01)12345678901114(17)190403(10)1234567890= Beispiel

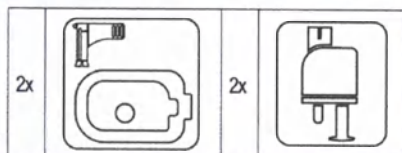

Made in: Finland

Version RO

EAN13

90 x 140 Var. B



INFO UDI-content:

GTIN = (01)

Expiry date - (17)

LOT (Charge) - (10)

Набор для введения инсулина «Акку-Чек® Соло» (Accu-Chek® Solo), 9 мм






Roche

0785888001/C

183x057x099 A

markings

MD



CE 0123 Rx only 

ACCU-CHEK and ACCU-CHEK SOLO are trademarks of Roche.

© 2019 Roche Diabetes Care




Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-check.com

DLF


ACCU-CHEK® Solo

Supply kit

9 mm

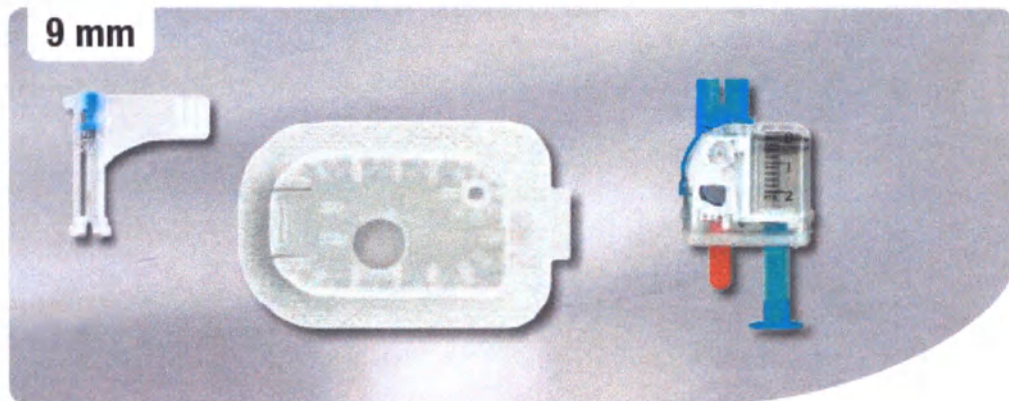

Roche

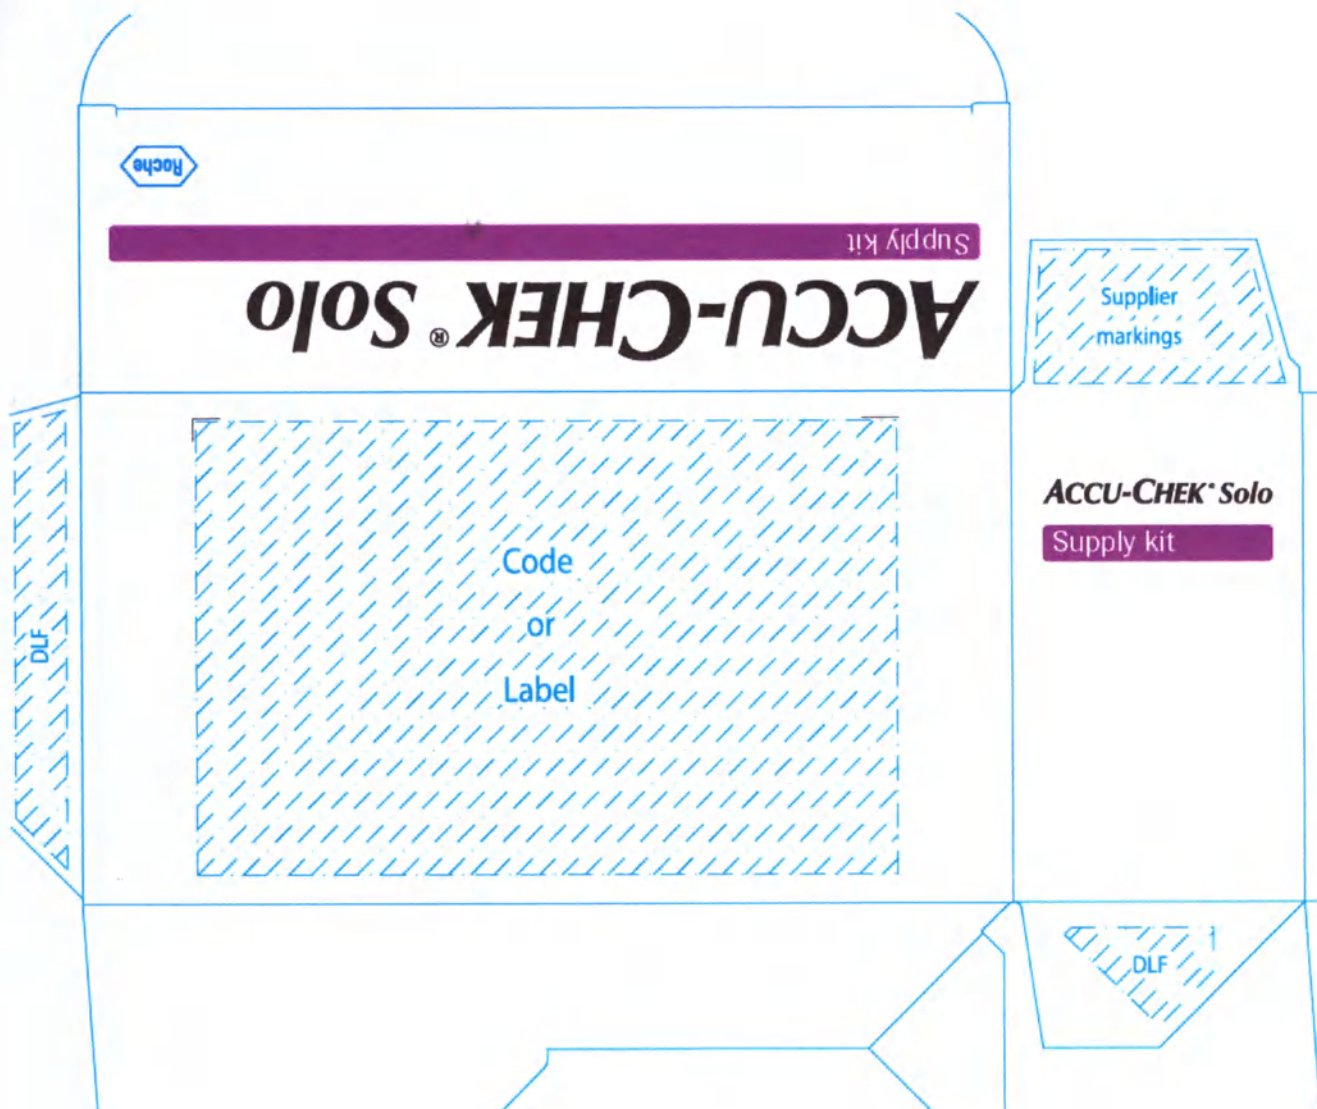

ACCU-CHEK® Solo supply kit

9 mm

07860676001/G

Supply kit / Verbrauchsset / Kit de consommables / Kit di materiali di consumo /
Kit de consumibles / Kit de consumíveis / Kit de insumos / Toebehorensset / Tilbehørskit /
Tilbehørssett / Tillbehörskit / Tarvikepakkaus / Πακέτο αναλωσίμων / Zestaw produktów
wymennych / Sada spotřebního materiálu / Súprava spotrebných častí / Egyszerhasználatos
készlet / Komplet s potrošnim materialom / набор для введения инсулина / 消费品套装 /
軟管組件 / 消耗品セット / 소모품 키트 / ชุดอุปกรณ์ที่ใช้แล้วทิ้ง / Kit bekalen / علبة المستلزمات

REF 111111111


LOT 1234567890

2020-04-03



UDI

(01)12345678901114(17)190403(10)1234567890= Beispiel

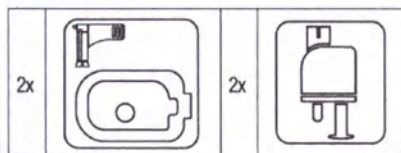

Made in: Finland

Version R0

EAN13

90 x 140 Var. B



INFO UDI-content:

GTIN = (01)

Expiry date - (17)

LOT (Charge) - (10)

Макет блистера

ACCU-CHEK® Solo

Cannula assembly & pump holder



STERILE EO

00 mm



Rx only

ACCU-CHEK and ACCU-CHEK SOLO are trademarks of Roche.

In US, distributed by:

Roche Diabetes Care, Inc.
Indianapolis, IN 46256, USA
Toll Free: 1-800-280-7801

 Mannheim,
Germany

Roche

CE 0123

REF 00000000

LOT 00000000

YYYY-MM-DD

YYYY-MM-DD

0785955400170

ACCU-CHEK® Solo

Reservoir assembly

REF 07976089001



STERILE EO



Rx only

ACCU-CHEK and ACCU-CHEK SOLO
are trademarks of Roche.

In US, distributed by:

Roche Diabetes Care, Inc.
Indianapolis, IN 46256, **USA**
Toll Free: 1-800-280-7801

 Mannheim,
Germany



CE 0123

LOT 00000000



YYYY-MM-DD



YYYY-MM-DD

07 85 95 62 00 17 F

Макет дополнительной маркировки на потребительскую упаковку

**Набор для введения инсулина
«Акку-Чек® Соло» (Accu-Chek® Solo), 6 мм**

Комплектация:

Модуль канюли, длина канюли 6 мм – 2 шт.

Фиксатор помпы – 2 шт.,

Модуль резервуара – 2 шт.,

Инструкция по использованию – 4 шт.

Регистрационное удостоверение:

№ от

Производитель, изготовитель:

«Рош Диабетс Кеа Гмбх»,

Сандхофер, Штрассе 116, 68305, Мангейм, Германия;

Медисайз Континлахти, Медисайз Оу, Завод

Ламминти, Ламминти, 1, 80710, Лехмо, Финляндия

Сделано в Финляндии

Импортер, уполномоченная организация
(претензии):

ООО «Рош Диабетс Кеа Рус»,

107031, Россия, Москва, Трубная площадь, 2,

помещение I, комната 42Б

Телефон: 8-800-200-88-99

Апирогенно. Нетоксично

**Набор для введения инсулина
«Акку-Чек® Соло» (Accu-Chek® Solo), 9 мм**

Комплектация:

Модуль канюли, длина канюли 9 мм – 2 шт.

Фиксатор помпы – 2 шт.,

Модуль резервуара – 2 шт.,

Инструкция по использованию – 4 шт.

Регистрационное удостоверение:

№ от

Производитель, изготовитель:

«Рош Диабетс Кеа Гмбх»,

Сандхофер, Штрассе 116, 68305, Мангейм, Германия;

Медисайз Континлахти, Медисайз Оу, Завод

Ламминти, Ламминти, 1, 80710, Лехмо, Финляндия

Сделано в Финляндии

Импортер, уполномоченная организация
(претензии):

ООО «Рош Диабетс Кеа Рус»,

107031, Россия, Москва, Трубная площадь, 2,

помещение I, комната 42Б

Телефон: 8-800-200-88-99

Апирогенно. Нетоксично

ПРОШЕНО
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
ЛИСТОМ
ДИАБЕТЕС
КЕЧУС
Рук-л. отдела качества
регуляторных вопросов
и поддержки пользователей
по доверенности 1375-26 от 17.08.2020