

Фотографические изображения
медицинского изделия

Электроды для артроскопической, электрохирургической системы

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор


ООО «ИНТЕР»

Пудовкин К.А.

« 11 » марта 2021 г.



1. Электрод биполярный 30°. Потребительская упаковка (картонная коробка).

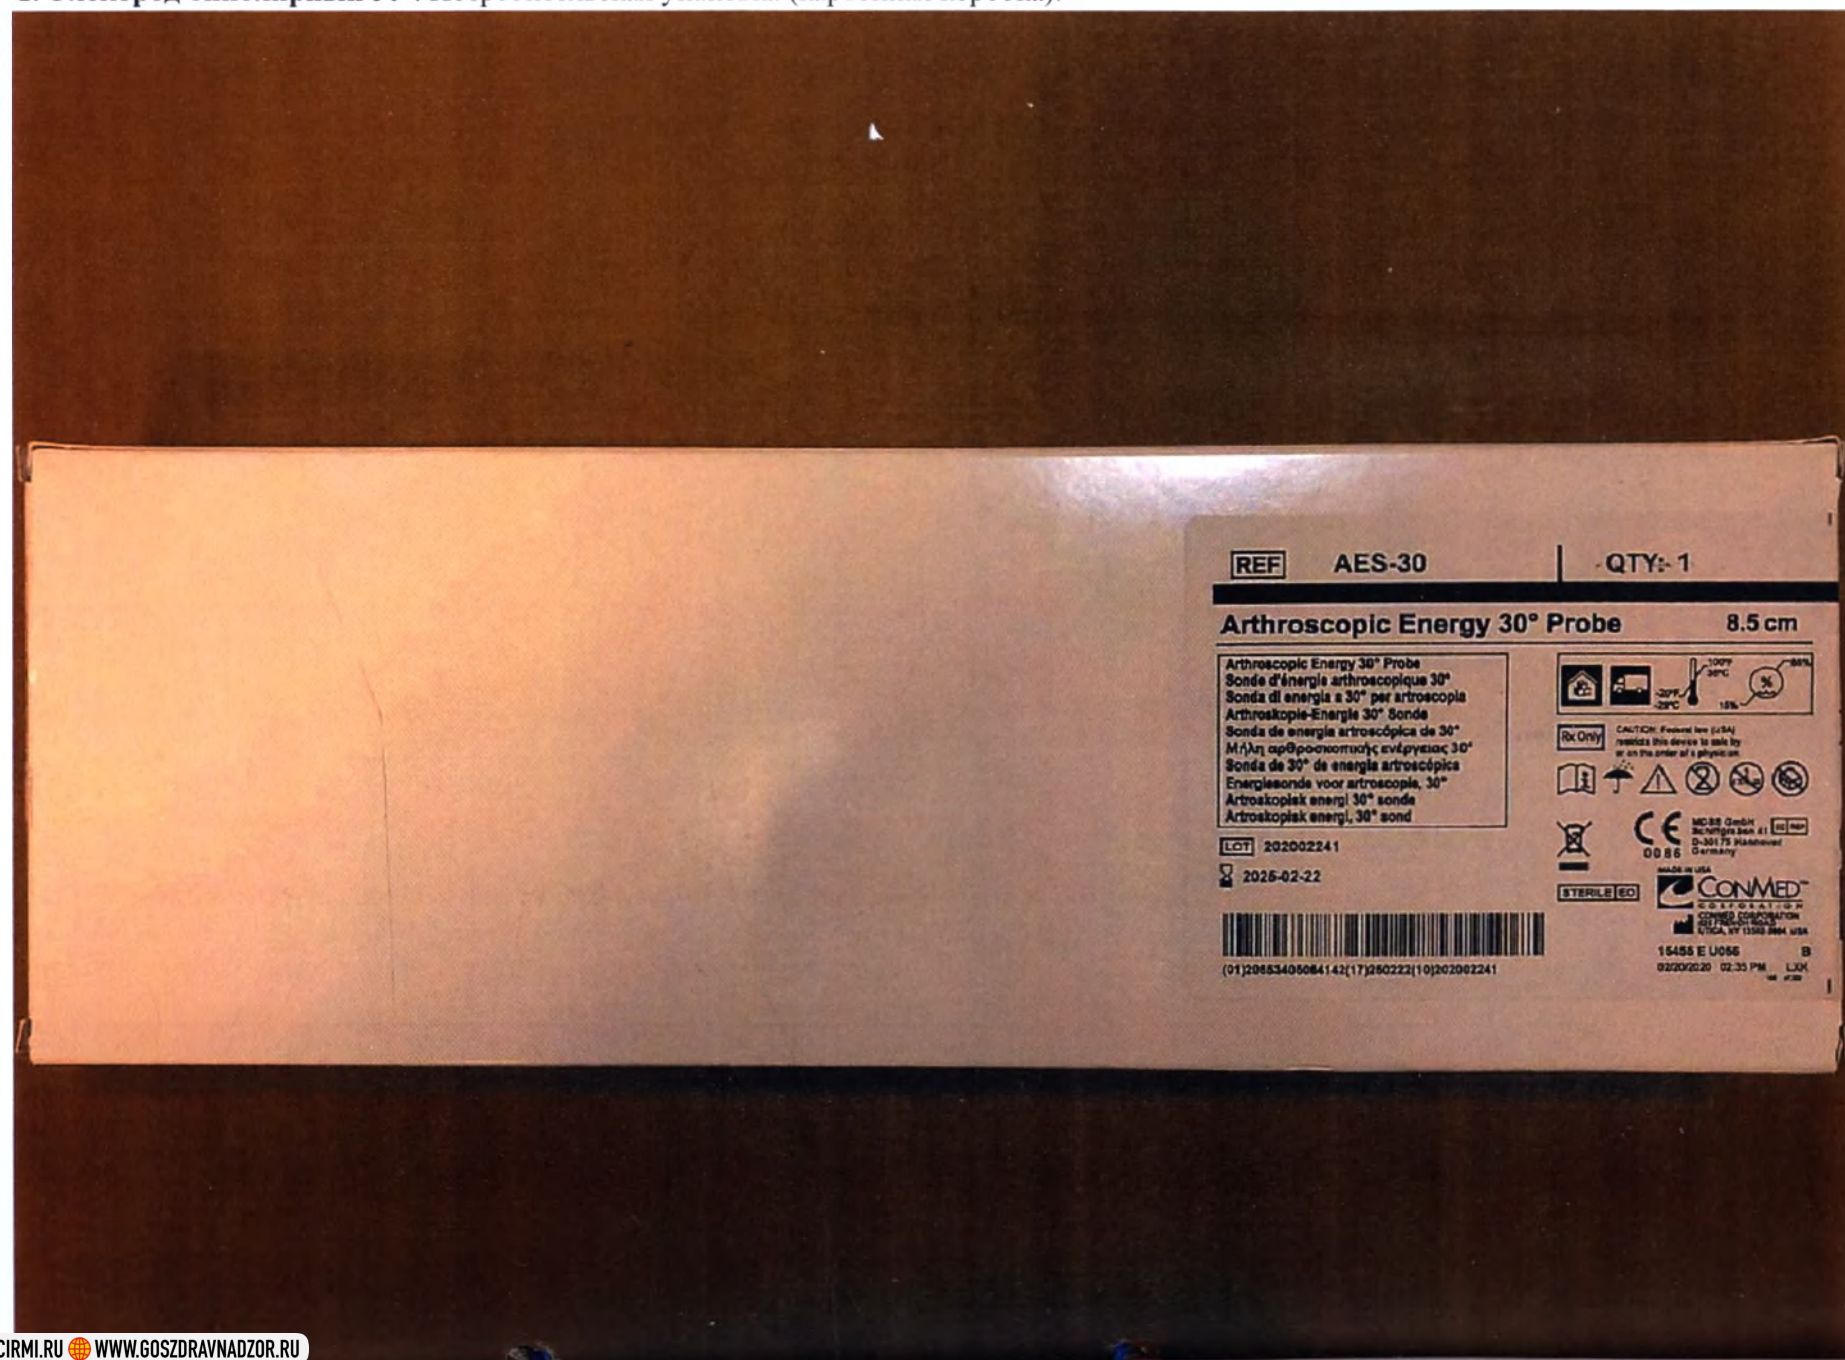

1. Электрод биполярный 30°. Индивидуальная упаковка (пакет).

REF	AES-30	QTY:	1
Artrosopic Energy 30° Probe Sonde d'énergie artrosopique 30° Sonda di energia a 30° per artroscopia Artroskopia-Energie 30° Sonde Sonda de energia artroscópica de 30° Μέλανη οπίσθια ενδοσκοπική 30° Sonda de 30° de energia artroscópica Energiesonde voor artroscopie, 30° Artroskopiiek energi 30° sonde Artroskopiiek energi, 30° sond			
			
(01)00653469064148(17)250222(1)0202002241			

LOT	202002241	2025-02-22
Rx Only	STERILE EO	CE
CAUTION: Federal law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician.		
MD 35 GmbH Schellstrasse 41 D-38175 Hannover Germany		
MADE IN USA CONMED CORPORATION 27177000000 01/1/2002 000 USA		
8.5 cm	16454 E U054	02/20/2020 01:32 PM
		B LKK


1. Электрод биполярный 30°. Индивидуальная упаковка (пакет).




1. Электрод биполярный 30°. Изделие вне упаковки.



1. Электрод биполярный 30°. Дистальный наконечник электрода.

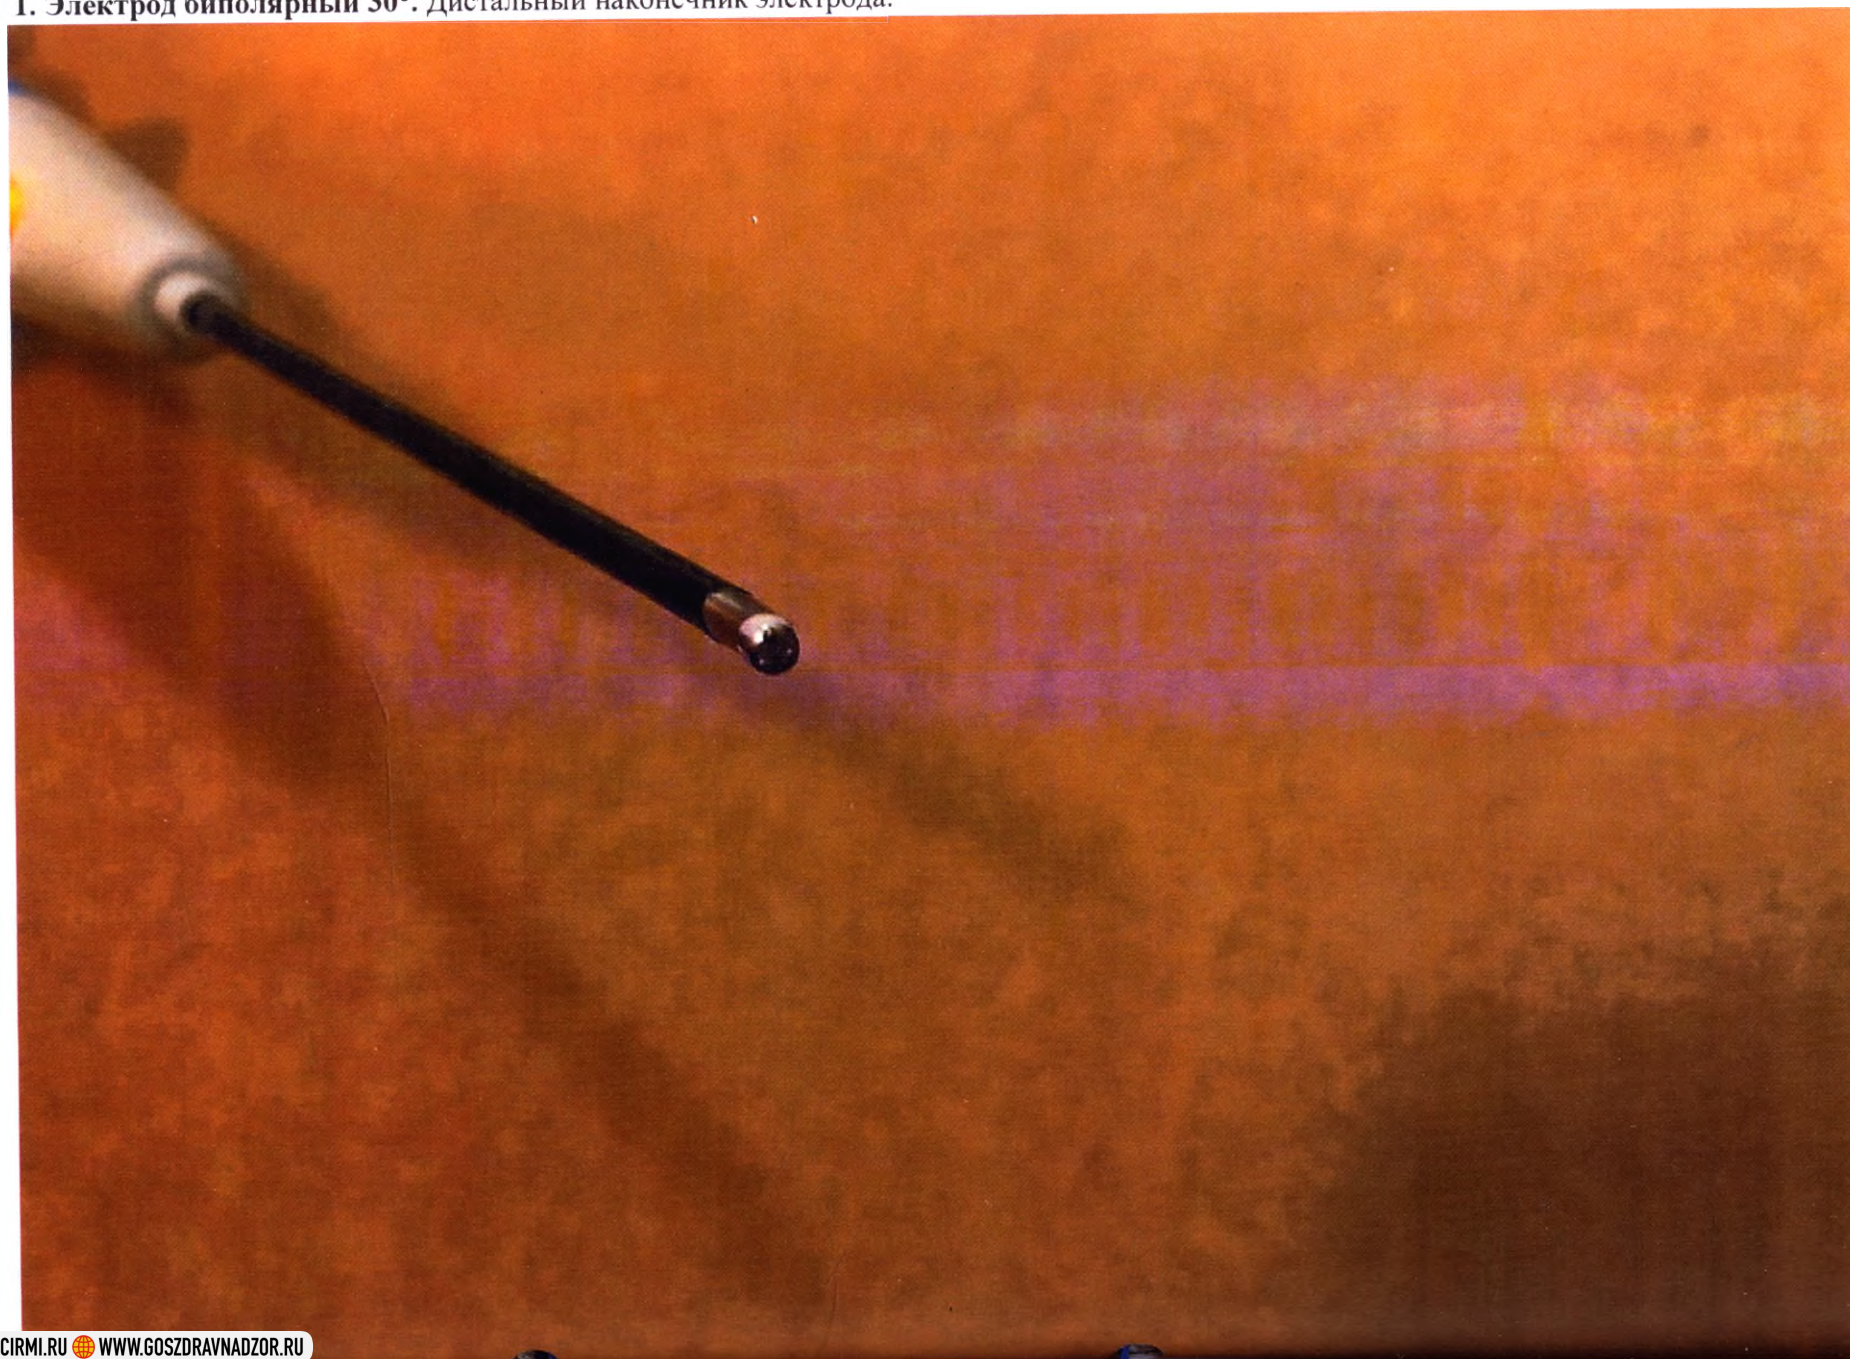

2. Электрод биполярный 50° с каналом для аспирации. Потребительская упаковка (картонная коробка).

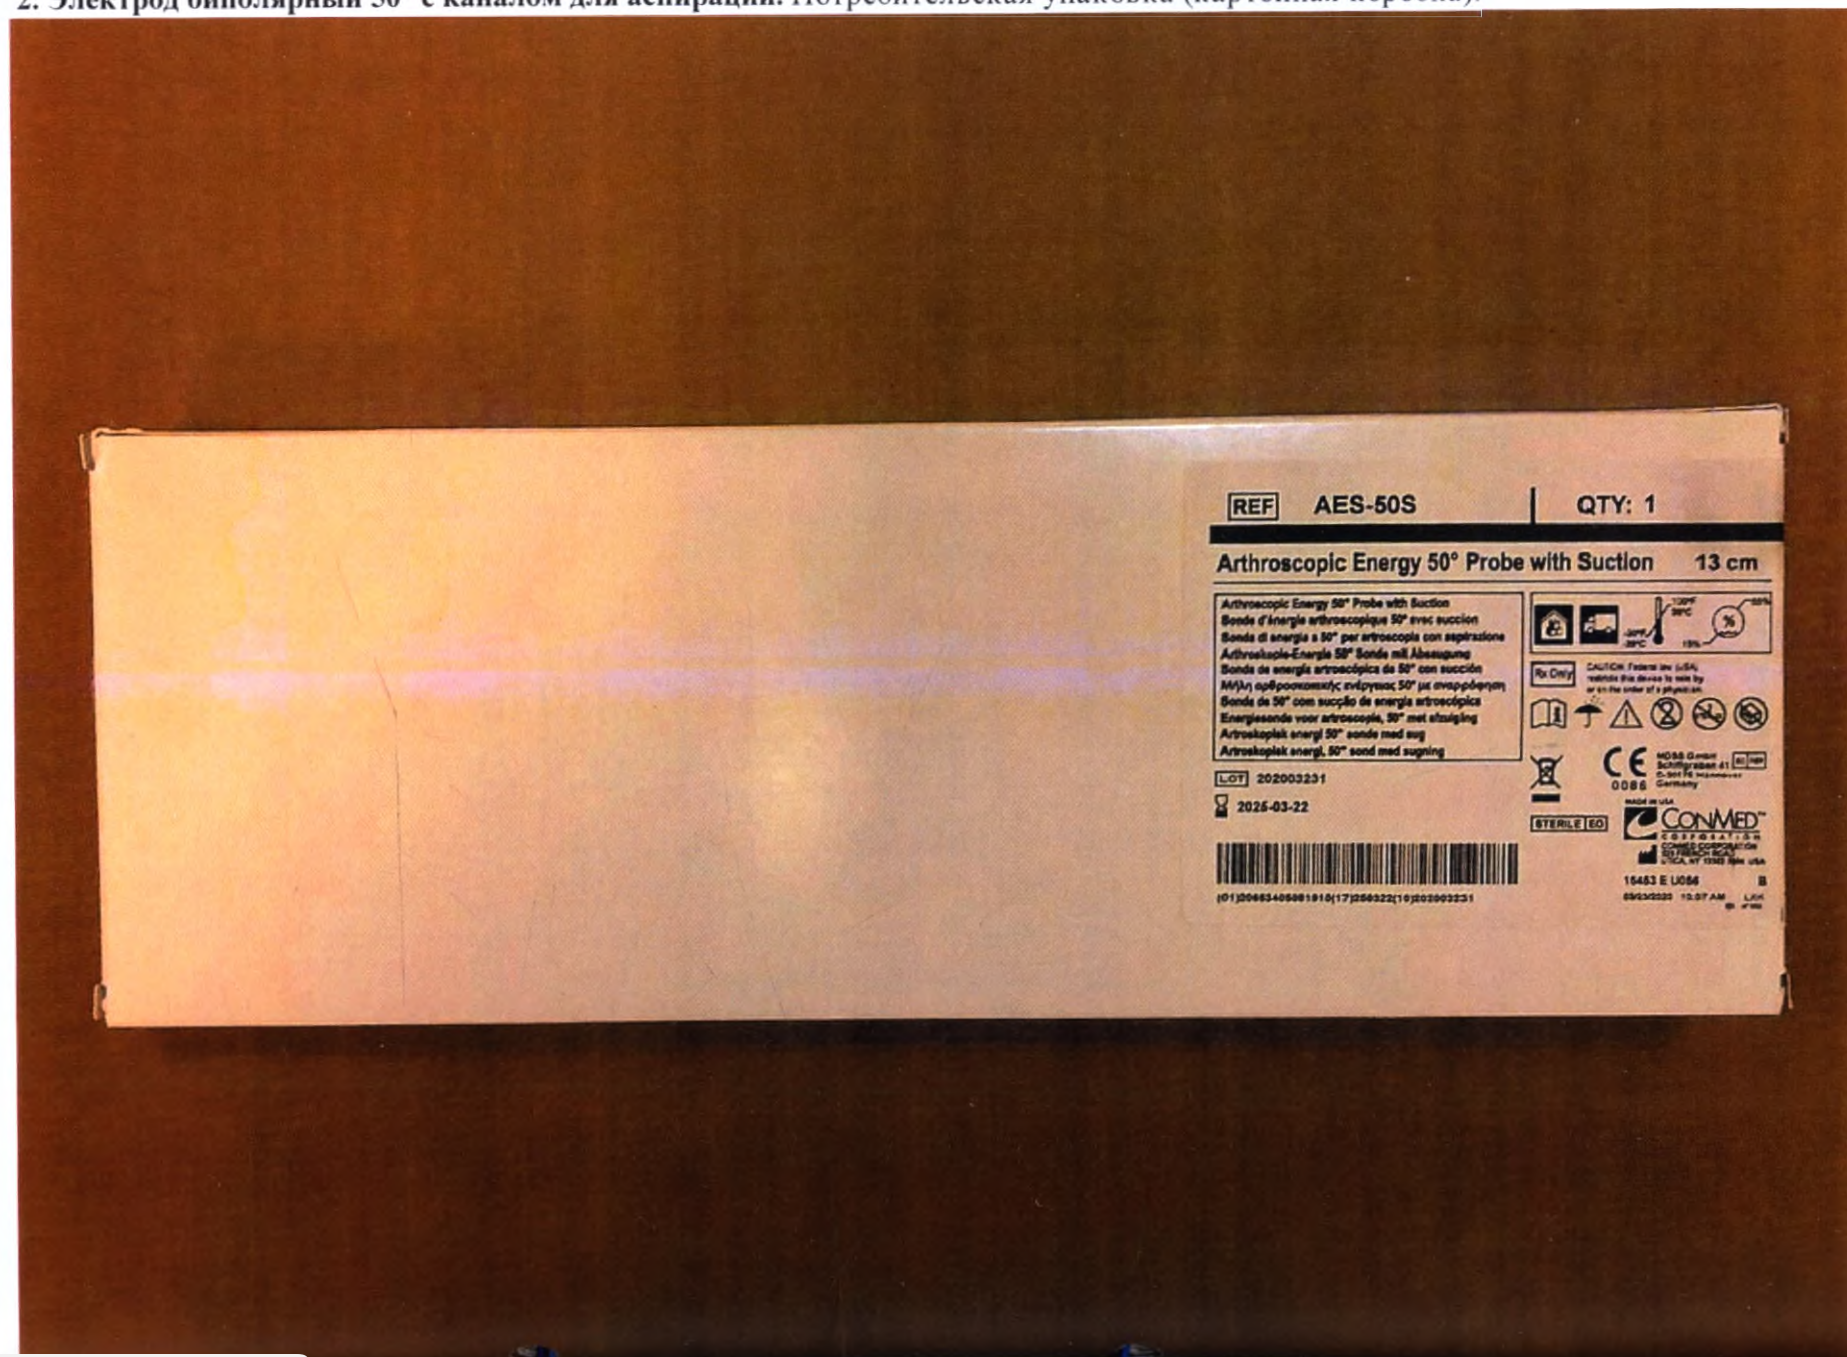

REF

AES-50S

QTY: 1

Arthroscopic Energy 50° Probe with Suction 13 cm

Arthroscopic Energy 50° Probe with Suction
 Sonda d'energia artroscopica 50° con aspirazione
 Sonda di energia a 50° per artroscopia con aspirazione
 Artroskopie-Energie 50° Sonda mit Absaugung
 Sonda de energia artroscópica de 50° con succión
 Műlyi artroskopikus energiás 50°-os szívócsővel
 Sonda de 50° con succión de energia artroscópica
 Energiesonde voor artroscopie, 50° met afzuiging
 Artroskopiek energij 50° sonde met suging
 Artroskopiek energij 50° sonde met suging

LOT 202003231

2025-03-22



1012046340508191017205032216202003231



Caution: Federal law (USA) prohibits the use of this device by untrained personnel.

CE MDSB GmbH
Schillingstrasse 41
08086
Germany

STERILE EO


CONMED CORPORATION
300 FRANKLIN BLVD
UTICA, NY 13501 USA15483 E U084
09/13/2021 15:07 AM LKH
01/10

2. Электрод биполярный 50° с каналом для аспирации. Индивидуальная упаковка (пакет).


2. Электрод биполярный 50° с каналом для аспирации. Индивидуальная упаковка (пакет).



2. Электрод биполярный 50° с каналом для аспирации. Изделие вне упаковки.

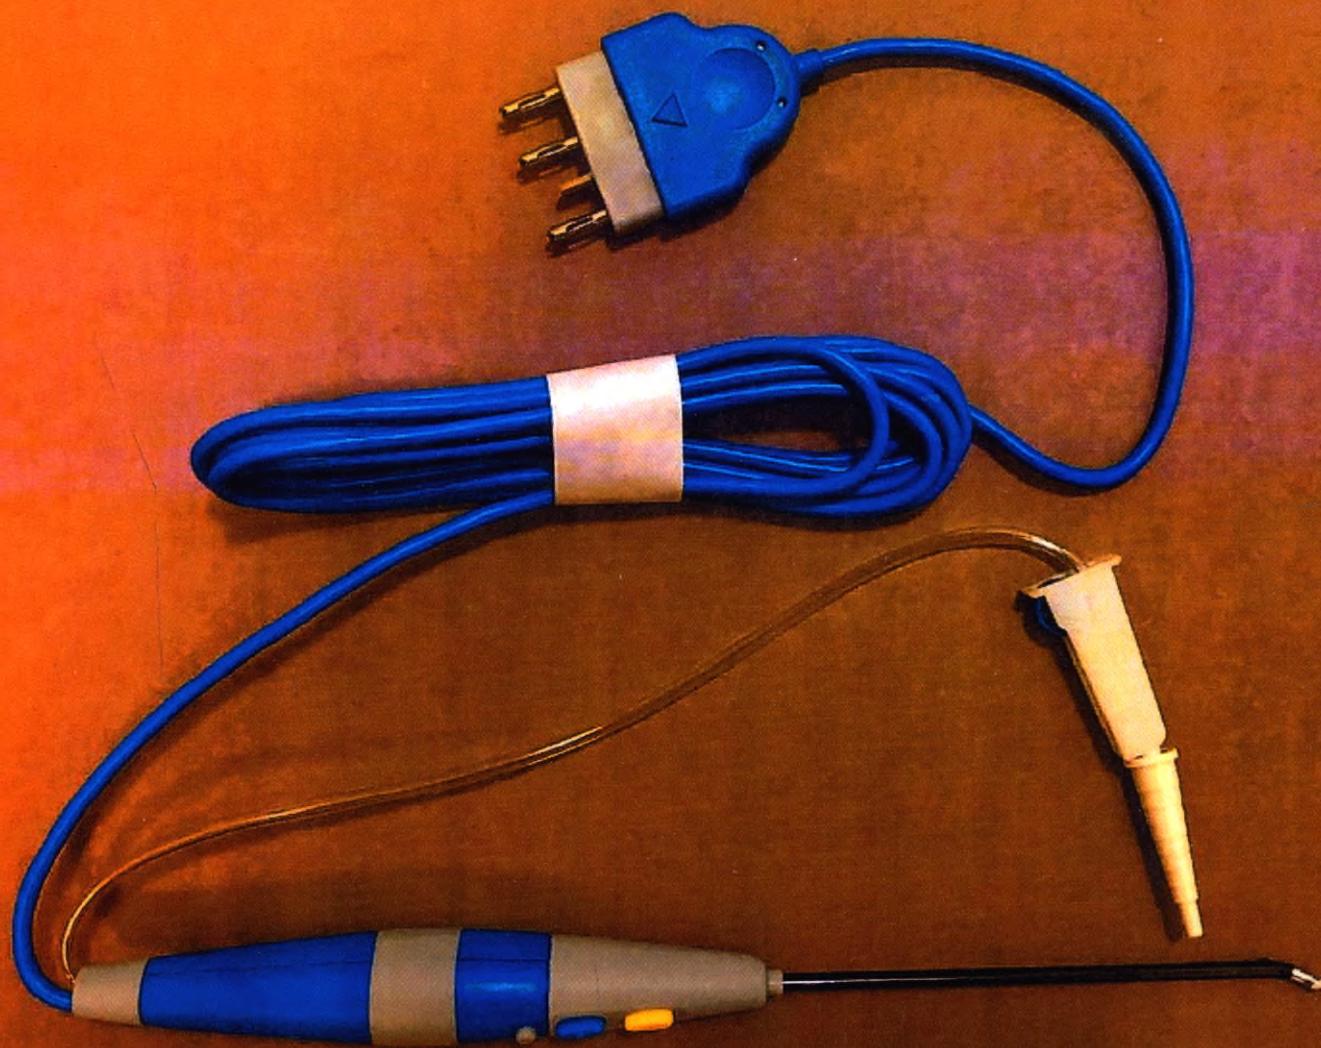

2. Электрод биполярный 50° с каналом для аспирации. Дистальный наконечник электрода.

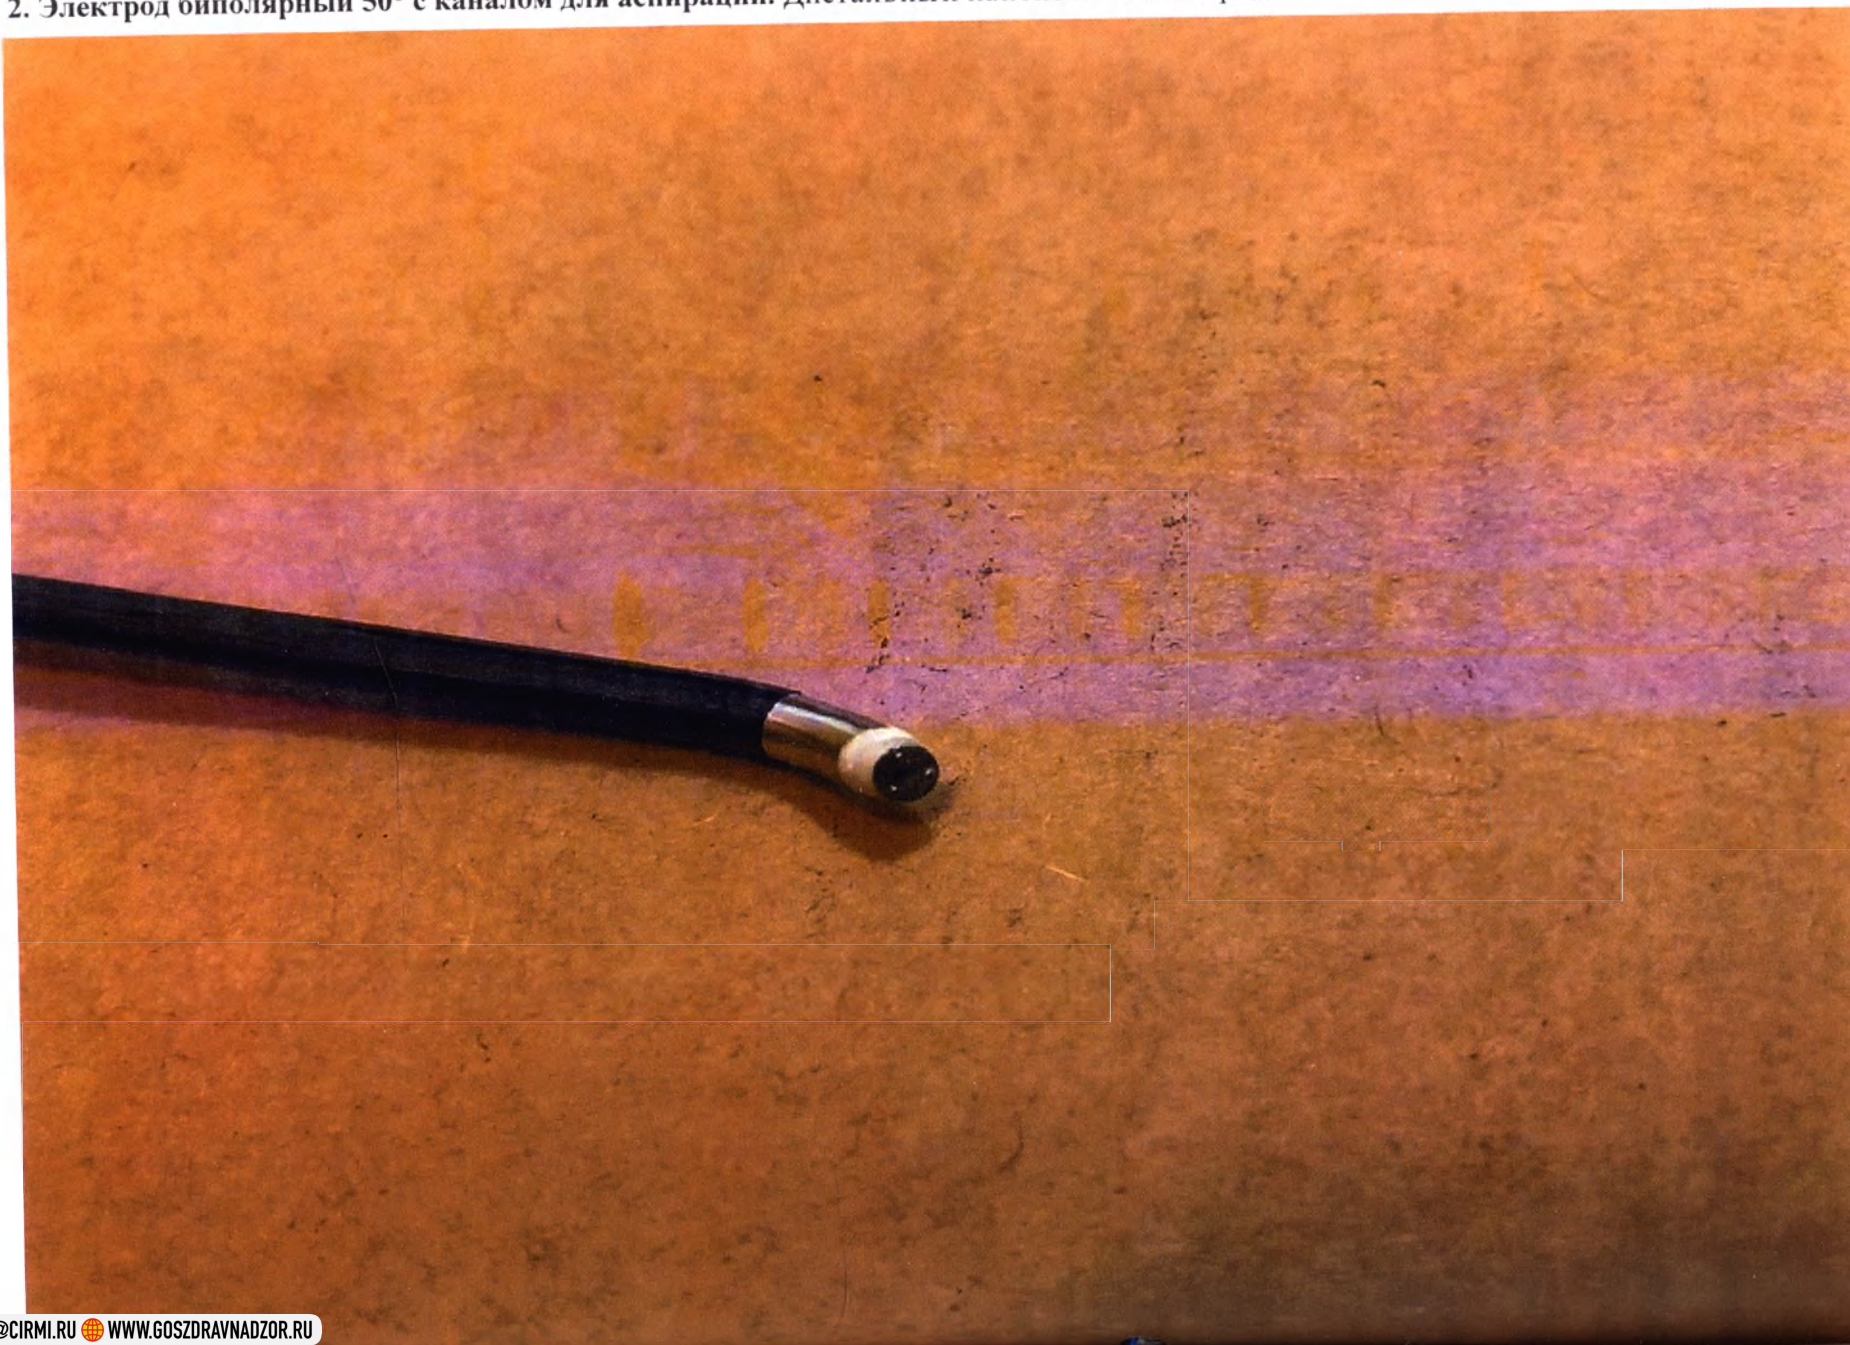


3. Электрод биполярный 90° с каналом для аспирации. Потребительская упаковка (картонная коробка).





3. Электрод биполярный 90° с каналом для аспирации. Индивидуальная упаковка (пакет).



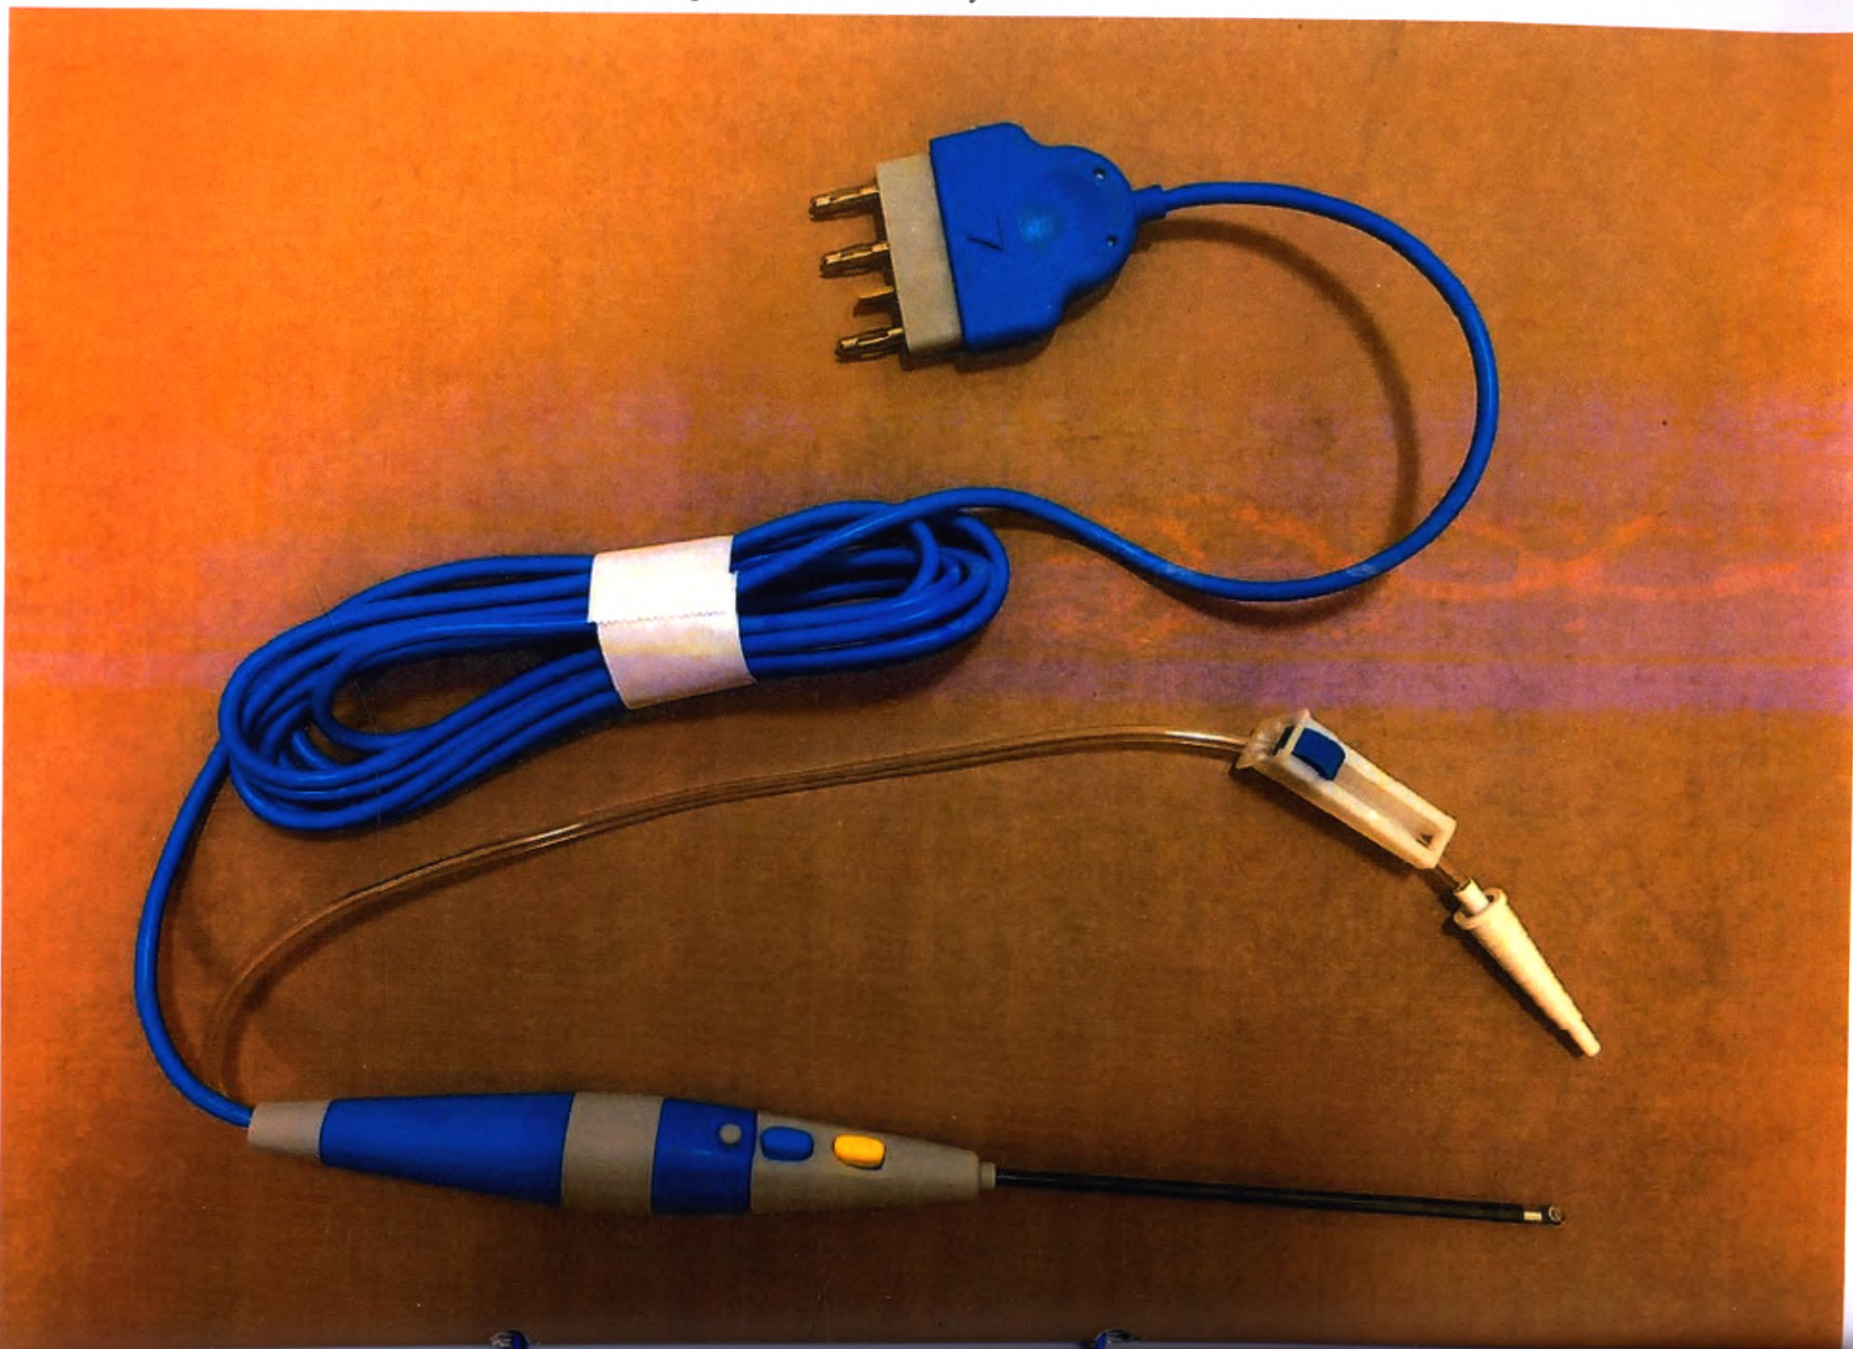


3. Электрод биполярный 90° с каналом для аспирации. Дистальный наконечник электрода.

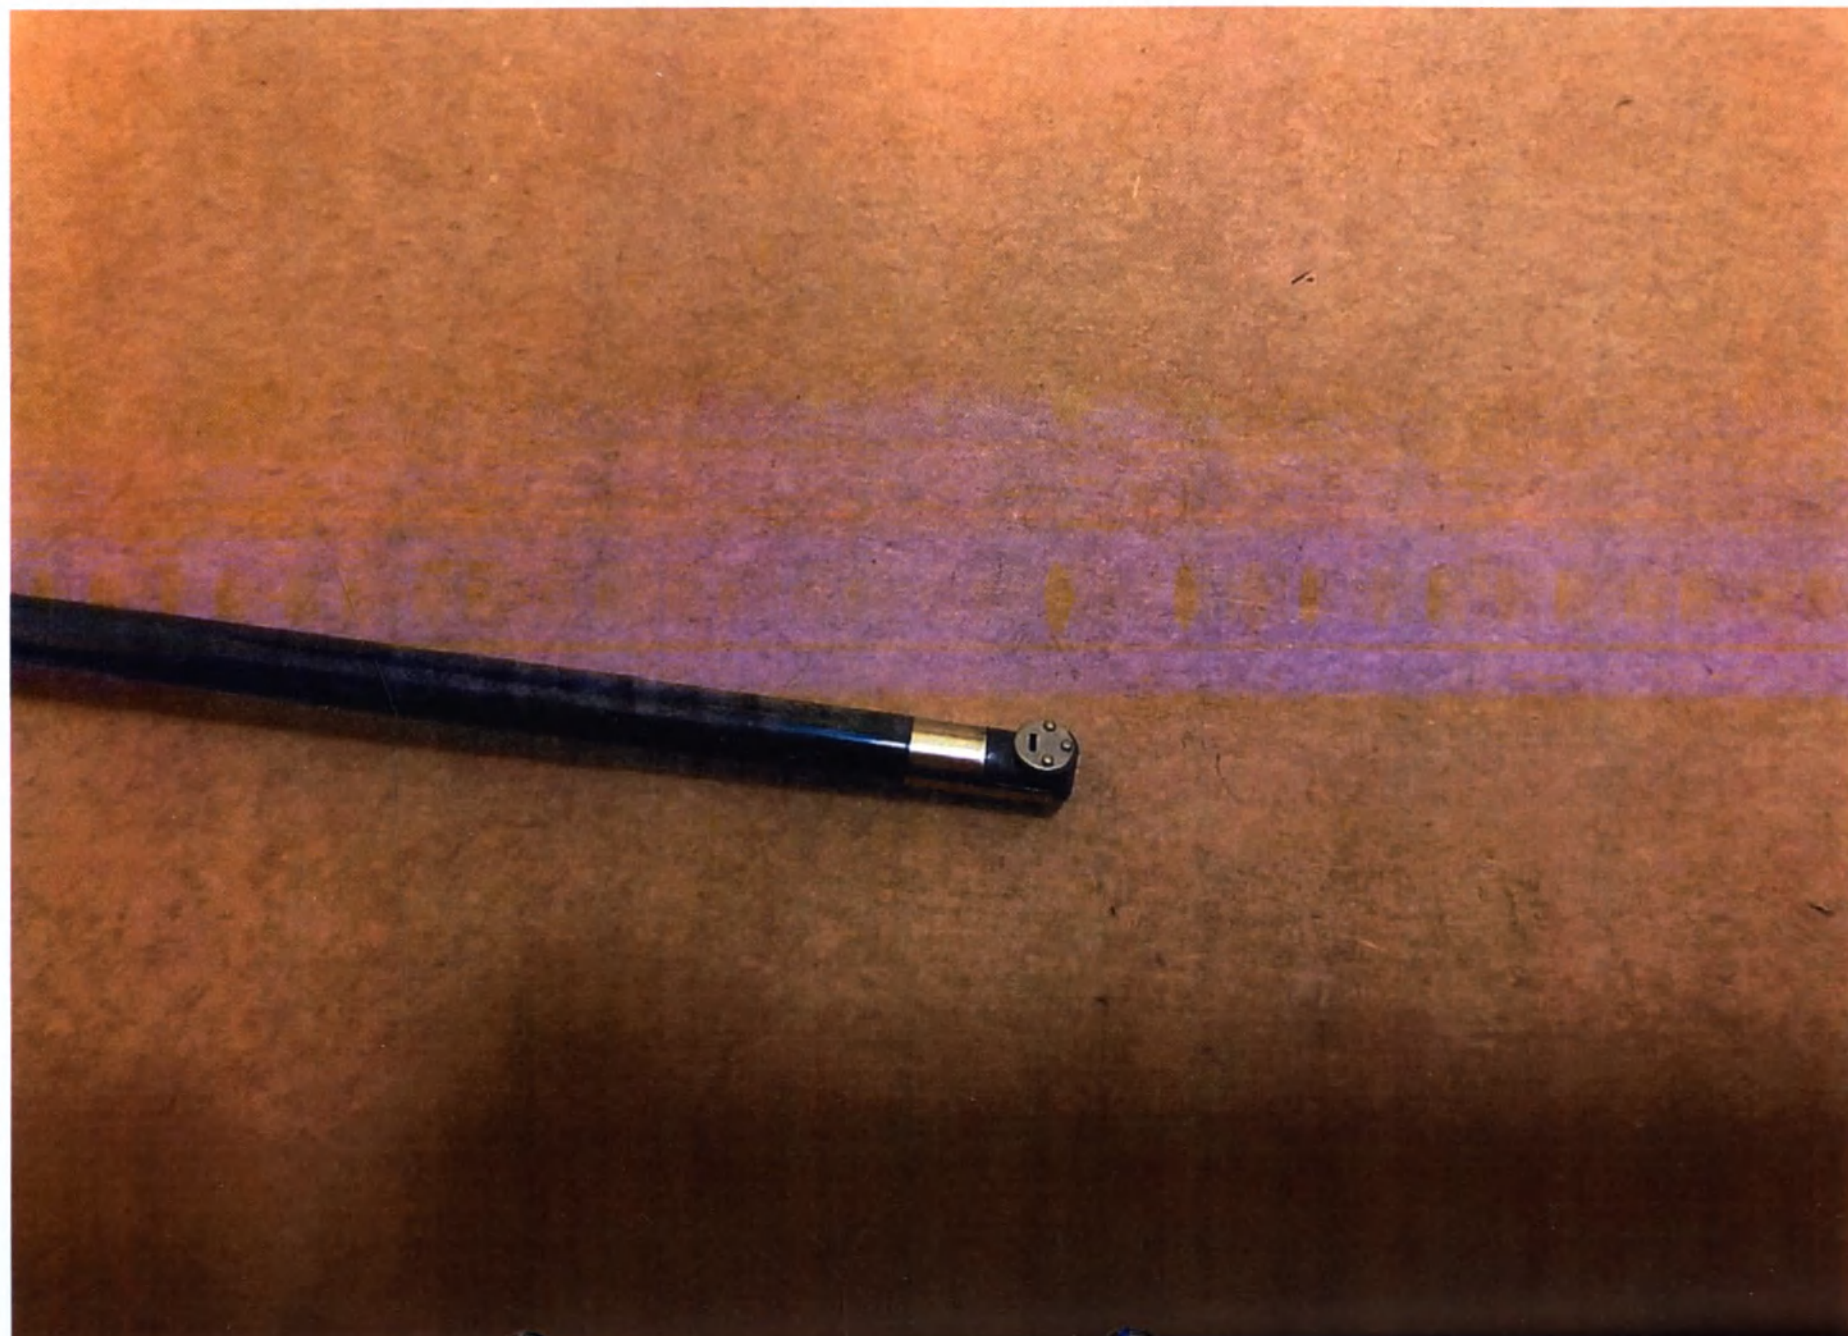


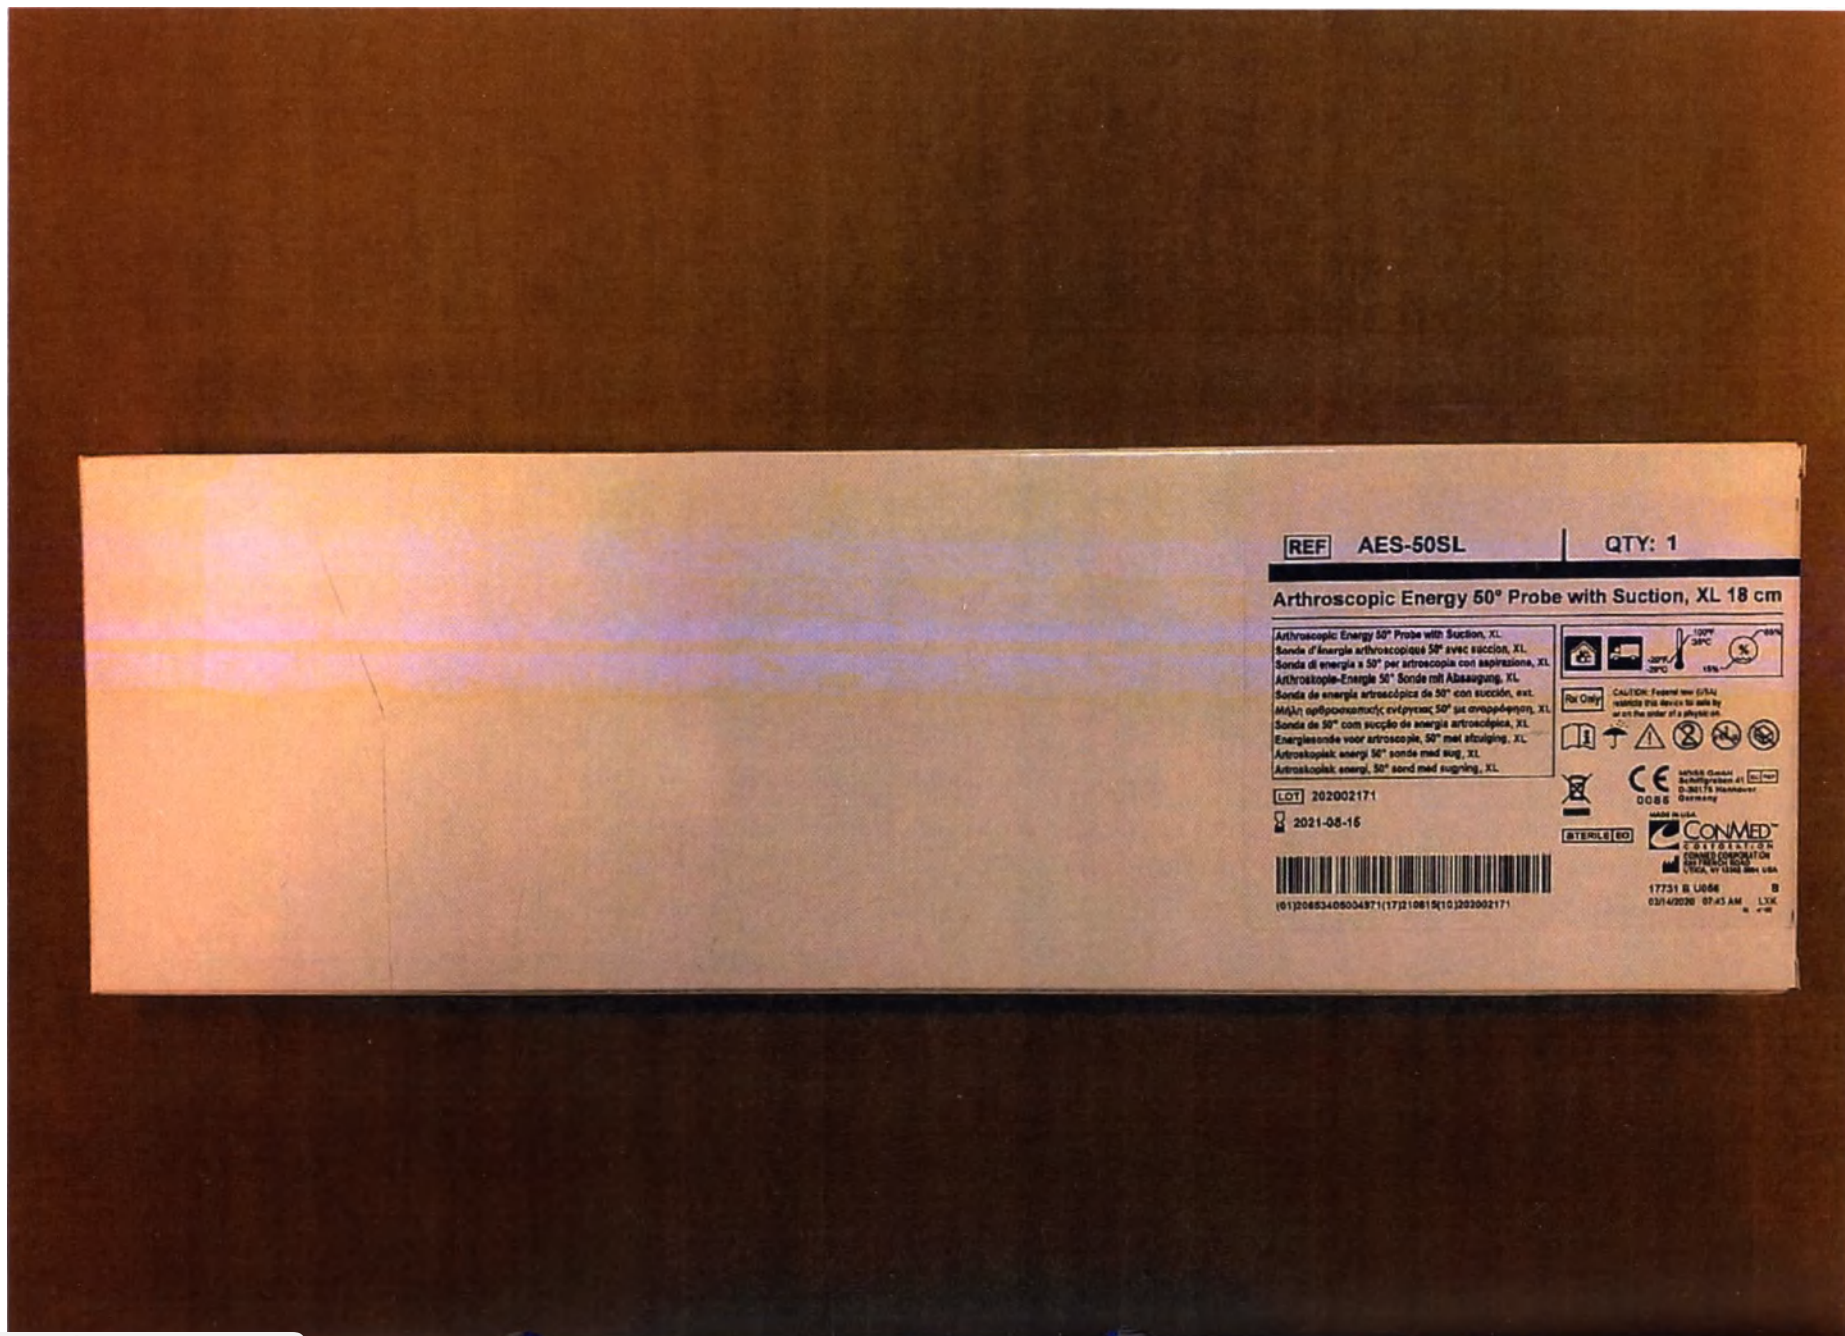


4. Электрод биполярный удлиненный 50° с каналом для аспирации. Индивидуальная упаковка (пакет).

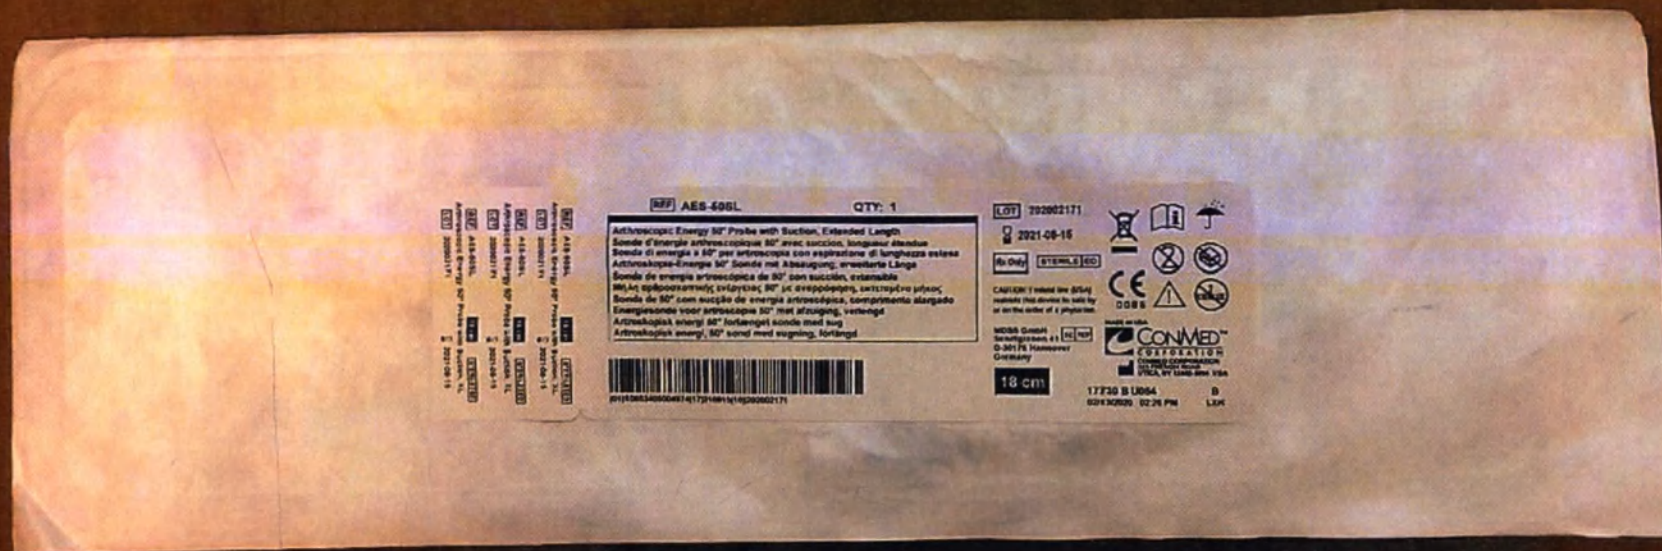


4. Электрод bipolarный удлиненный 50° с каналом для аспирации. Индивидуальная упаковка (пакет).

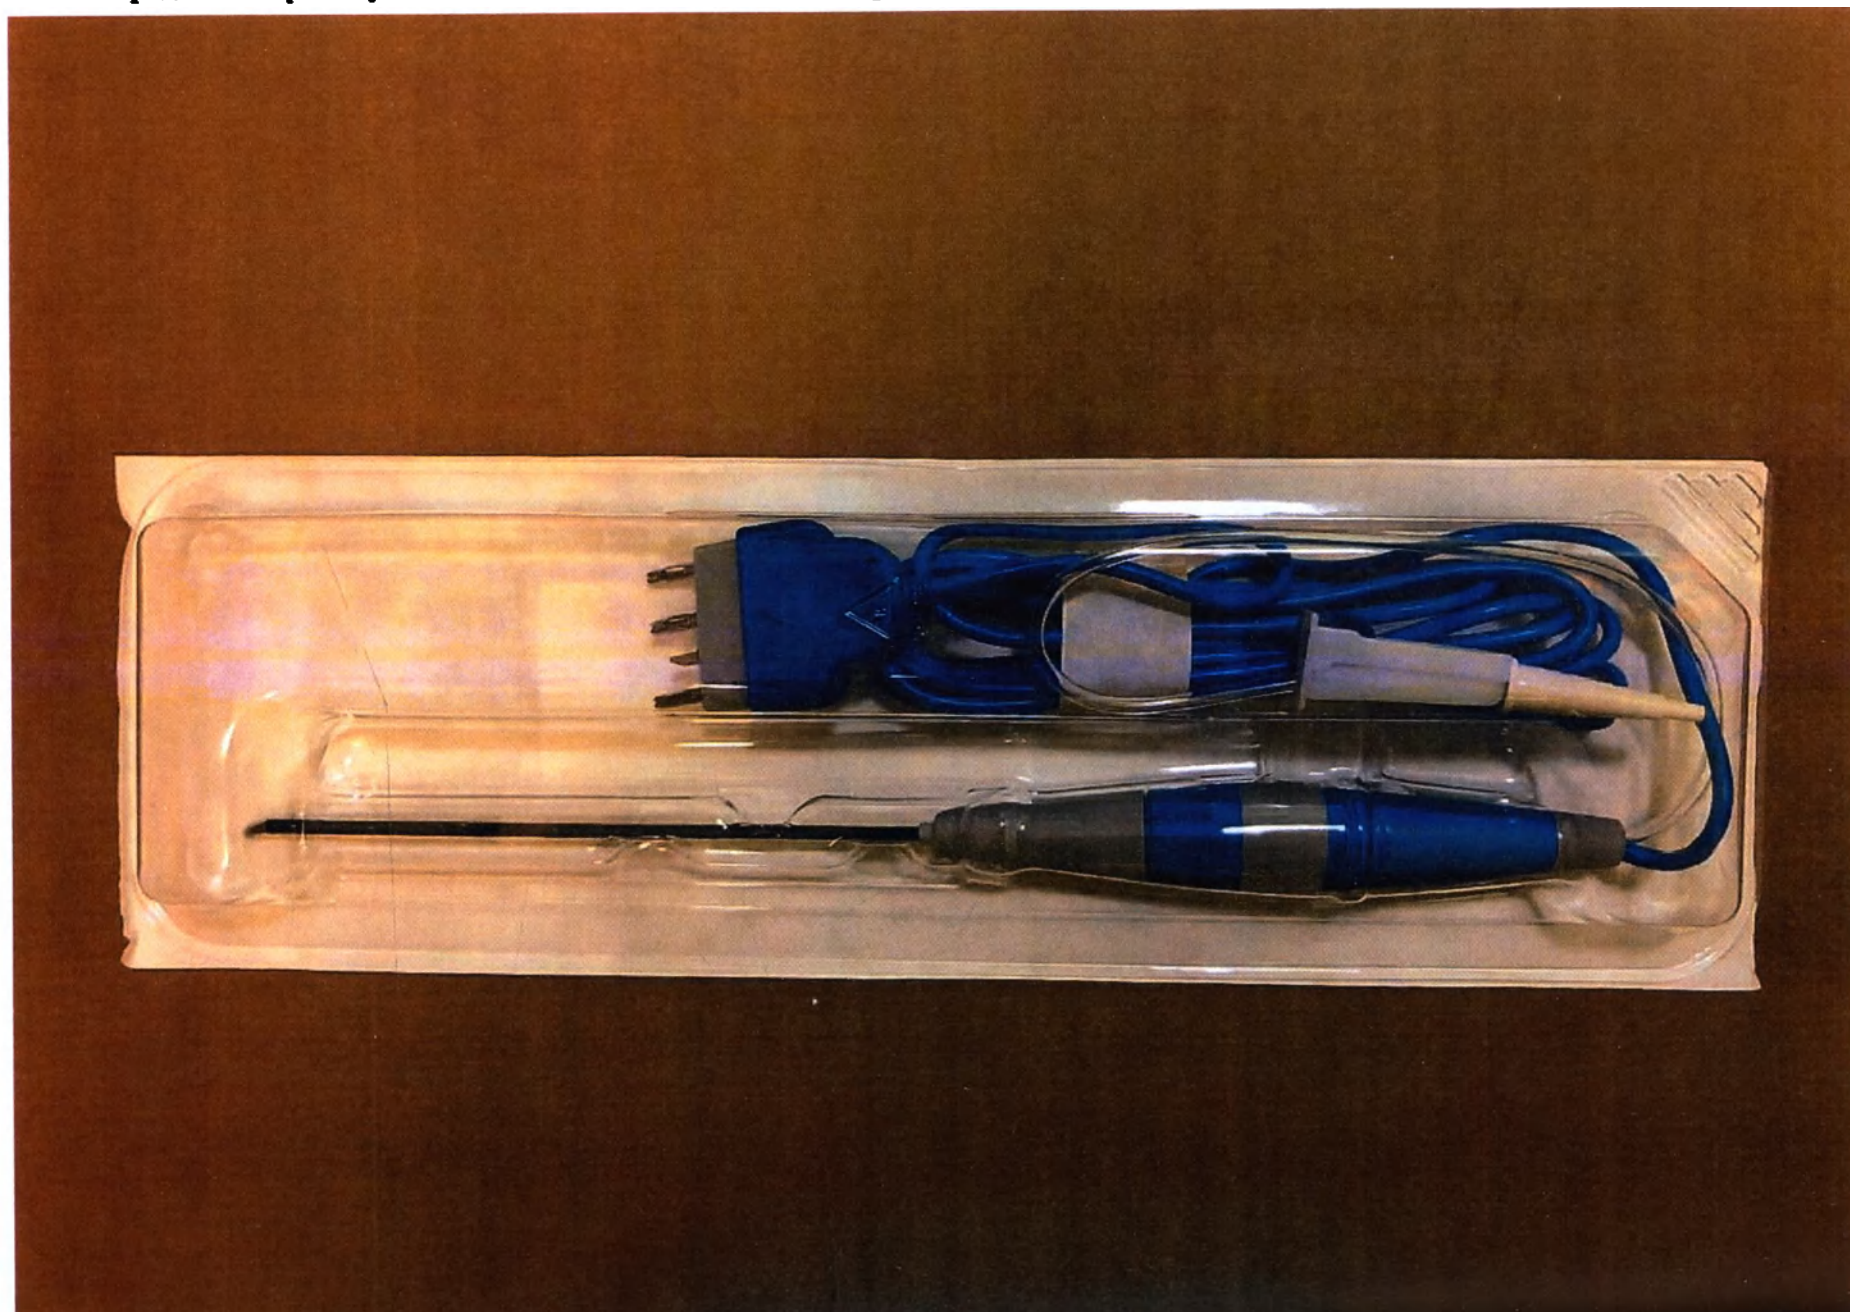


4. Электрод биполярный удлинённый 50° с каналом для аспирации. Изделие вне упаковки.

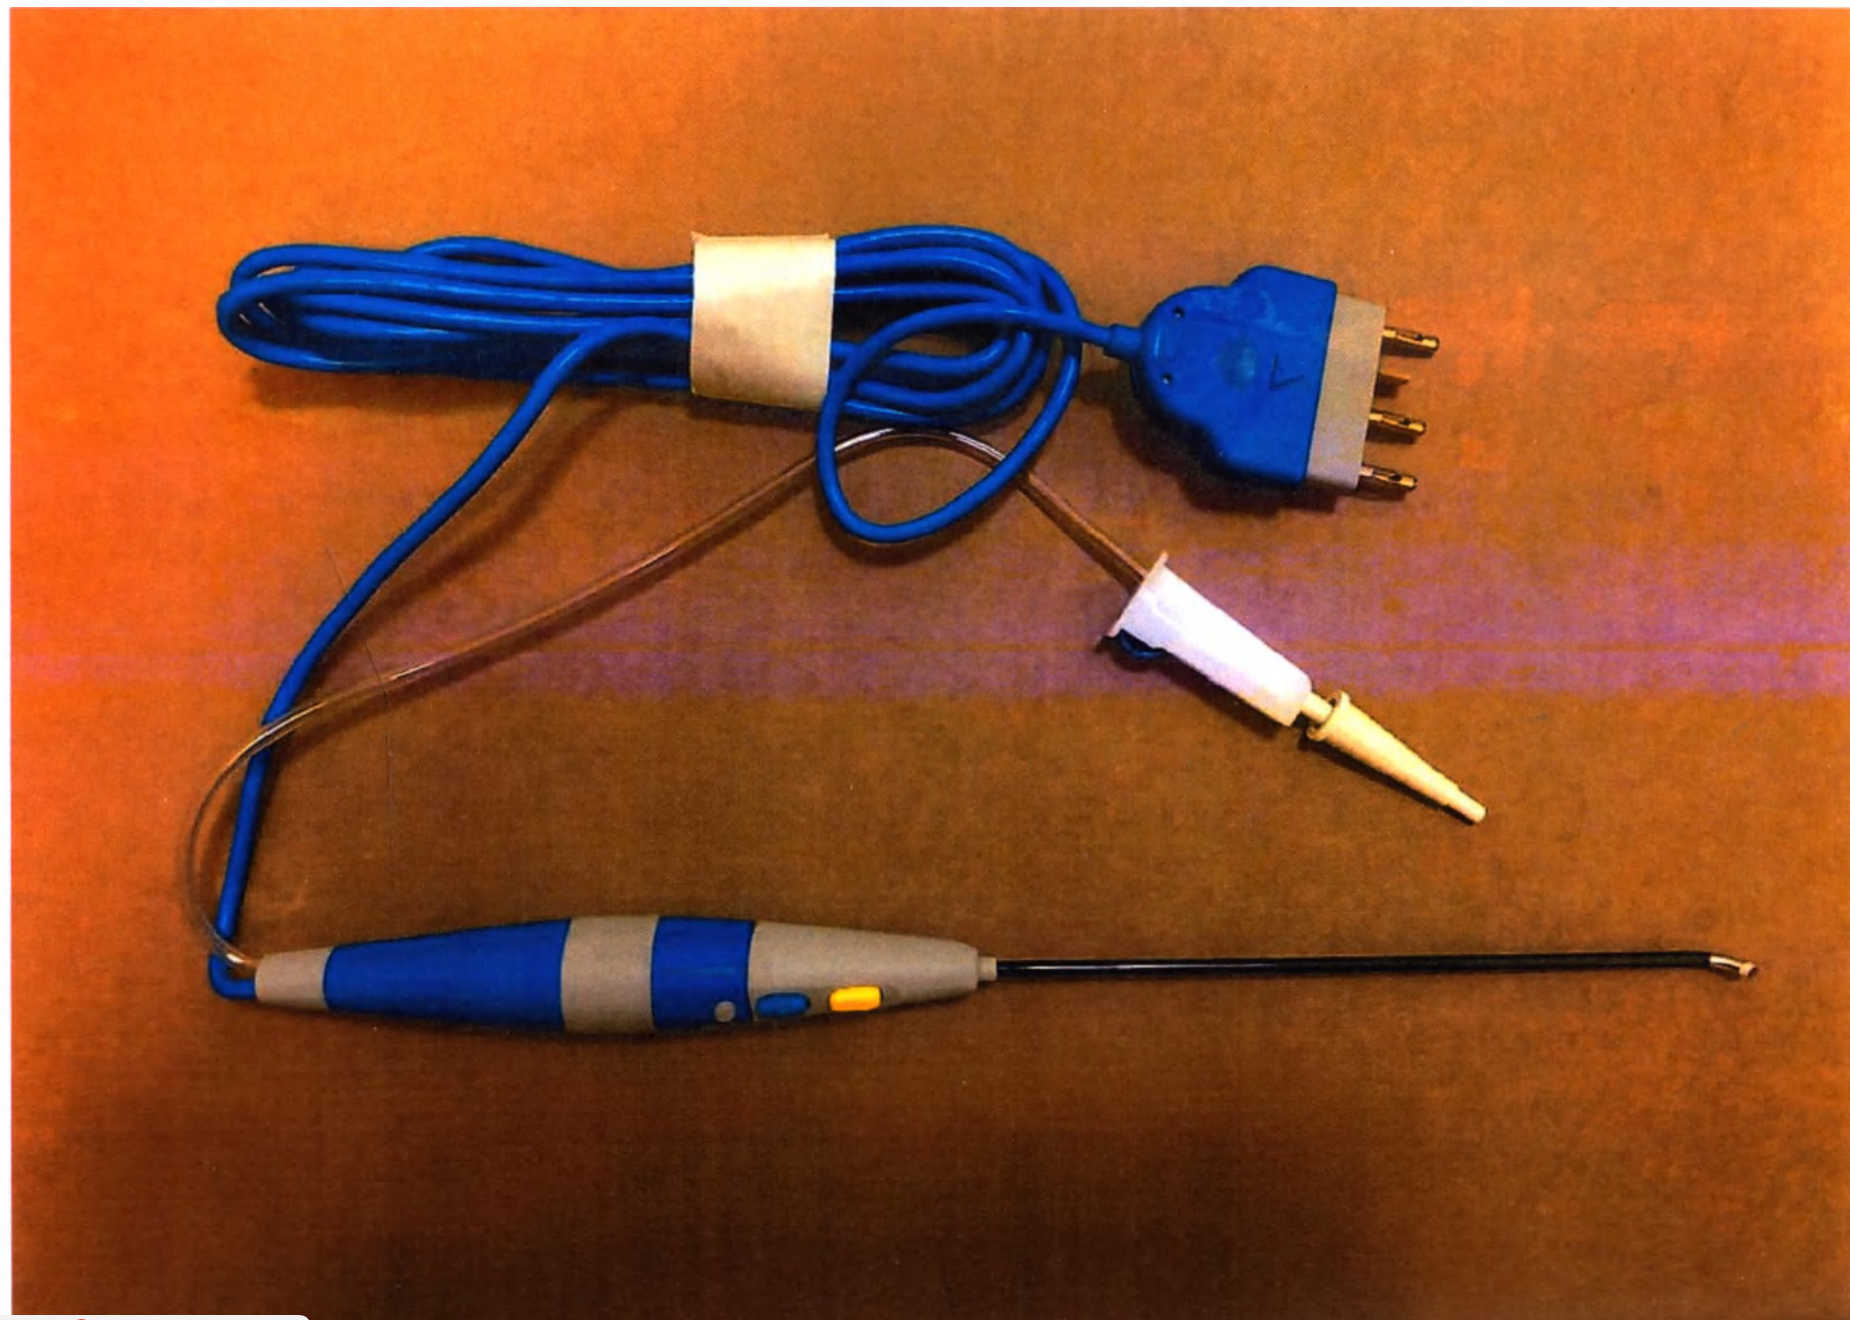


4. Электрод биполярный удлиненный 50° с каналом для аспирации. Дистальный наконечник электрода.

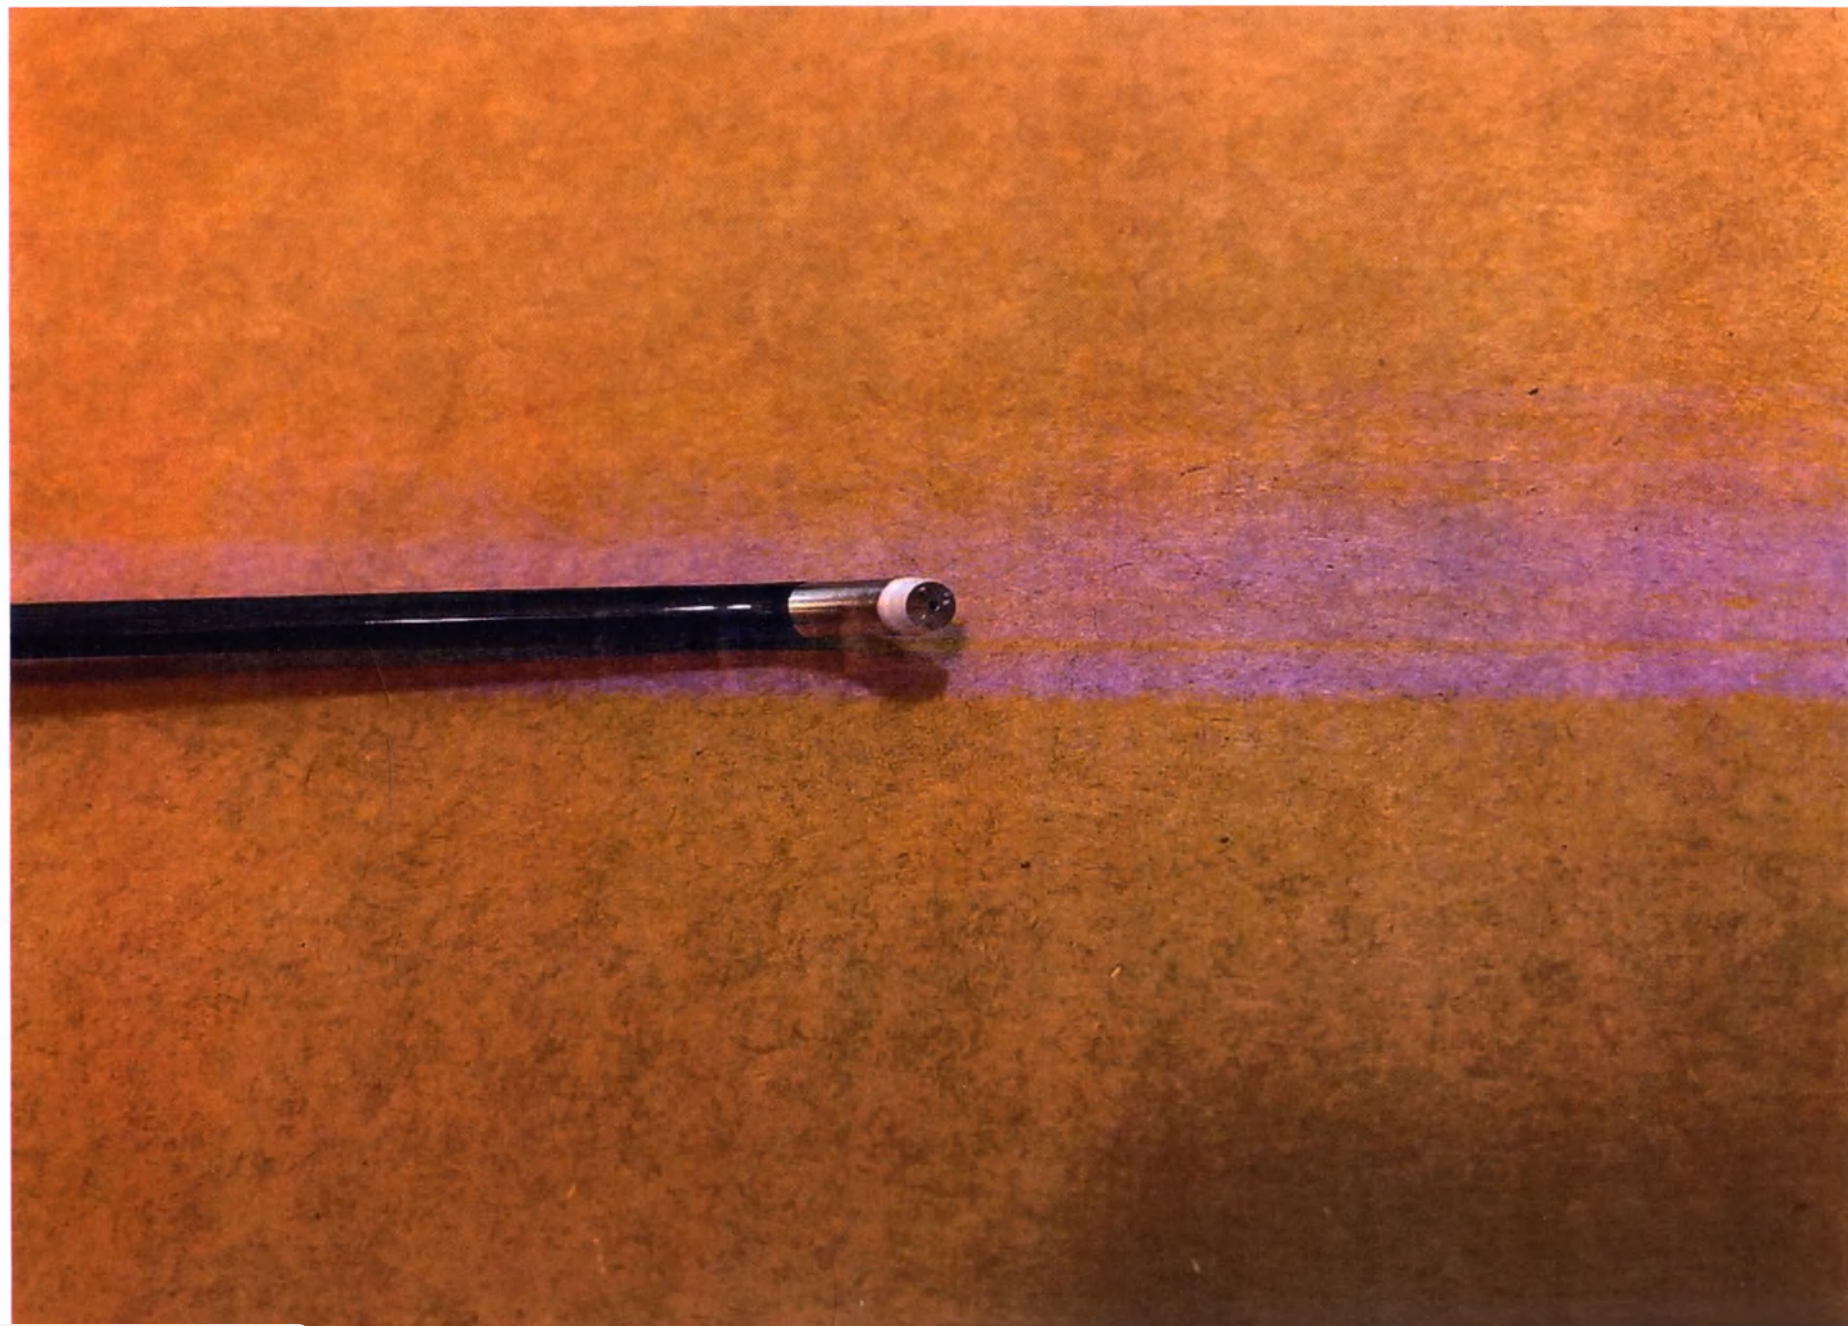


5. Электрод биполярный удлинённый 90° с каналом для аспирации. Потребительская упаковка (картонная коробка).

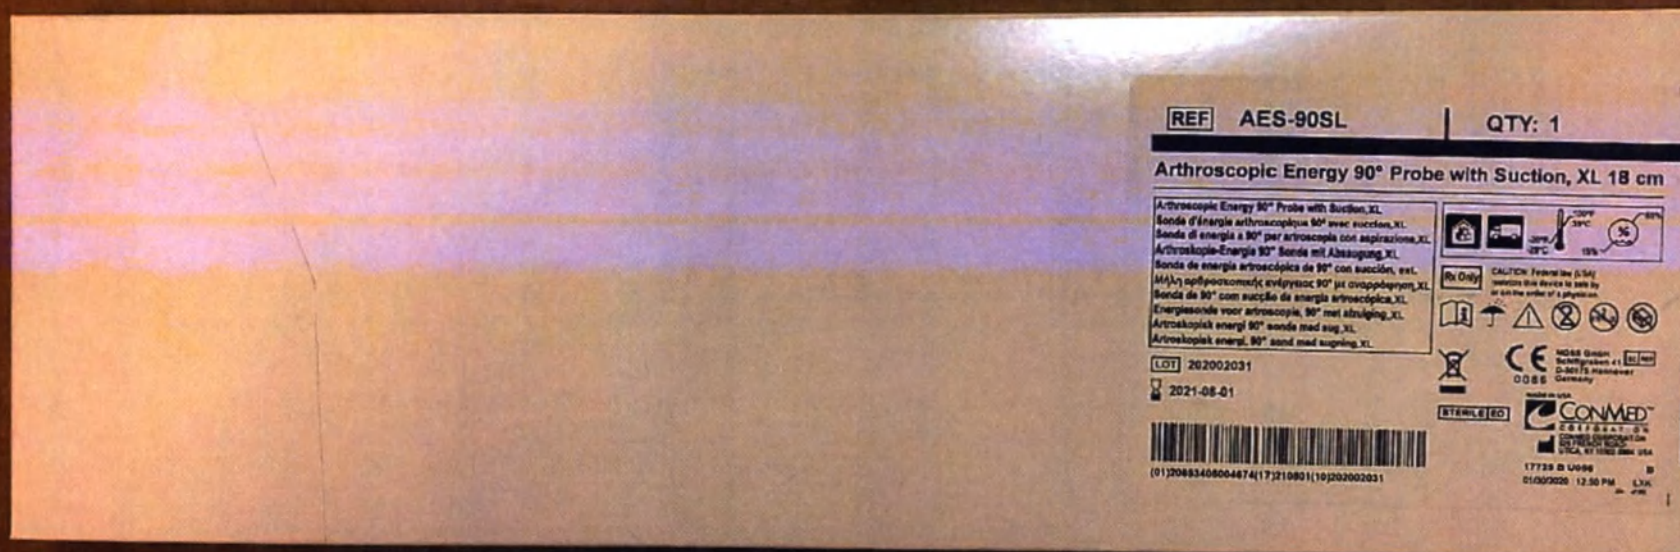


5. Электрод биполярный удлиненный 90° с каналом для аспирации. Индивидуальная упаковка (пакет).

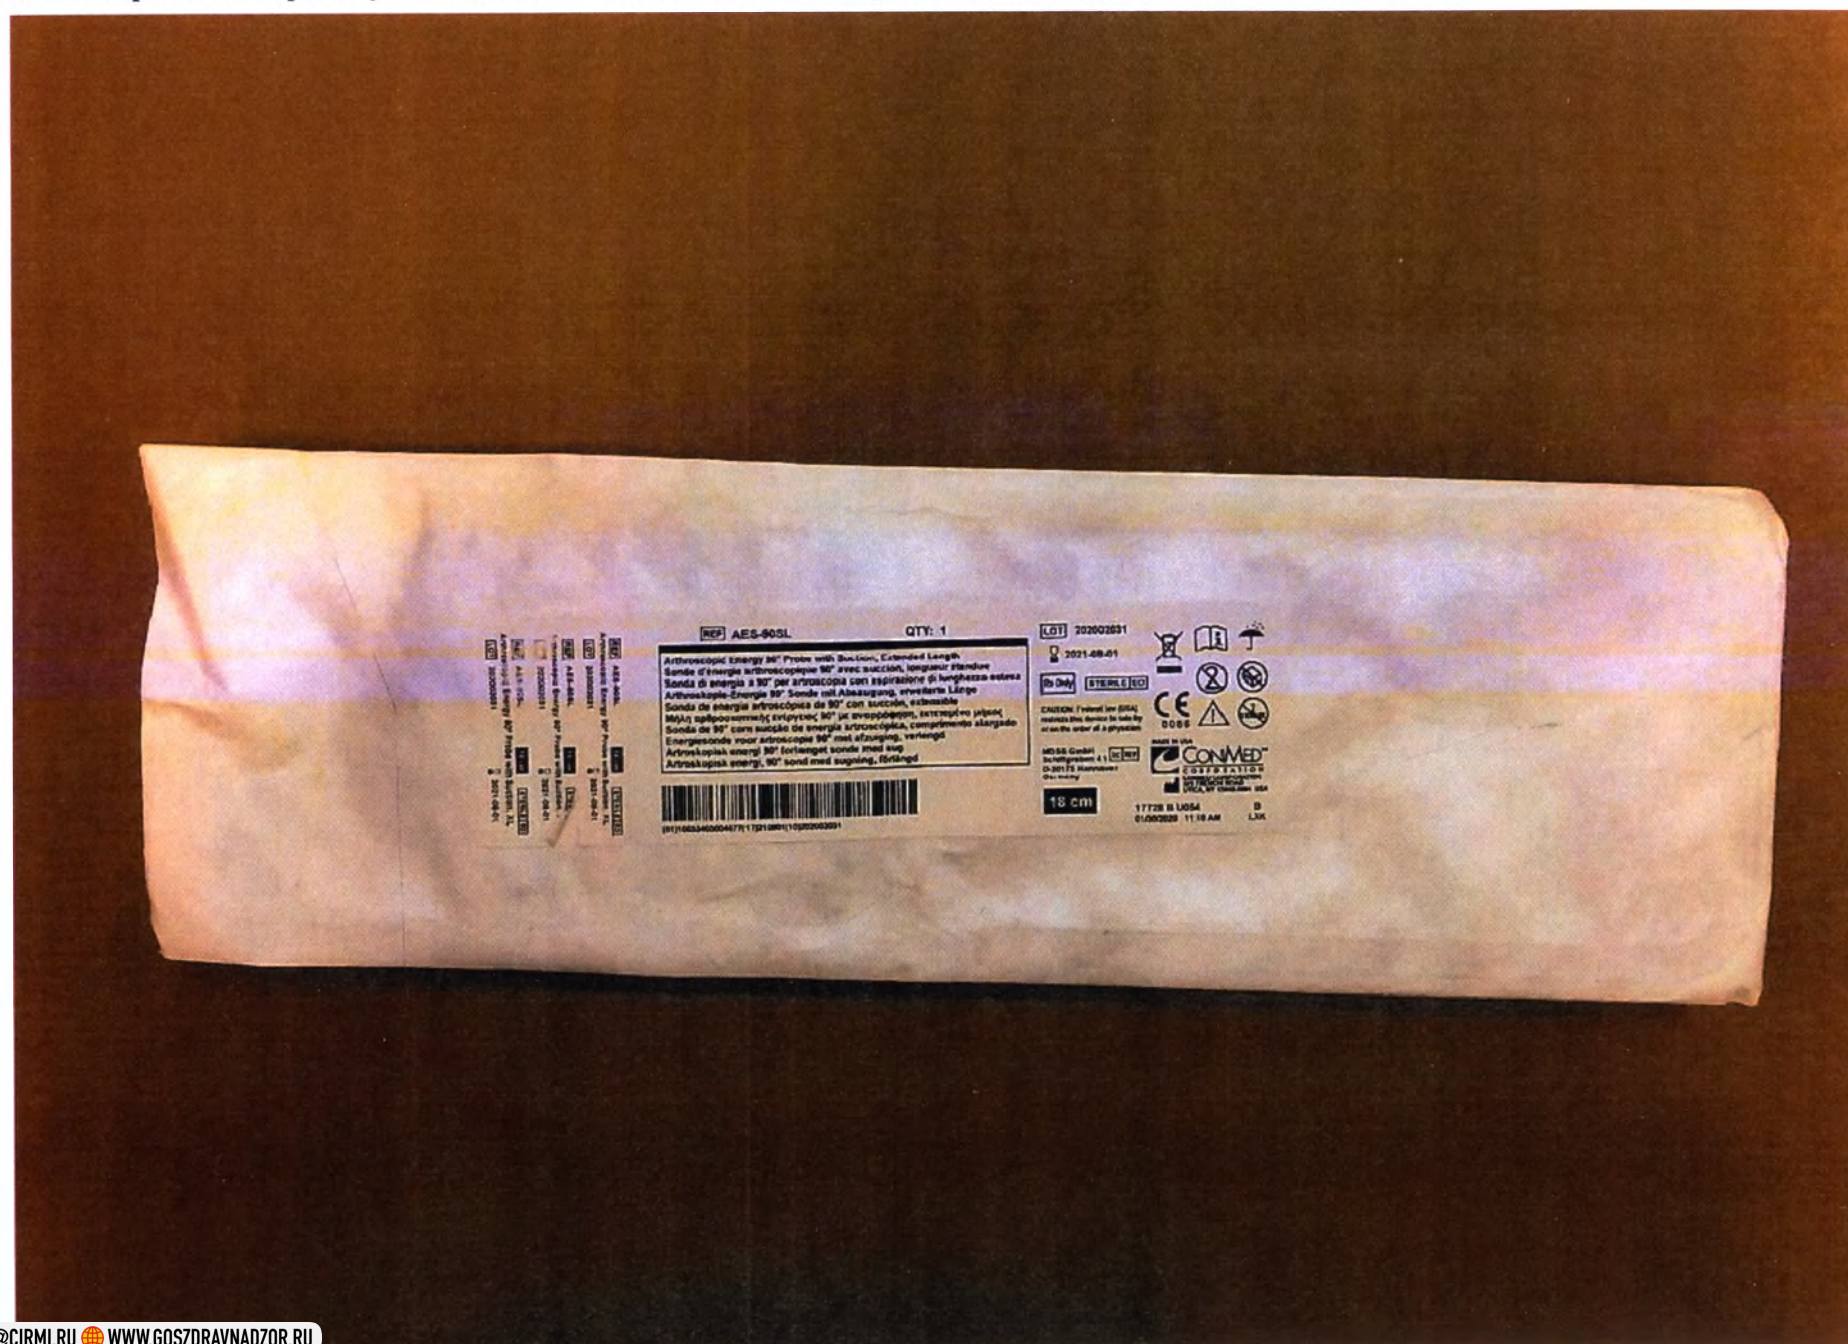


5. Электрод bipolarный удлиненный 90° с каналом для аспирации. Индивидуальная упаковка (пакет).

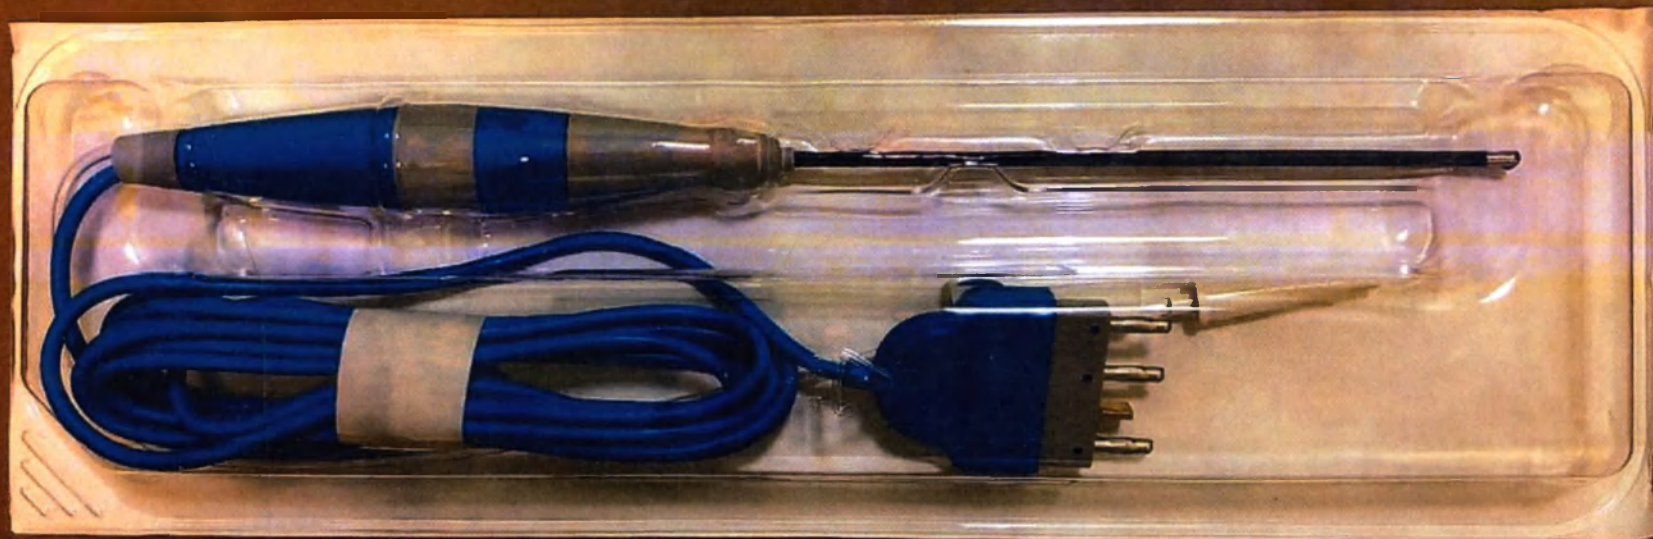


5. Электрод биполярный удлиненный 90° с каналом для аспирации. Изделие вне упаковки.

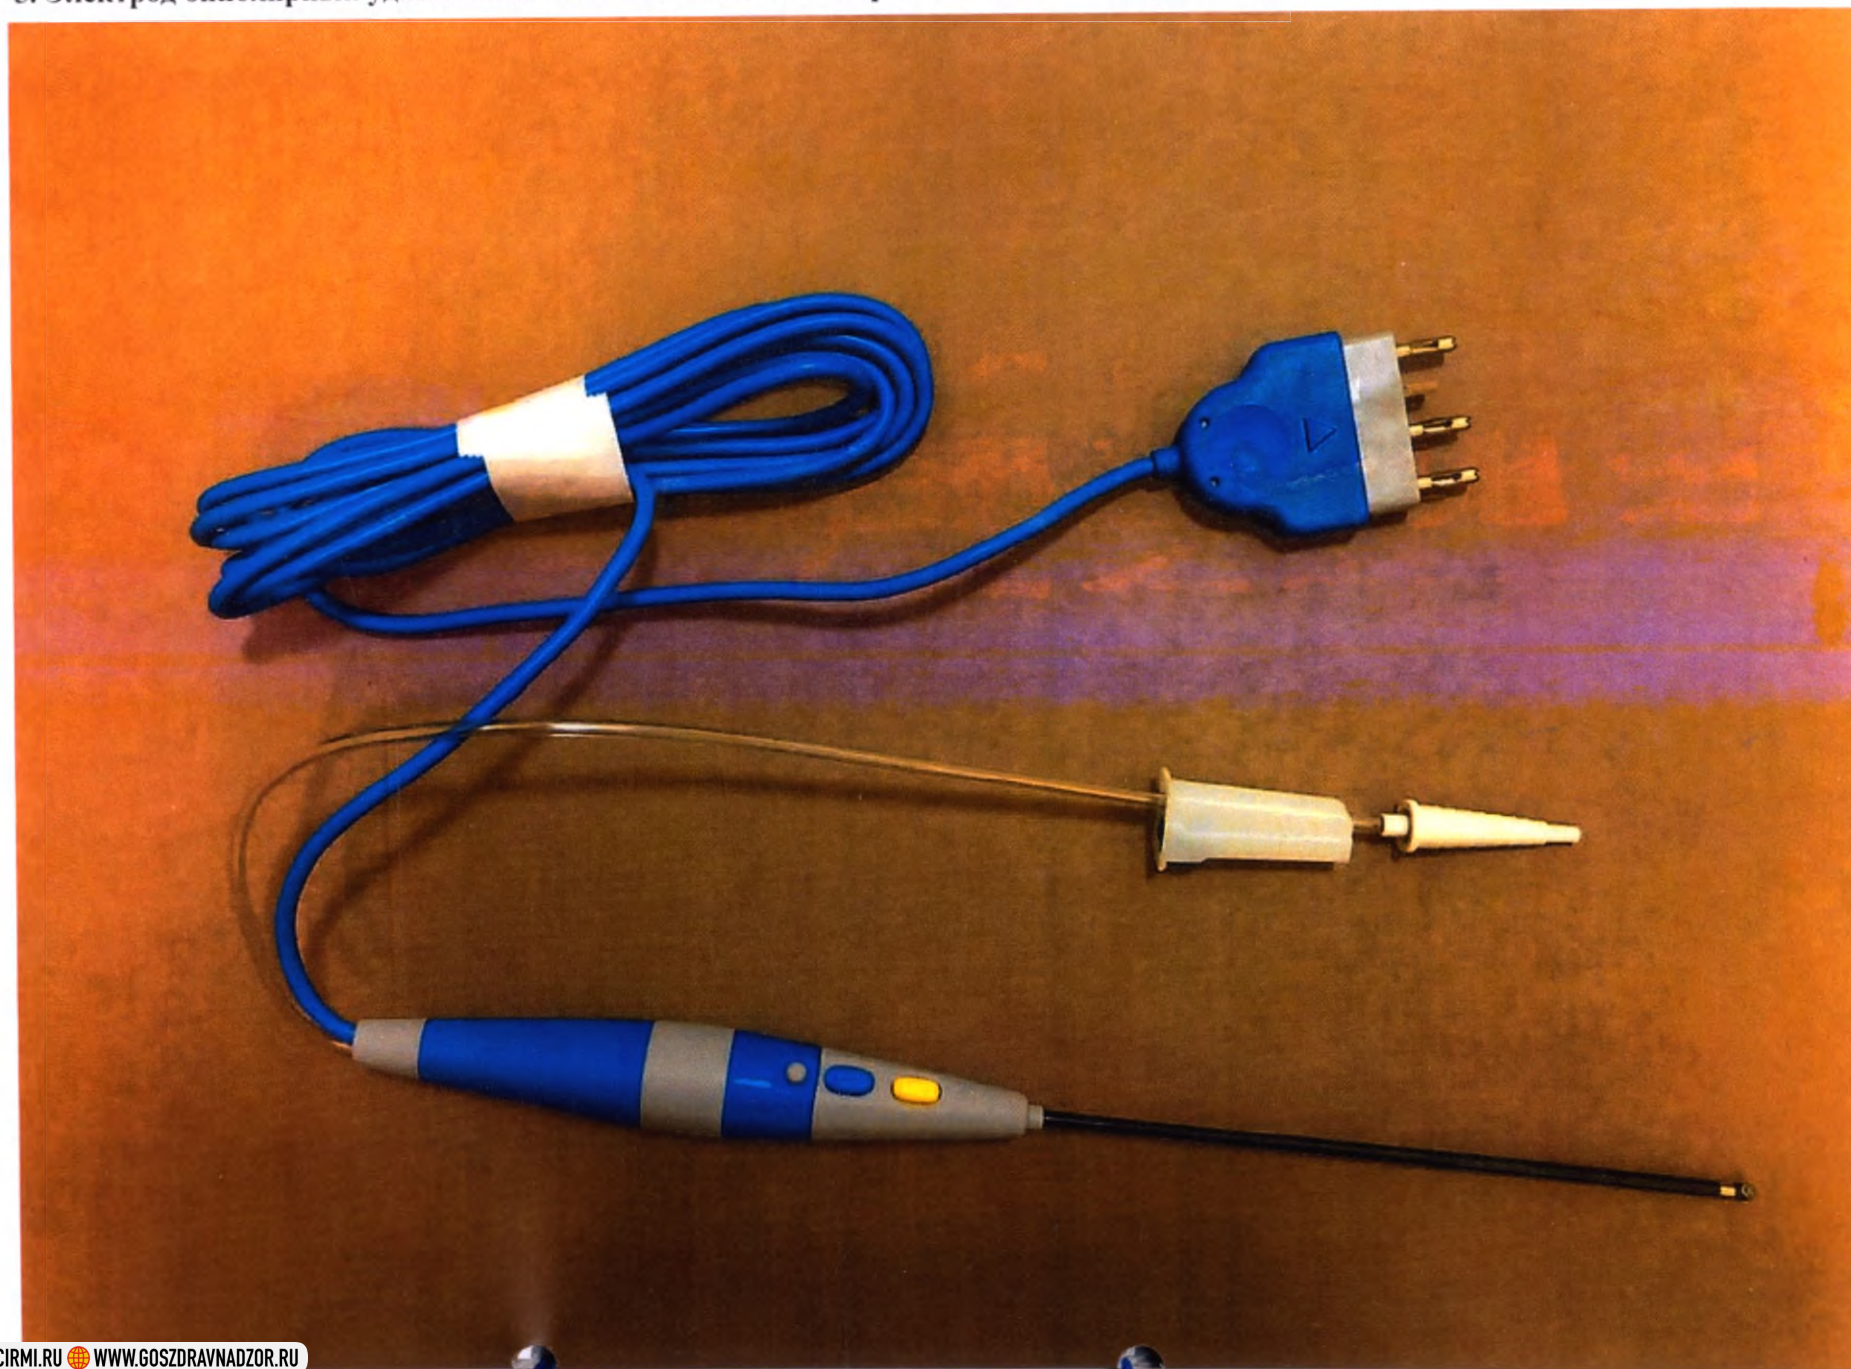


5. Электрод биполярный удлинённый 90° с каналом для аспирации. Дистальный наконечник электрода.

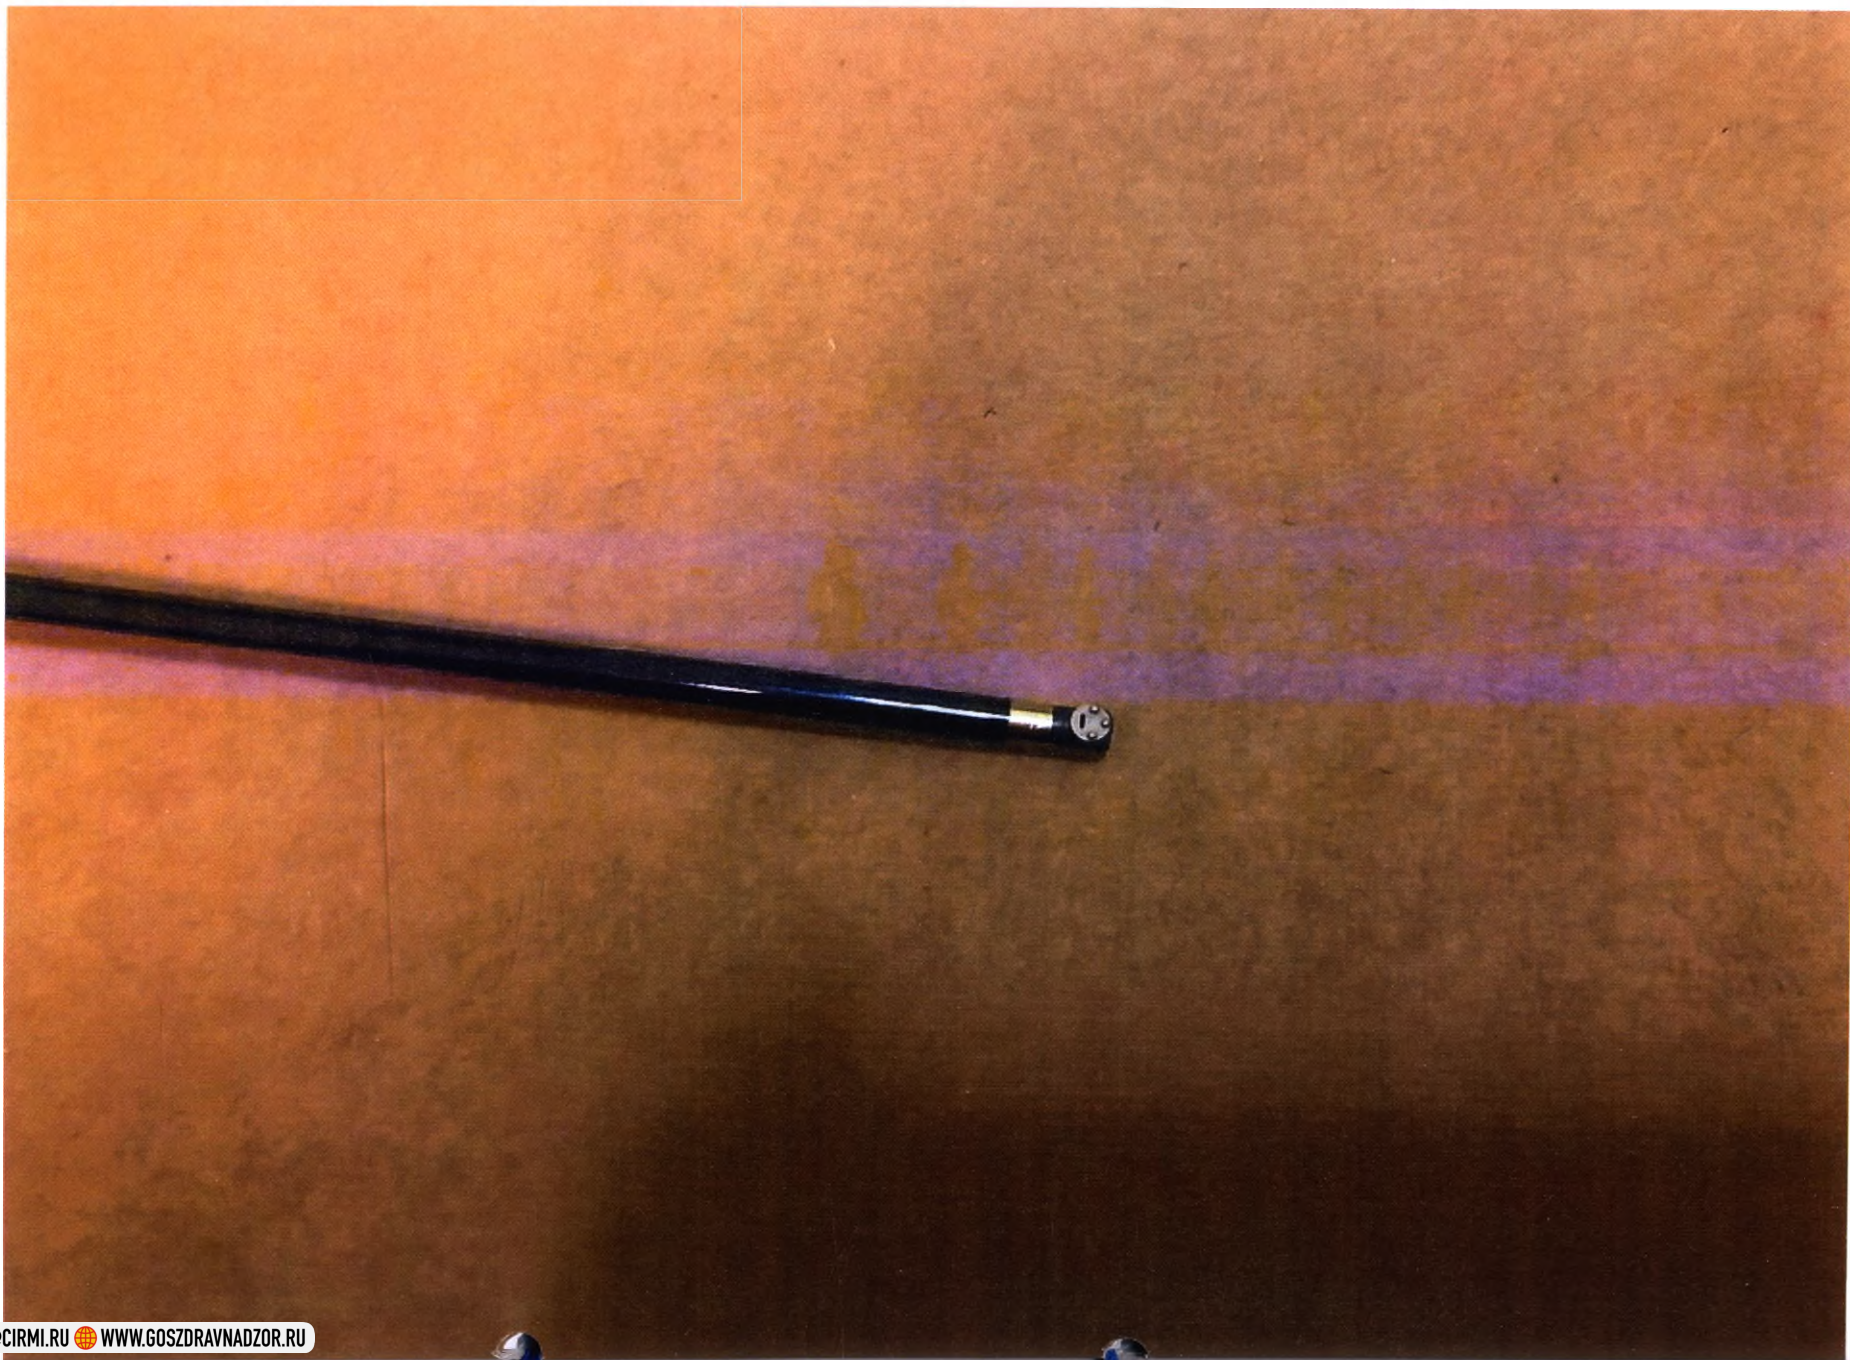

6. Электрод биполярный крючок, прямой. Потребительская упаковка (картонная коробка).

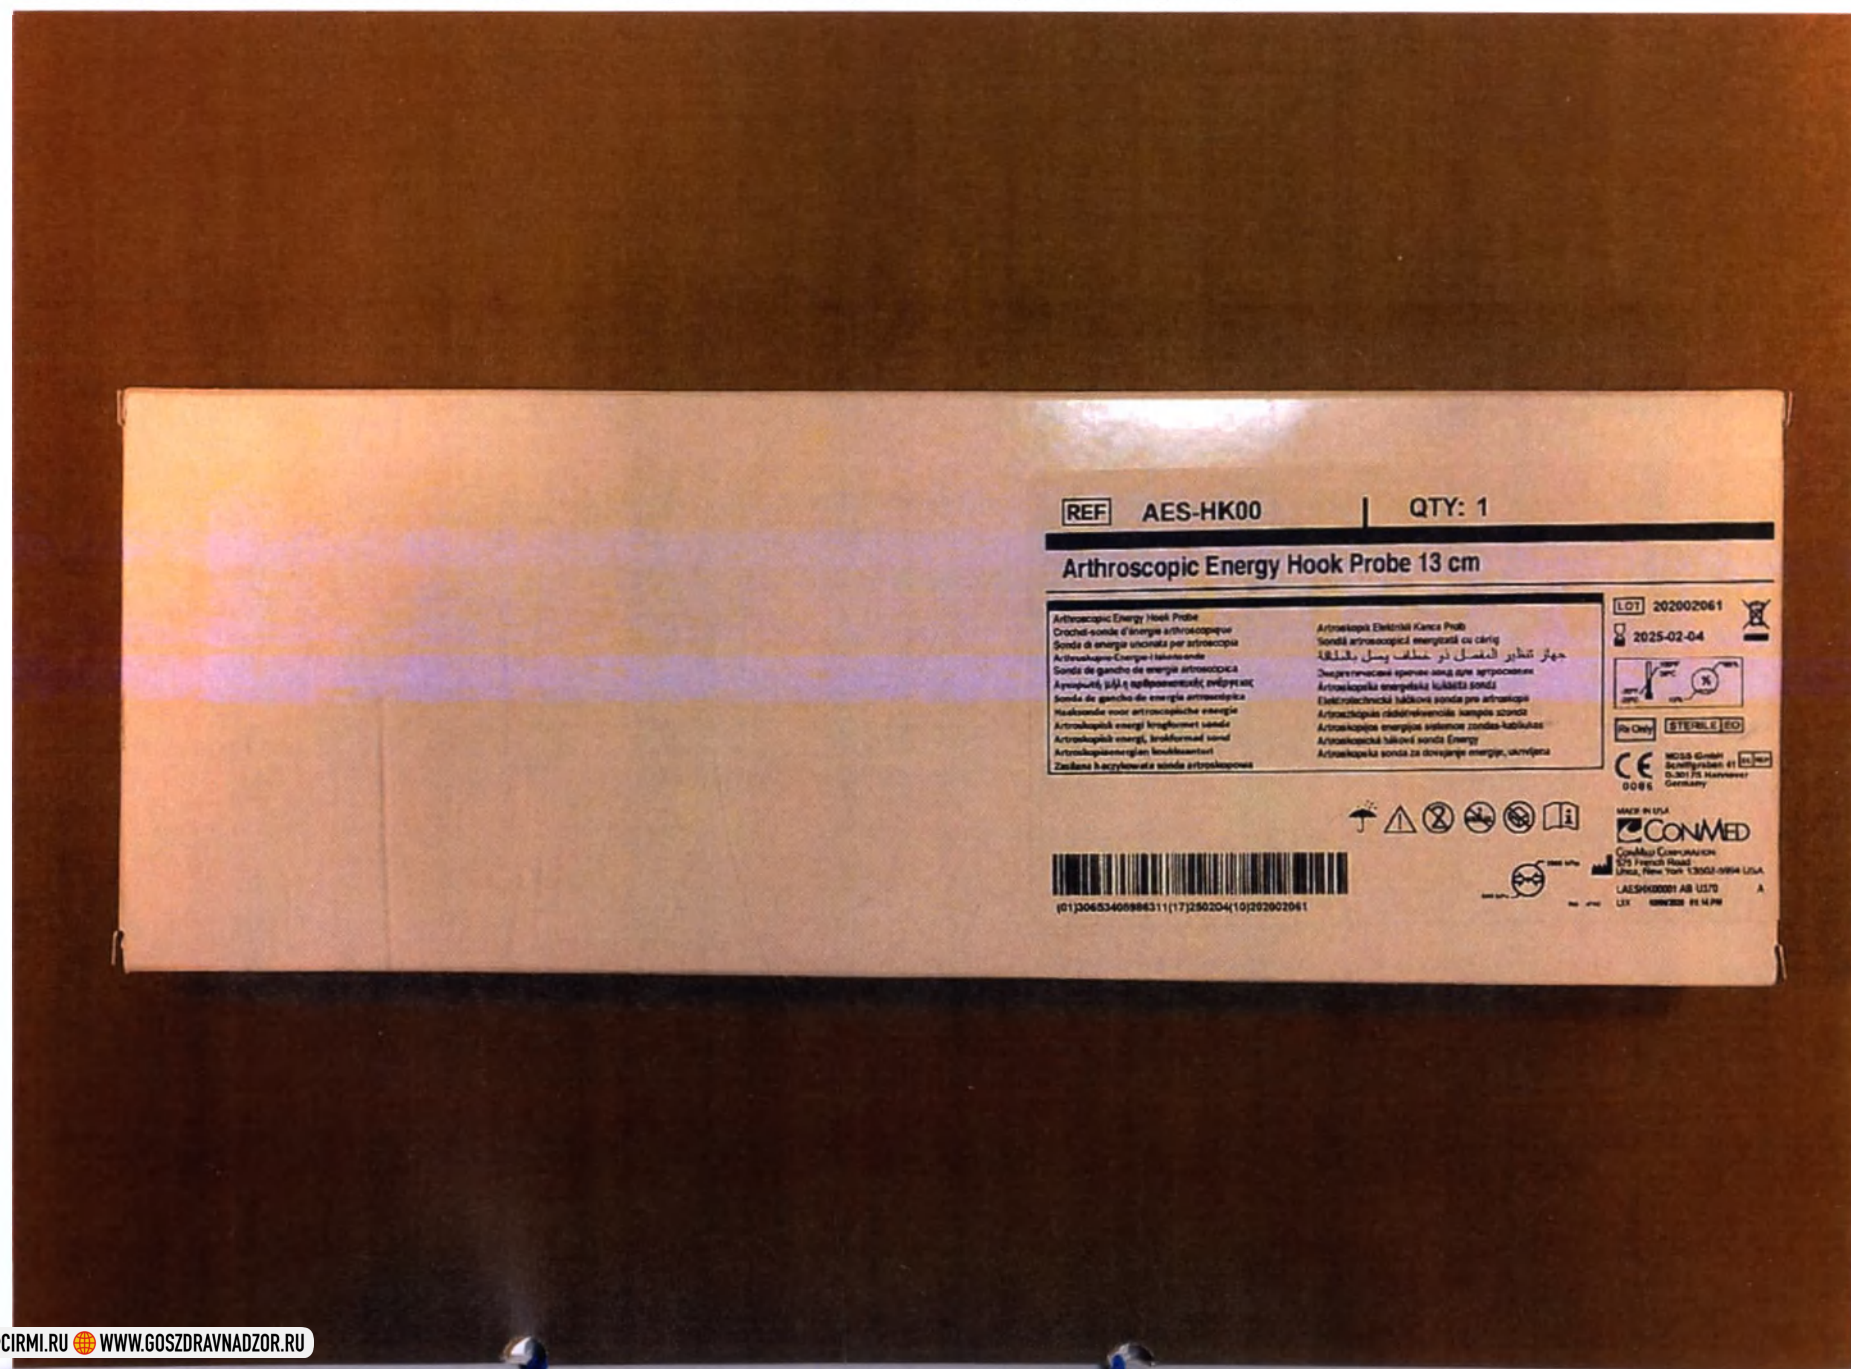


6. Электрод биполярный крючок, прямой. Индивидуальная упаковка (пакет).

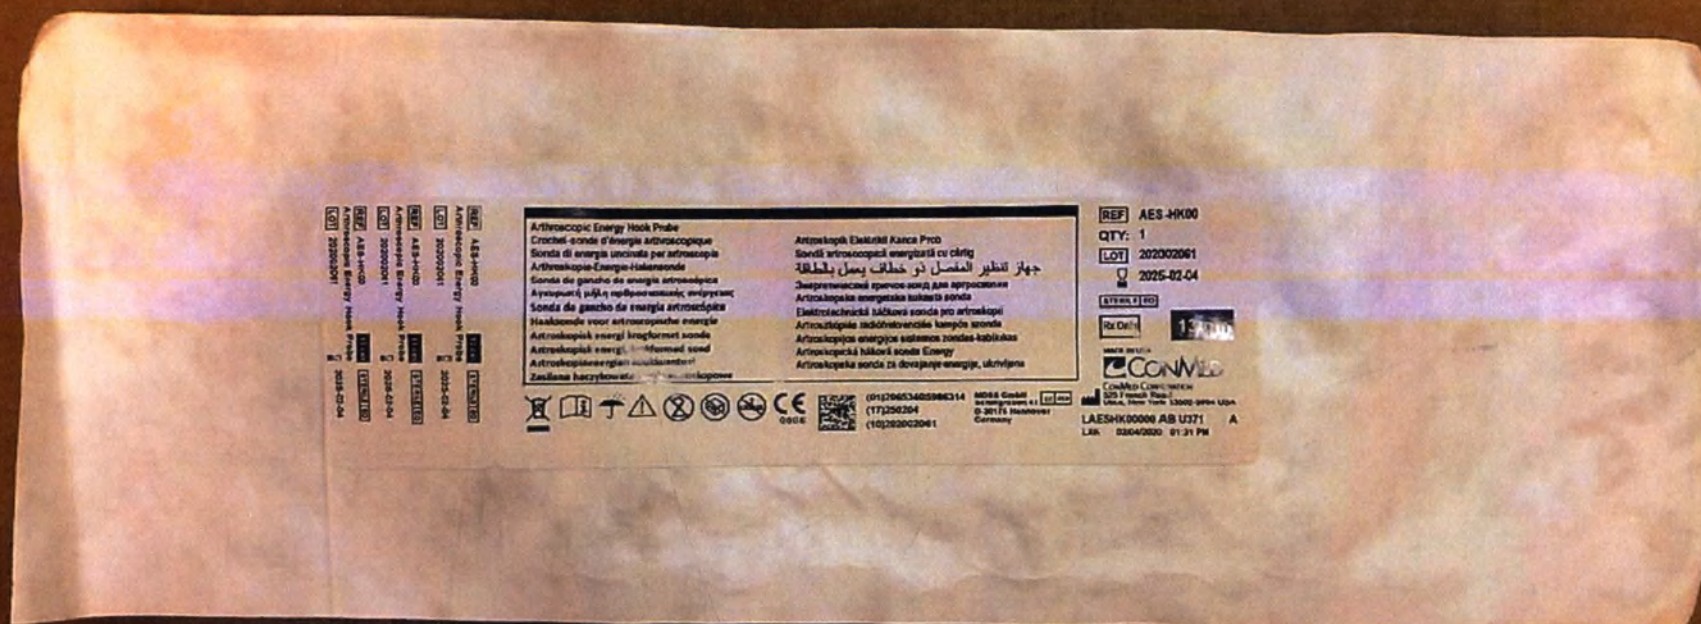


6. Электрод биполярный крючок, прямой. Индивидуальная упаковка (пакет).




6. Электрод биполярный крючок, прямой. Изделие вне упаковки.

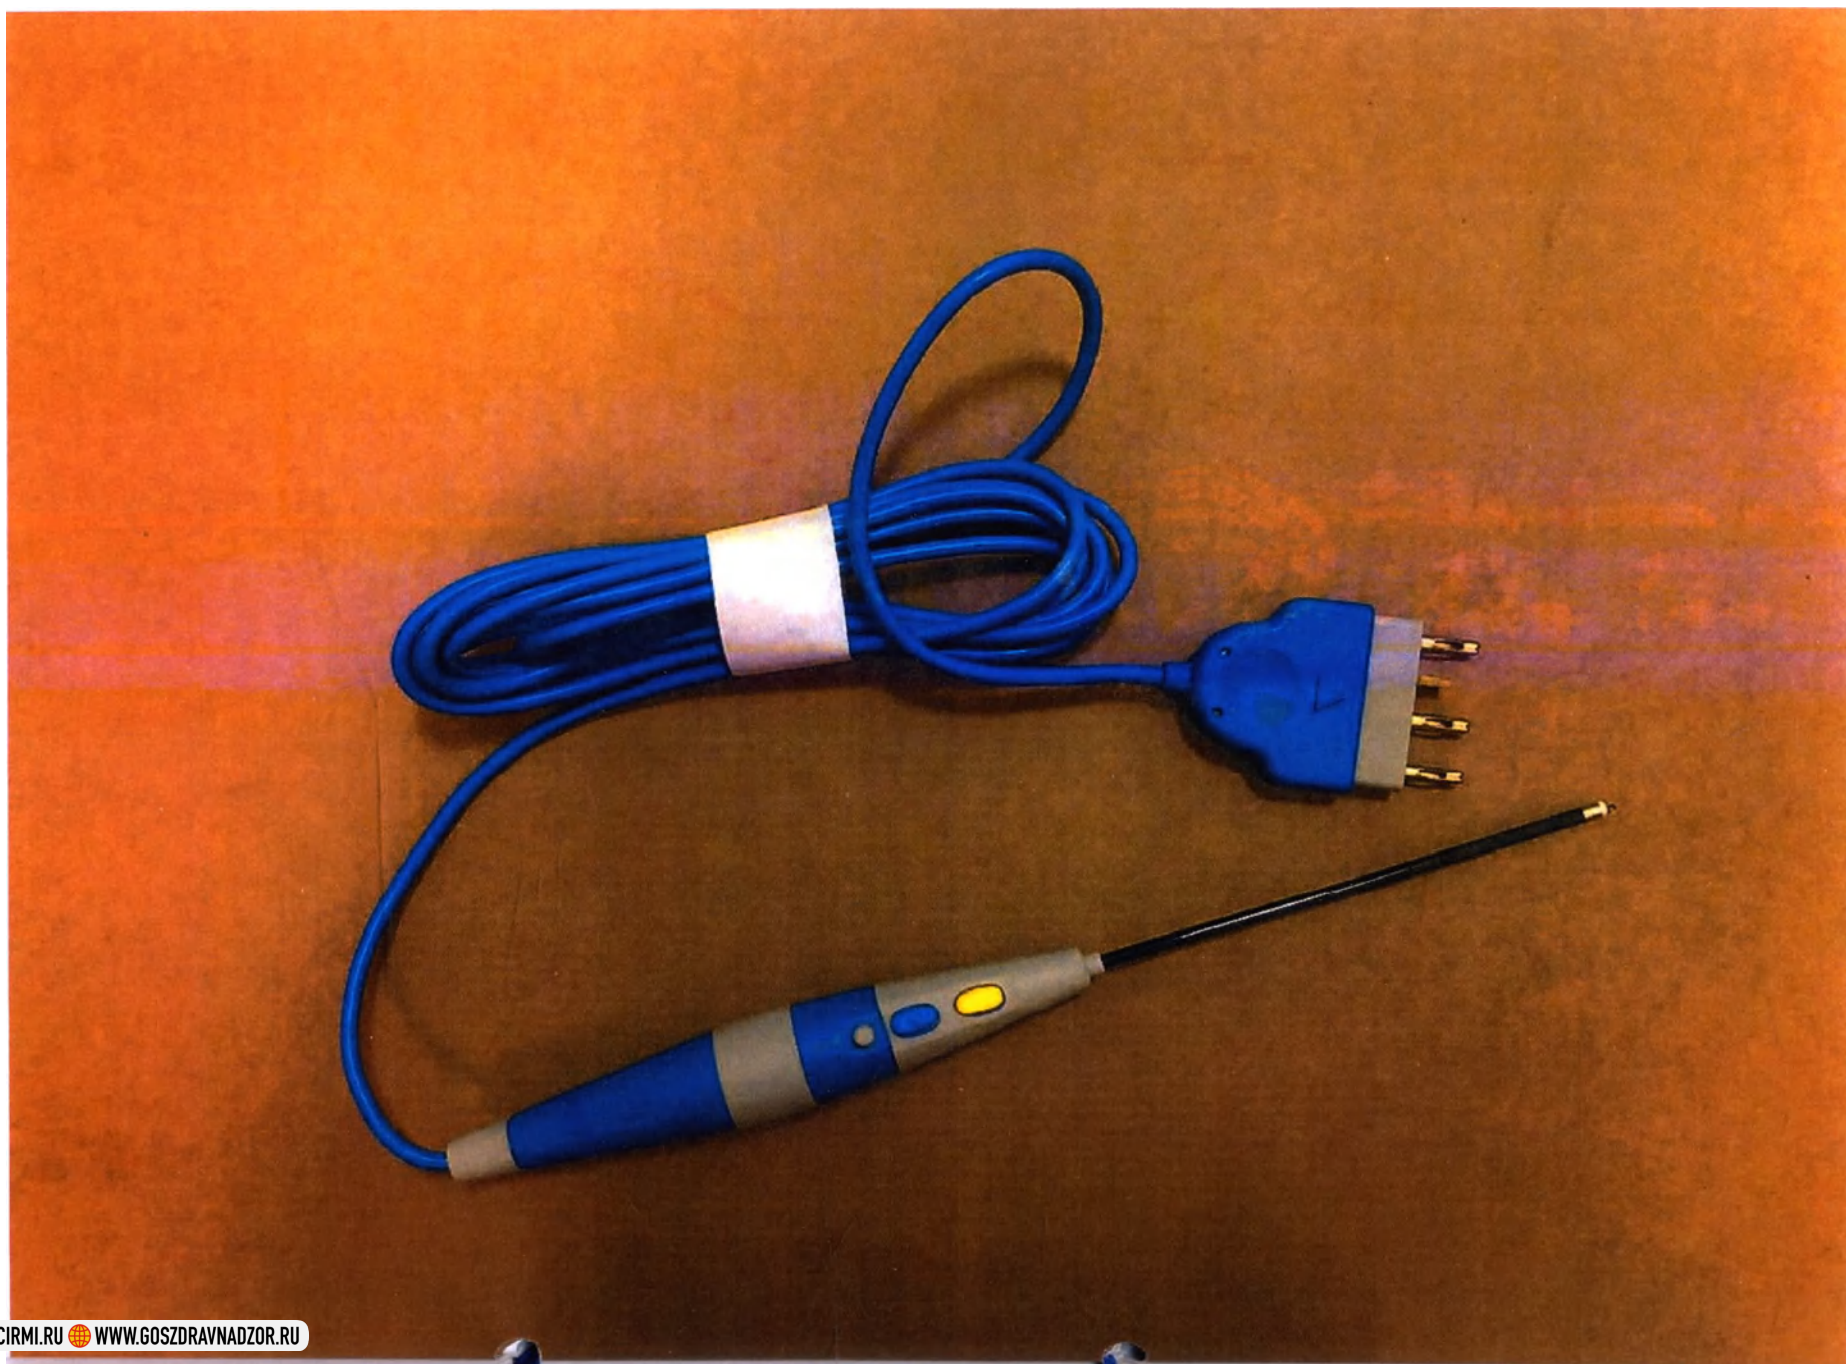

6. Электрод биполярный крючок, прямой. Дистальный наконечник электрода.

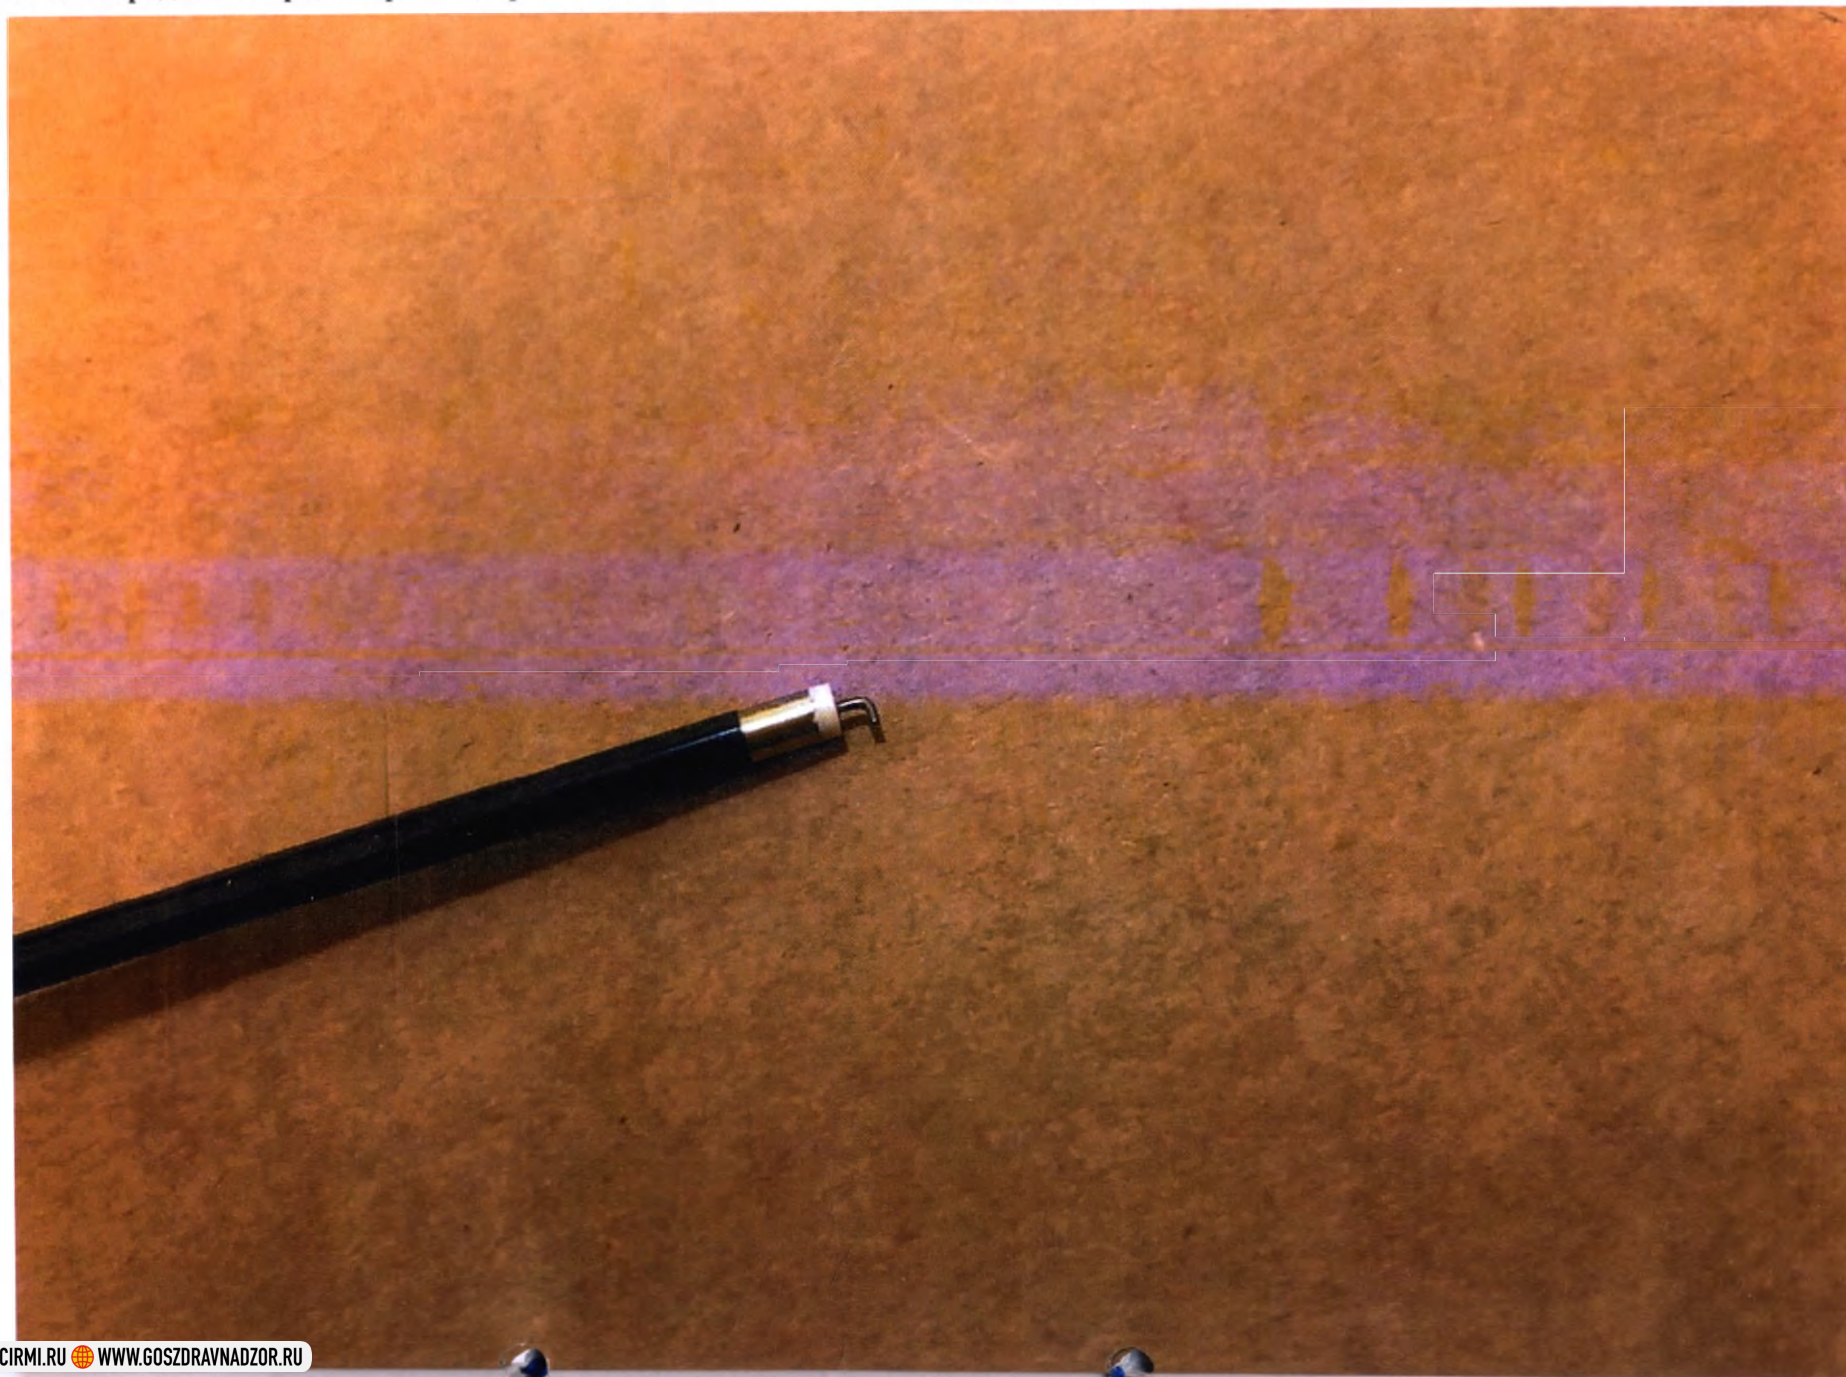

7. Электрод биполярный крючок, 20°. Индивидуальная упаковка (пакет).

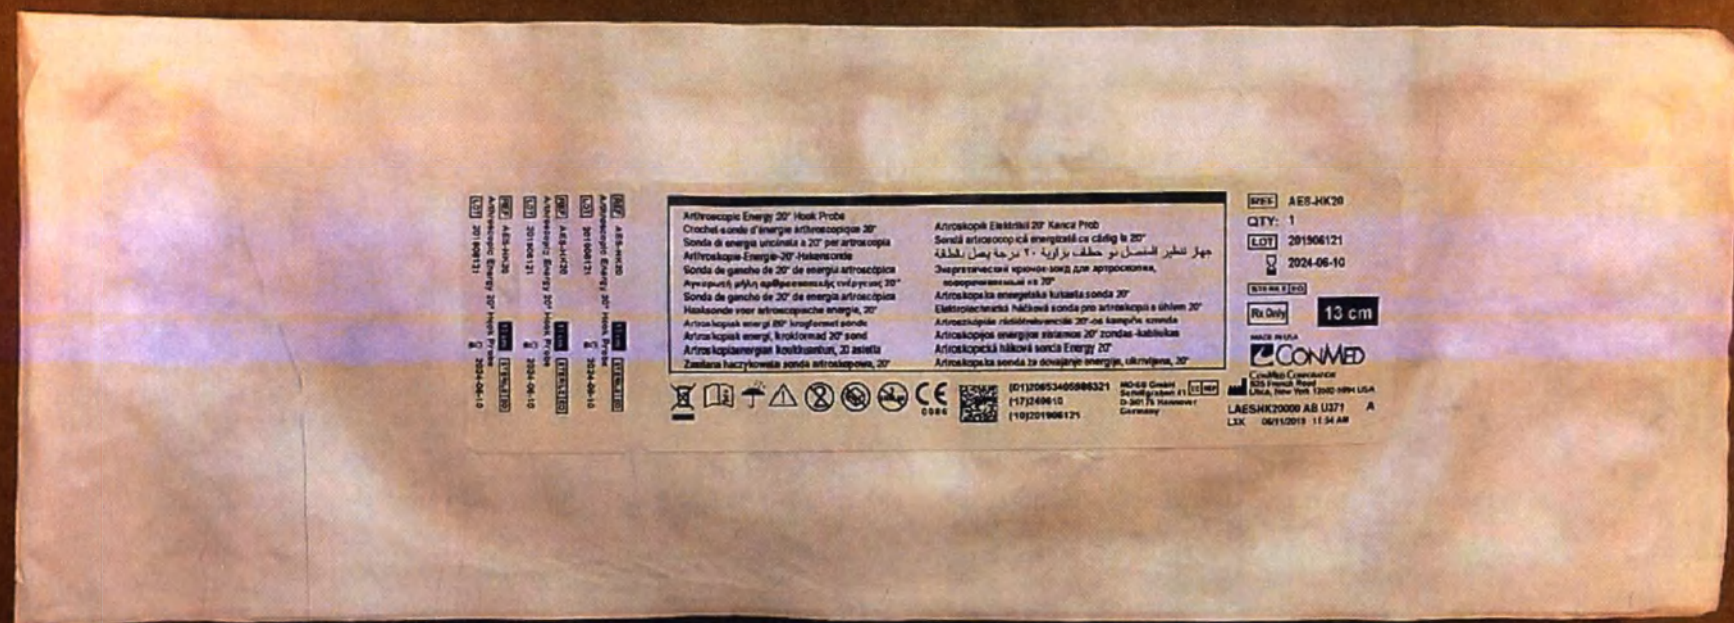


7. Электрод биполярный крючок, 20°. Индивидуальная упаковка (пакет).



7. Электрод биполярный крючок, 20°. Изделие вне упаковки.



7. Электрод биполярный крючок, 20°. Дистальный наконечник электрода.

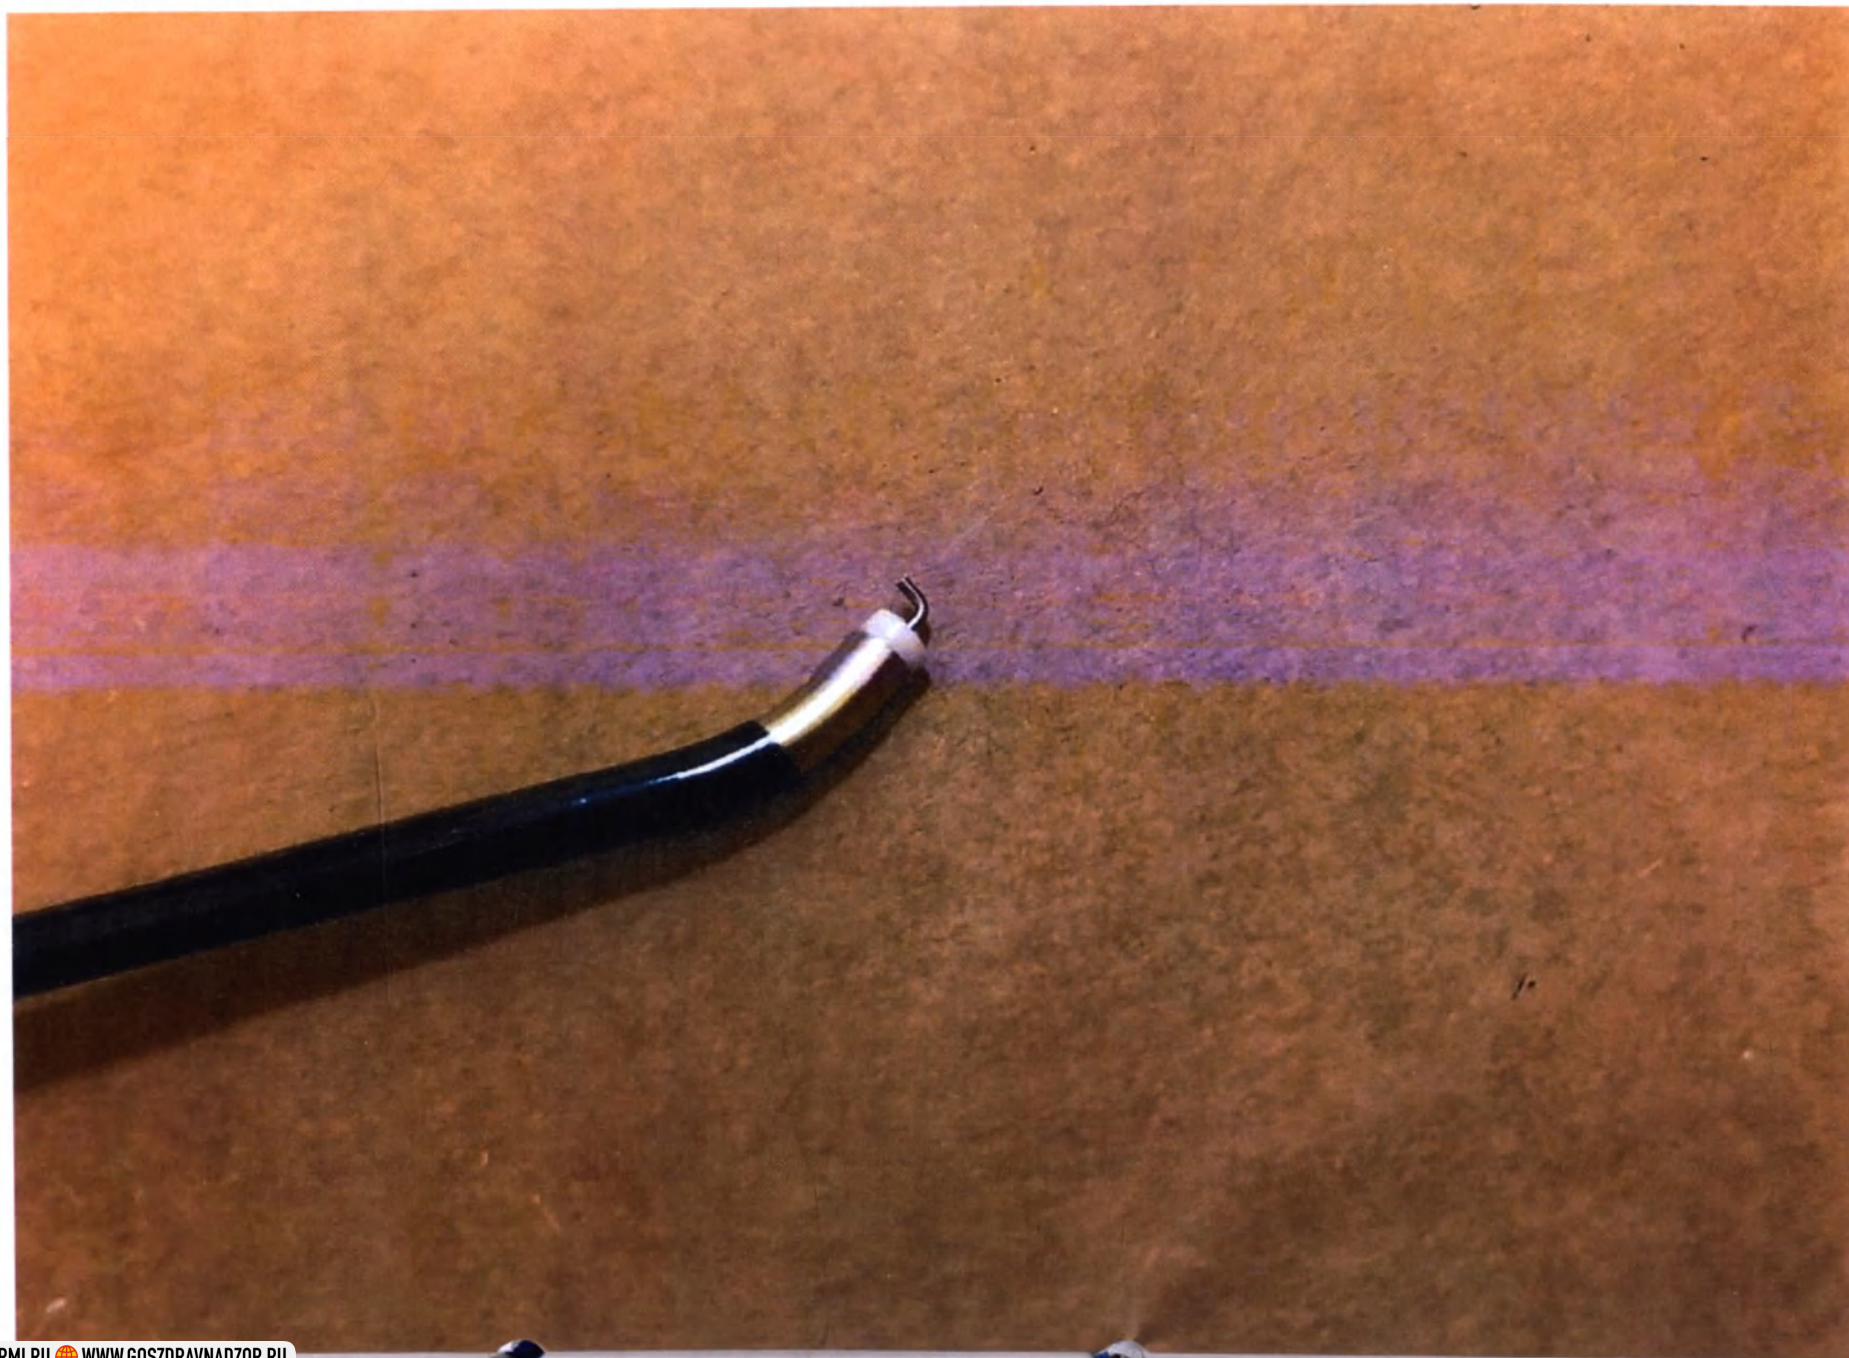

Локальный стикер на русском языке для обращения продукции на территории Российской Федерации.

Наименование медицинского изделия:

Маркировочные символы см. на упаковке

Дата изготовления: _____

Производитель:

«КонМед Корпорейшн»

(ConMed Corporation)

525 French Road, Utica, New York, 13502, USA

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР»

ООО «ИНТЕР»

141031, Московская область, городской округ Мытищи, поселок Вешки, территория
ТПЗ Алтуфьево, шоссе 2-й километр Липкинского, строение 7/1, офис 401-2

Телефон: +7 (495) 229-38-86

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

СДЕЛАНО В США



ВЕРНО

Всего в копии прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 37 листов

Генеральный директор ООО Интер

_____ Пудовкин К.А.

Дата _____