


Фотографические изображения

Набор реагентов и калибраторов для качественного определения нуклеокапсидного антигена коронавируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys SARS-CoV-2 Antigen cobas e analyzers/COV2AG), 200 тестов, Серия: LOT 53112001.

Набор реагентов и калибраторов для качественного определения нуклеокапсидного антигена коронавируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys SARS-CoV-2 Antigen cobas e analyzers/COV2AG), 200 тестов, Серия: LOT 53112001.

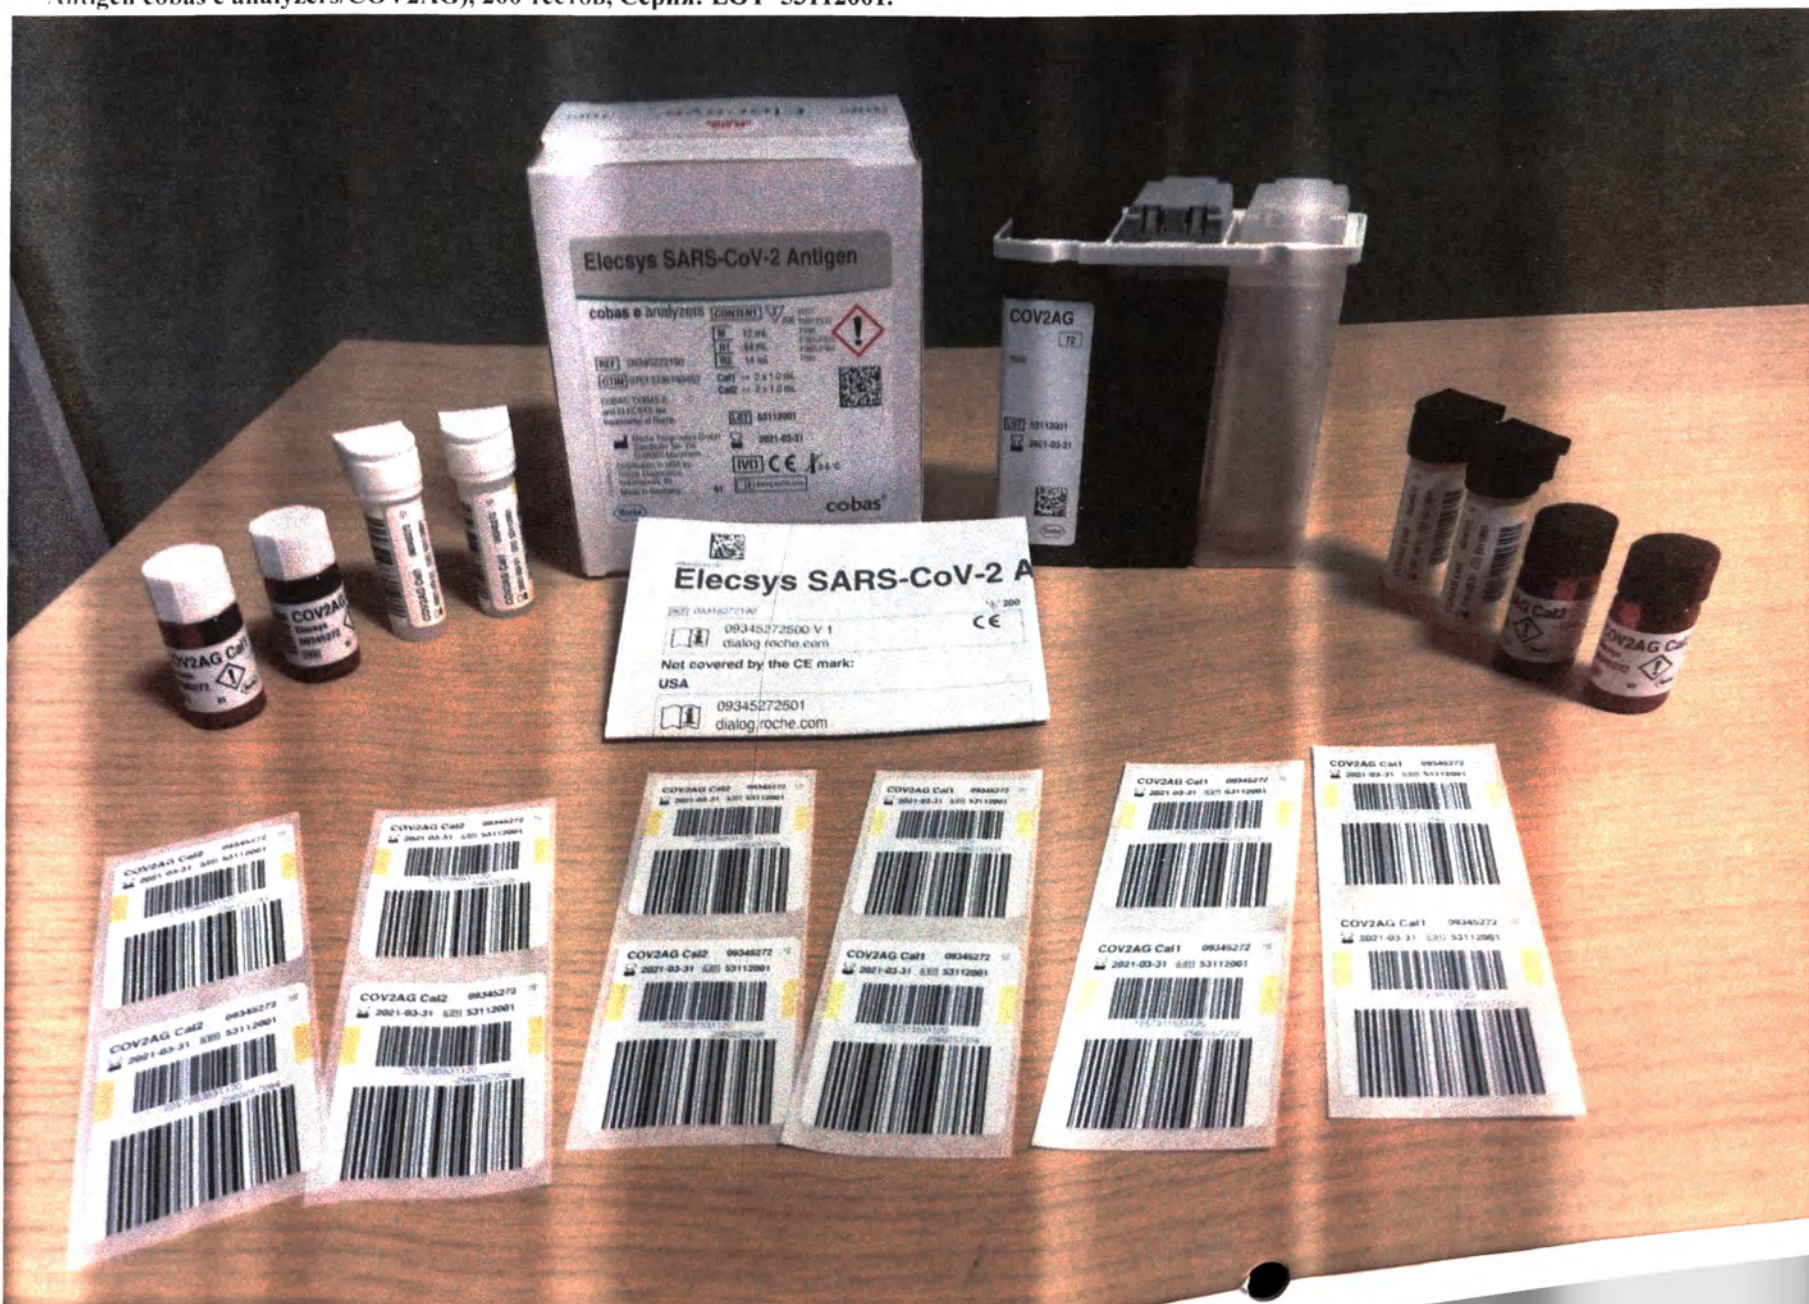

Набор реагентов и калибраторов для качественного определения нуклеокапсидного антигена коронавируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys SARS-CoV-2 Antigen cobas e analyzers/COV2AG), 200 тестов, Серия: LOT 53112001



Набор реагентов и калибраторов для качественного определения нуклеокапсидного антигена коронавируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys SARS-CoV-2 Antigen cobas e analyzers/COV2AG), 200 тестов. Серия: LOT 53112001

Elecsys SARS-CoV-2 Antigen

REF 09345272190

For USA: **CONTENT**

For Emergency Use Authorization only

- M** Streptavidin-coated microparticles 0.72 mg/mL
- R1** Biotinylated monoclonal anti-SARS-CoV-2 antibody (mouse) <1.4 mg/L; HEPES buffer
- R2** Two monoclonal anti-SARS-CoV-2 antibodies (rabbit) labeled with ruthenium complex < 2.3 mg/L (each); HEPES buffer
- Cal1** Non-reactive for SARS-CoV-2 antigen, buffer
- Cal2** Reactive for SARS-CoV-2 antigen, buffer



Rx only

01




Набор реагентов и калибраторов для качественного определения нуклеокапсидного антигена коронавируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys SARS-CoV-2 Antigen cobas e analyzers/COV2AG), 200 тестов. Серия: LOT 53112001



Набор реагентов и калибраторов для качественного определения нуклеокапсидного антигена коронавируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys SARS-CoV-2 Antigen cobas e analyzers/COV2AG), 200 тестов, Серия: LOT 53112001



Набор реагентов и калибраторов для качественного определения нуклеокапсидного антигена коронавируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys SARS-CoV-2 Antigen cobas e analyzers/COV2AG), 200 тестов, Серия: LOT 53112001

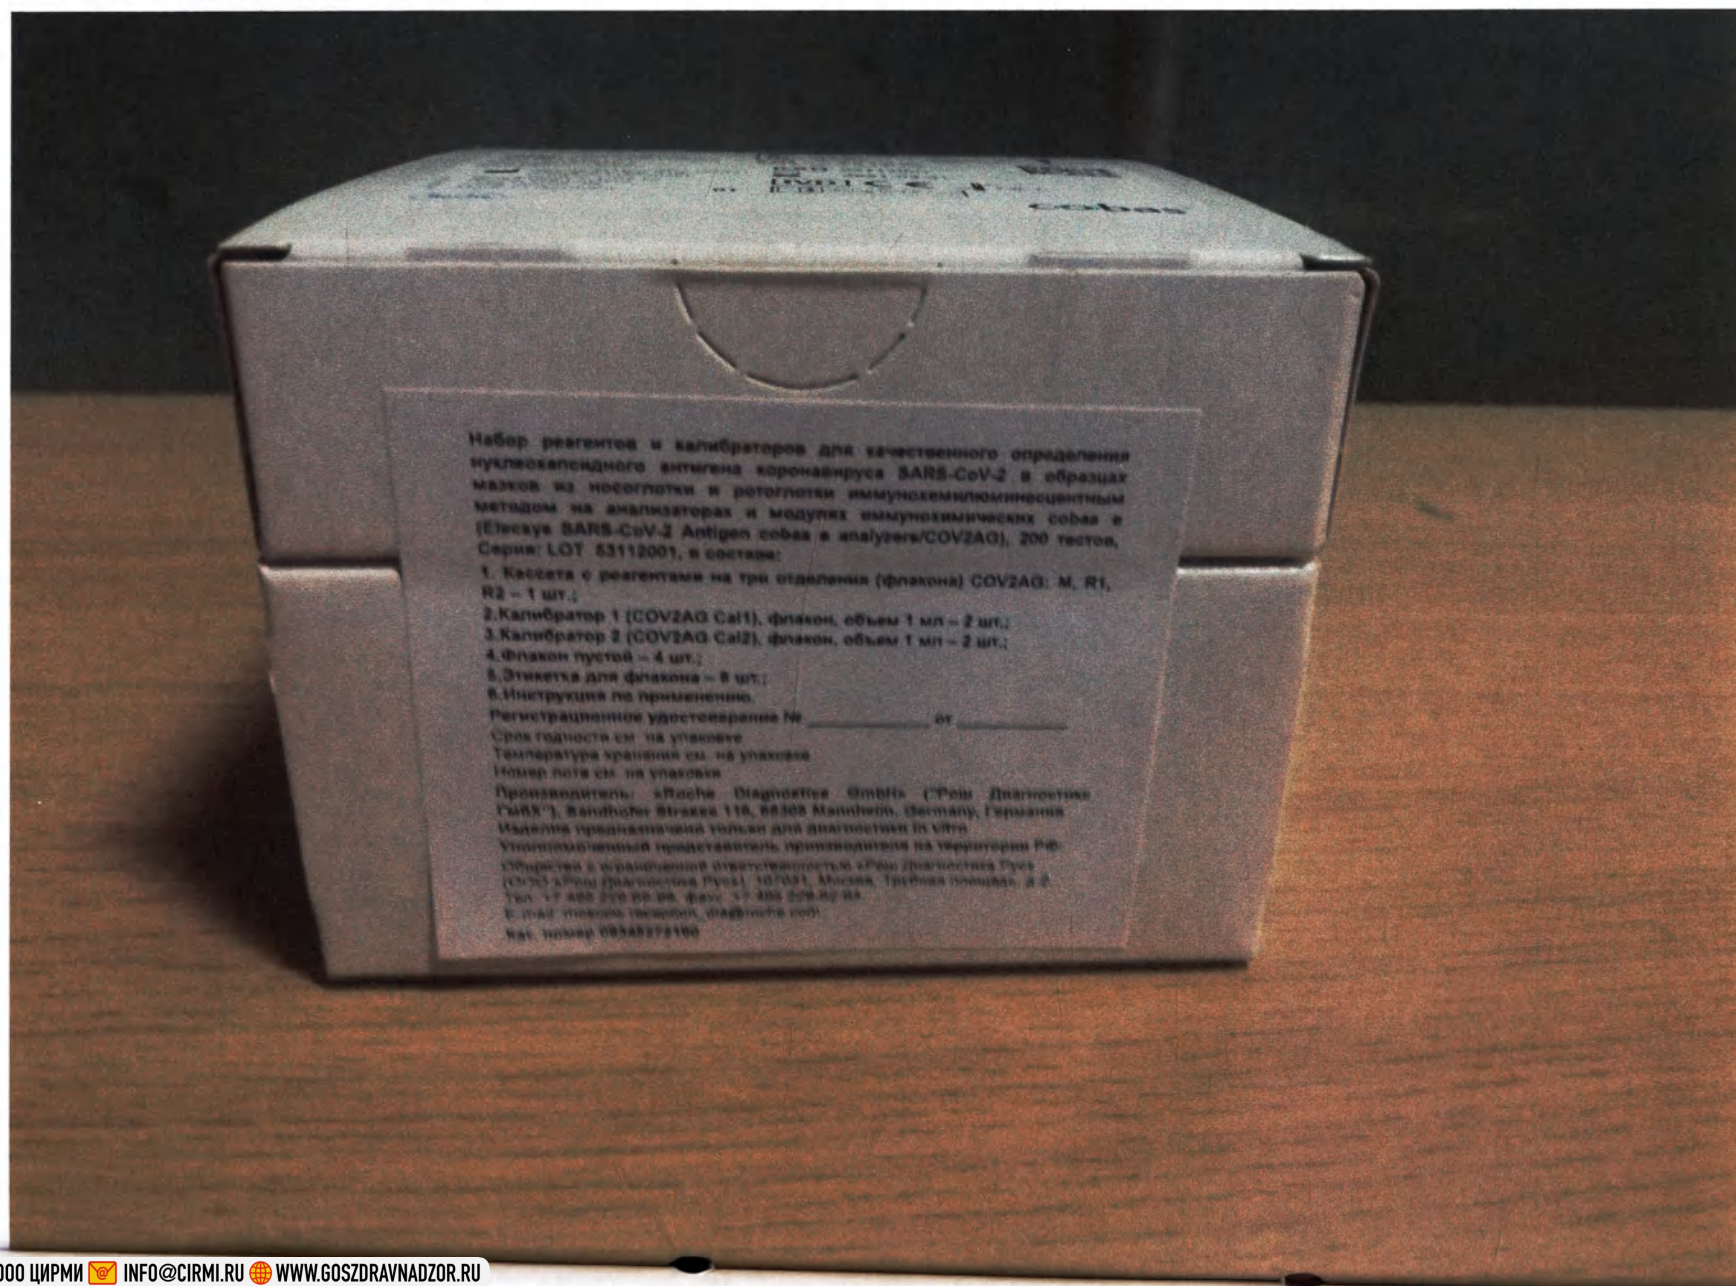

Набор реагентов и калибраторов для качественного определения нуклеокапсидного антигена коронавируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys SARS-CoV-2 Antigen cobas e analyzers/COV2AG), 200 тестов, Серия: LOT 53112001, в составе:

1. Кассета с реагентами на три отделения (флакона) COV2AG: M, R1, R2 – 1 шт.;
2. Калибратор 1 (COV2AG Cal1), флакон, объем 1 мл – 2 шт.;
3. Калибратор 2 (COV2AG Cal2), флакон, объем 1 мл – 2 шт.;
4. Флакон пустой – 4 шт.;
5. Этикетка для флакона – 8 шт.;
6. Инструкция по применению.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностика ГмбХ"), Sandhofer Strasse 118, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Идентификация только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус»

(ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д. 2


Тел: +7 495 209 09 09, Факс: +7 495 209 09 04

E-mail: info@roche.ru, diagnostika@roche.ru

Web: www.roche.ru

Набор реагентов и калибраторов для качественного определения нуклеокапсидного антигена коронавируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys SARS-CoV-2 Antigen cobas e analyzers/COV2AG), 200 тестов, Серия: LOT 53112001

1. Кассета с реагентами на три отделения (флакона) COV2AG: M, R1, R2 – 1 шт.;

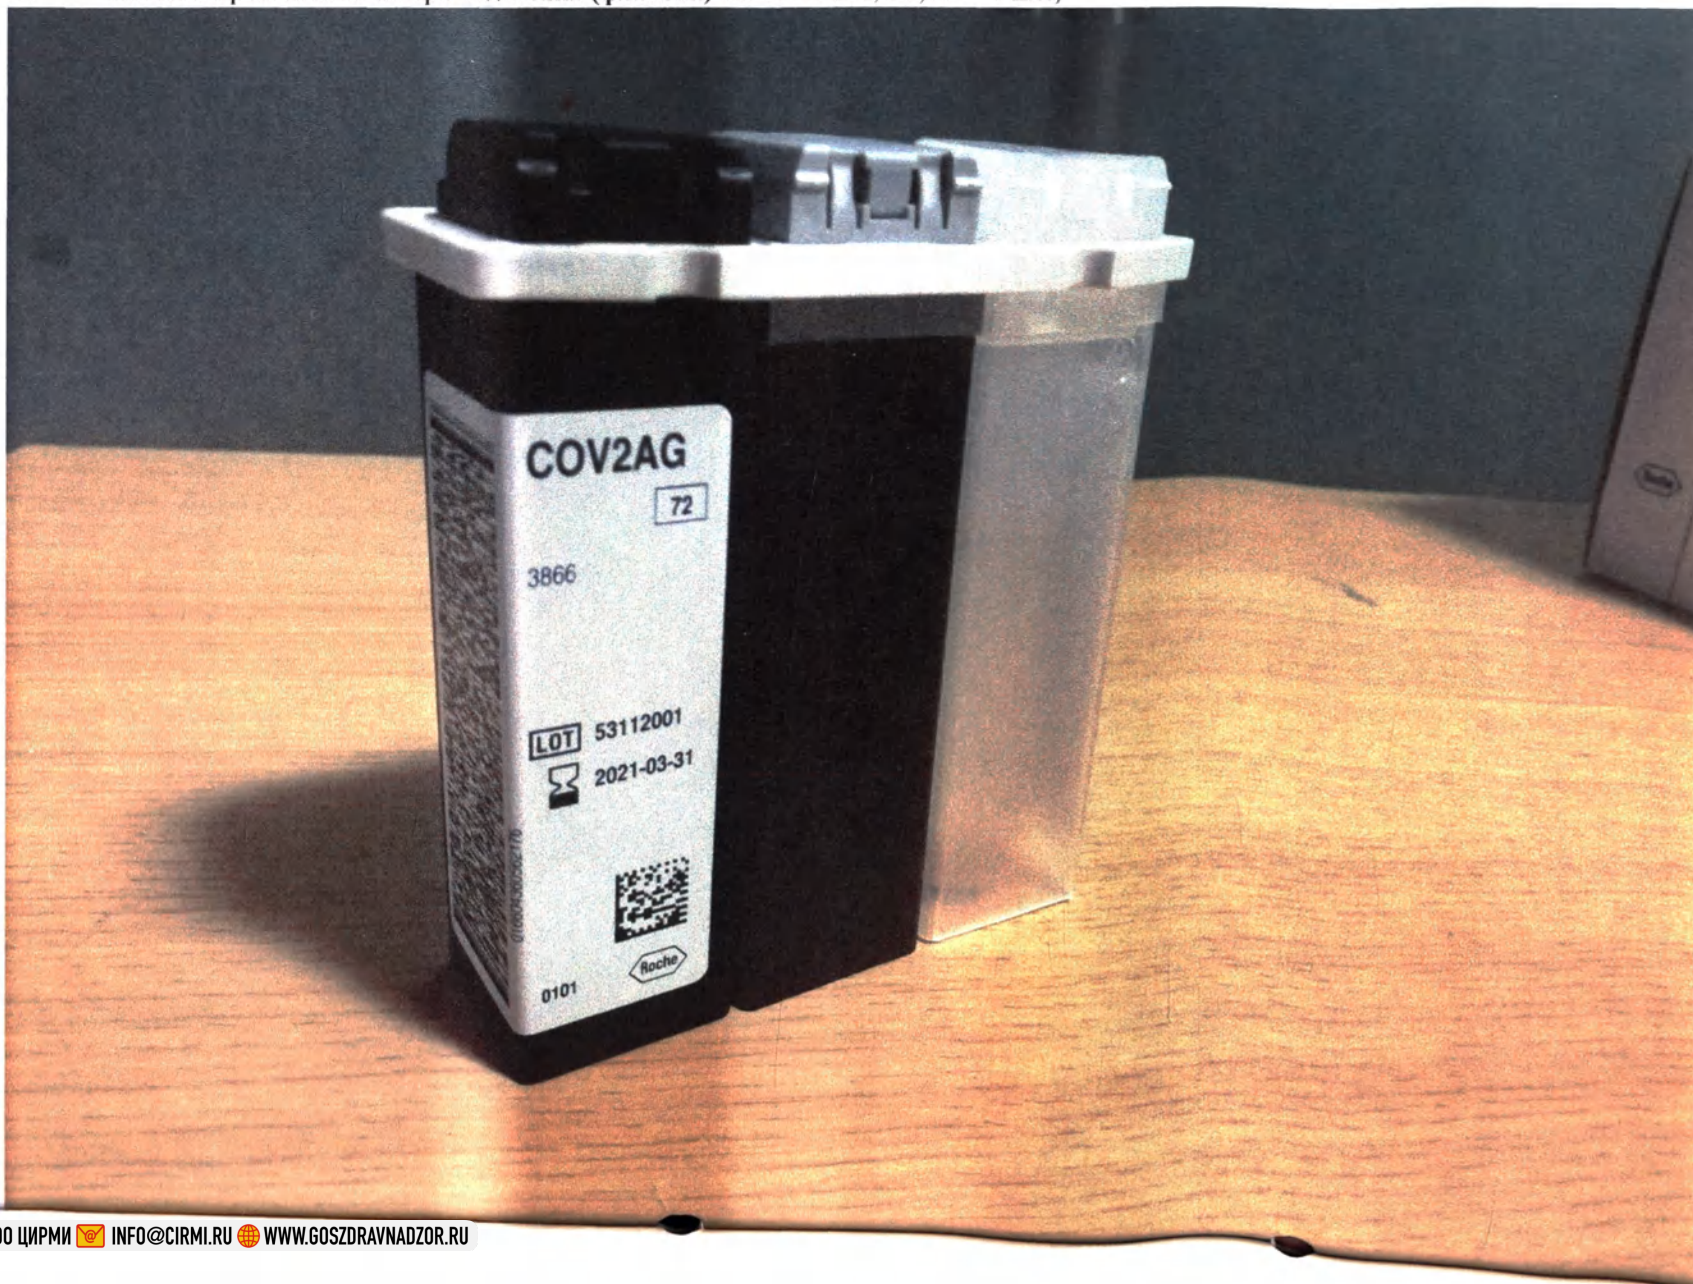

Набор реагентов и калибраторов для качественного определения нуклеокапсидного антигена коронавируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys SARS-CoV-2 Antigen cobas e analyzers/COV2AG), 200 тестов, Серия: LOT 53112001

1. Кассета с реагентами на три отделения (флакона) COV2AG: M, R1, R2 – 1 шт.;




Набор реагентов и калибраторов для качественного определения нуклеокапсидного антигена коронавируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys SARS-CoV-2 Antigen cobas e analyzers/COV2AG), 200 тестов, Серия: LOT 53112001

2. Калибратор 1 (COV2AG Cal1) флакон, объем 1 мл – 2 шт.:



Набор реагентов и калибраторов для качественного определения нуклеокапсидного антигена коронавируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys SARS-CoV-2 Antigen cobas e analyzers/COV2AG), 200 тестов, Серия: LOT 53112001

3. Калибратор 2 (COV2AG Cal2), флакон, объем 1 мл – 2 шт.;

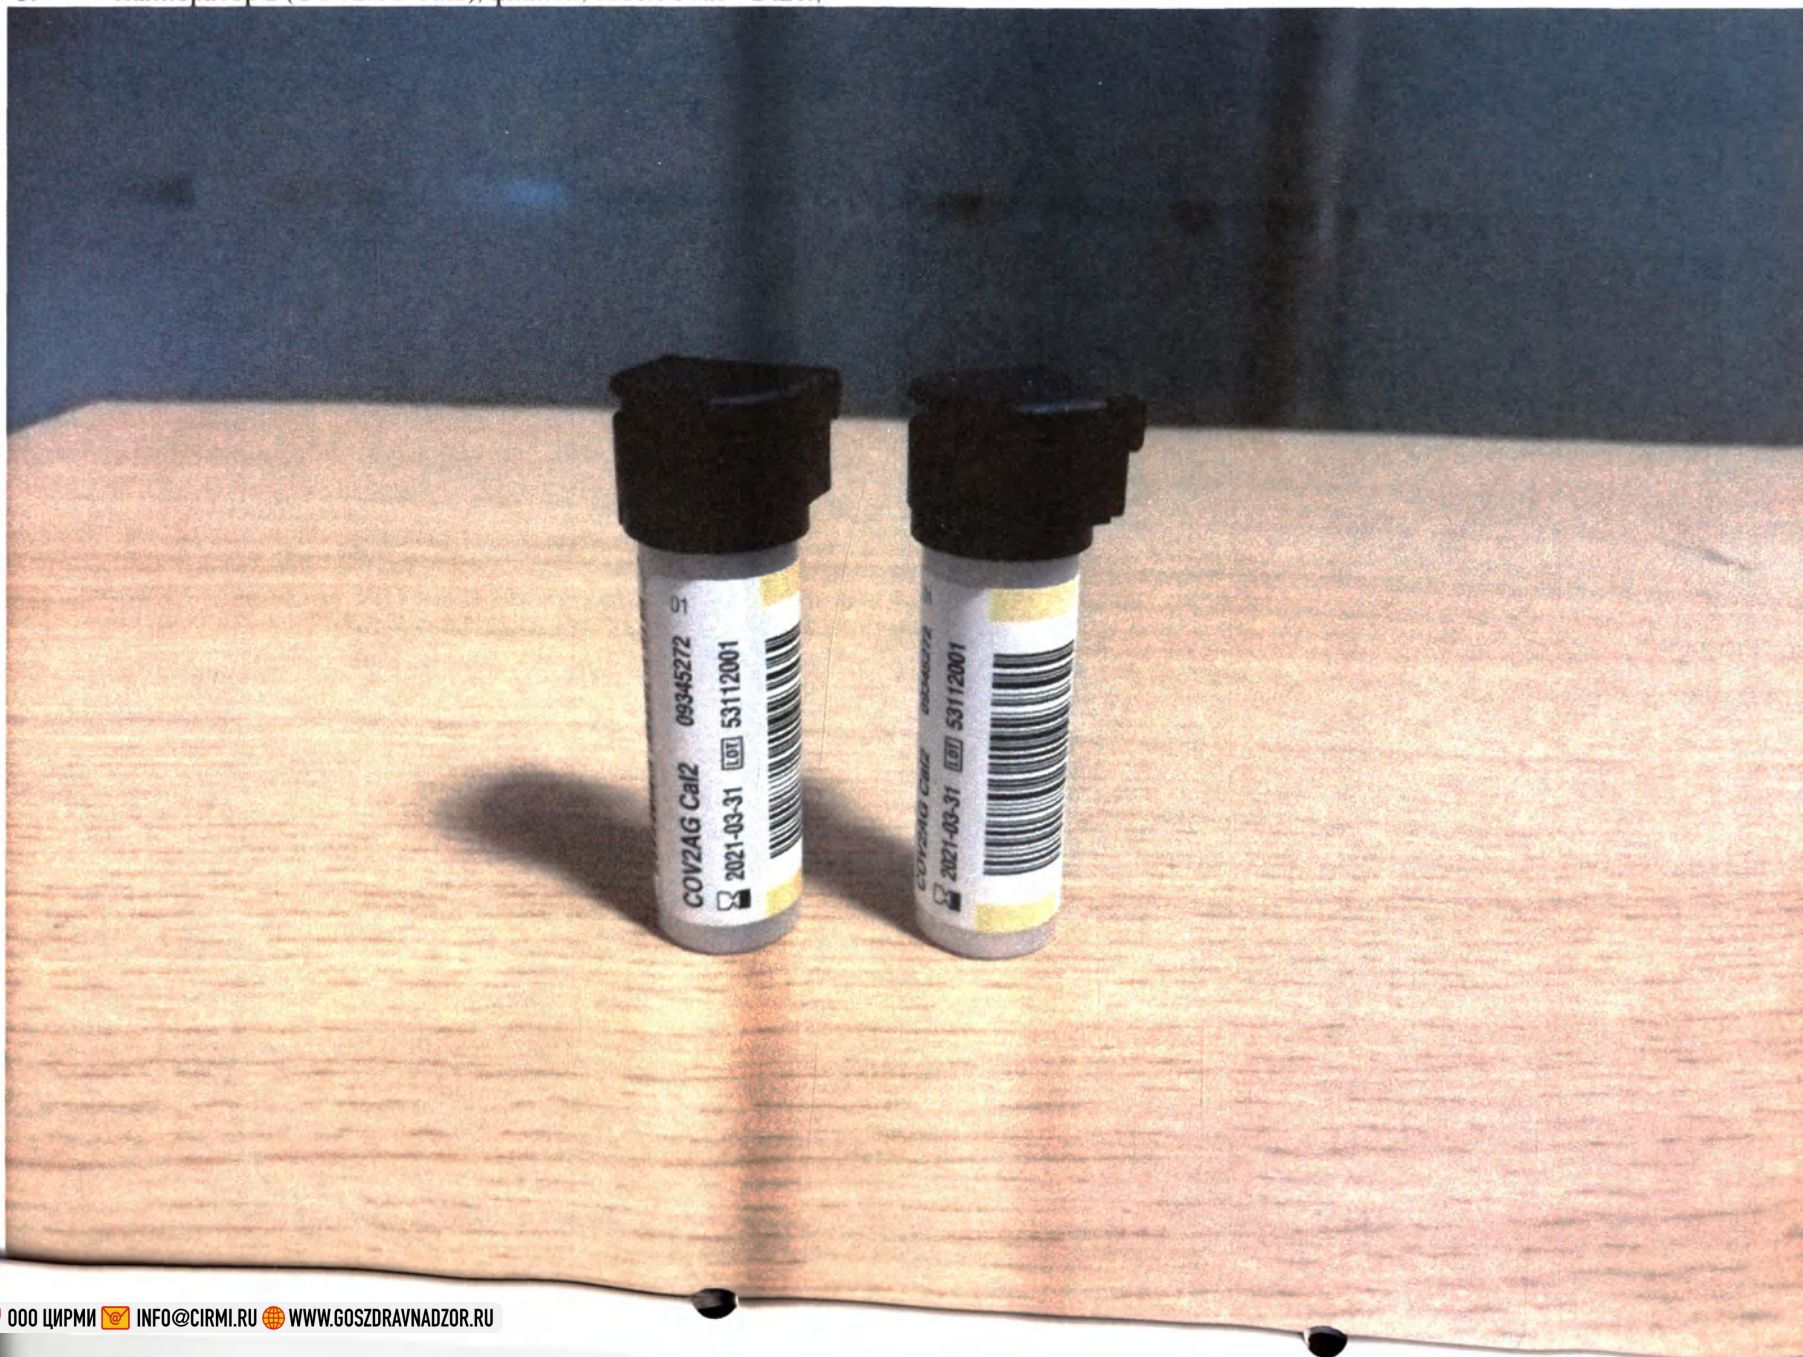

Набор реагентов и калибраторов для качественного определения нуклеокапсидного антигена коронавируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys SARS-CoV-2 Antigen cobas e analyzers/COV2AG), 200 тестов, Серия: LOT 53112001

4. Флакон пустой – 4 шт.;



Набор реагентов и калибраторов для качественного определения нуклеокапсидного антигена коронавируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys SARS-CoV-2 Antigen cobas e analyzers/COV2AG), 200 тестов, Серия: LOT 53112001

4. Флакон пустой – 4 шт.;



Набор реагентов и калибраторов для качественного определения нуклеокапсидного антигена коронавируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys SARS-CoV-2 Antigen cobas e analyzers/COV2AG), 200 тестов, Серия: LOT 53112001

5. Этикетка для флакона – 8 шт.;



Набор реагентов и калибраторов для качественного определения нуклеокапсидного антигена коронавируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys SARS-CoV-2 Antigen cobas e analyzers/COV2AG), 200 тестов, Серия: LOT 53112001
6. Инструкция по применению.

Elecsys SARS-CoV-2 Antigen

cobas®

0004572190 0004572600 200

0004572190 0004572600 200

Система информации
Для информации об анализе см. инструкцию к набору реагентов и калибраторов Elecsys SARS-CoV-2 Antigen cobas e (Lot 53112001).

Назначение
Тест Elecsys SARS-CoV-2 Antigen предназначен для качественного определения нуклеокапсидного антигена коронавируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки, полученных у пациентов с симптомами и признаками, свидетельствующими о наличии SARS-CoV-2. Тест Elecsys SARS-CoV-2 Antigen предназначен для использования на иммунохимическом анализаторе cobas e.

Технические характеристики
Тест Elecsys SARS-CoV-2 Antigen предназначен для использования на иммунохимическом анализаторе cobas e. Тест Elecsys SARS-CoV-2 Antigen предназначен для использования на иммунохимическом анализаторе cobas e. Тест Elecsys SARS-CoV-2 Antigen предназначен для использования на иммунохимическом анализаторе cobas e.

Область применения
Тест Elecsys SARS-CoV-2 Antigen предназначен для использования на иммунохимическом анализаторе cobas e. Тест Elecsys SARS-CoV-2 Antigen предназначен для использования на иммунохимическом анализаторе cobas e. Тест Elecsys SARS-CoV-2 Antigen предназначен для использования на иммунохимическом анализаторе cobas e.

Преимущества
Тест Elecsys SARS-CoV-2 Antigen предназначен для использования на иммунохимическом анализаторе cobas e. Тест Elecsys SARS-CoV-2 Antigen предназначен для использования на иммунохимическом анализаторе cobas e. Тест Elecsys SARS-CoV-2 Antigen предназначен для использования на иммунохимическом анализаторе cobas e.

Область применения
Тест Elecsys SARS-CoV-2 Antigen предназначен для использования на иммунохимическом анализаторе cobas e. Тест Elecsys SARS-CoV-2 Antigen предназначен для использования на иммунохимическом анализаторе cobas e. Тест Elecsys SARS-CoV-2 Antigen предназначен для использования на иммунохимическом анализаторе cobas e.

Преимущества
Тест Elecsys SARS-CoV-2 Antigen предназначен для использования на иммунохимическом анализаторе cobas e. Тест Elecsys SARS-CoV-2 Antigen предназначен для использования на иммунохимическом анализаторе cobas e. Тест Elecsys SARS-CoV-2 Antigen предназначен для использования на иммунохимическом анализаторе cobas e.

Область применения
Тест Elecsys SARS-CoV-2 Antigen предназначен для использования на иммунохимическом анализаторе cobas e. Тест Elecsys SARS-CoV-2 Antigen предназначен для использования на иммунохимическом анализаторе cobas e. Тест Elecsys SARS-CoV-2 Antigen предназначен для использования на иммунохимическом анализаторе cobas e.

Преимущества
Тест Elecsys SARS-CoV-2 Antigen предназначен для использования на иммунохимическом анализаторе cobas e. Тест Elecsys SARS-CoV-2 Antigen предназначен для использования на иммунохимическом анализаторе cobas e. Тест Elecsys SARS-CoV-2 Antigen предназначен для использования на иммунохимическом анализаторе cobas e.

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
15 листа (ов)



Лучина И. А.
Руководитель отдела Логистики
и качества по доверенности от:

02 ИЮЛ 2018