

**ПОДТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор  
ООО «биоМерье Рус»

Н.В. Бердникова

«30» сентября 2020 г.




**Фотографическое изображение медицинского изделия для диагностики *in vitro***

«Карты VITEK 2 AST-P для определения чувствительности *Staphylococcus* spp., *Enterococcus* spp., *Streptococcus agalactiae* к антимикробным препаратам на анализаторах автоматических бактериологических семейства VITEK 2» в вариантах исполнения:

1. Карта VITEK 2 AST-GP75, 20 шт./ уп.
2. Карта VITEK 2 AST –P651, 20 шт./ уп.,

производства «биоМерье, Инк.» (bioMérieux Inc.), США

Общий вид изделия «Карты VITEK 2 AST-P для определения чувствительности *Staphylococcus* spp., *Enterococcus* spp., *Streptococcus agalactiae* к антимикробным препаратам на анализаторах автоматических бактериологических семейства VITEK 2», вариант исполнения Карта VITEK 2 AST-GP75, 20 шт./уп.

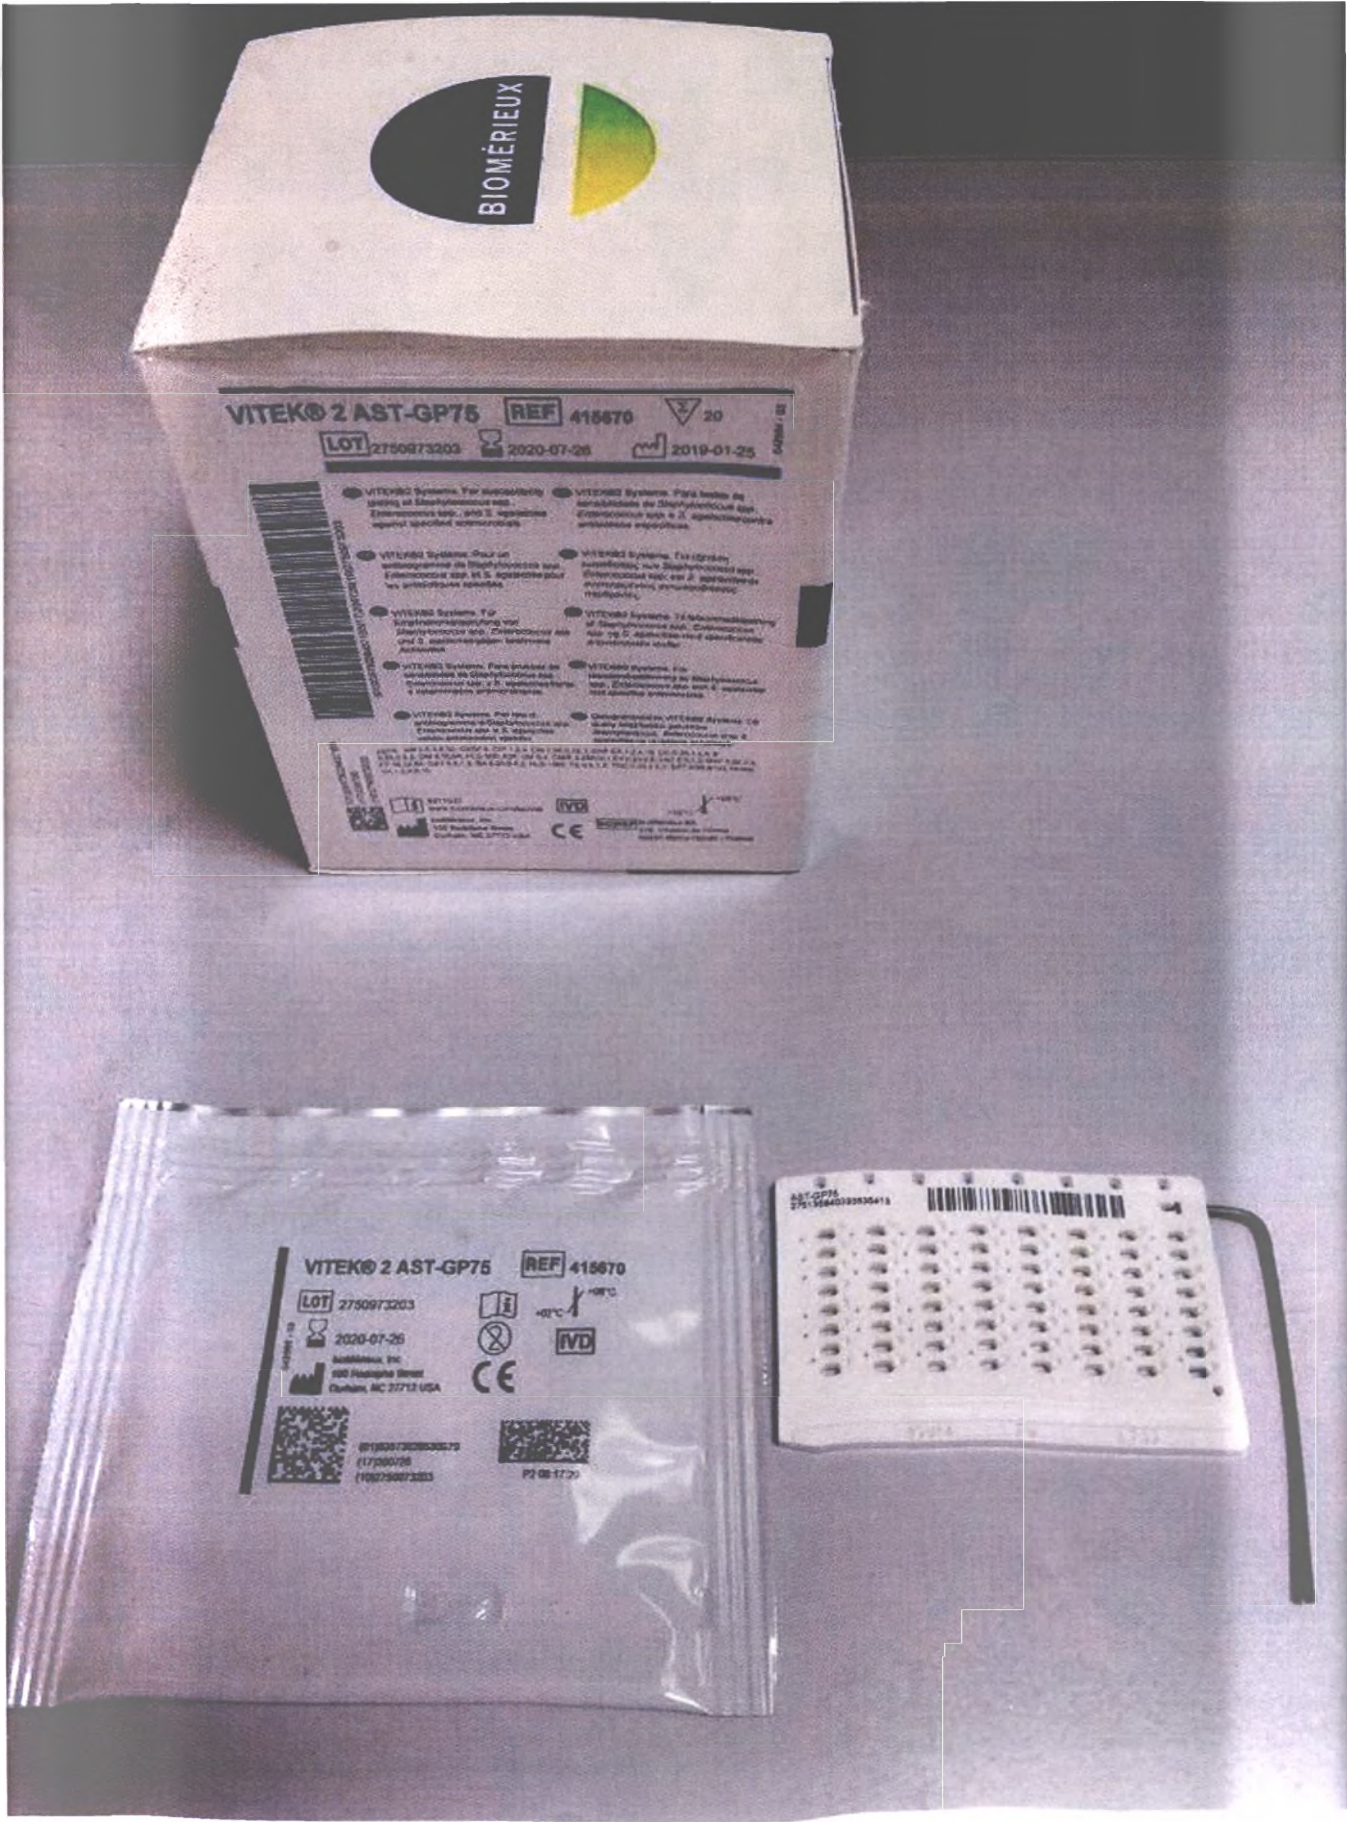

Вторичная упаковка изделия «Карты VITEK 2 AST-P для определения чувствительности *Staphylococcus* spp., *Enterococcus* spp., *Streptococcus agalactiae* к антимикробным препаратам на анализаторах автоматических бактериологических семейства VITEK 2», вариант исполнения Карта VITEK 2 AST-GP75, 20 шт./уп.

**VITEK® 2 AST-GP75**

**REF 415670**


**Σ 20**

**LOT 2750973203**

**2020-07-26**

**2019-01-25**

042564 - 03

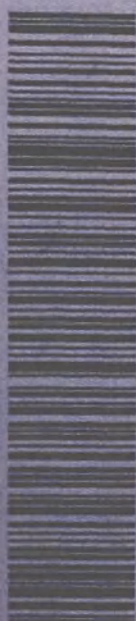

**EN** VITEK®2 Systems. For susceptibility testing of *Staphylococcus* spp., *Enterococcus* spp., and *S. agalactiae* against specified antimicrobials.

**PT** VITEK®2 Systems. Para testes de sensibilidade de *Staphylococcus* spp., *Enterococcus* spp. e *S. agalactiae* contra antibióticos específicos.

**FR** VITEK®2 Systems. Pour un antibiogramme de *Staphylococcus* spp., *Enterococcus* spp. et *S. agalactiae* pour les antibiotiques spécifiés.

**EL** VITEK®2 Systems. Για εξέταση ευαισθησίας των *Staphylococcus* spp., *Enterococcus* spp. και *S. agalactiae* σε συγκεκριμένους αντιμικροβιακούς παράγοντες.

**DE** VITEK®2 Systems. Für Empfindlichkeitsprüfung von *Staphylococcus* spp., *Enterococcus* spp. und *S. agalactiae* gegen bestimmte Antibiotika.

**UA** VITEK®2 Systems. Til falsomhedstestning af *Staphylococcus* spp., *Enterococcus* spp. og *S. agalactiae* imod specificerede antimikrobielle stoffer.

**ES** VITEK®2 Systems. Para pruebas de sensibilidad de *Staphylococcus* spp., *Enterococcus* spp. y *S. agalactiae* frente a determinados antimicrobianos.

**SV** VITEK®2 Systems. För resistensbestämning av *Staphylococcus* spp., *Enterococcus* spp. och *S. agalactiae* mot specifika antimikrobiika.

**PL** VITEK®2 Systems. Per test di antibiogramma di *Staphylococcus* spp., *Enterococcus* spp. e *S. agalactiae* contro antimicrobici specifici.

**PL** Oprogramowanie VITEK®2 Systems. Do oceny wrażliwości gatunków *Staphylococcus*, *Enterococcus* oraz *S. agalactiae* na określone antybiotyki.

µg/mL: AM 0.5,4,8,32; OXSF 8; CIP 1,2,4; CM 0.06,0.25,1; DAP 0.5,1,2,4,16; DO 0.25,1,2,4; E 0.25,0.5,2; GM 8,16,64; HLG 500; ICR: CM 0.5, CM/E 0.25/0.5; LEV 0.25,2,8; LNZ 0.5,1,2; MUF 0.25,2,8; FT 16,32,64; OX1 0.5,1,2; RA 0.25,0.5,2; HLS 1000; TE 0.5,1,2; TGC 0.25,0.5,1; SXT 2/38,8/152,16/304; VA 1,2,4,8,16

(01)03573026437183

(17)200726

(10)2750973203



9311537  
www.biomerieux.com/techlib



bioMérieux, Inc.  
100 Rodolphe Street  
Durham, NC 27712 USA




bioMérieux SA  
376, Chemin de l'Orme  
69290 Marcy-l'Etoile - France

+08°C  
+02°C


Вторичная упаковка изделия «Карты VITEK 2 AST-P для определения чувствительности *Staphylococcus* spp., *Enterococcus* spp., *Streptococcus agalactiae* к антимикробным препаратам на анализаторах автоматических бактериологических семейства VITEK 2», вариант исполнения Карта VITEK 2 AST-GP75, 20 шт./уп.



Внешний вид изделия «Карты VITEK 2 AST-P для определения чувствительности *Staphylococcus* spp., *Enterococcus* spp., *Streptococcus agalactiae* к антимикробным препаратам на анализаторах автоматических бактериологических семейства VITEK 2», вариант исполнения Карта VITEK 2 AST-GP75, 20 шт./уп.

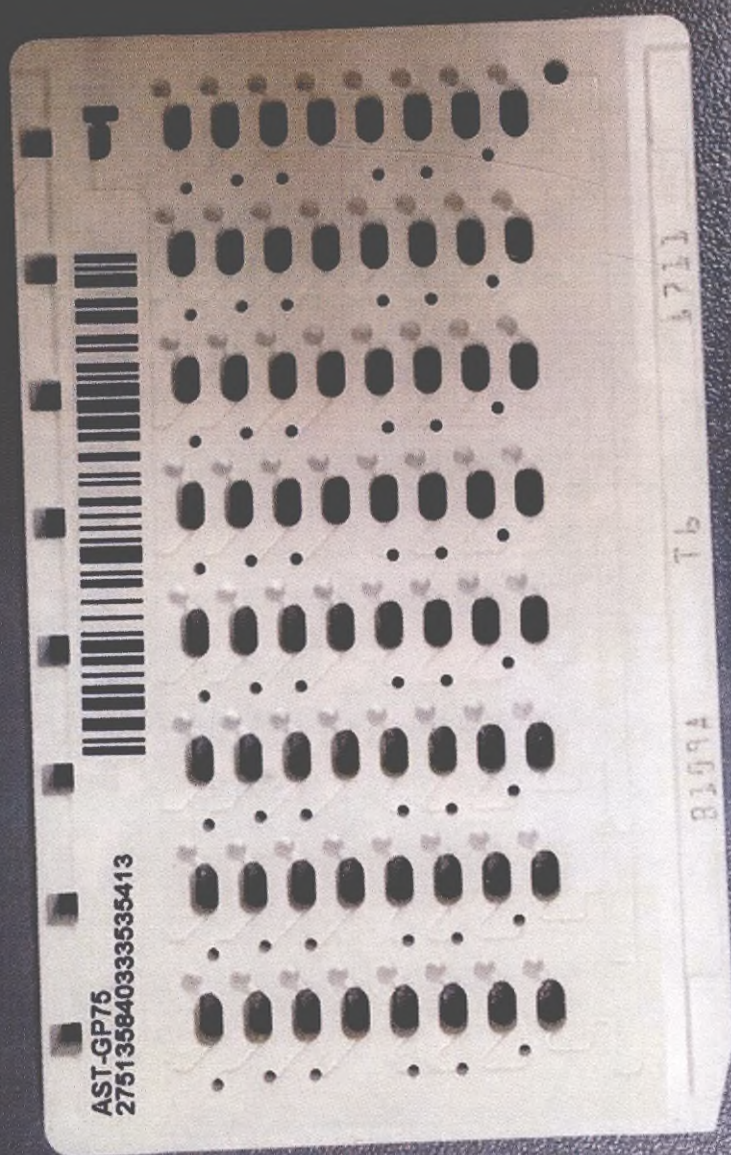

Общий вид изделия «Карты VITEK 2 AST-P для определения чувствительности *Staphylococcus* spp., *Enterococcus* spp., *Streptococcus agalactiae* к антимикробным препаратам на анализаторах автоматических бактериологических семейства VITEK 2», вариант исполнения Карта VITEK 2 AST-P651, 20 шт./уп.

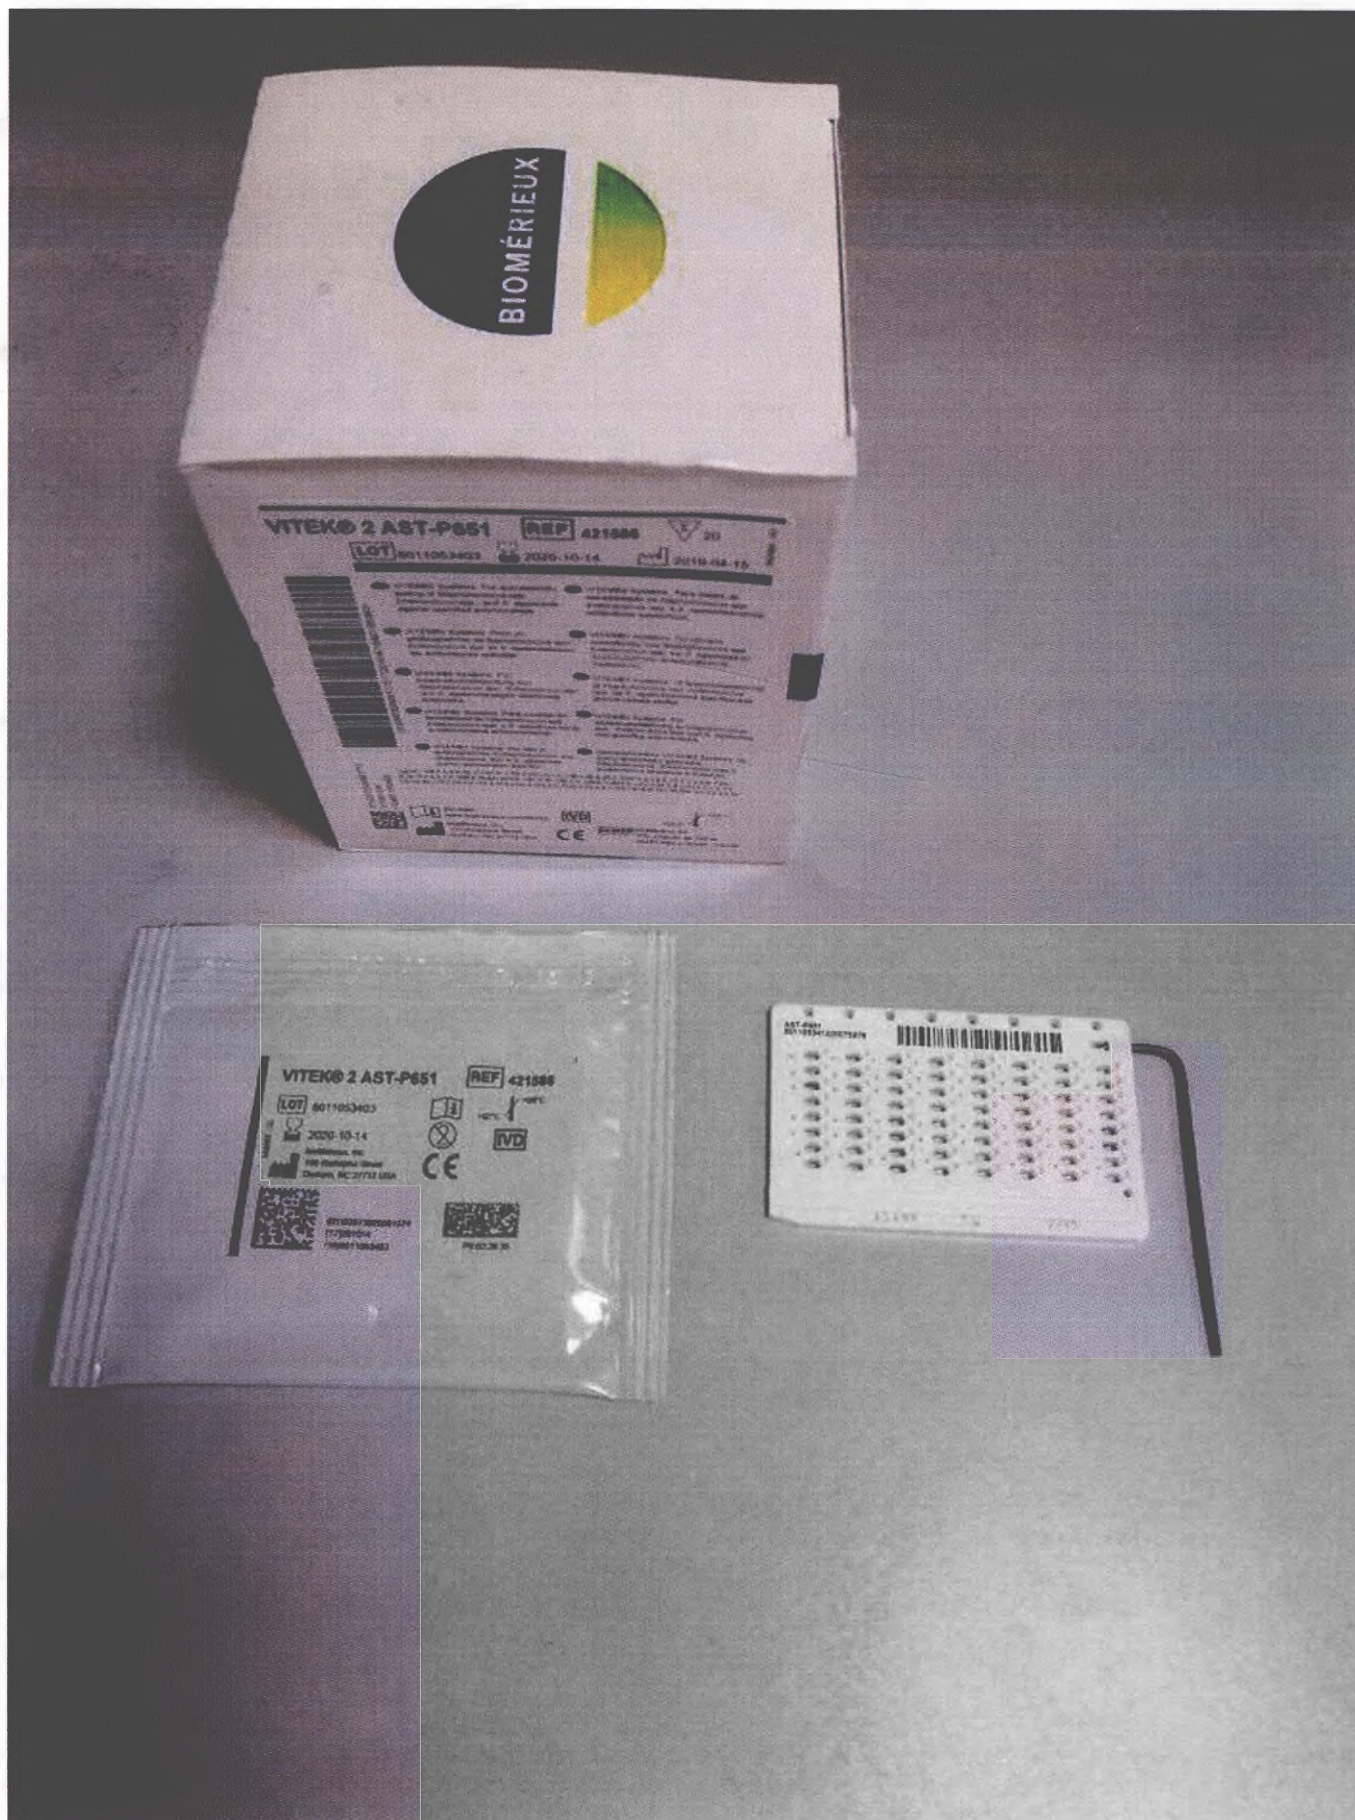

Вторичная упаковка изделия «Карты VITEK 2 AST-P для определения чувствительности *Staphylococcus* spp., *Enterococcus* spp., *Streptococcus agalactiae* к антимикробным препаратам на анализаторах автоматических бактериологических семейства VITEK 2», вариант исполнения Карта VITEK 2 AST-P651, 20 шт./уп.

**VITEK® 2 AST-P651**

**REF 421586**


**Σ 20**

**LOT 8011053403**

**2020-10-14**

**2019-04-15**

042564 - 03

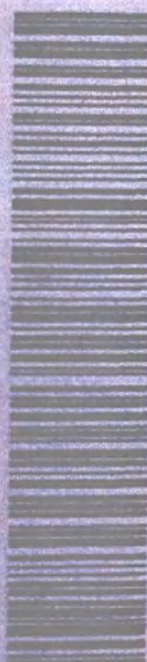

**EN** VITEK®2 Systems. For susceptibility testing of *Staphylococcus* spp., *Enterococcus* spp., and *S. agalactiae* against specified antimicrobials.

**PT** VITEK®2 Systems. Para testes de sensibilidade de *Staphylococcus* spp., *Enterococcus* spp. e *S. agalactiae* contra antibióticos específicos.

**FR** VITEK®2 Systems. Pour un antibiogramme de *Staphylococcus* spp., *Enterococcus* spp. et *S. agalactiae* pour les antibiotiques spécifiés.

**EL** VITEK®2 Systems. Για εξέταση ευαισθησίας των *Staphylococcus* spp., *Enterococcus* spp. και *S. agalactiae* σε συγκεκριμένους αντιμικροβιακούς παράγοντες.

**DE** VITEK®2 Systems. Für Empfindlichkeitsprüfung von *Staphylococcus* spp., *Enterococcus* spp. und *S. agalactiae* gegen bestimmte Antibiotika.

**DA** VITEK®2 Systems. Til følsomhedstestning af *Staphylococcus* spp., *Enterococcus* spp. og *S. agalactiae* imod specificerede antimikrobielle stoffer.

**ES** VITEK®2 Systems. Para pruebas de sensibilidad de *Staphylococcus* spp., *Enterococcus* spp. y *S. agalactiae* frente a determinados antimicrobianos.

**SV** VITEK®2 Systems. För resistensbestämning av *Staphylococcus* spp., *Enterococcus* spp. och *S. agalactiae* mot specifika antimikrobika.

**IT** VITEK®2 Systems. Per test di antibiogramma di *Staphylococcus* spp., *Enterococcus* spp. e *S. agalactiae* contro antimicrobici specifici.

**PL** Oprogramowanie VITEK®2 Systems. Do oceny wrażliwości gatunków *Staphylococcus*, *Enterococcus* oraz *S. agalactiae* na określone antybiotyki.

up/mL: AM 0.5,4,8,32; OXSF 8; CTR 0.25,0.5,1,2; CM 0.06,0.25,1; DAP 0.5,1,2,4,16; E 1,2,4,8; FOS 8,32; FA 0.5,1,4; GM 8,16,64; GHLR 150; ICR: CM 0.5, CM/E 0.25/0.5; LEV 0.25,2,8; LNZ 0.5,1,2; FT 16,32,64; OX1 0.5,1,2; RA 0.015,0.03,0.125,0.5; TGC 0.25,0.5,1; SXT 2/38,8/152,16/304; VA 1,2,4,8,16

(01)03573026561772  
(17)201014  
(10)8011053403



9312987

[www.biomerieux.com/techlib](http://www.biomerieux.com/techlib)




bioMérieux, Inc.  
100 Rodolphe Street  
Durham, NC 27712 USA




bioMérieux SA  
376, Chemin de l'Orme  
69280 Marcy-l'Etoile - France

+08°C  
+02°C

Вторичная упаковка изделия «Карты VITEK 2 AST-P для определения чувствительности *Staphylococcus* spp., *Enterococcus* spp., *Streptococcus agalactiae* к антимикробным препаратам на анализаторах автоматических бактериологических семейства VITEK 2», вариант исполнения Карта VITEK 2 AST-P651, 20 шт./уп.

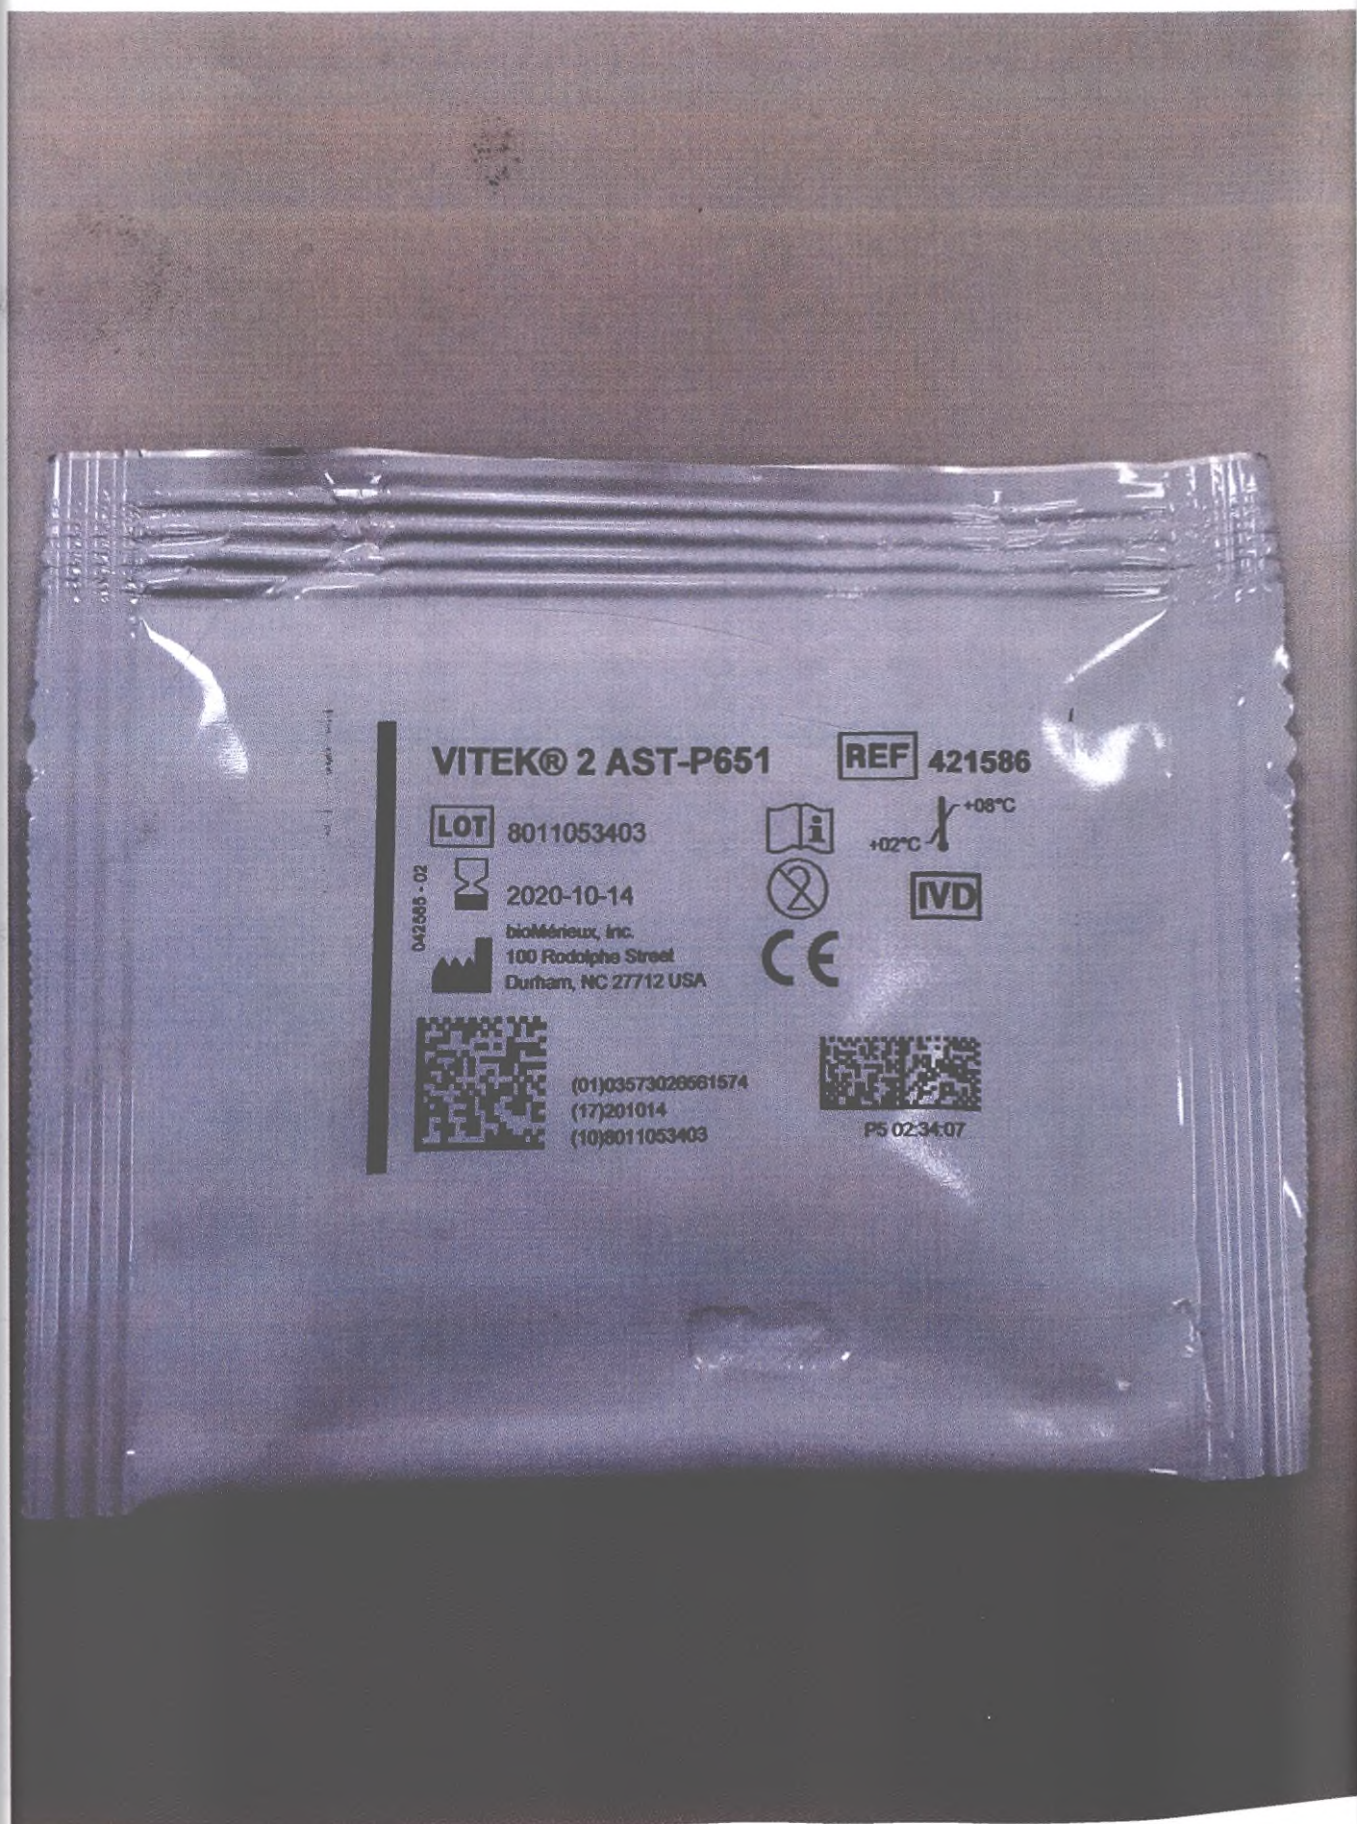

Внешний вид изделия «Карты VITEK 2 AST-P для определения чувствительности *Staphylococcus* spp., *Enterococcus* spp., *Streptococcus agalactiae* к антимикробным препаратам на анализаторах автоматических бактериологических семейства VITEK 2», вариант исполнения Карта VITEK 2 AST-P651, 20 шт./уп.

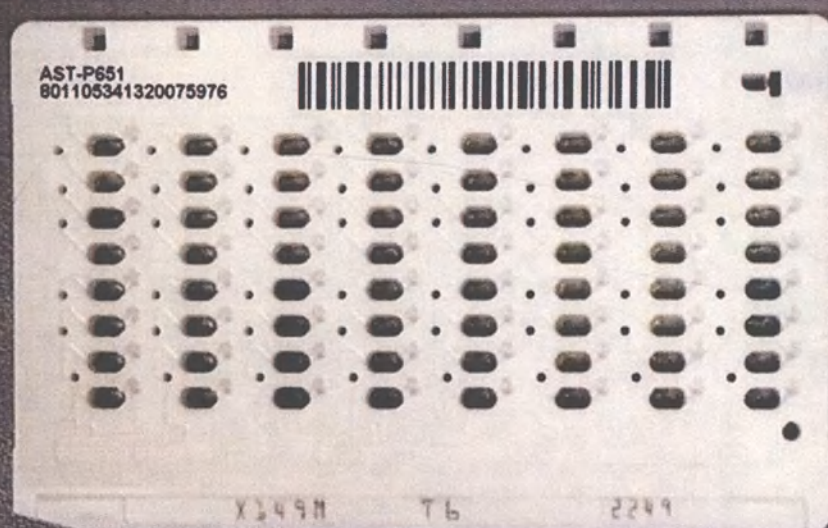

Прошито и пронумеровано

9 листов

« 30 » июня 20 20 года

Генеральный директор

Бердникова Н.В.

