«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ЗАО «МЕДИЭЙС»
Викторов Н.В.
16 ноября 2020 г.

Фотографические изображения медицинского изделия

«Ультразвуковая диагностическая система HS70A-RUS с принадлежностями»

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Наименование принадлежности	*№ страницы*
Ультразвуковая диагностическая система HS70A-RUS	4
Электронная консоль, Панель управления, Специальный LED Монитор, Сенсорная панель, Держатель датчиков	5
Сетевой кабель	6
Руководство пользователя	7
Конвексные датчики: CA2-8A	8
Конвексные датчики CF4-9	9
Конвексные датчики C2-6	10
Ковексный монокристальный датчик CA1-7A	11
Ковексный монокристальный датчик CA3-10A	12
Ковексный монокристальный датчик CA2-9A	13
Конвексный внутриполостный датчик E3-12A	14
Конвексный внутриполостный датчик VR5-9	15
Конвексный внутриполостный датчик EA2-11B	16
Объемный конвексный датчик CV1-8A	17
Объемный внутриполостной датчик V5-9	18
Объемный внутриполостной датчик EV2-10A	19
Объемный линейный датчик LV3-14A	20
Линейный датчик L3-12A	21
Линейный датчик LA3-16A	22
Линейный датчик LA3-16AI	23
Линейный датчик LA2-9A	24
Линейный датчик LA4-18B	25
Линейный датчик LM4-15B	26
Фазированный датчик PE2-4	27
Фазированный датчик PA3-8B	28
Фазированный датчик PA4-12B	29
Фазированный датчик PA1-5A	30
Постоянно-волновой датчик DP2B	31
Постоянно-волновой датчик CW4.0	32

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Постоянно-волновой датчик CW6.0..... 33
Карандашный датчик DP8B..... 34
Чреспищеводный датчик MMPT3-7 35
Набор для проведения биопсии,в составе: насадка для биопсии, крепление, направляющая иглы..... 36
Ножной переключатель 37
Подогреватель геля 38
Флеш-накопитель информации..... 39
Держатель датчиков EC 40
Накладка силиконовая на клавиатуру CP SKIN 41
Пример лицензионного ключа для активации функции..... 42
Маркировка изделия..... 43

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Ультразвуковая диагностическая система HS70A-RUS

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

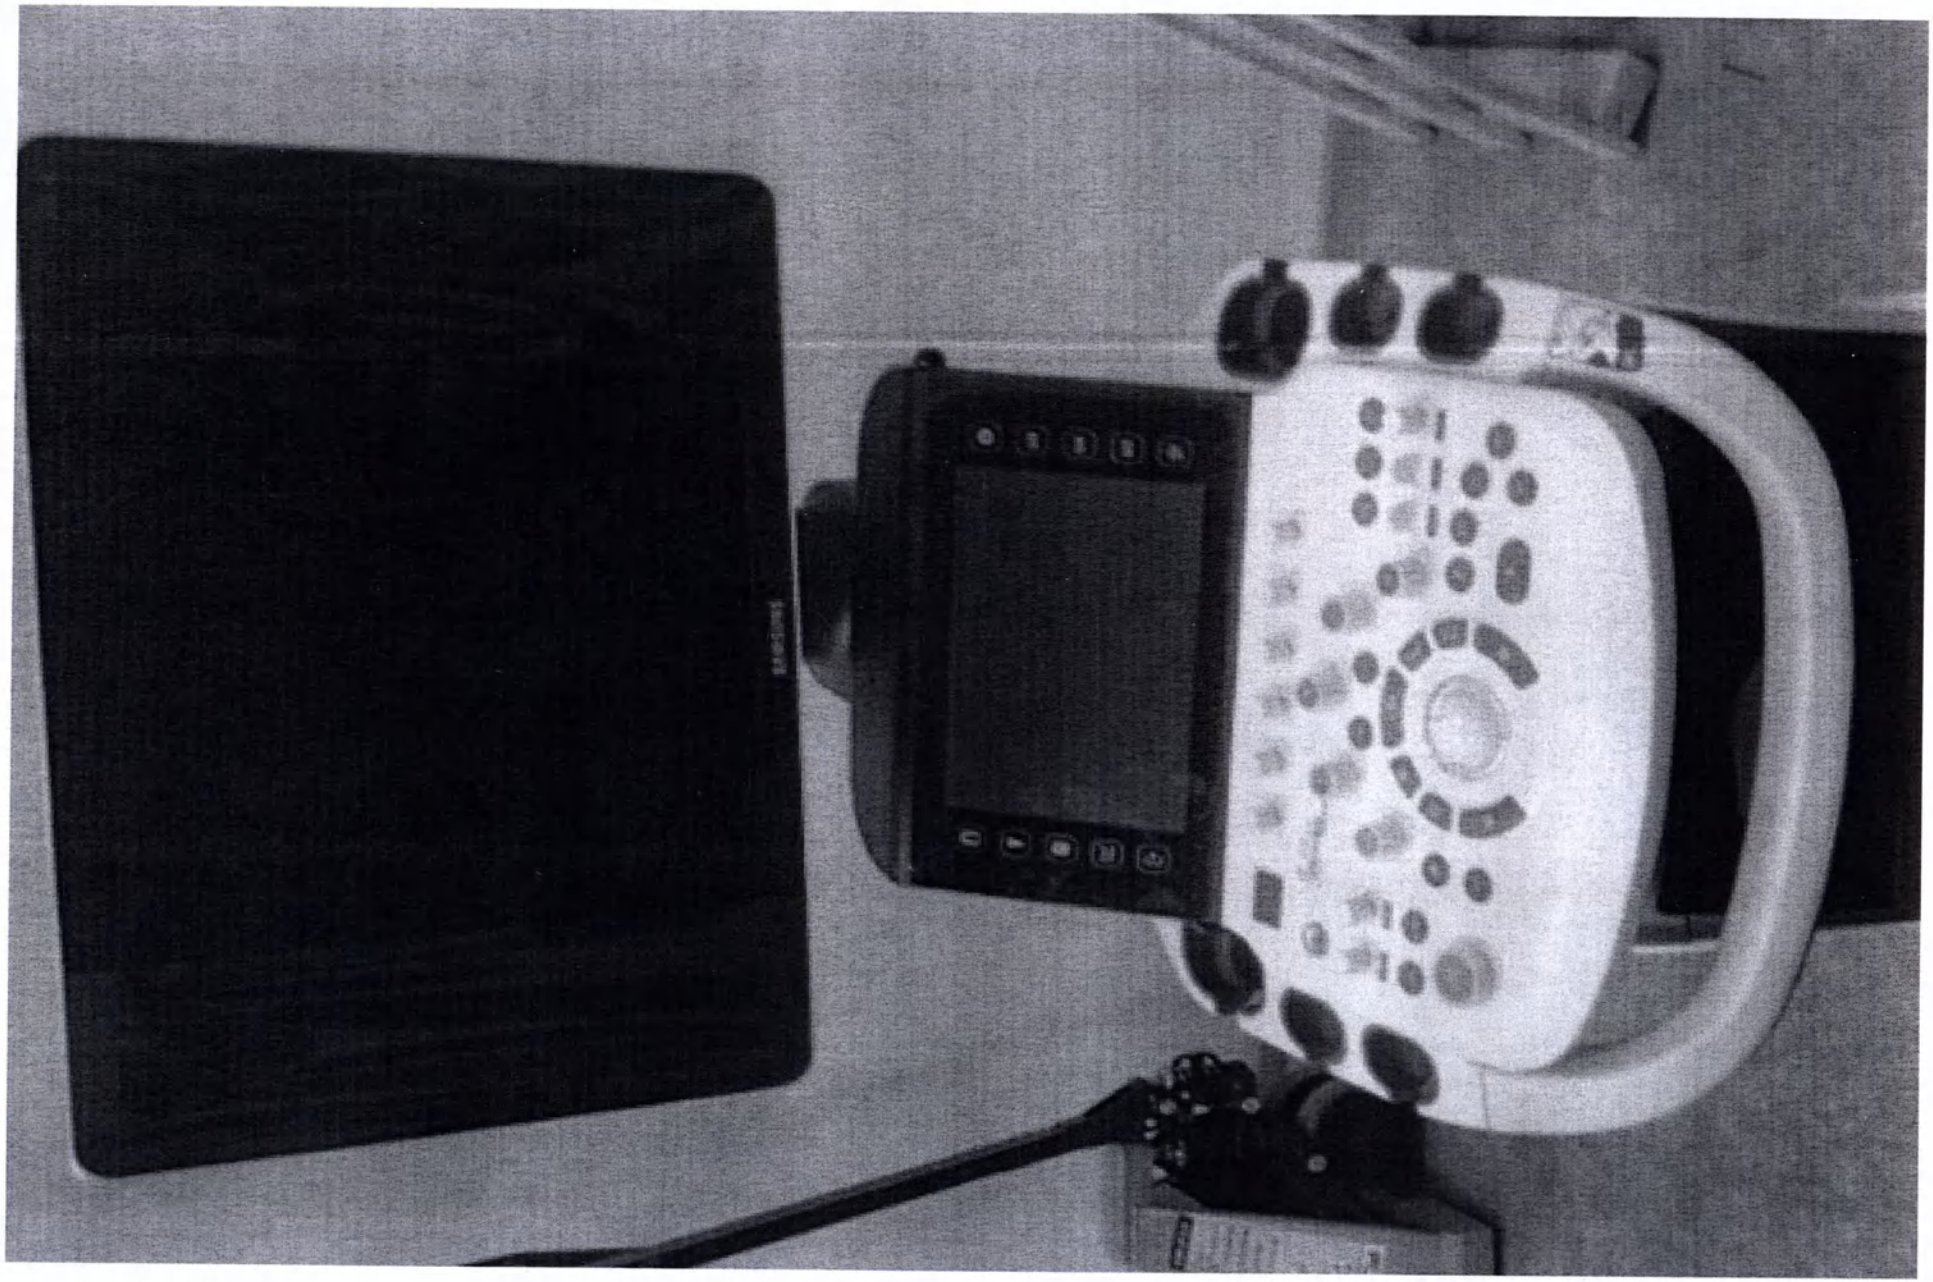

Электронная консоль, Панель управления, Специальный LED Монитор, Сенсорная панель, Держатель датчиков

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

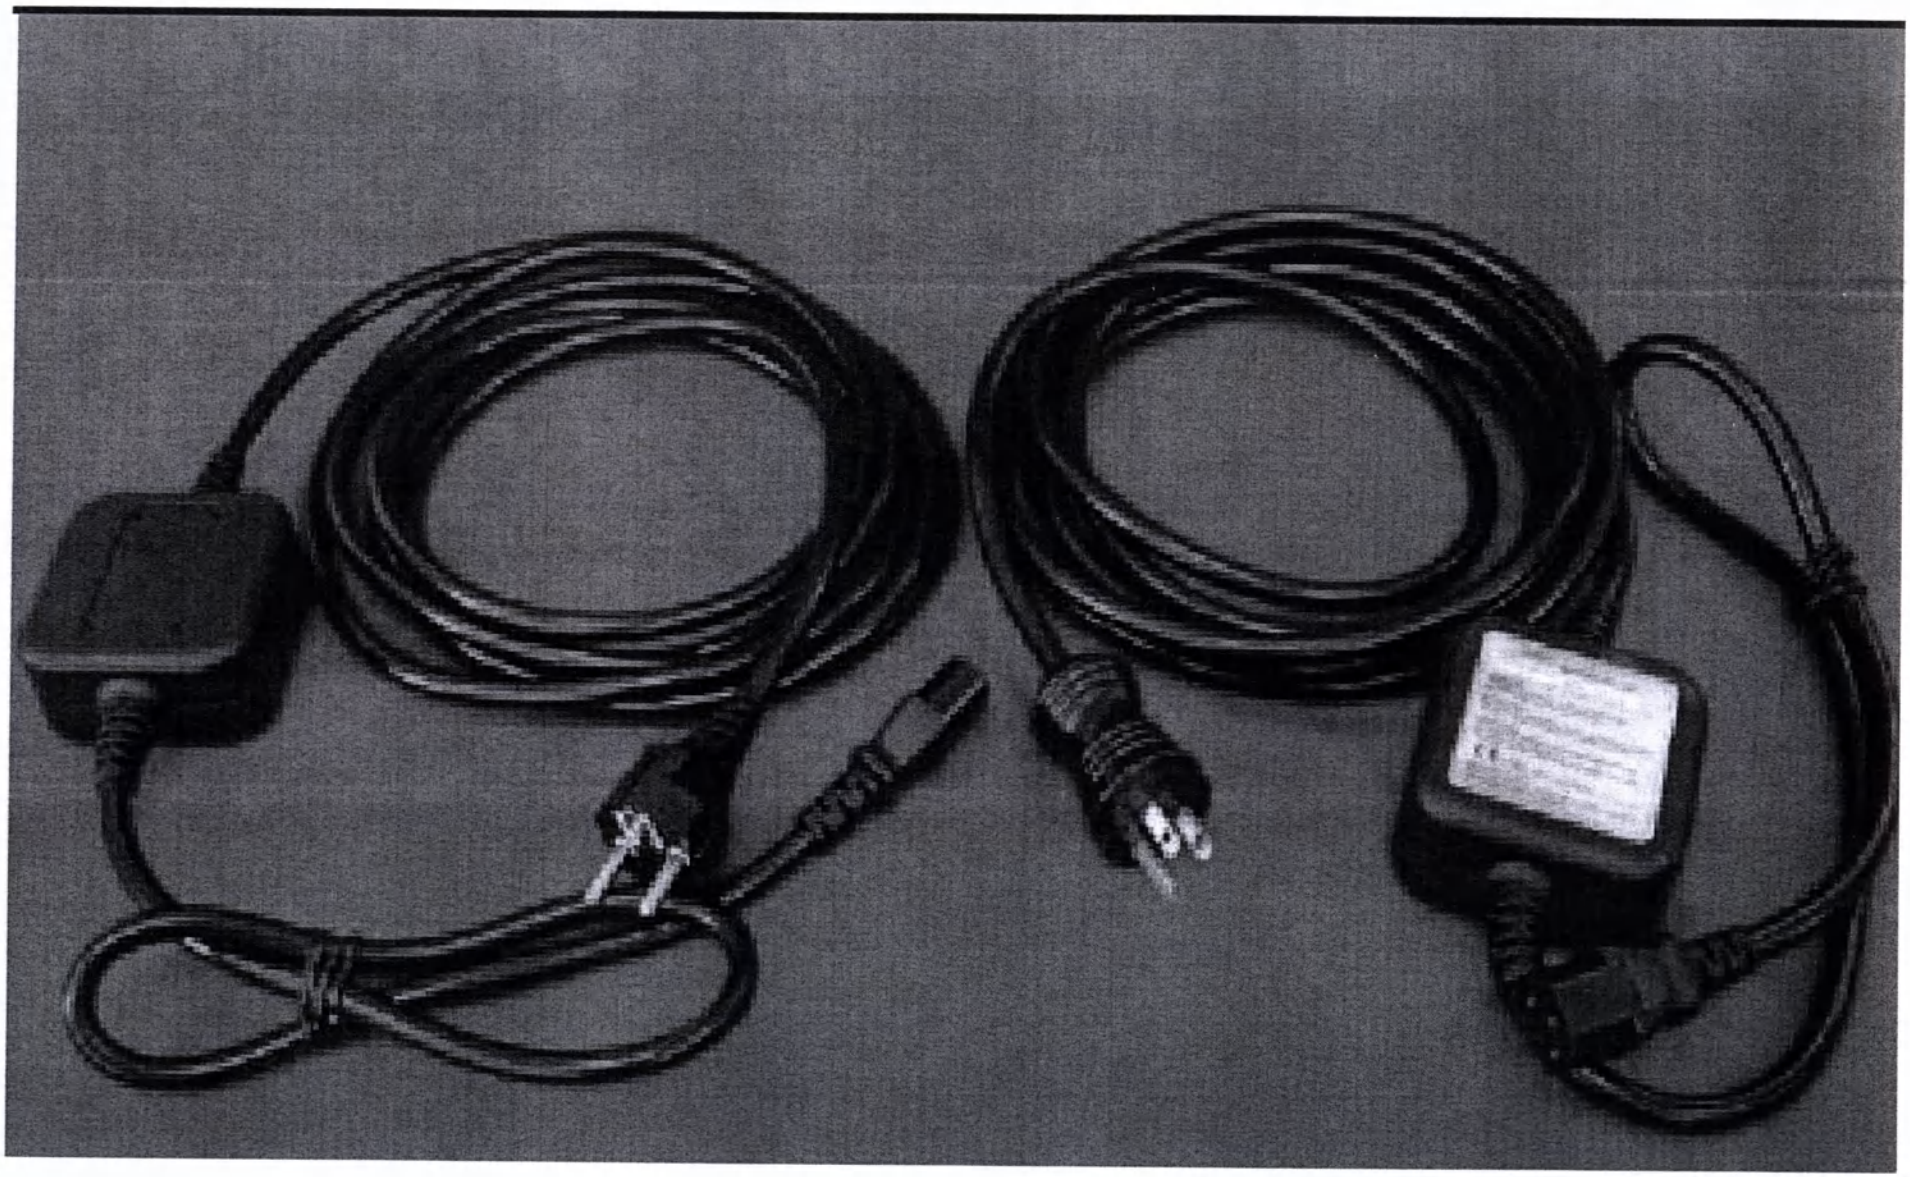

Сетевой кабель

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

SAMSUNG

SAMSUNG MEDISON
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Версия 1.00

HS70A-RUS

Руководство пользователя

Том 1

Русский

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

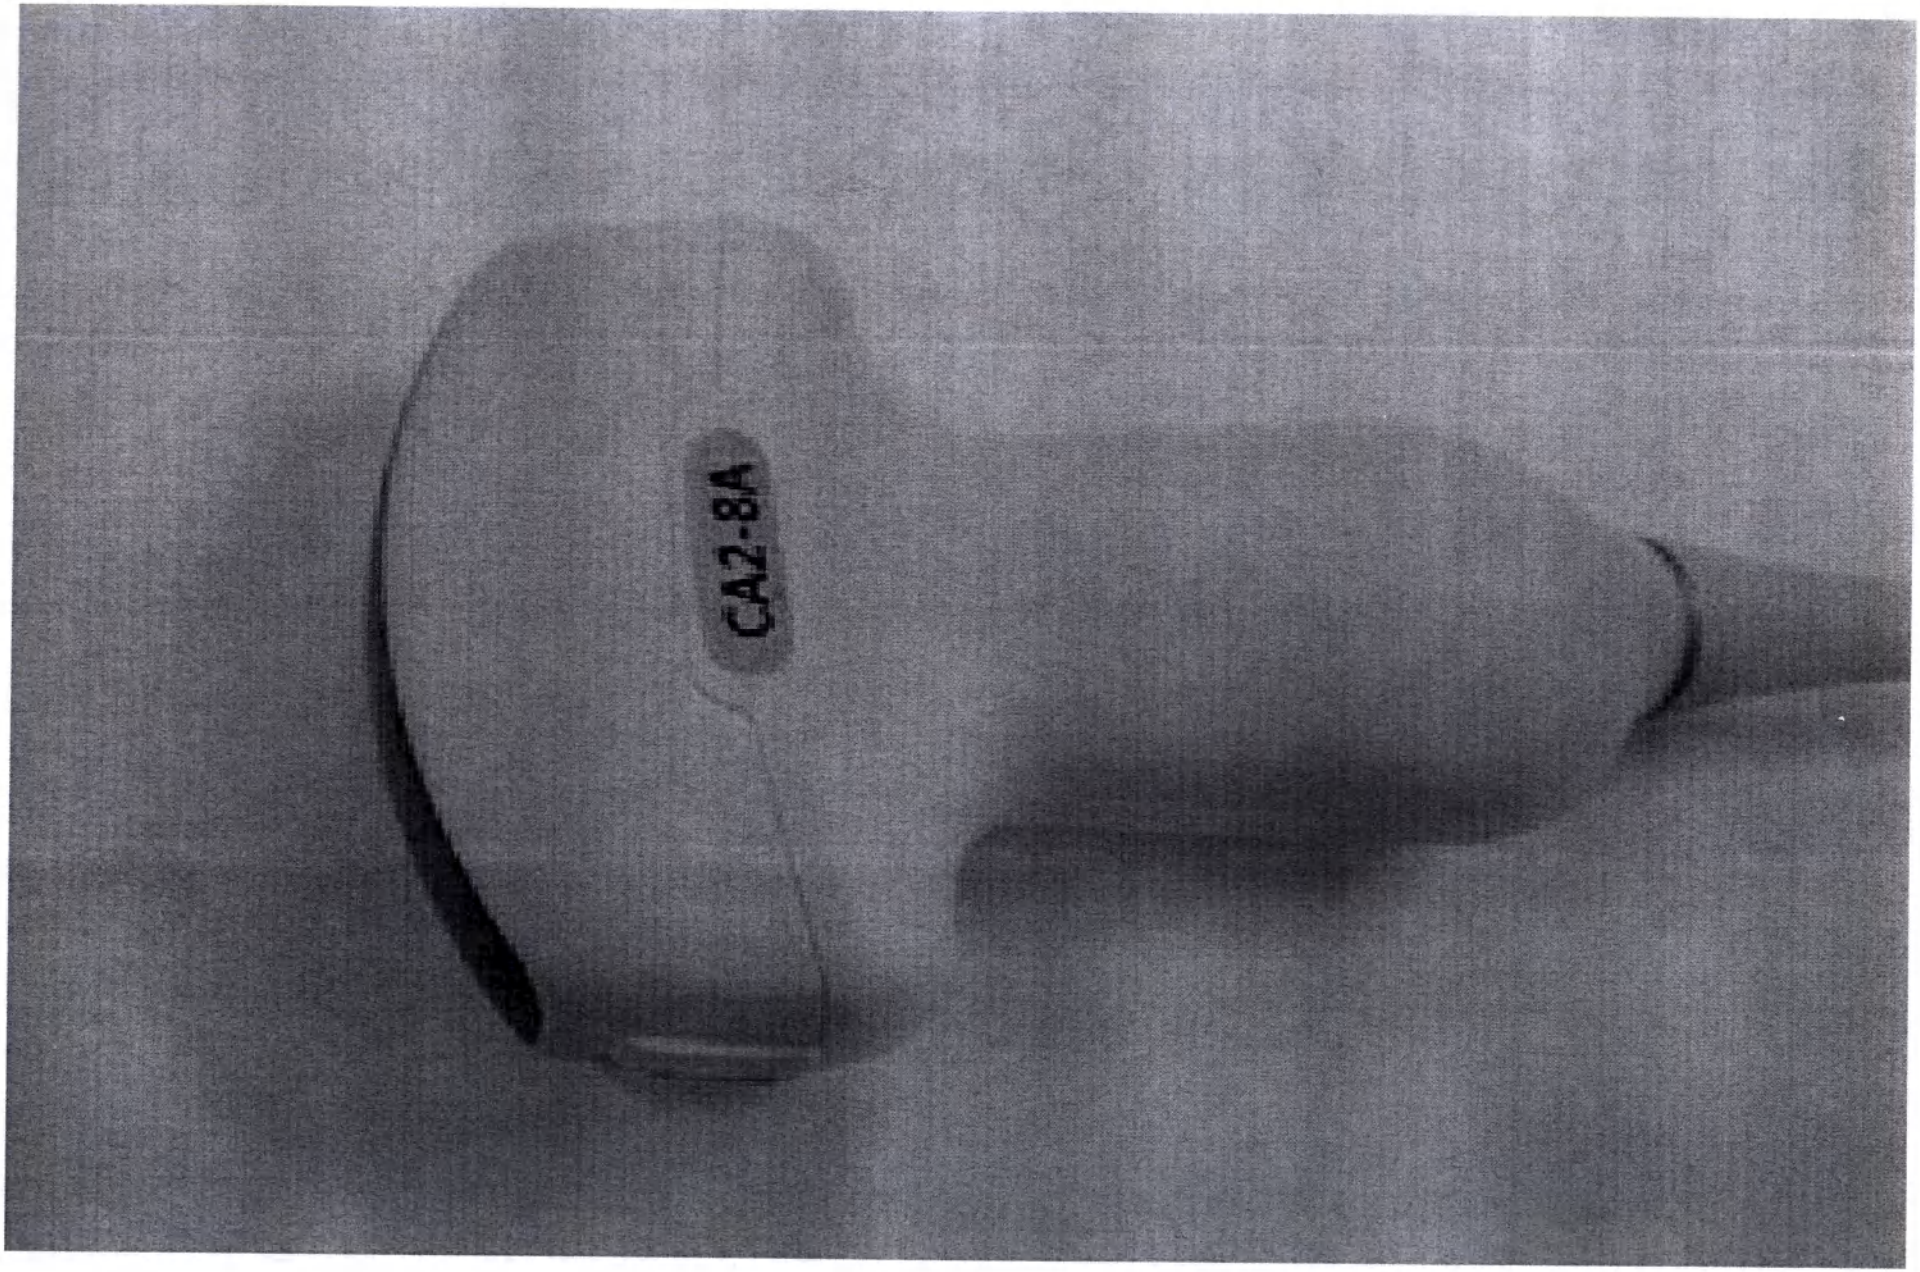

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

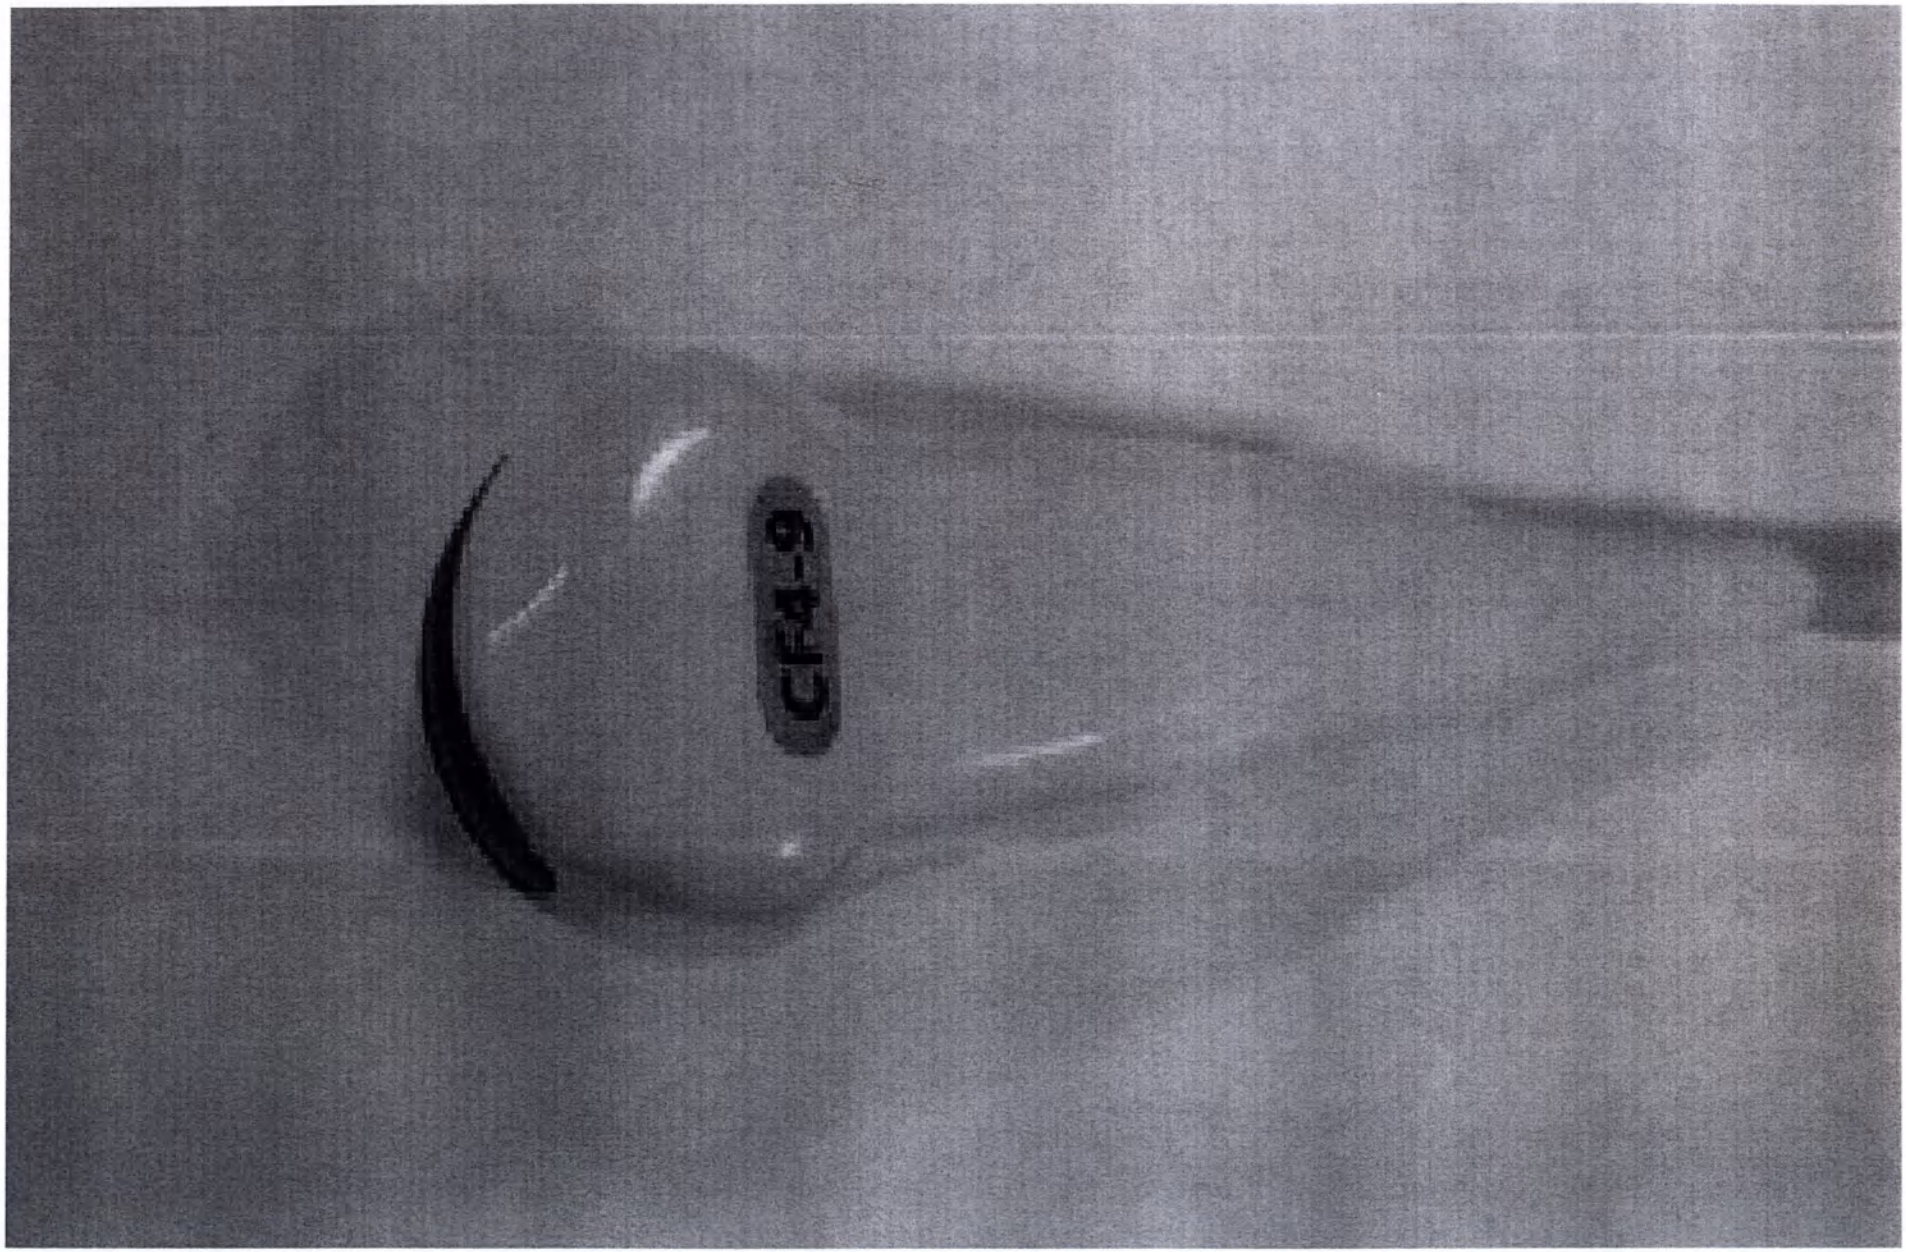

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

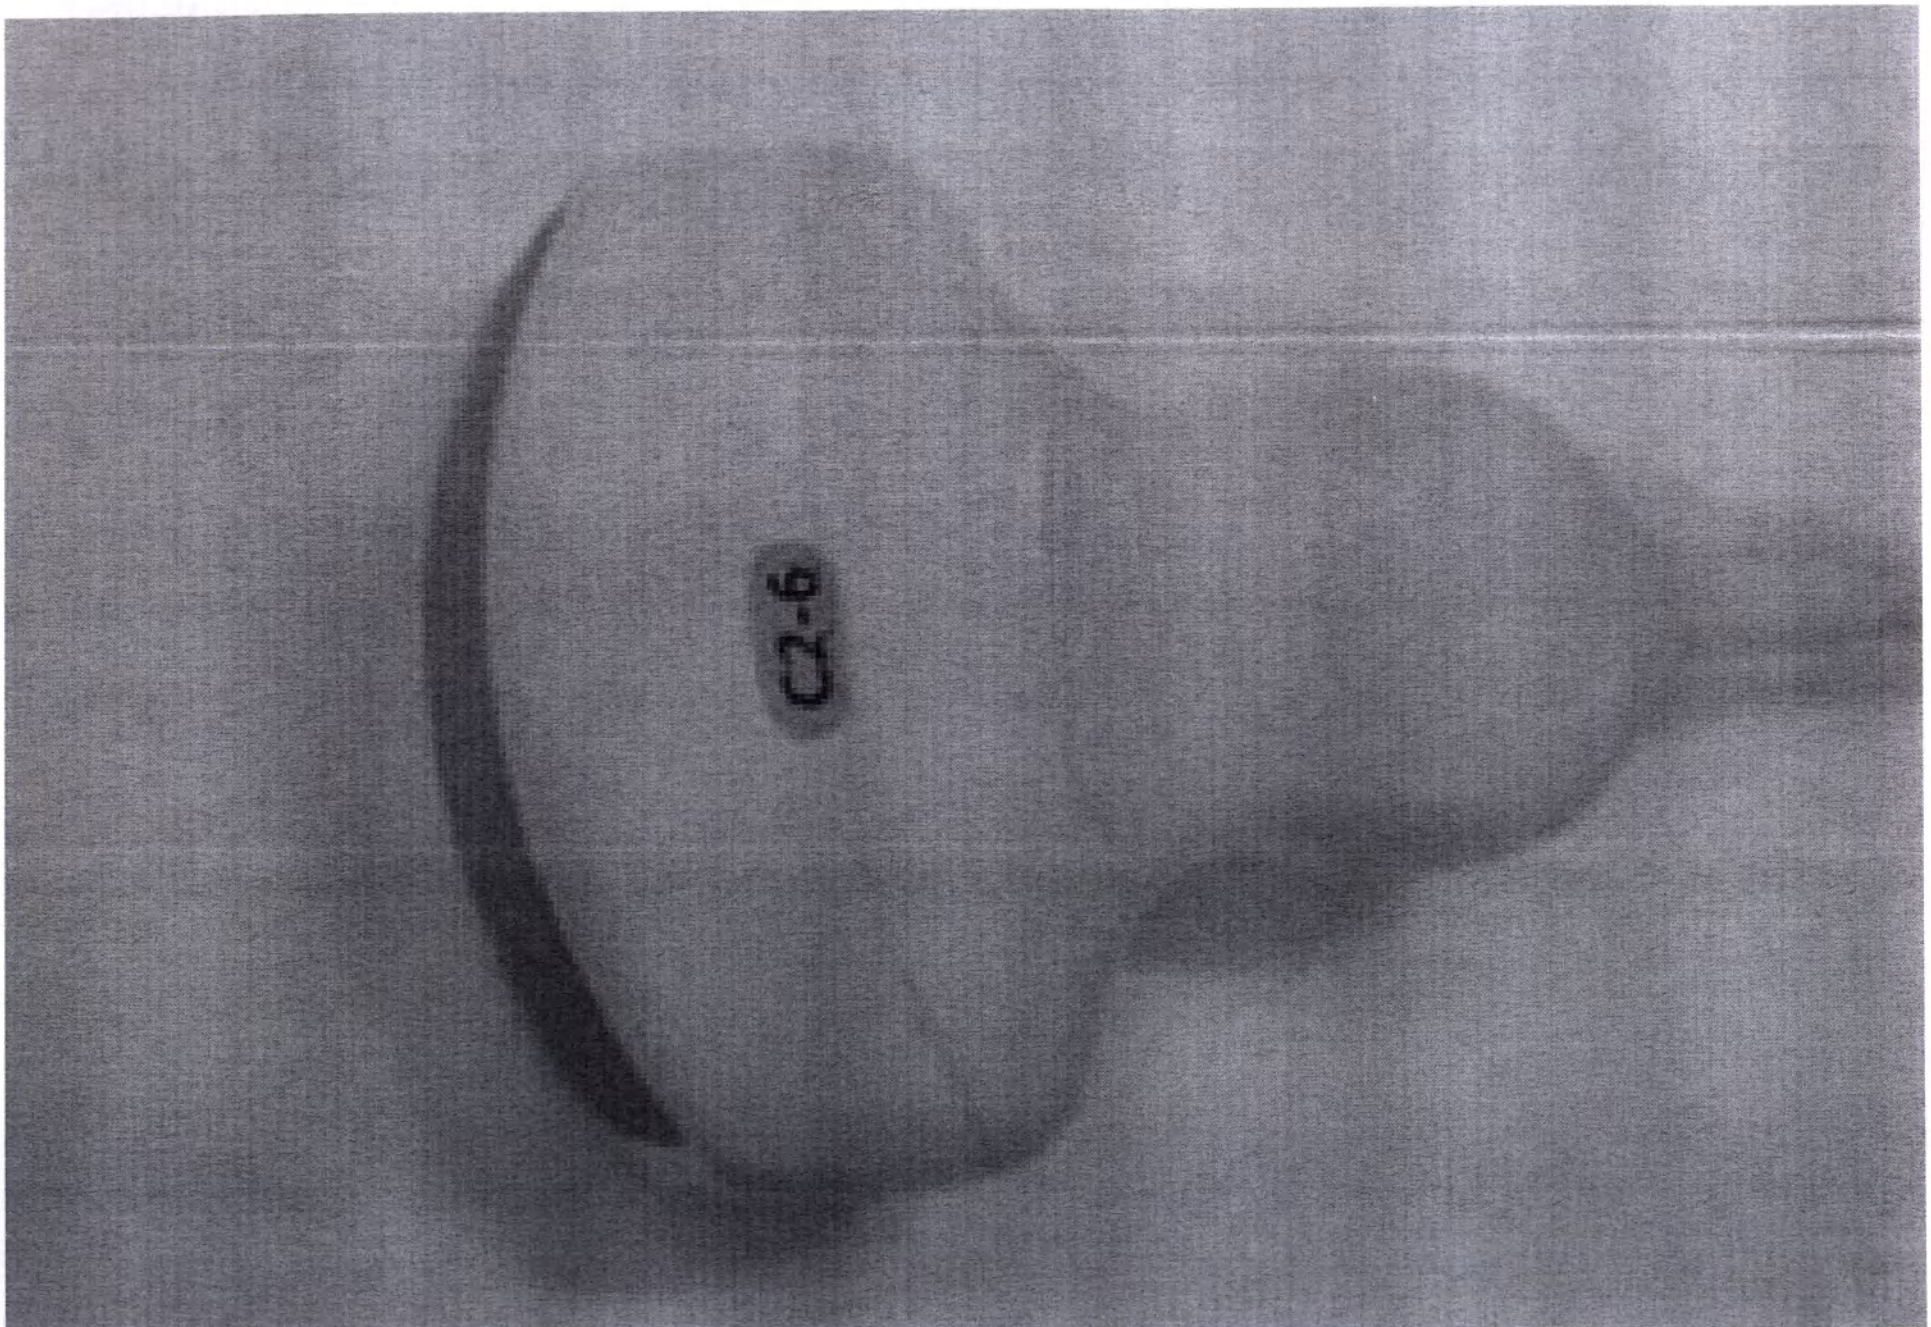

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

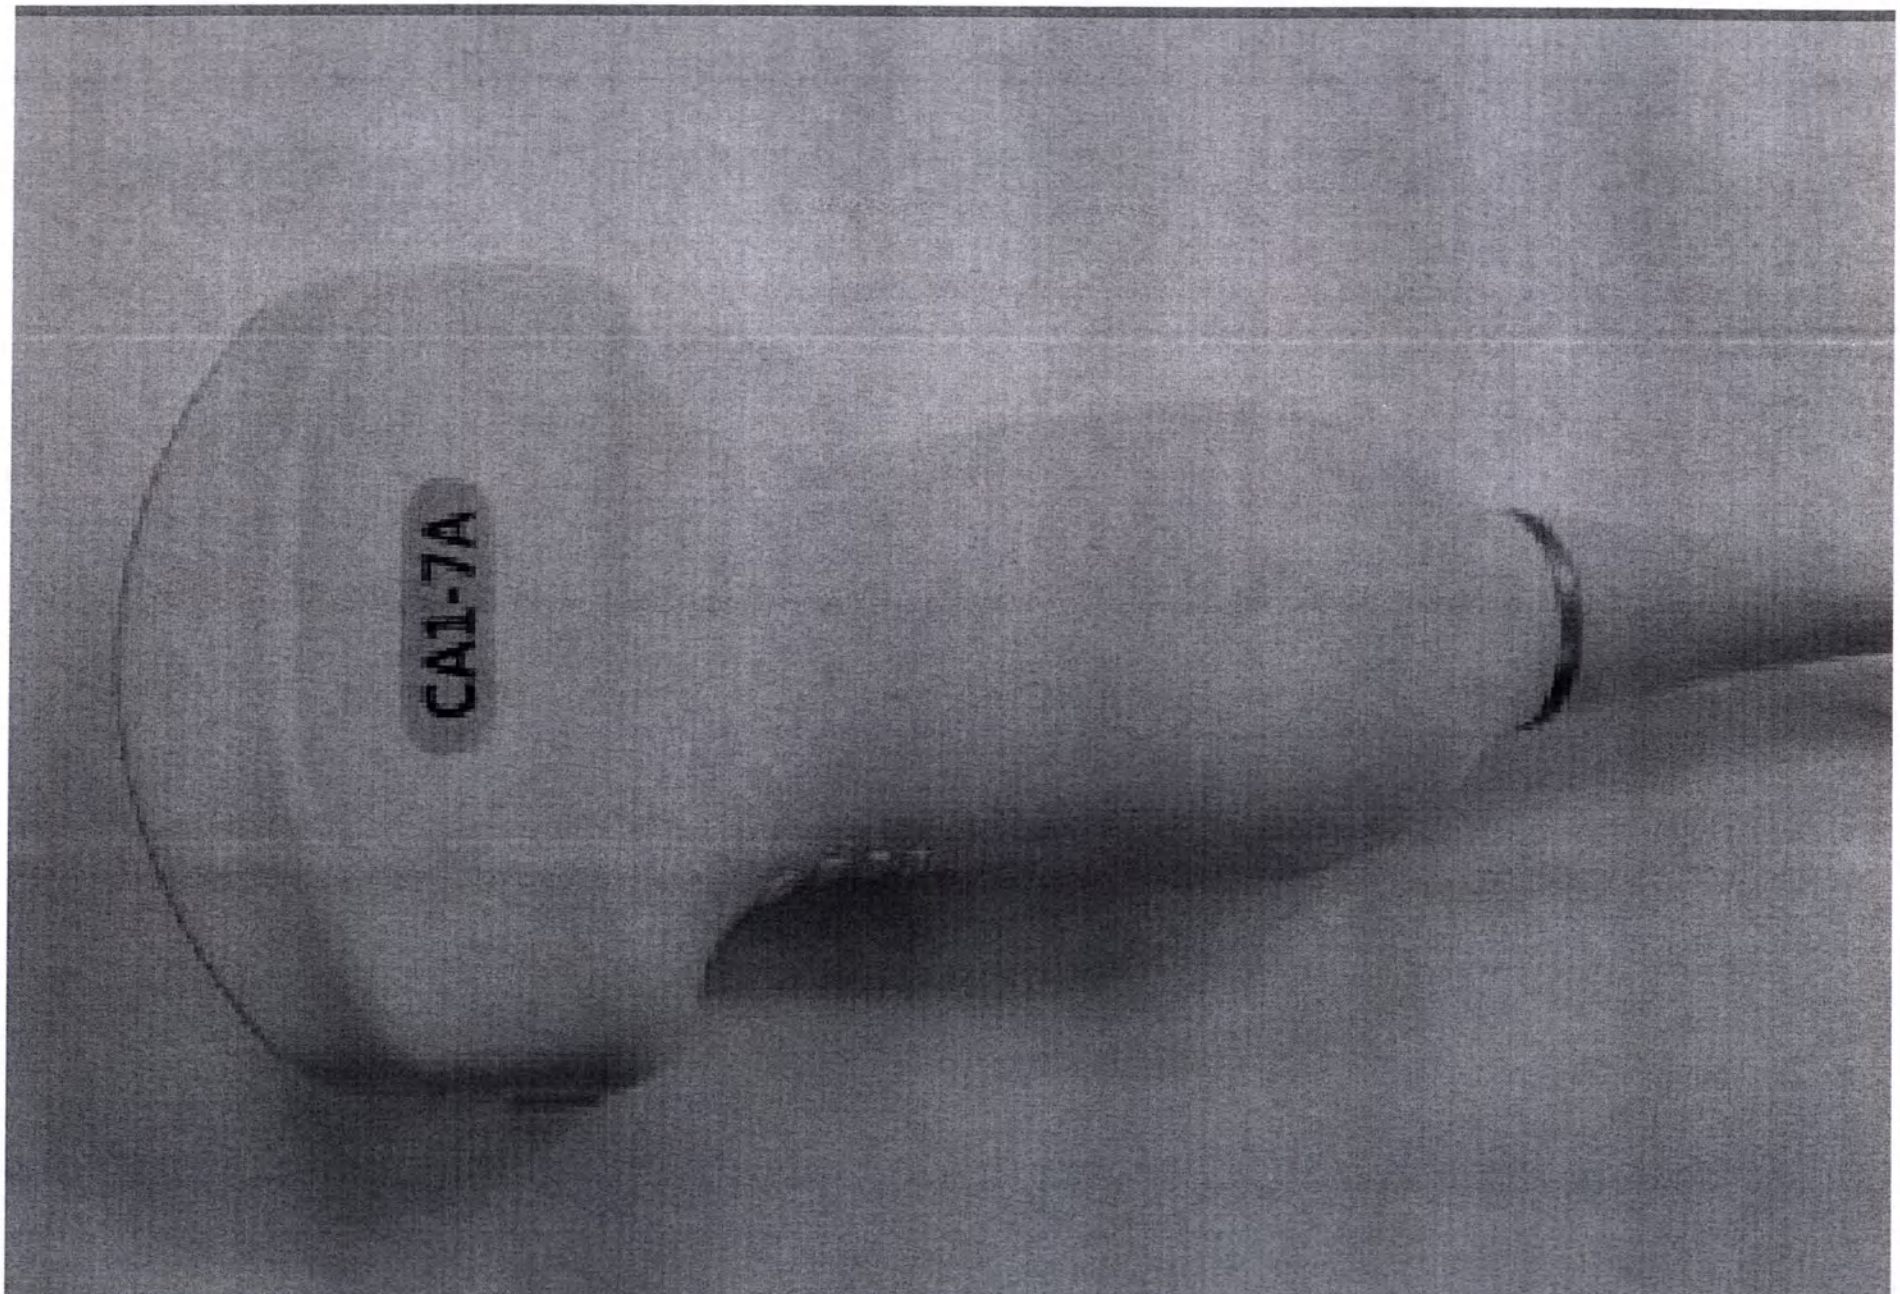

Ковексный монокристальный датчик CA1-7A

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

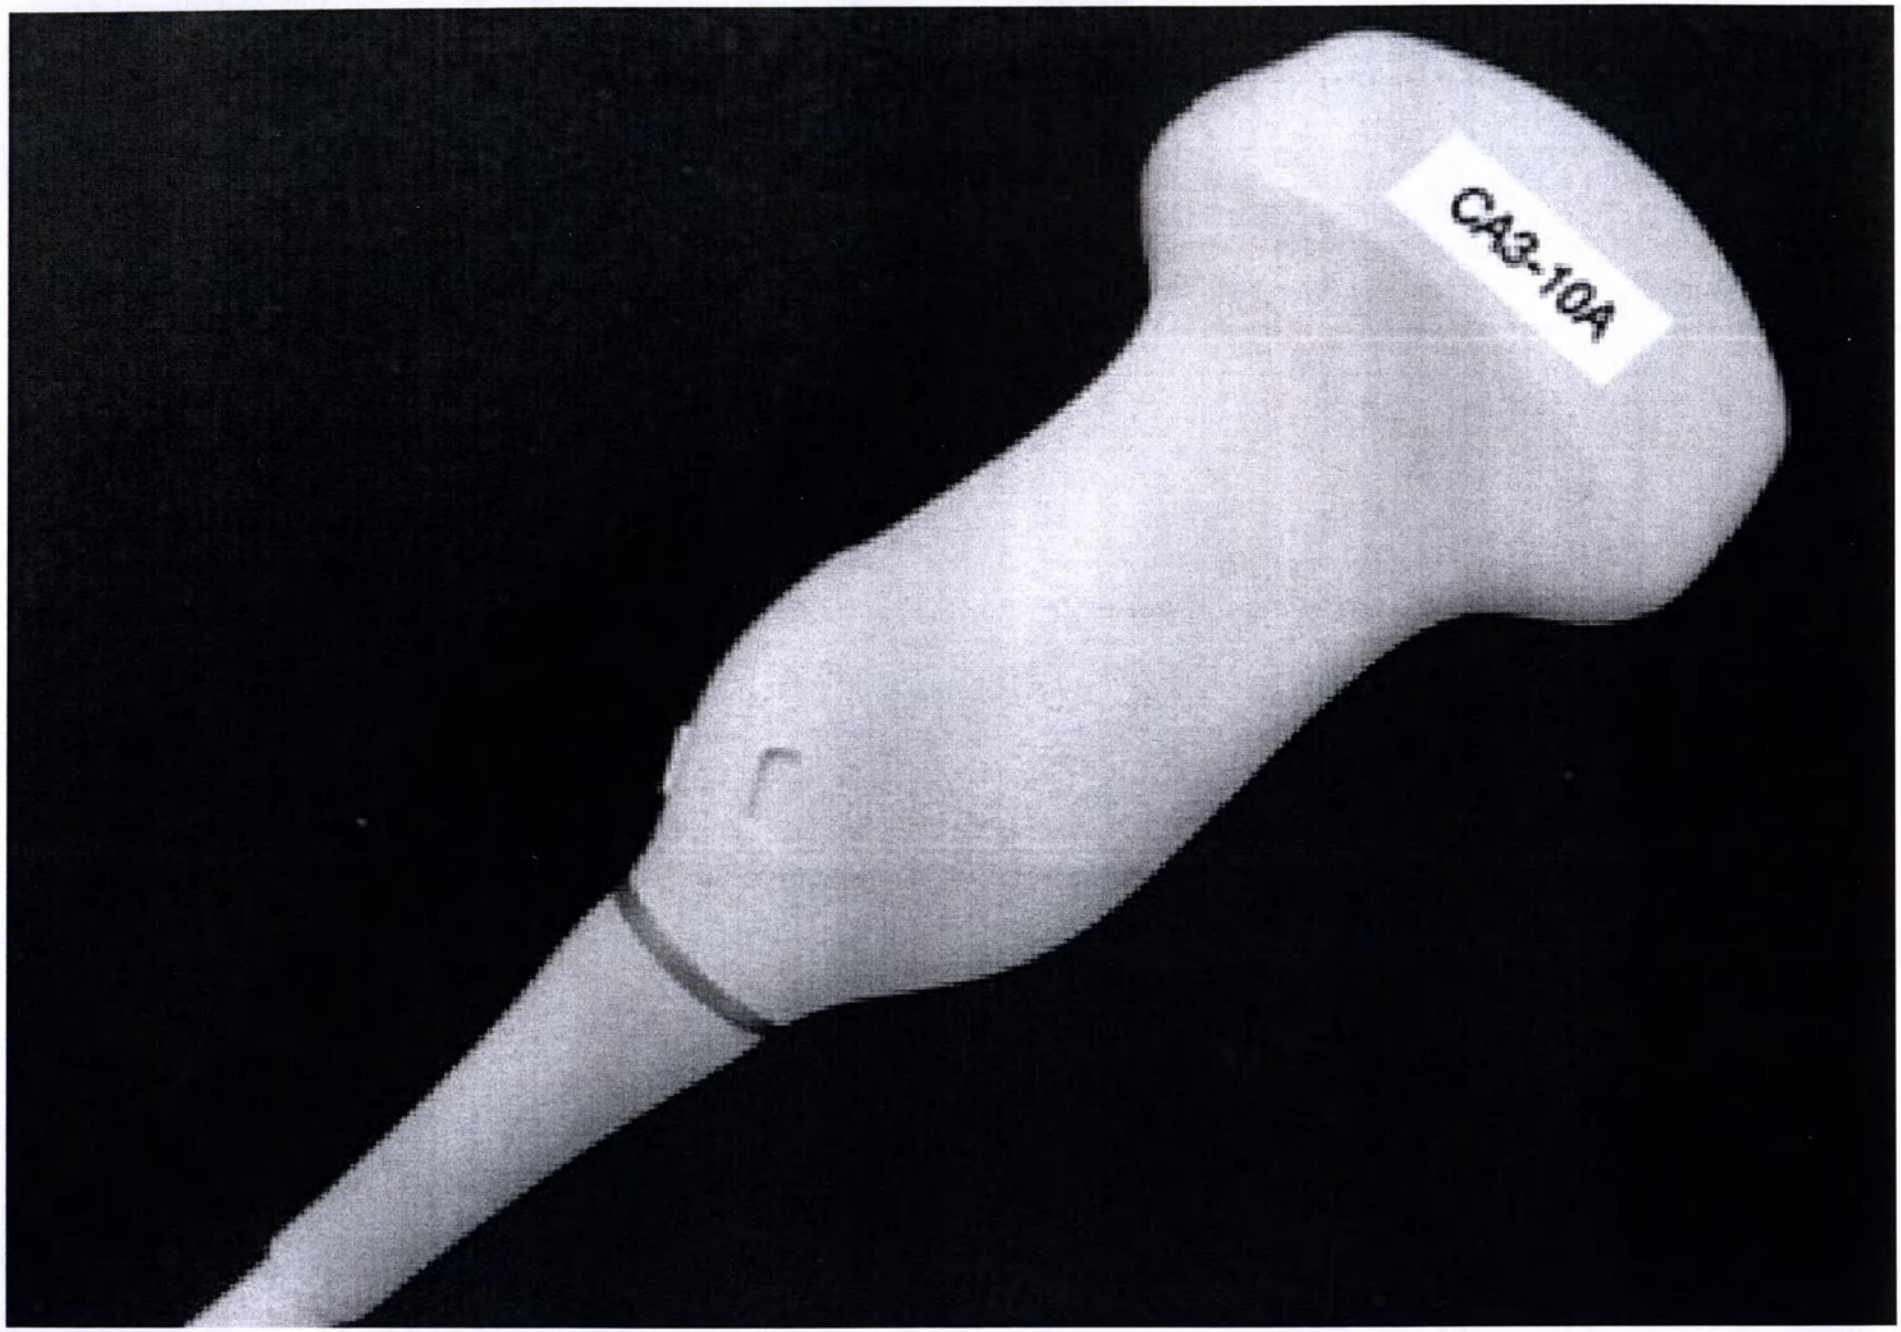

Ковексный монокристальный датчик CA3-10A

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

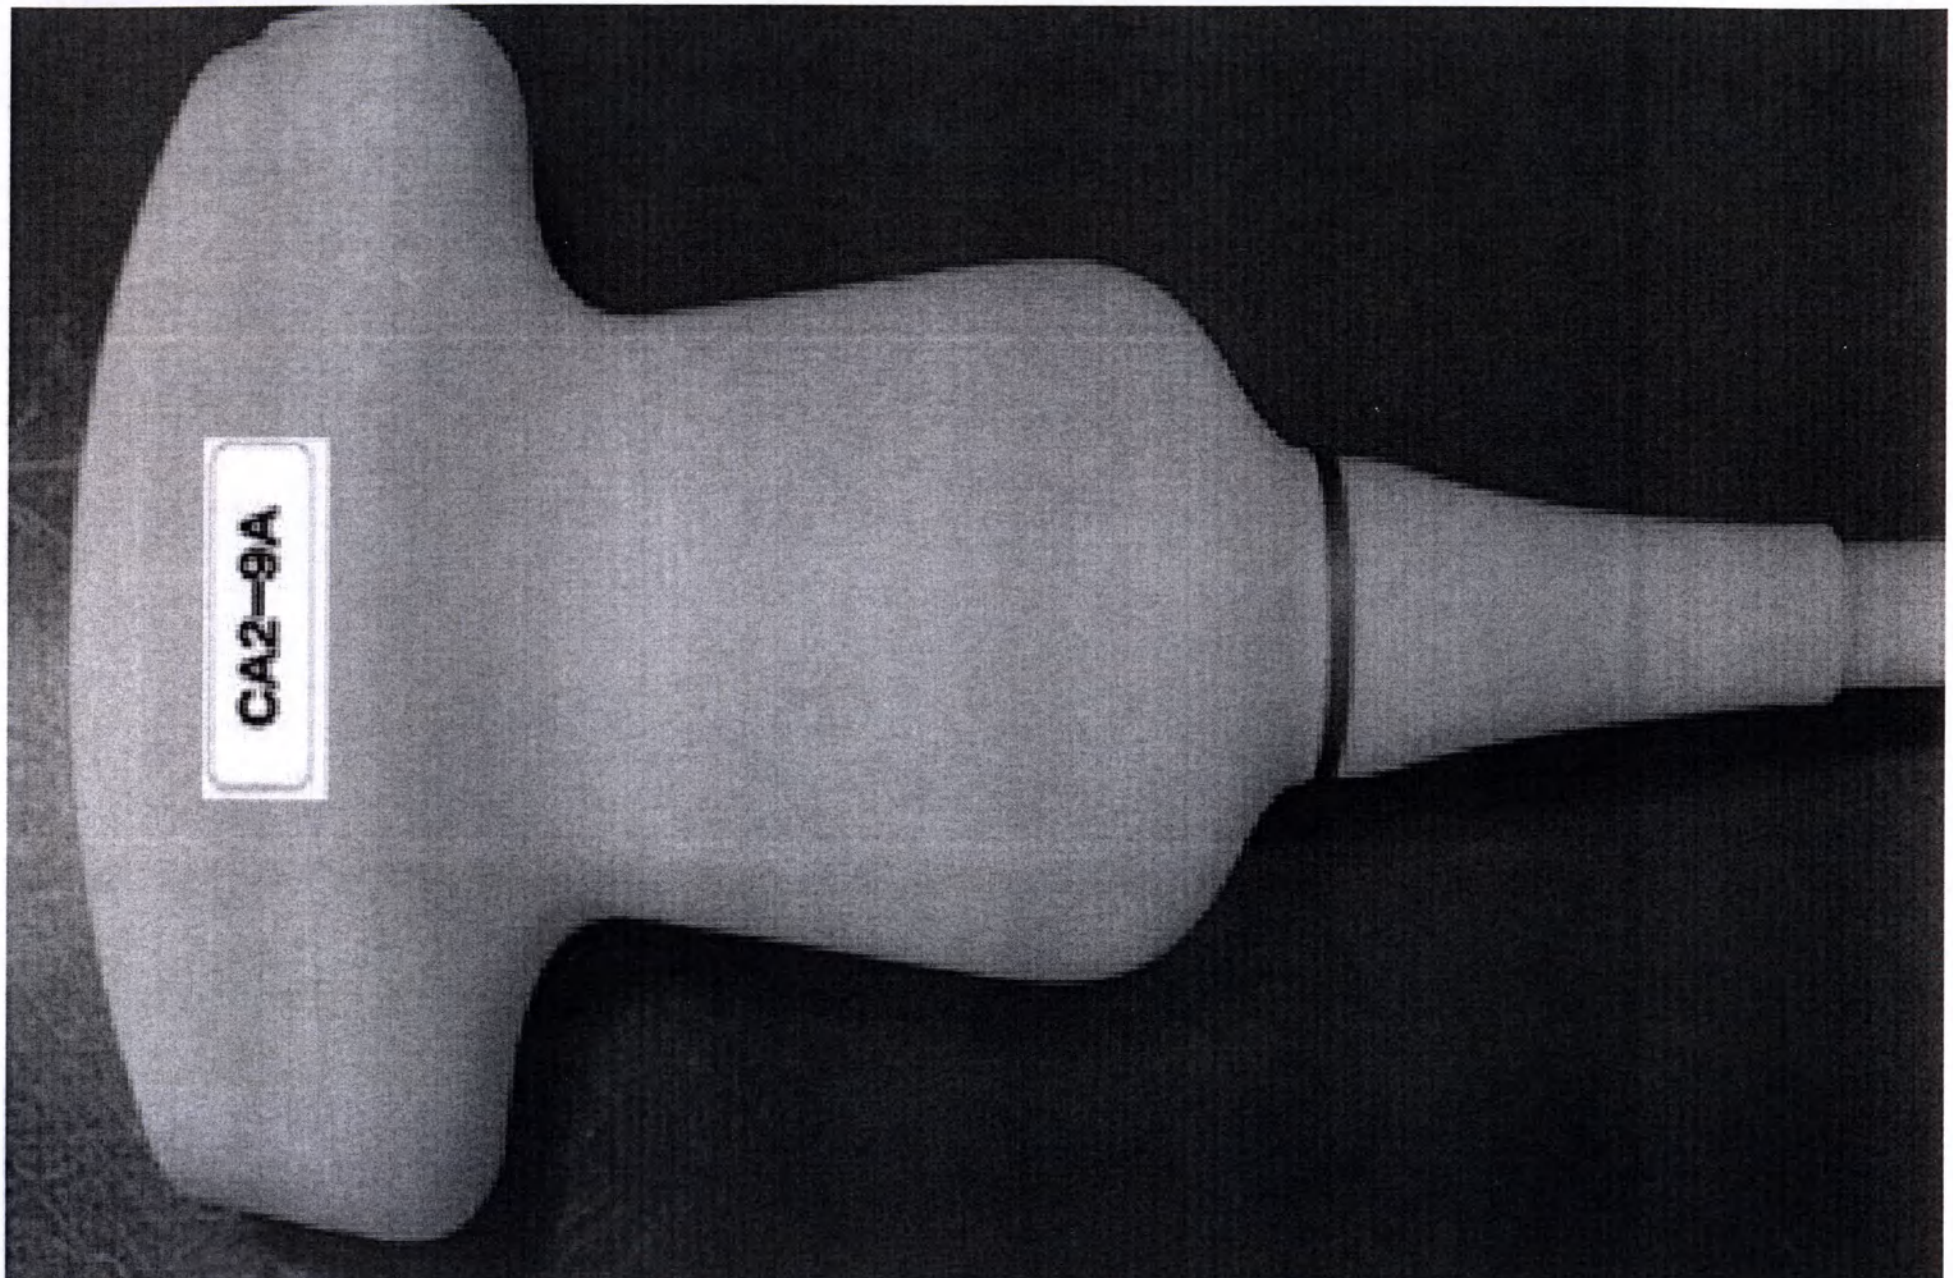

Ковексный монокристальный датчик CA2-9A

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

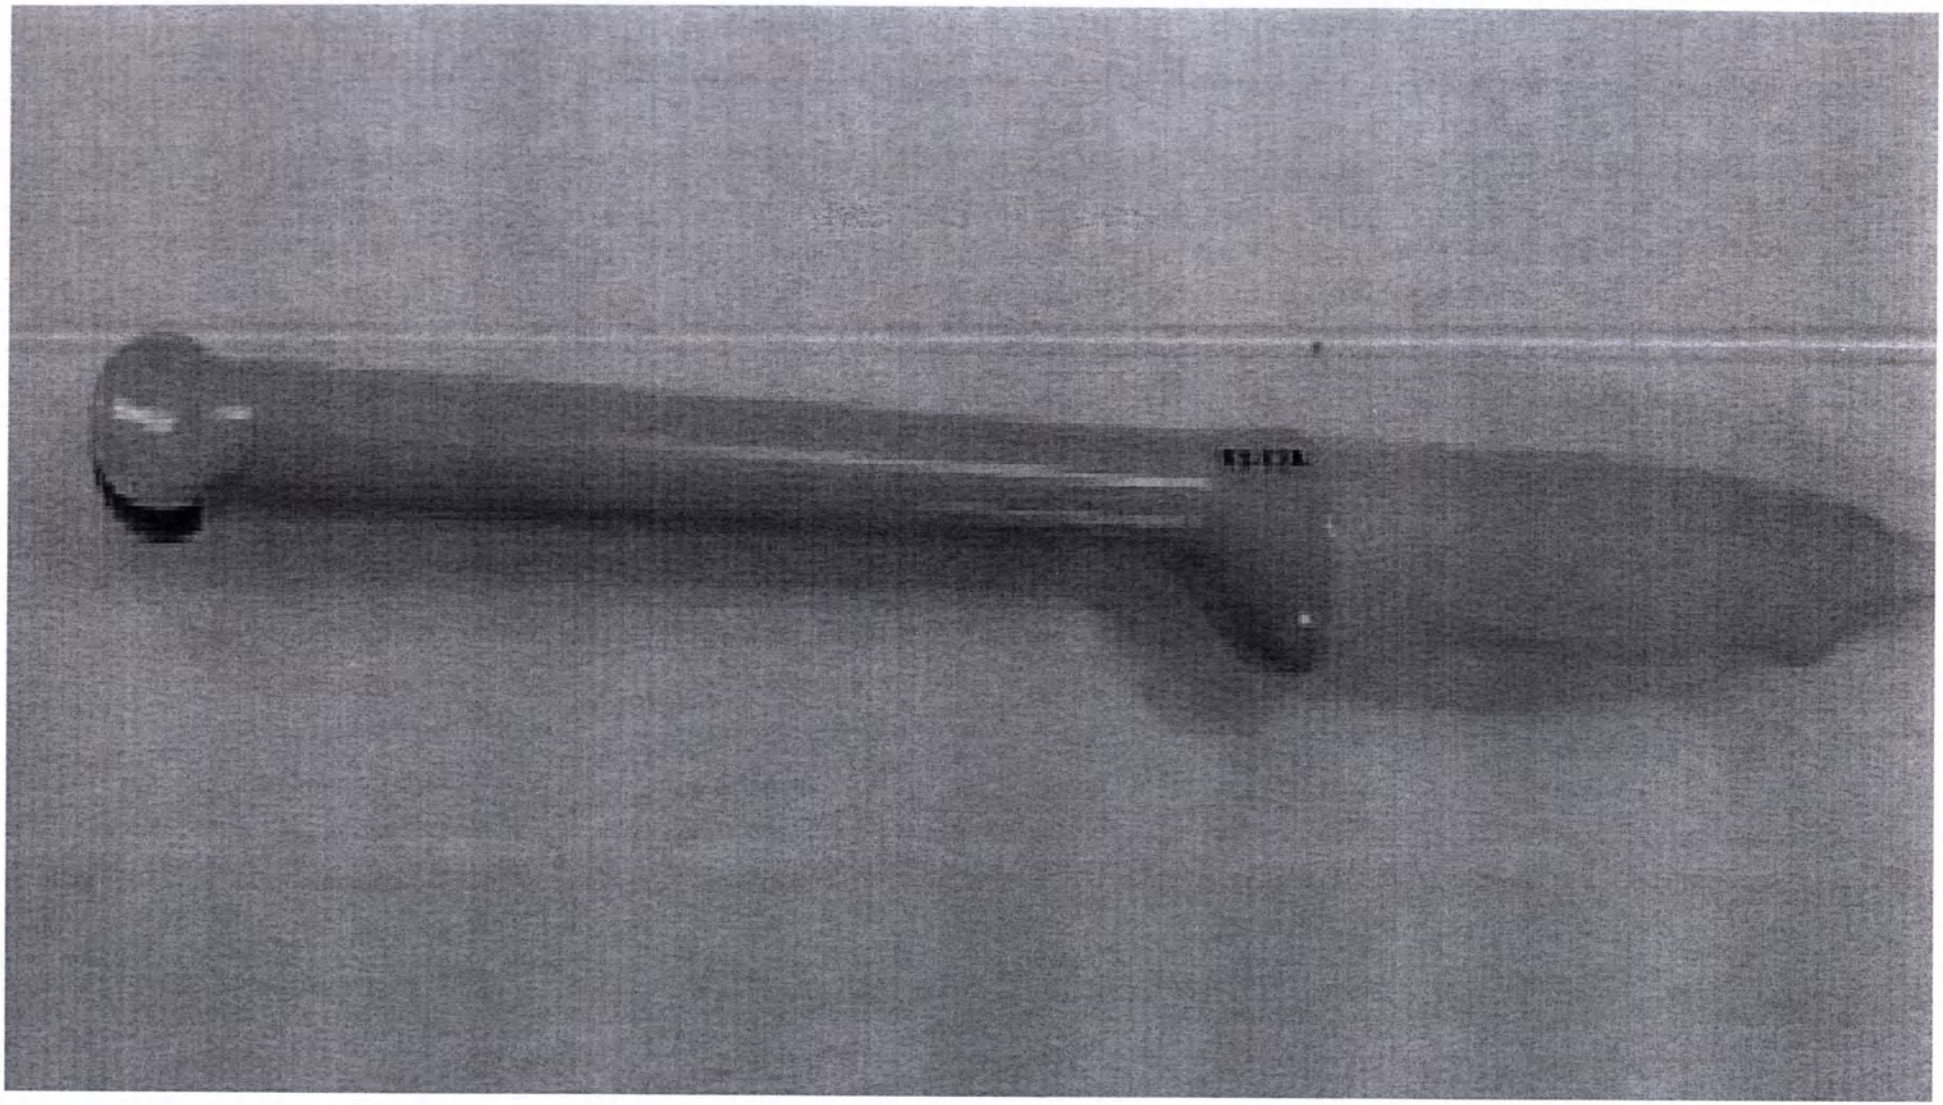

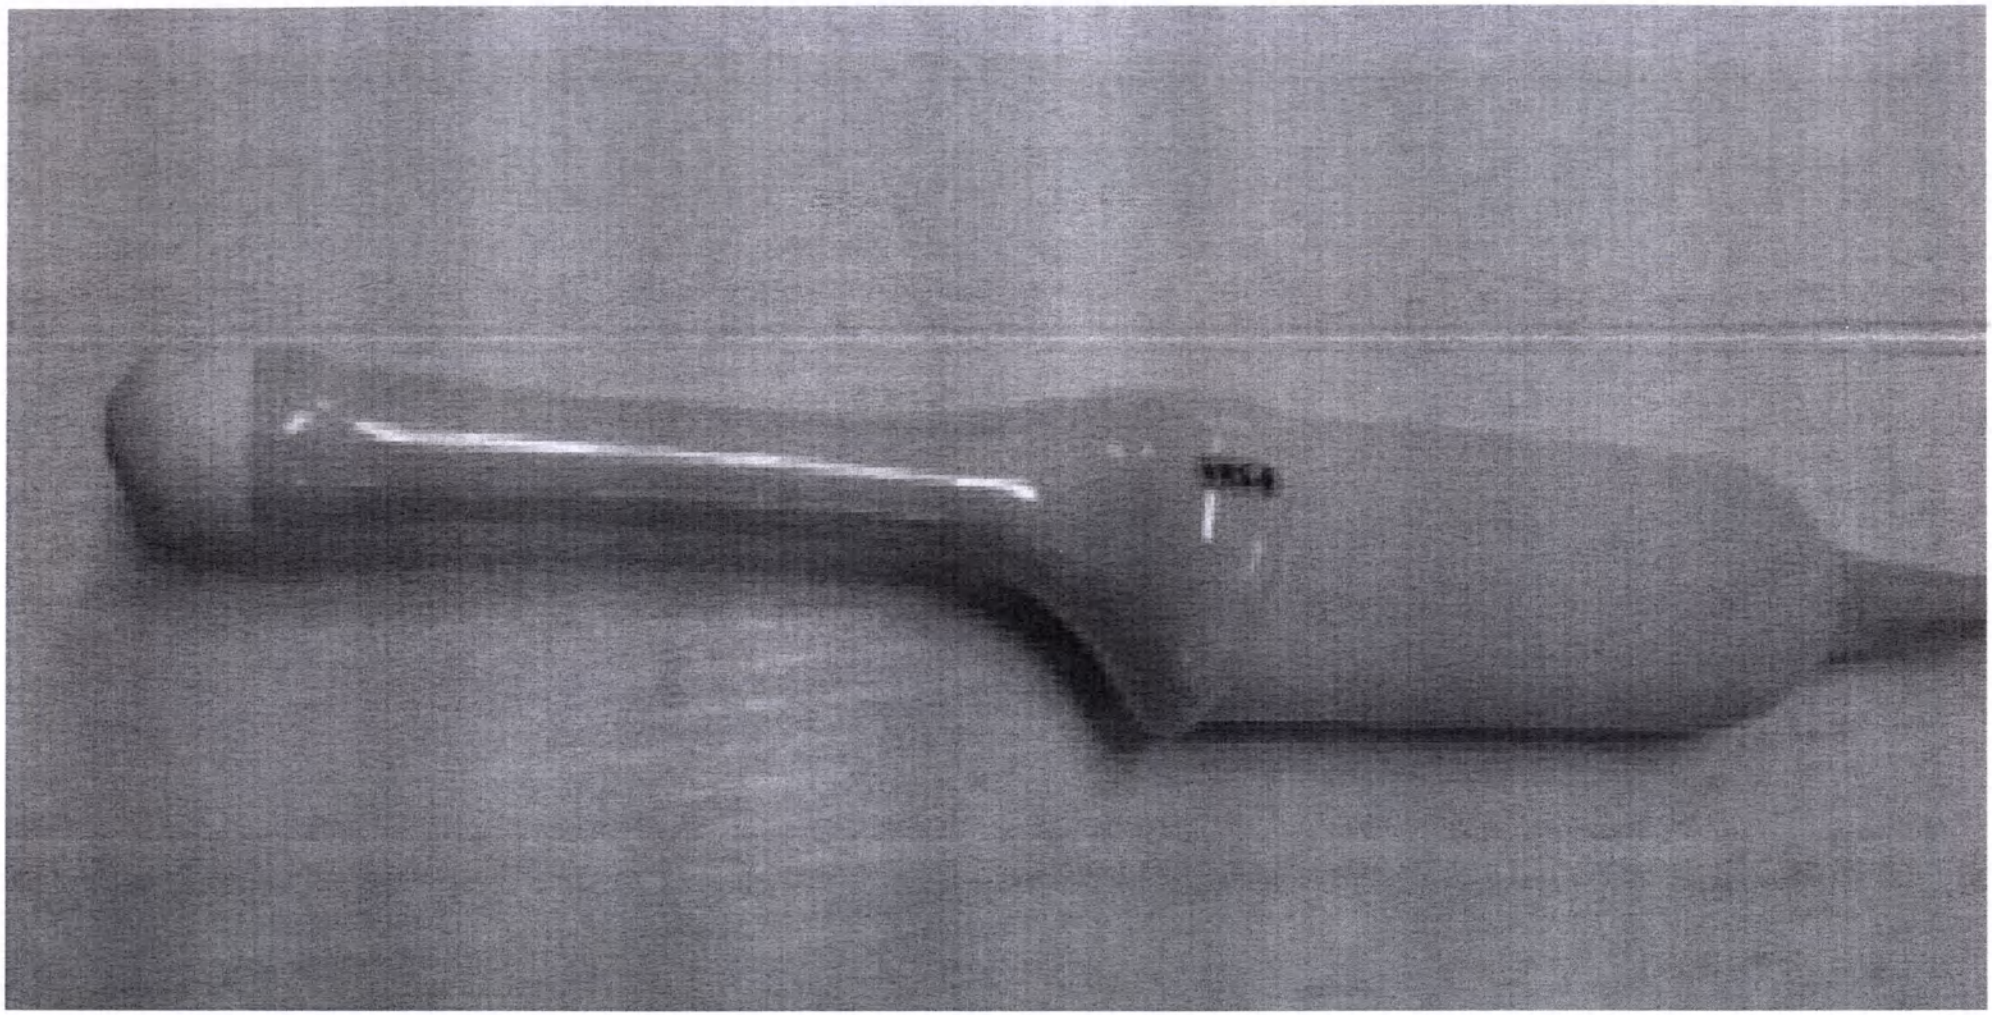

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

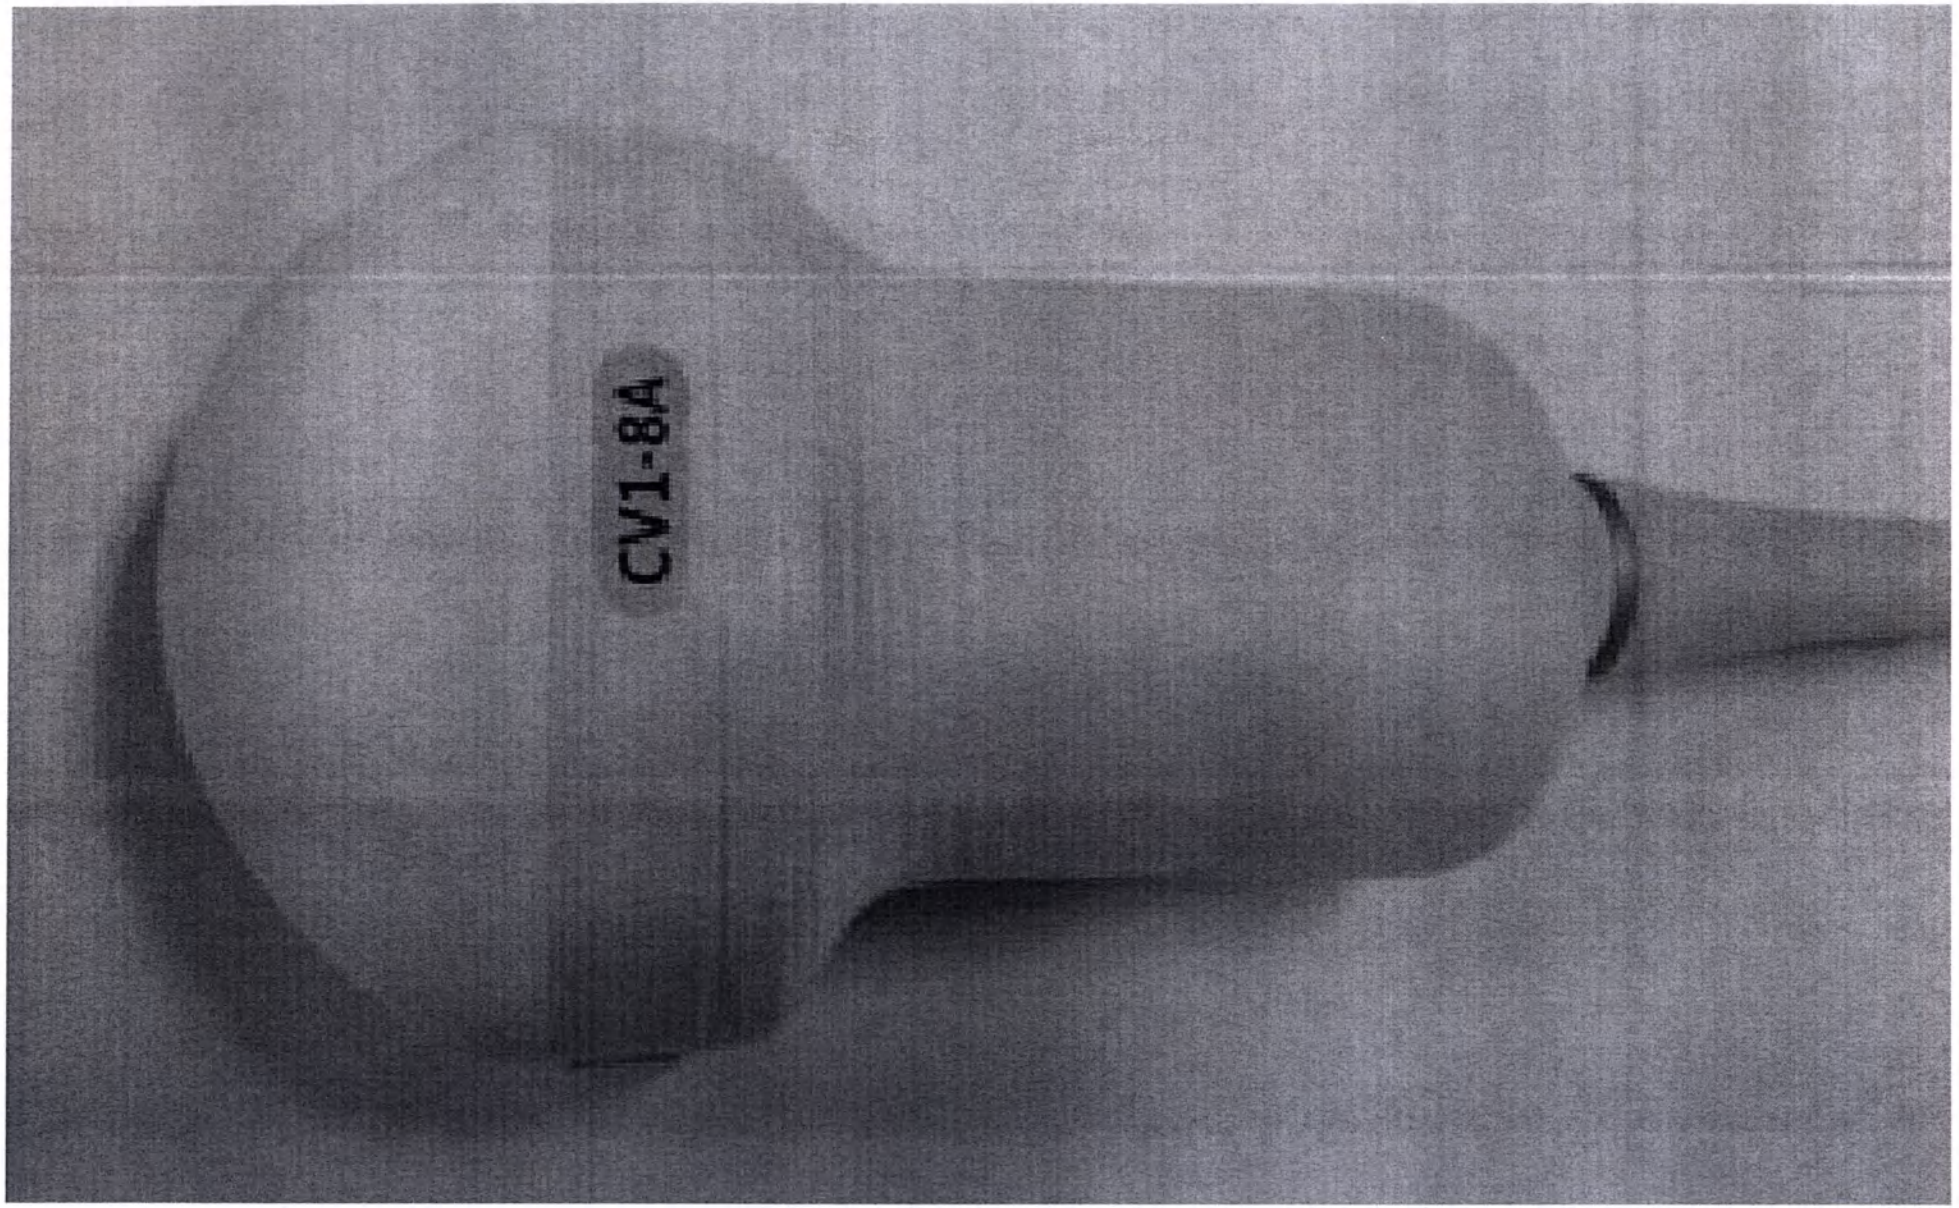

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

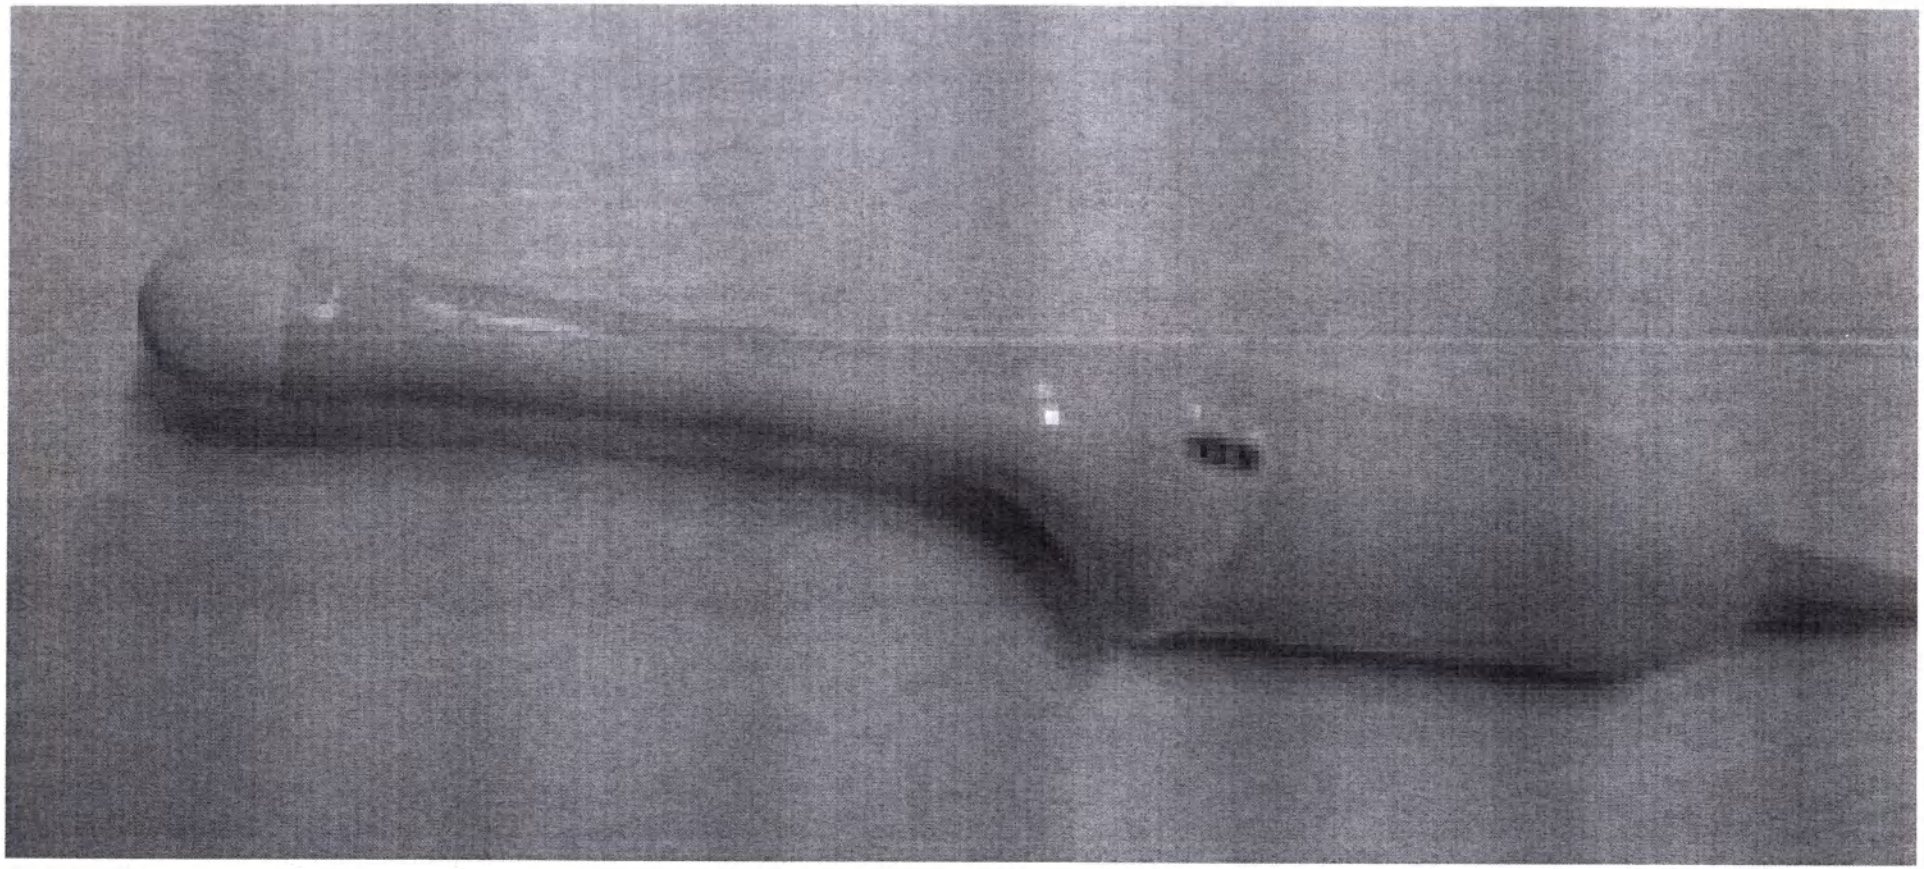

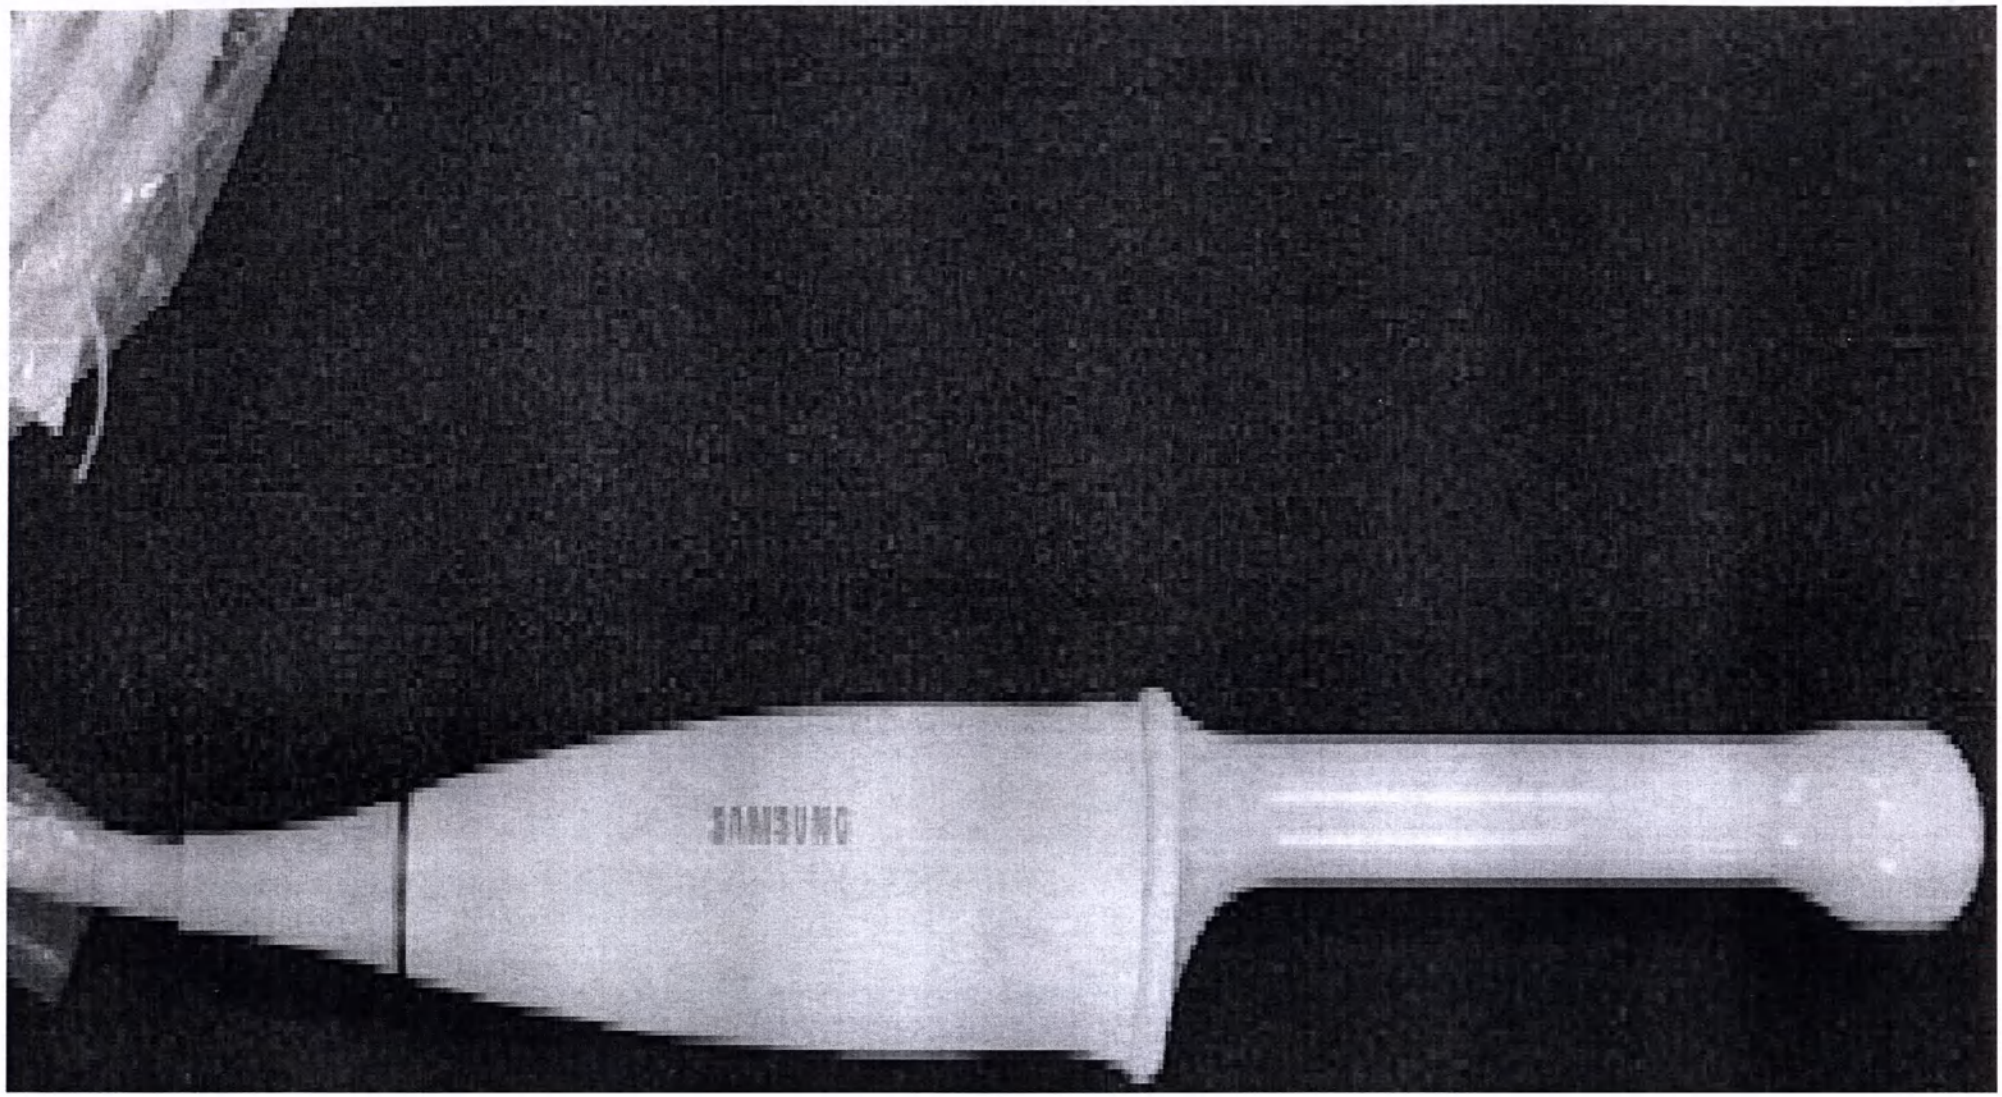

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

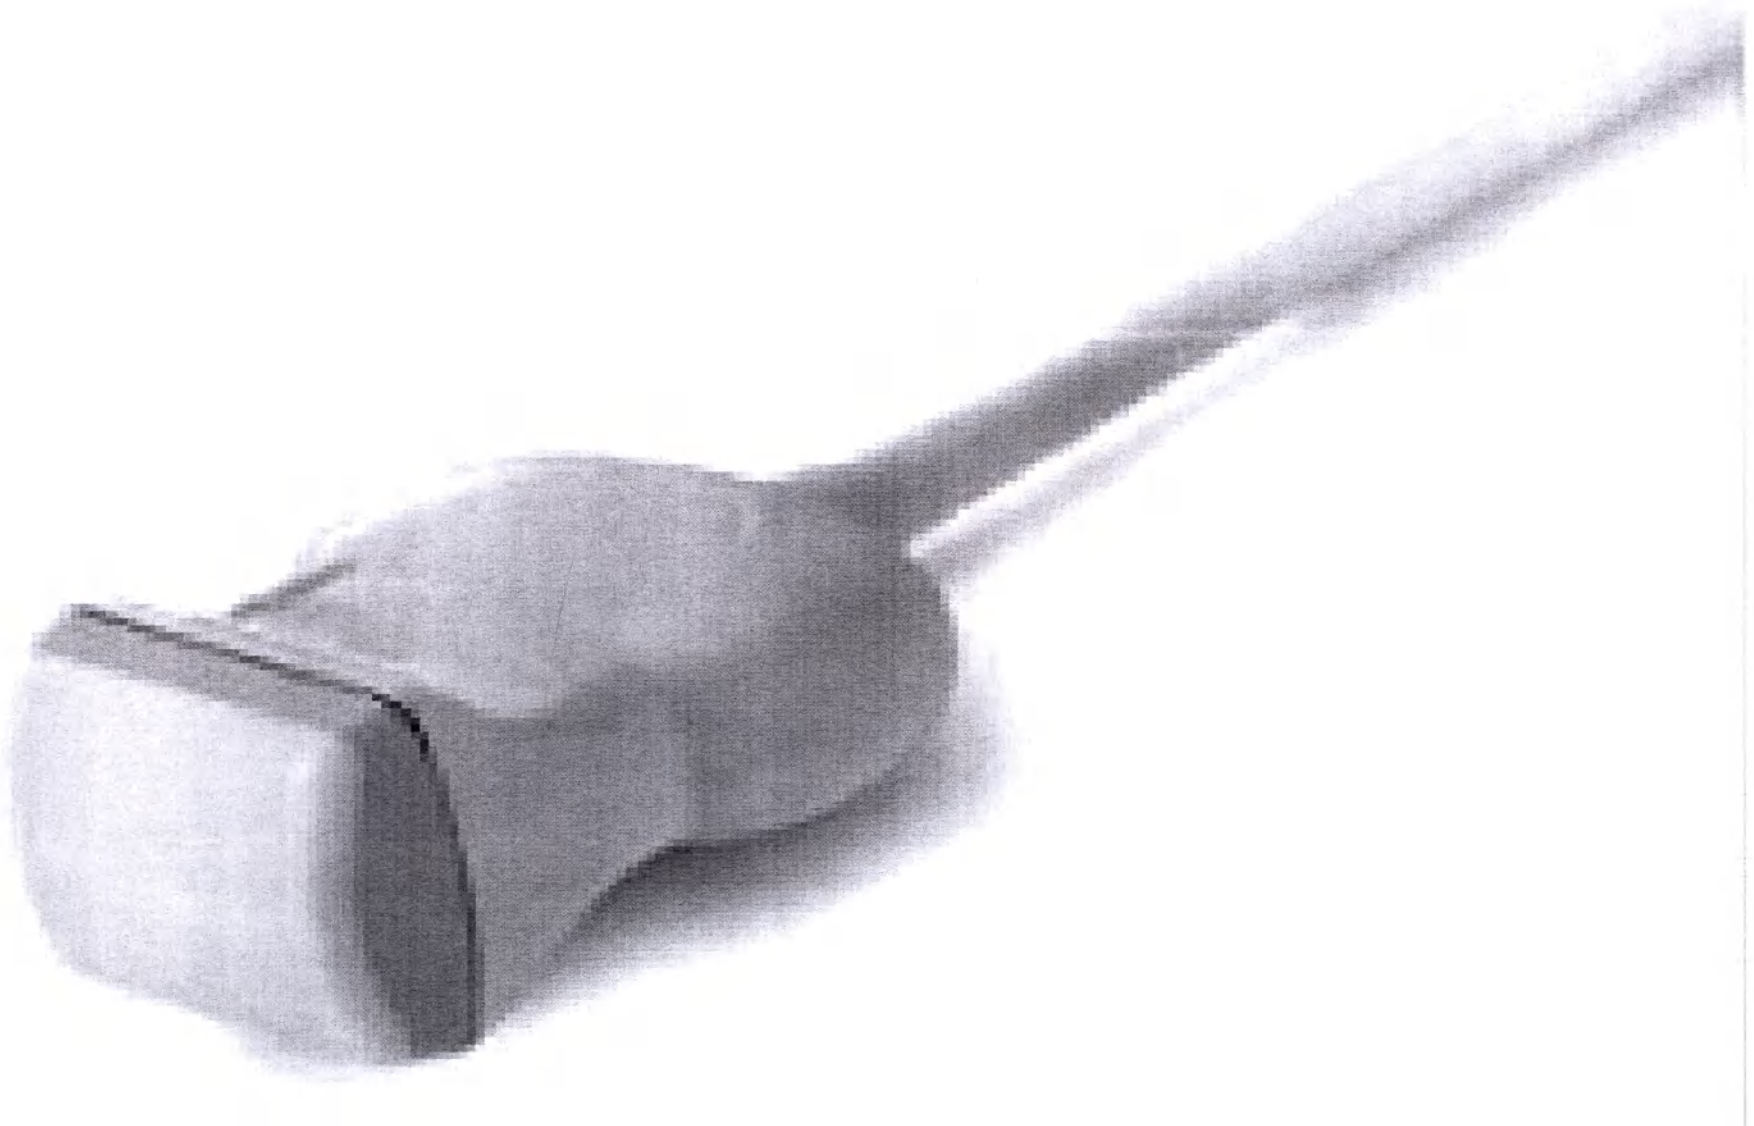

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

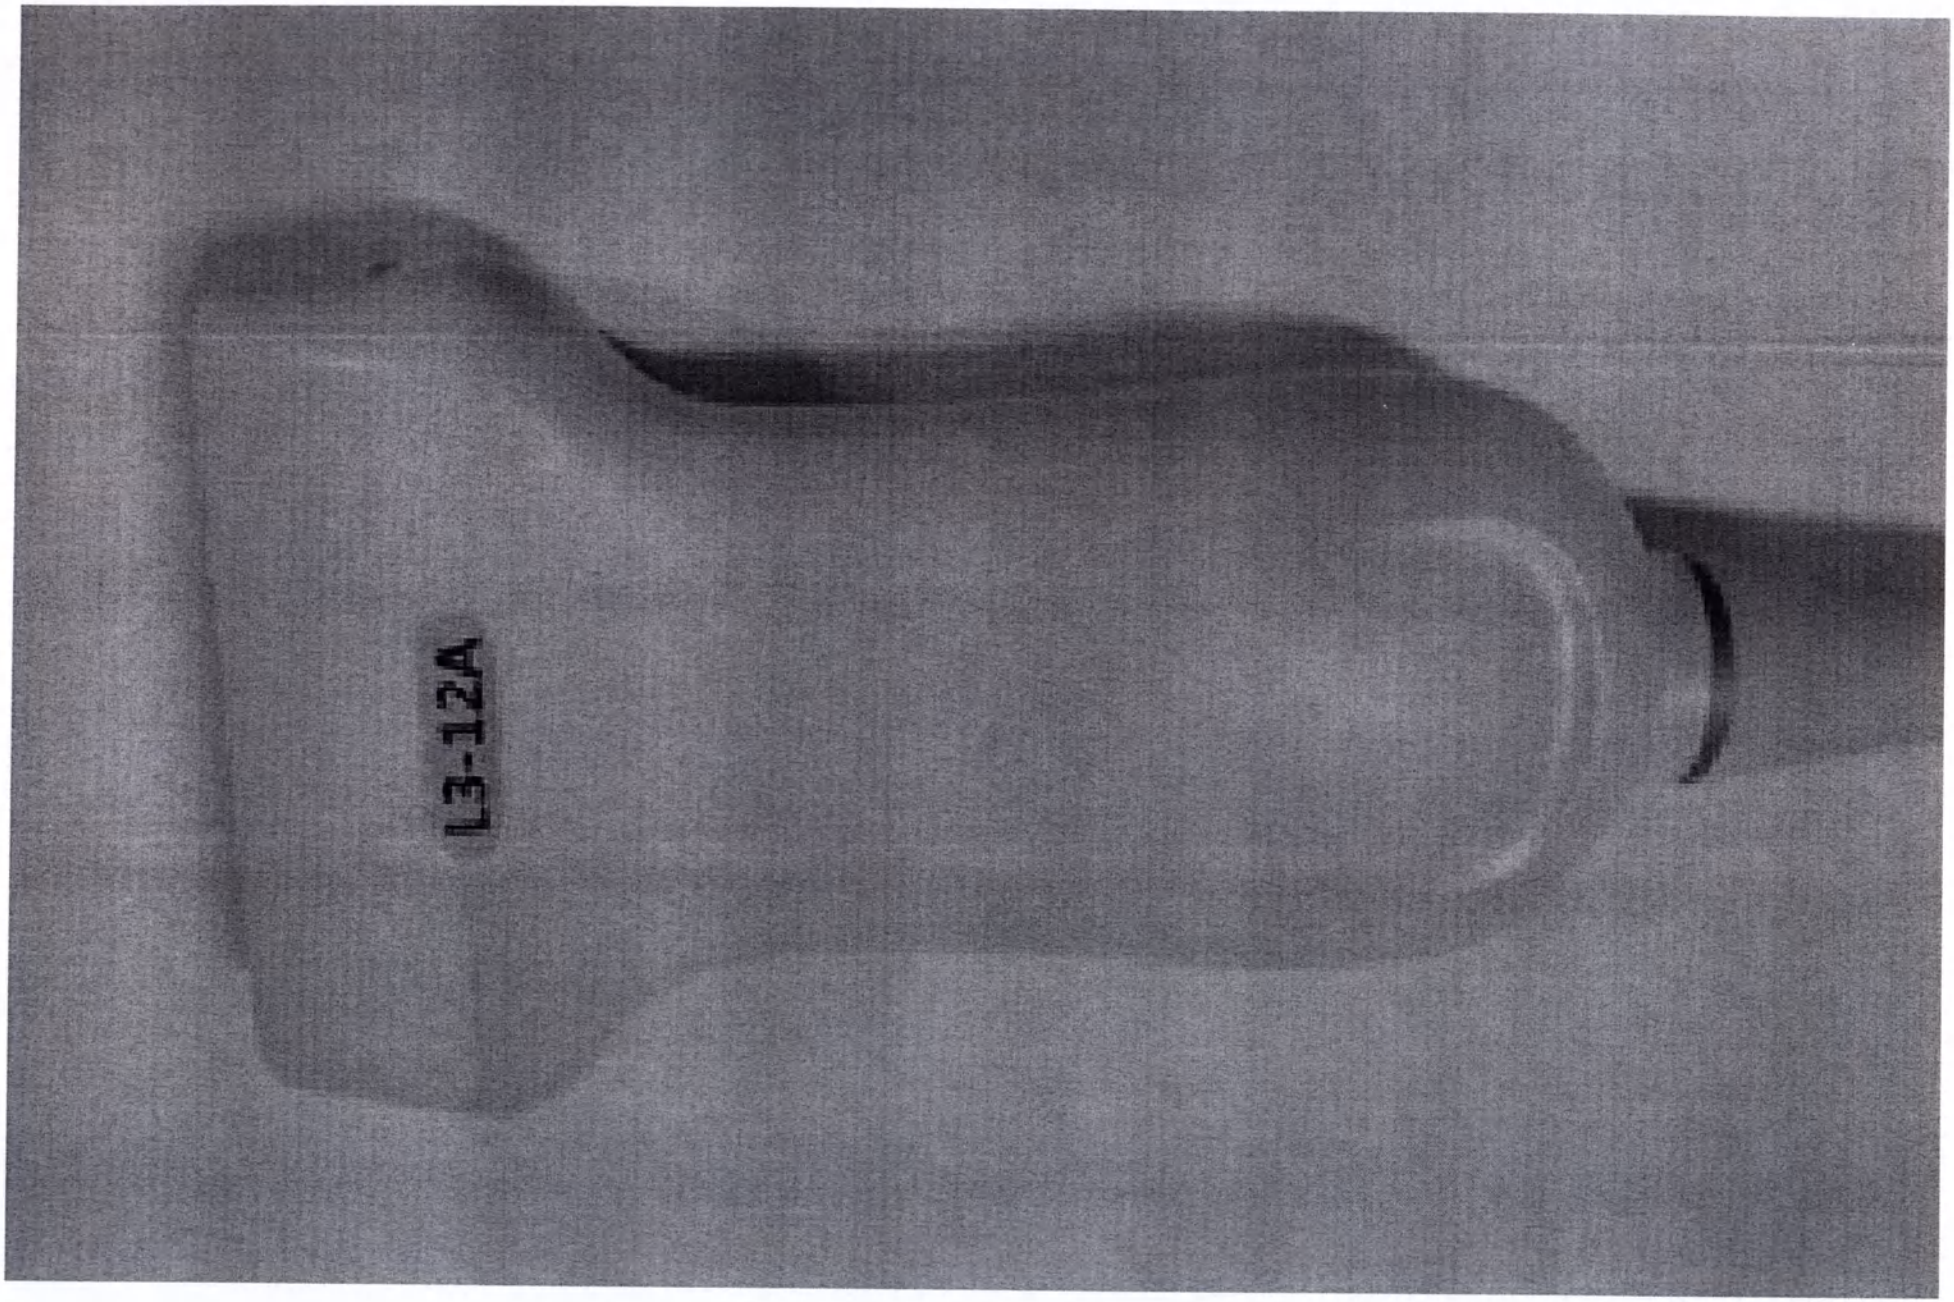

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Линейный датчик LA3-16A

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

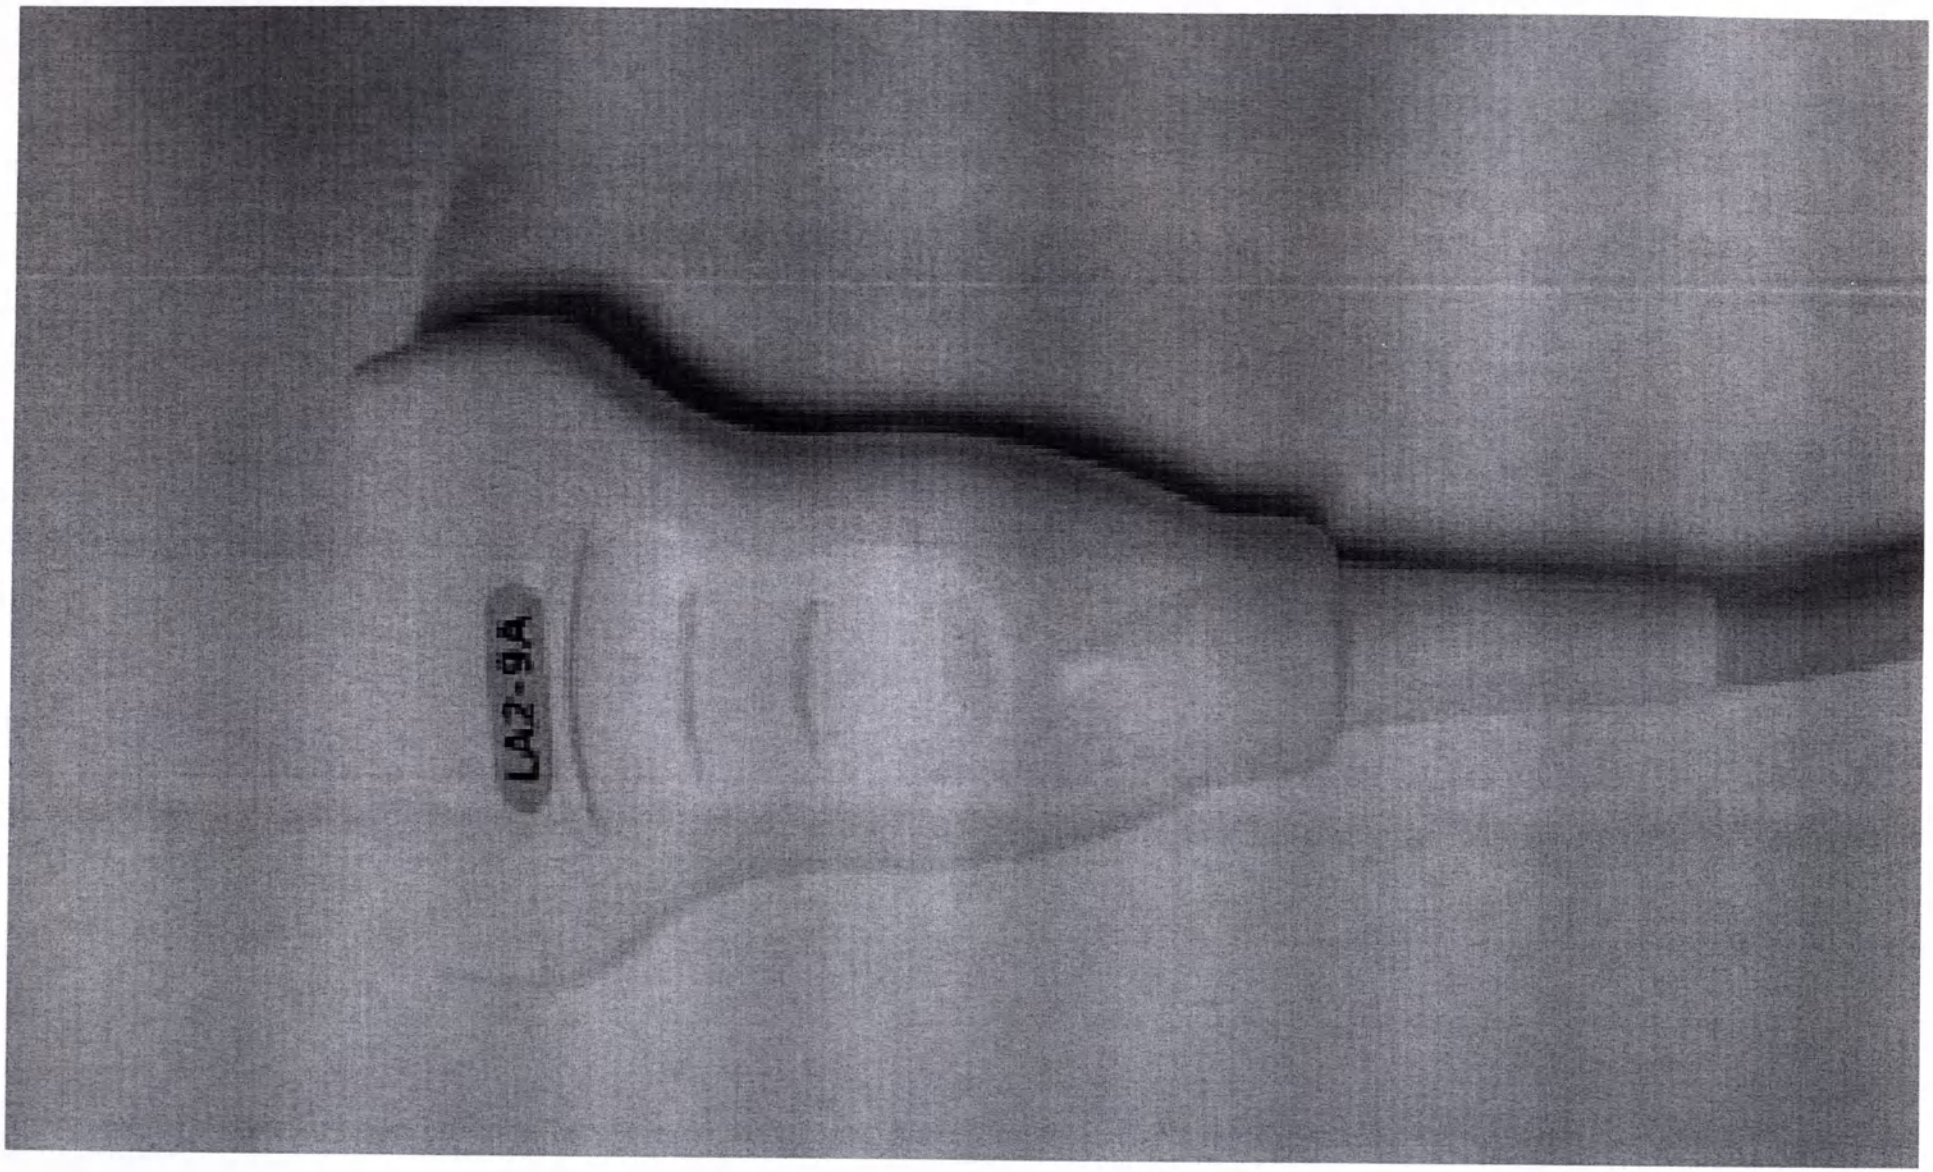

Линейный датчик LA2-9A

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

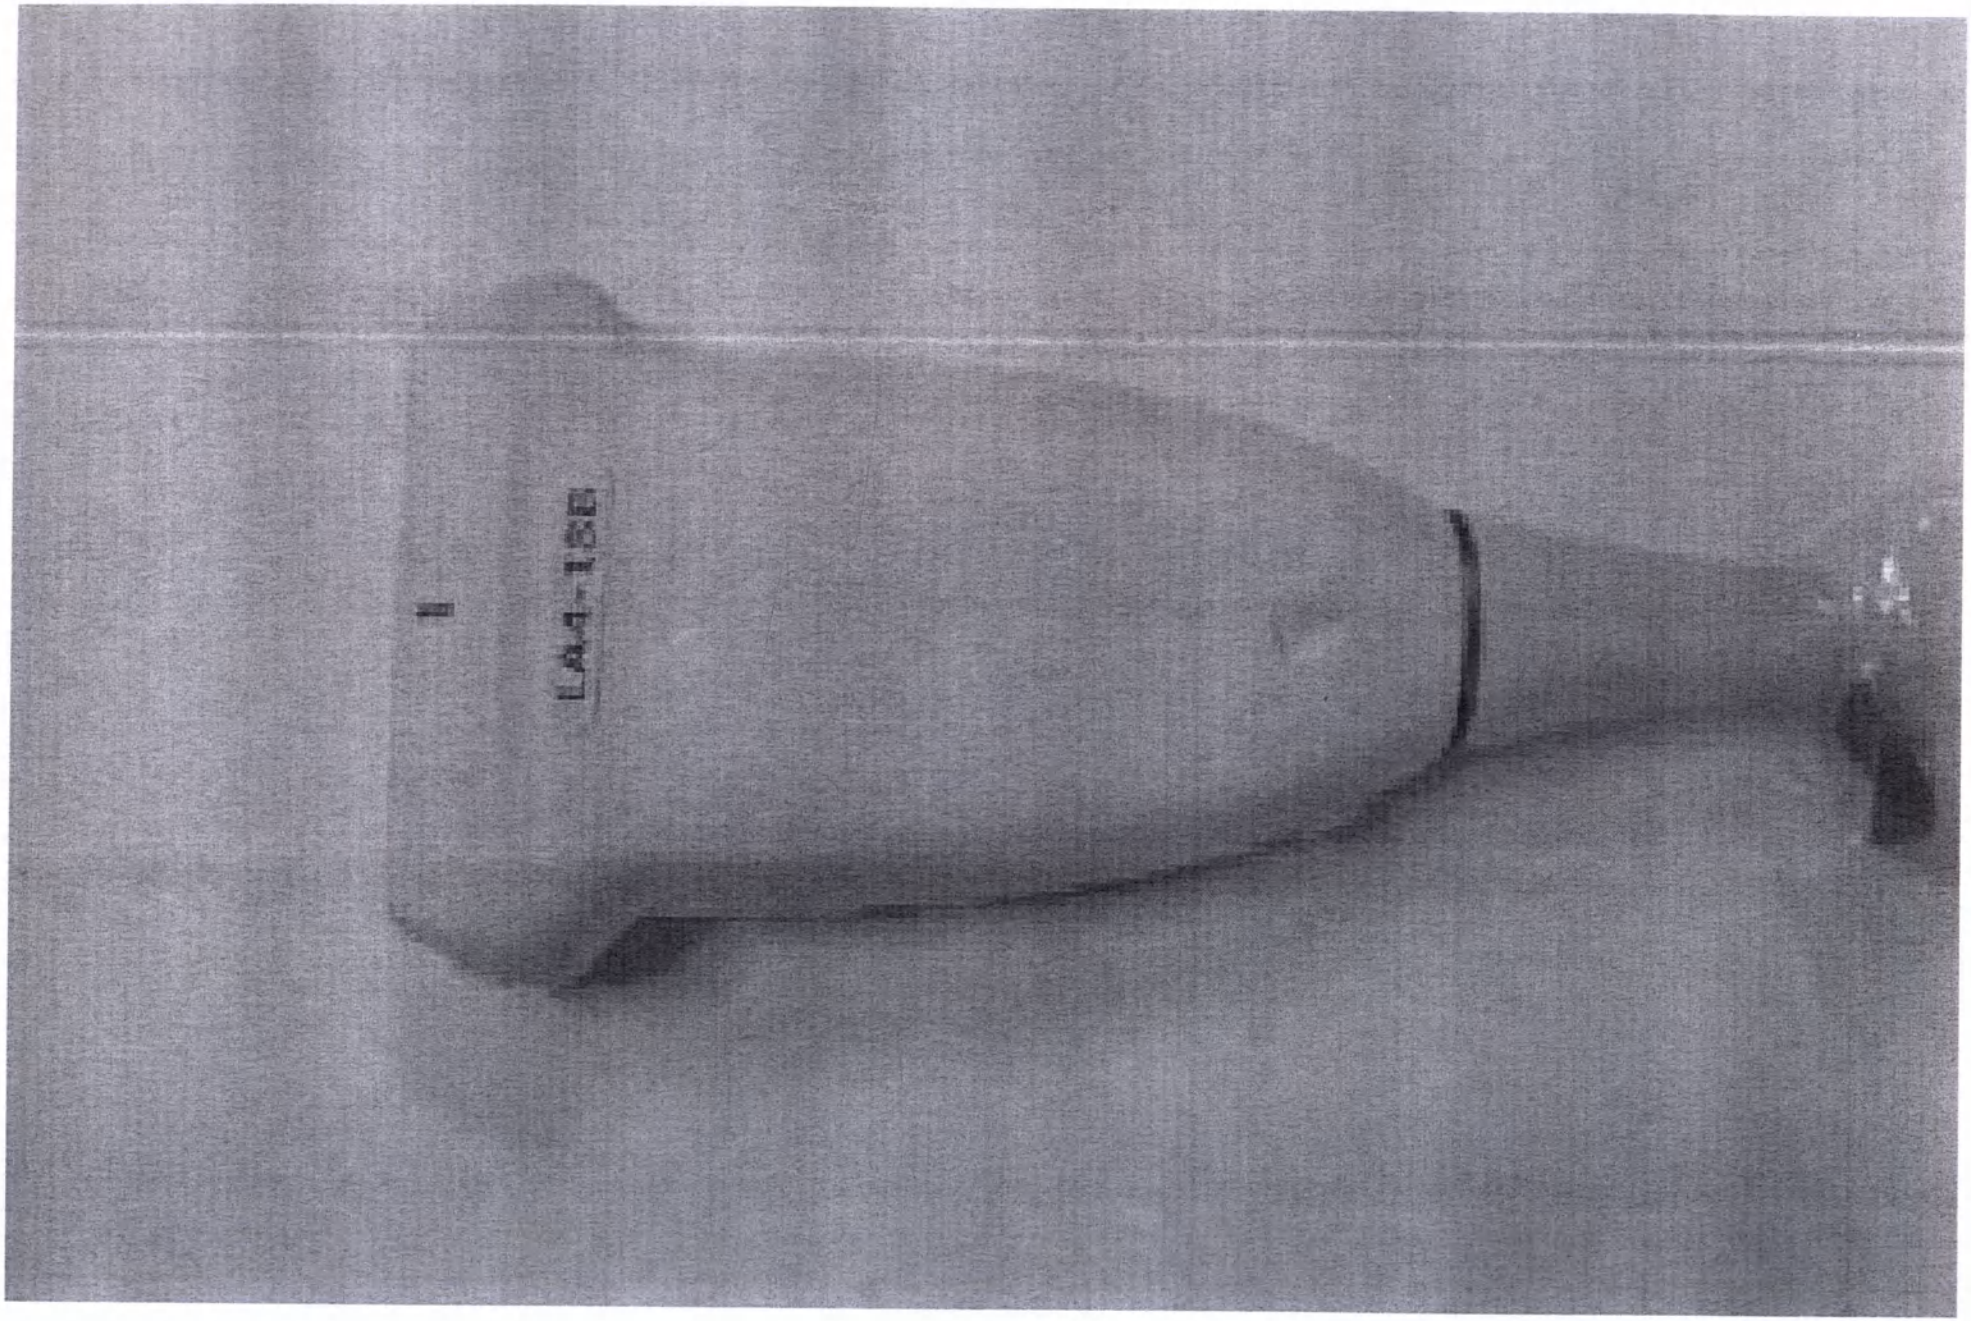

Линейный датчик LM4-15B

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

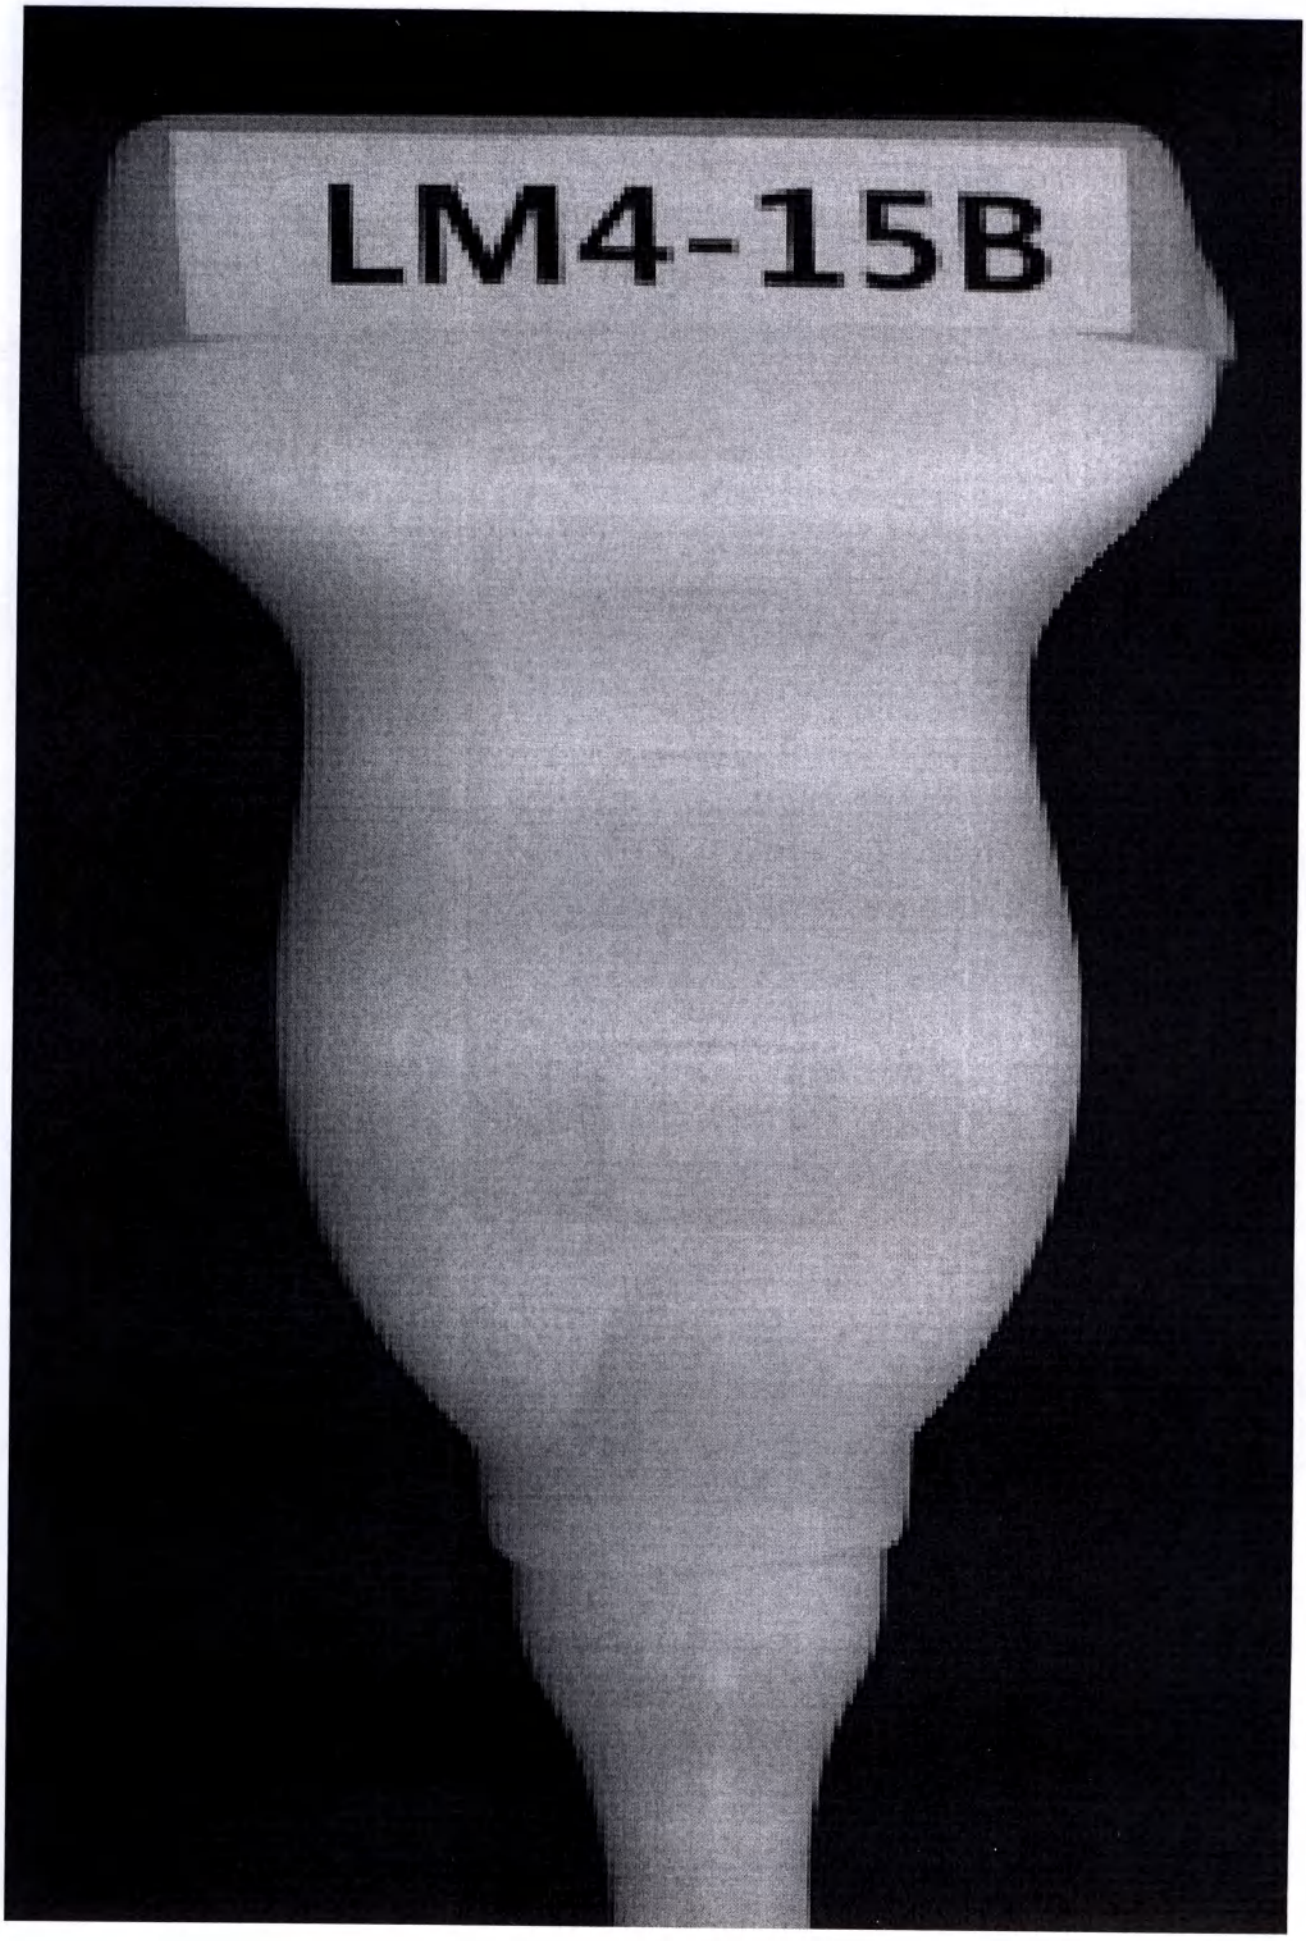

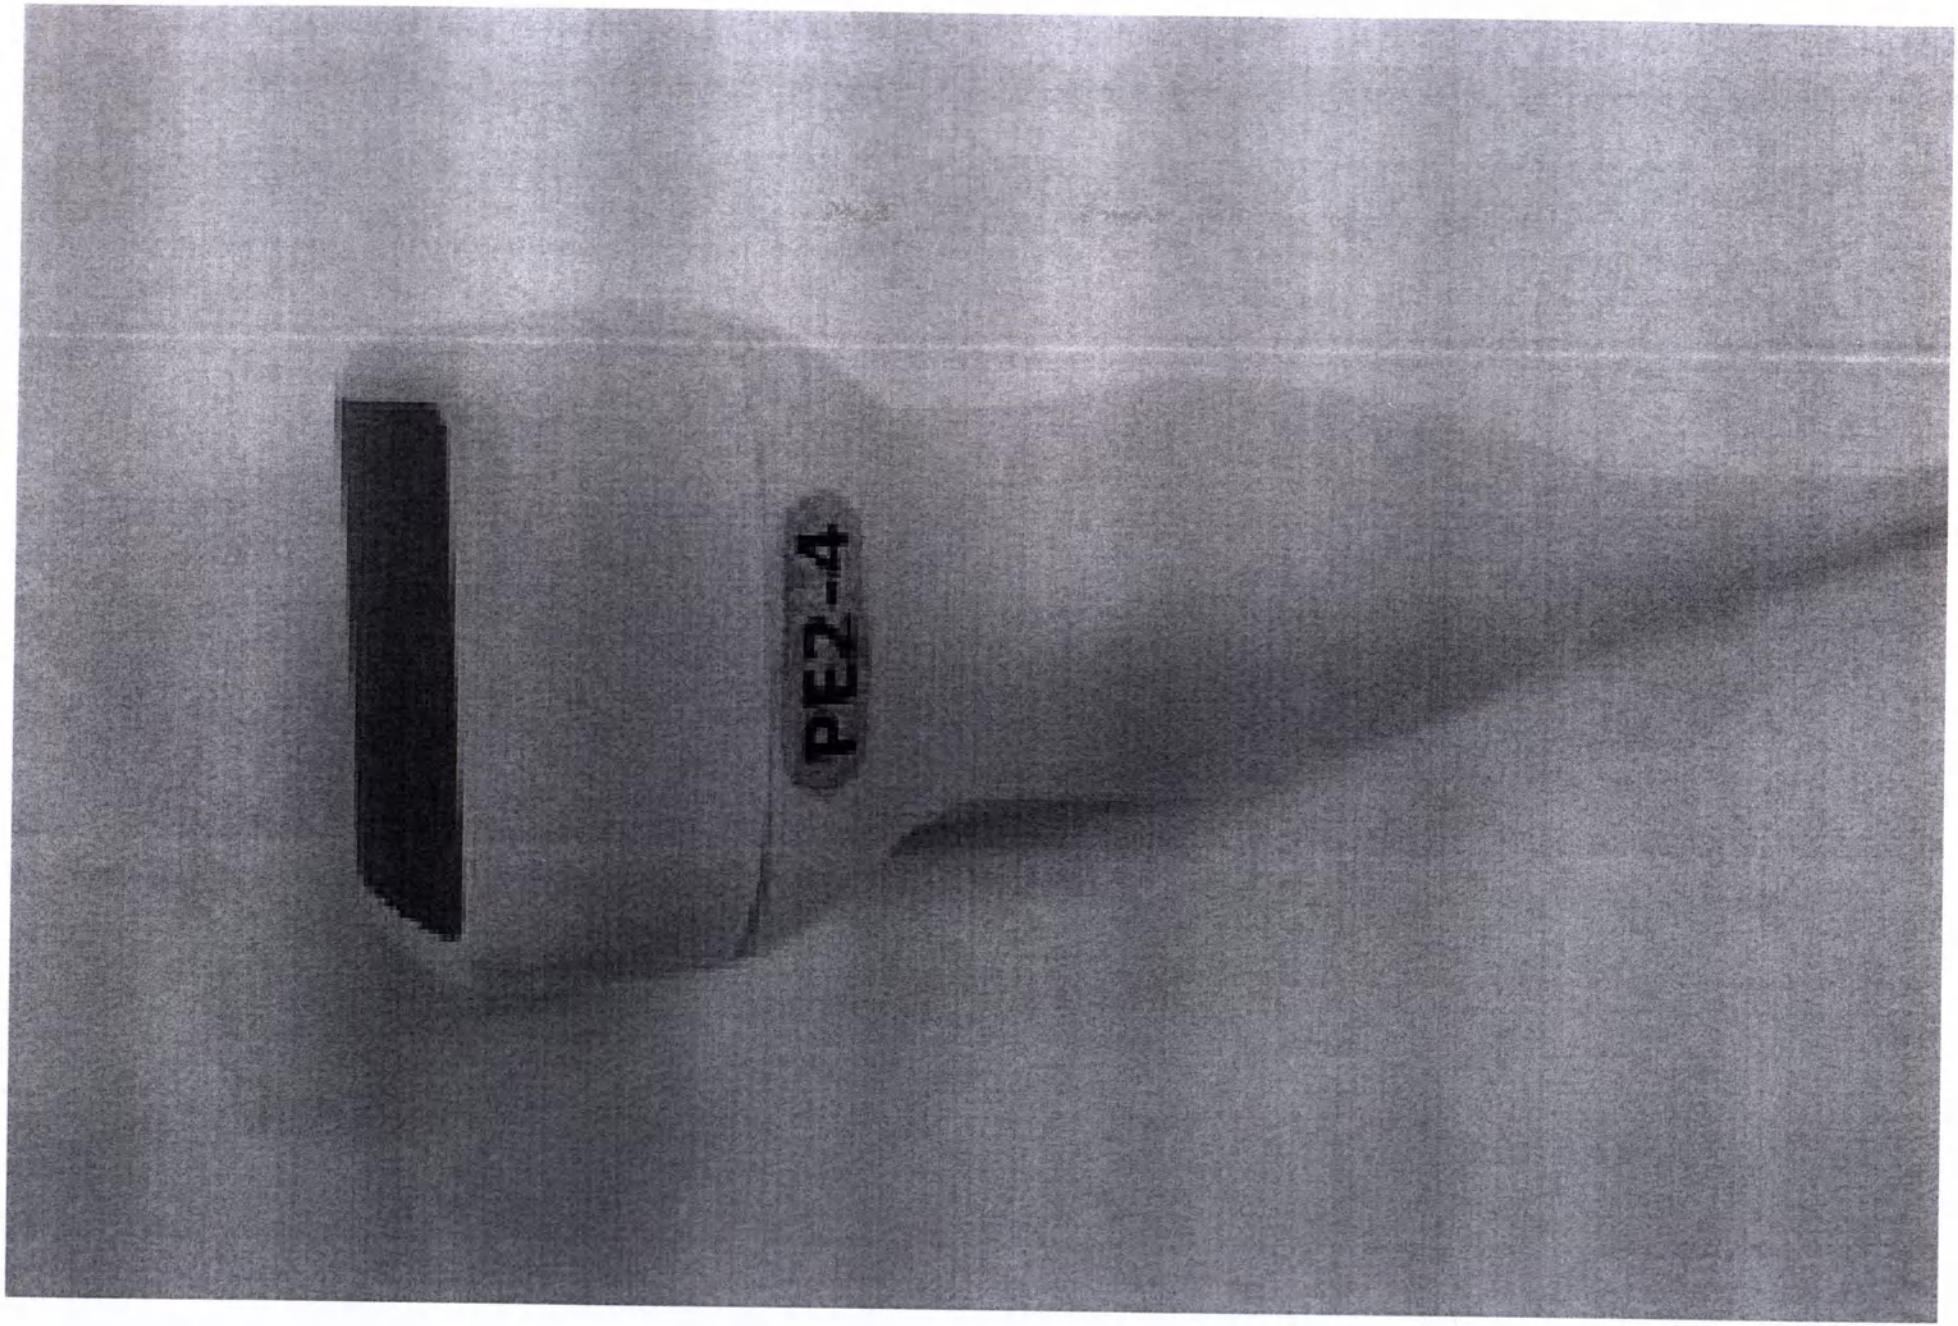

Фазированный датчик PE2-4

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

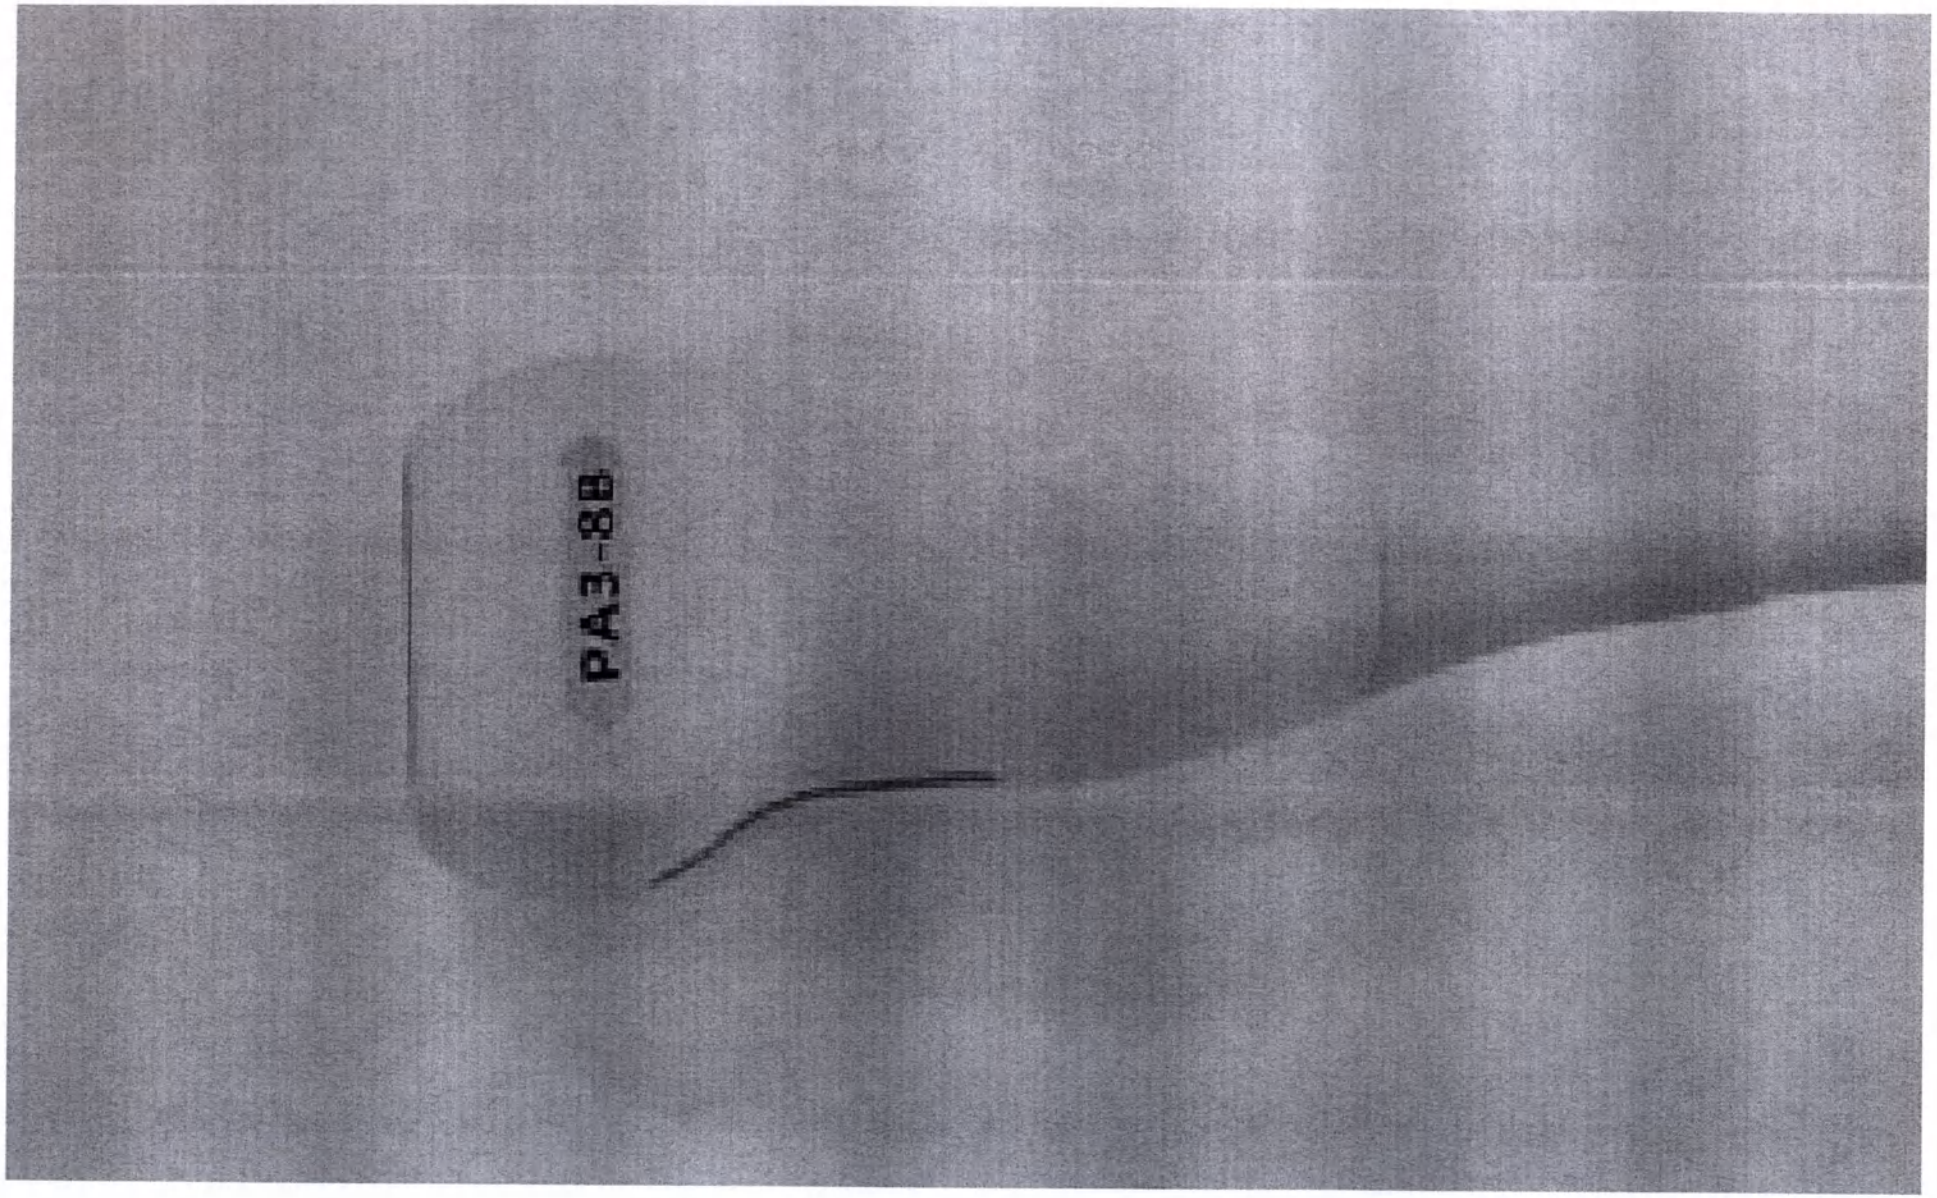

Фазированный датчик РАЗ-8В

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фазированный датчик PA4-12B

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

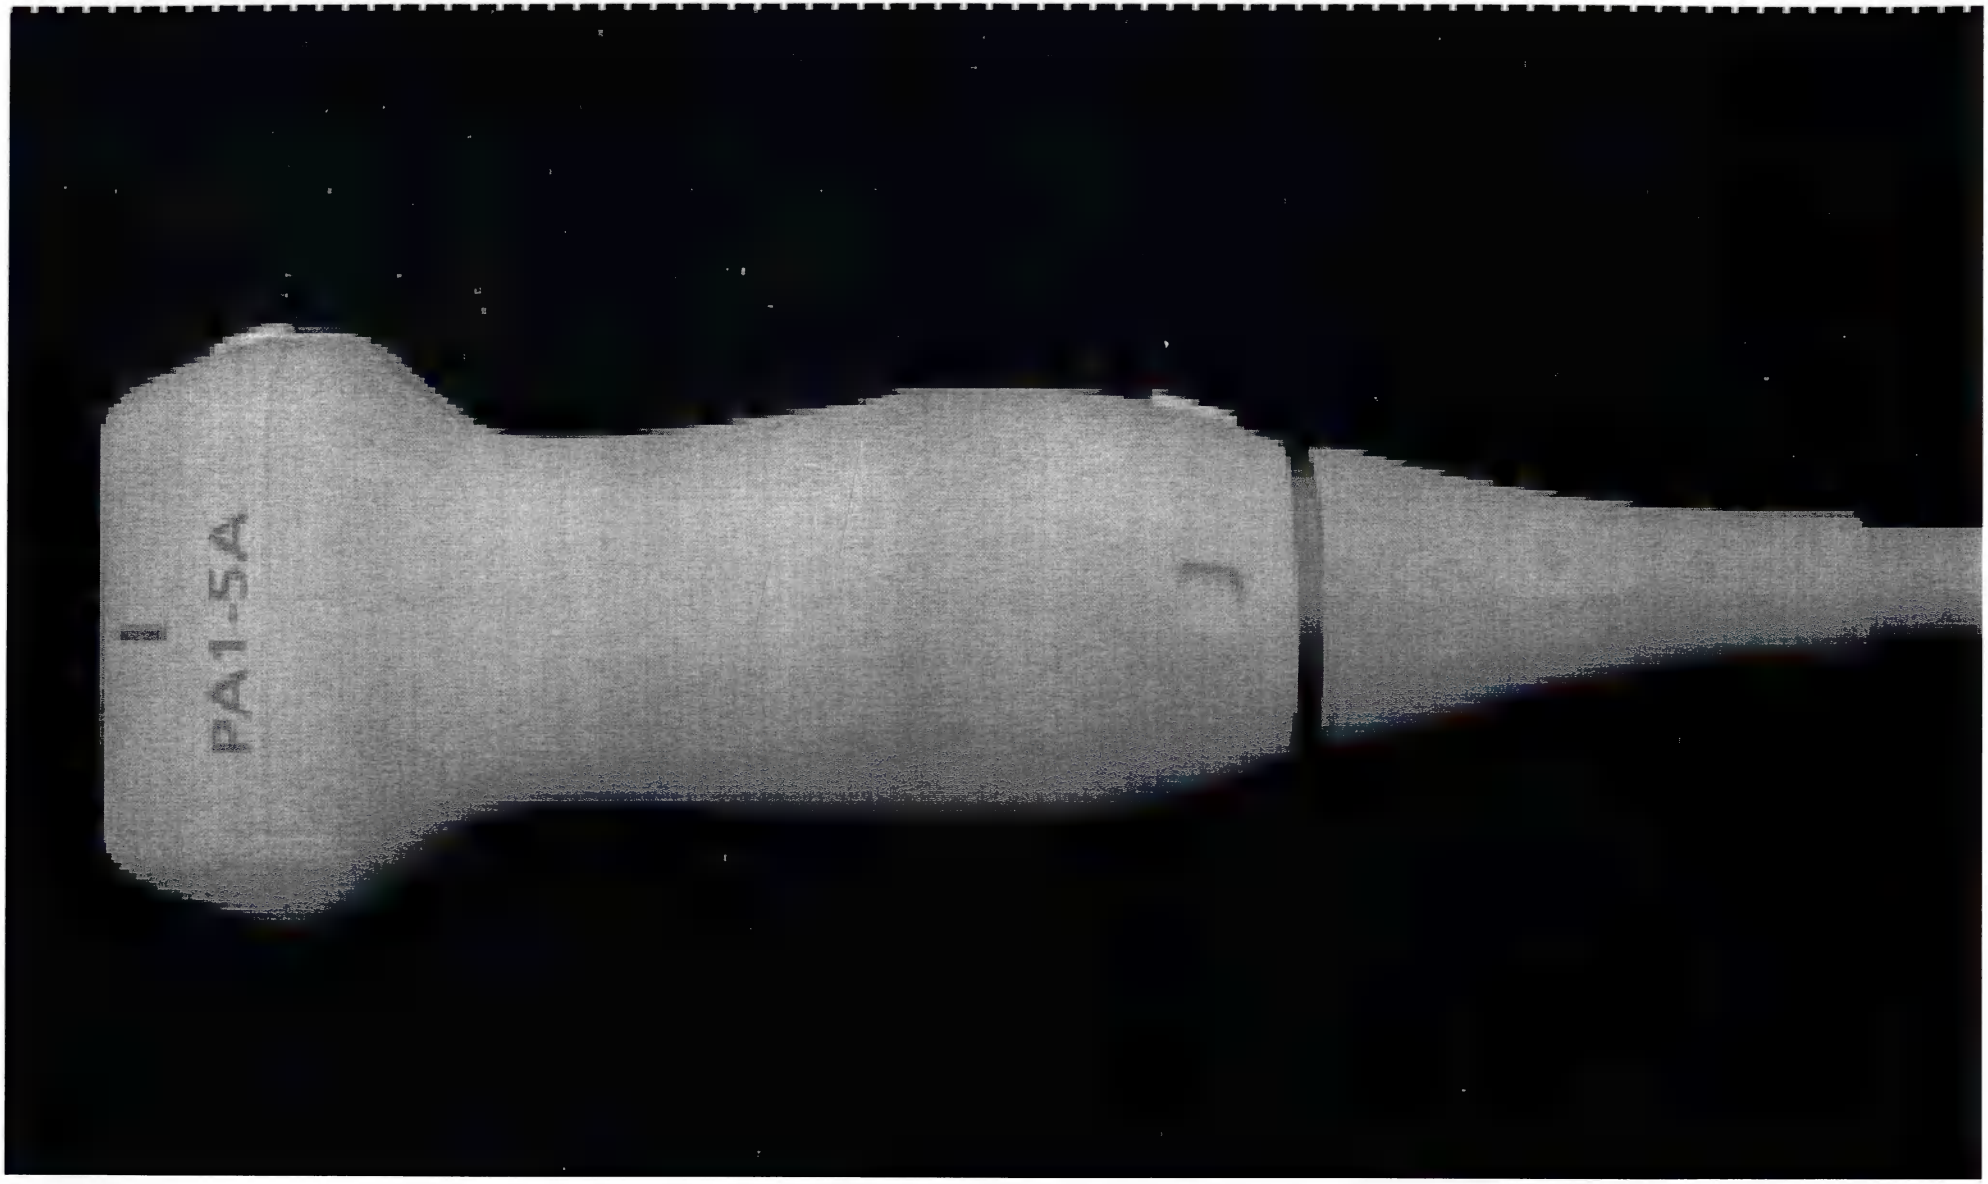

Фазированный датчик PA1-5A

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

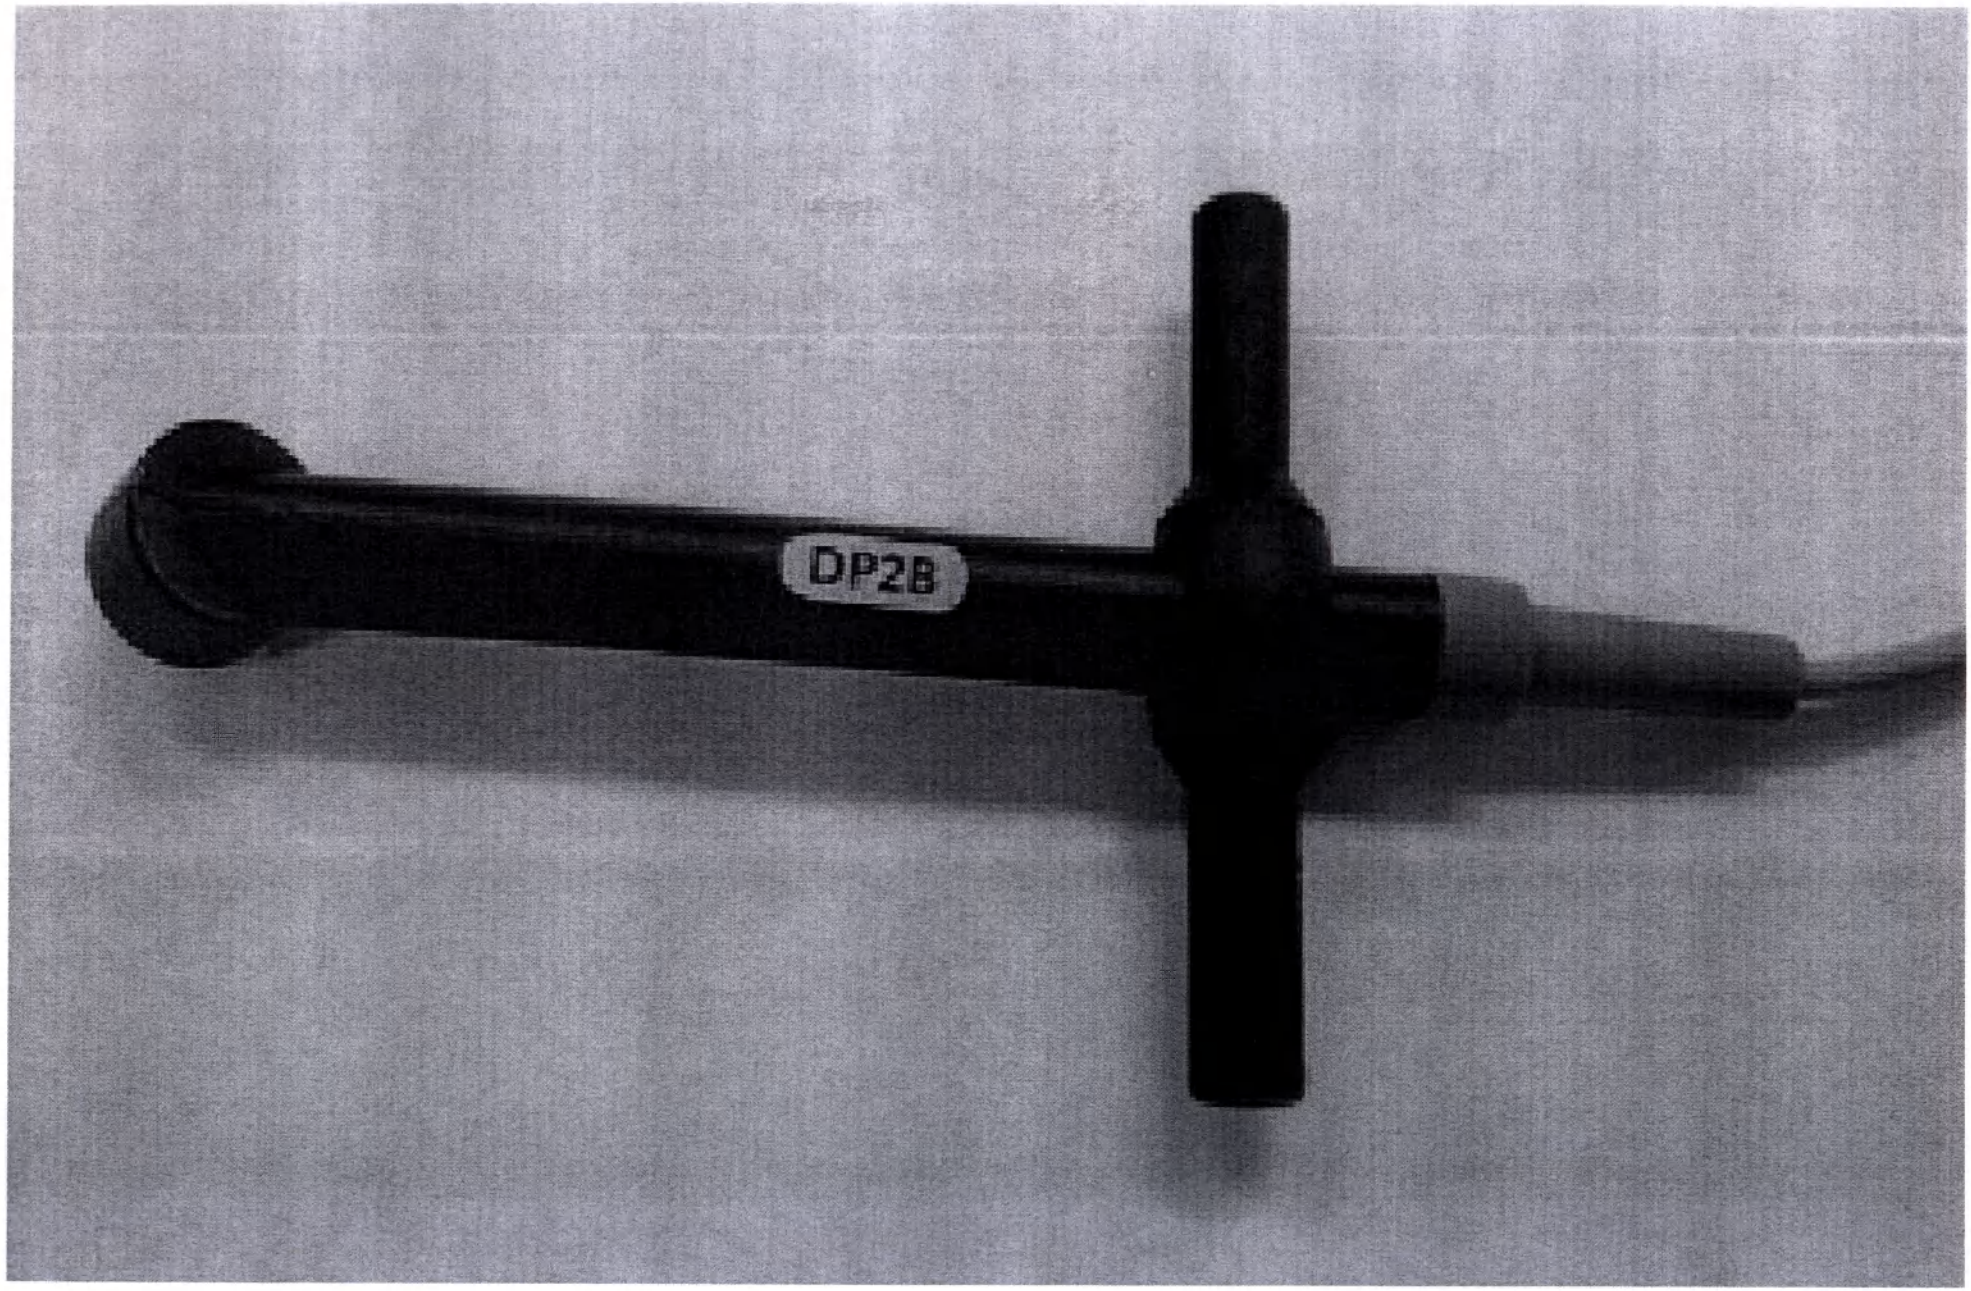

Постоянно-волновой **латчик DP2B**

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

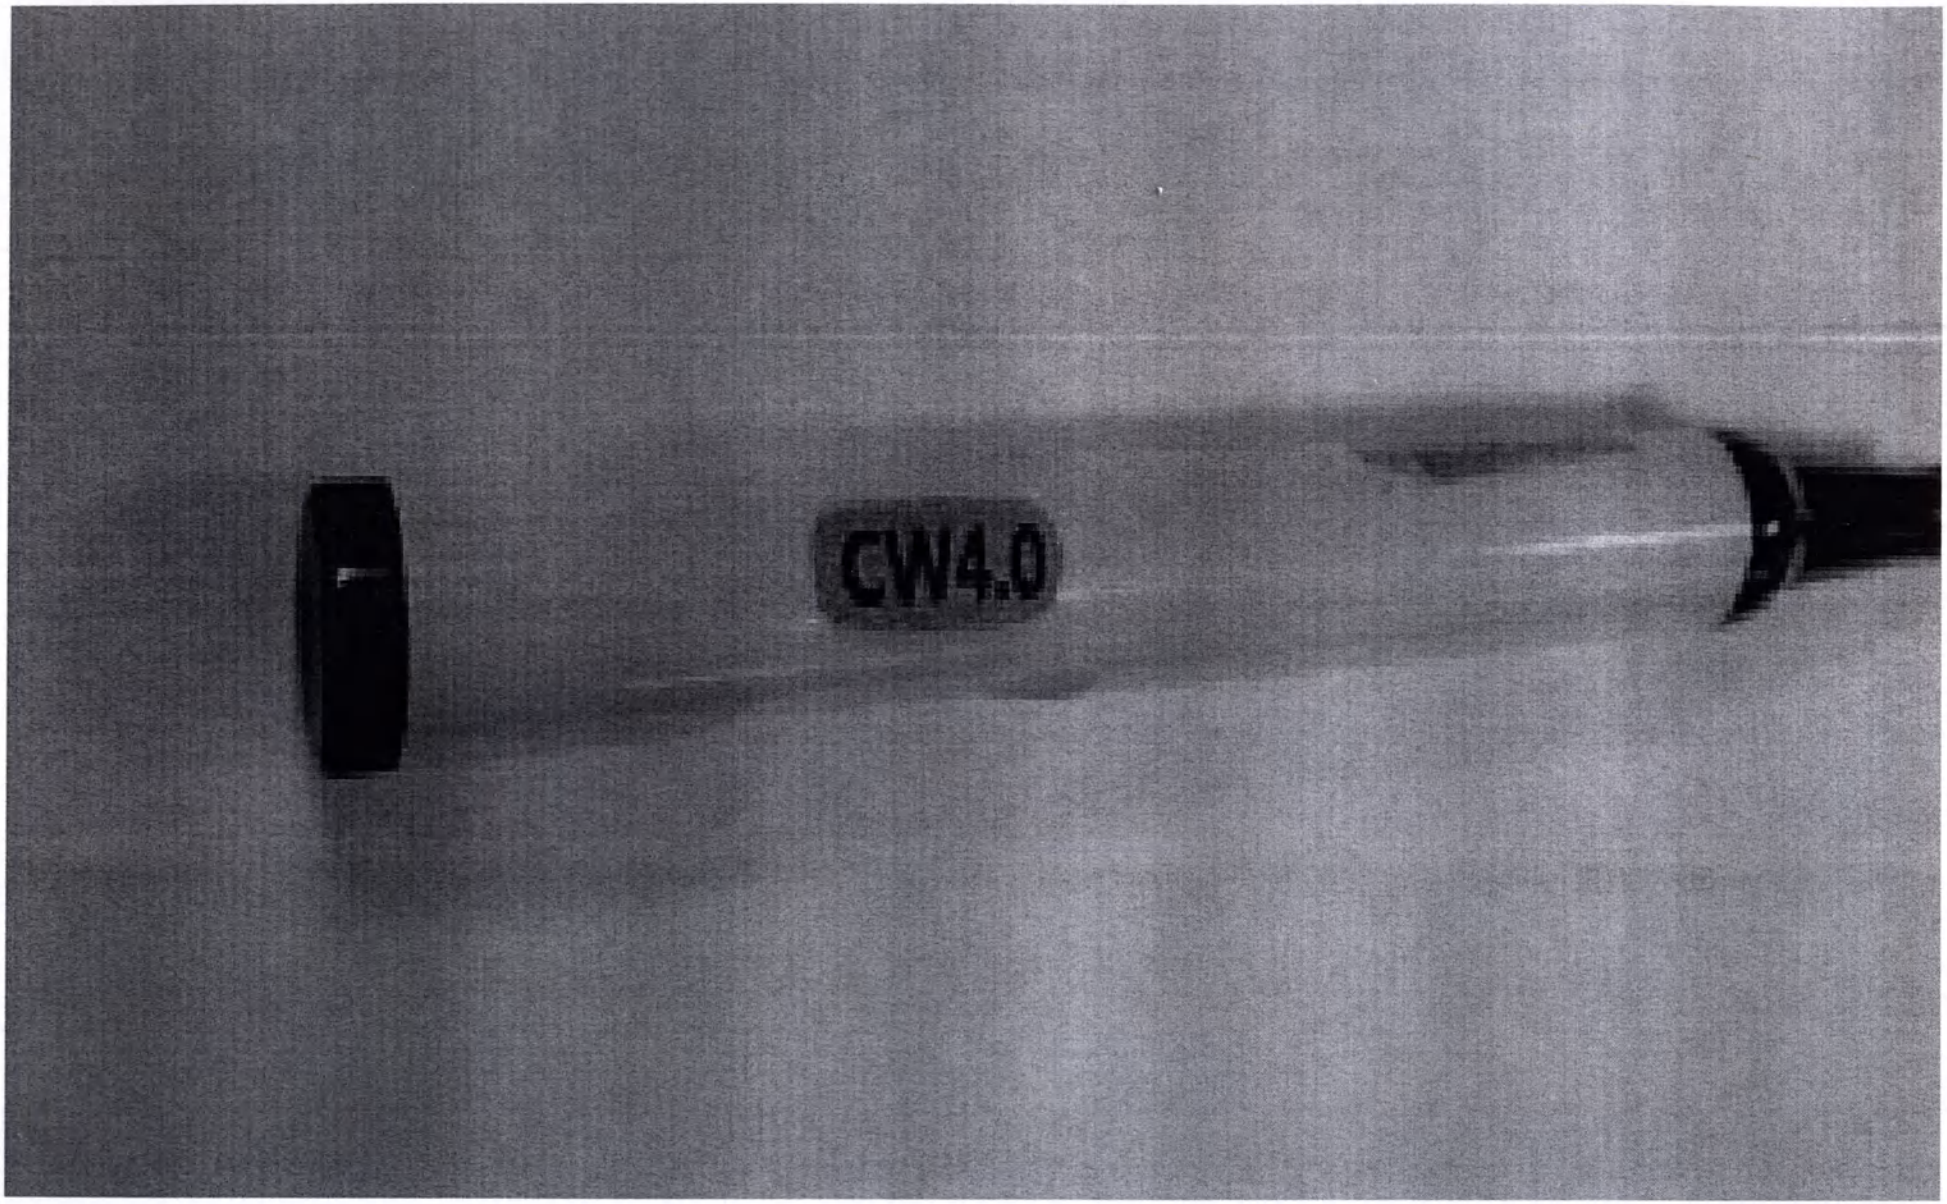

Постоянно-волновой датчик CW4.0

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

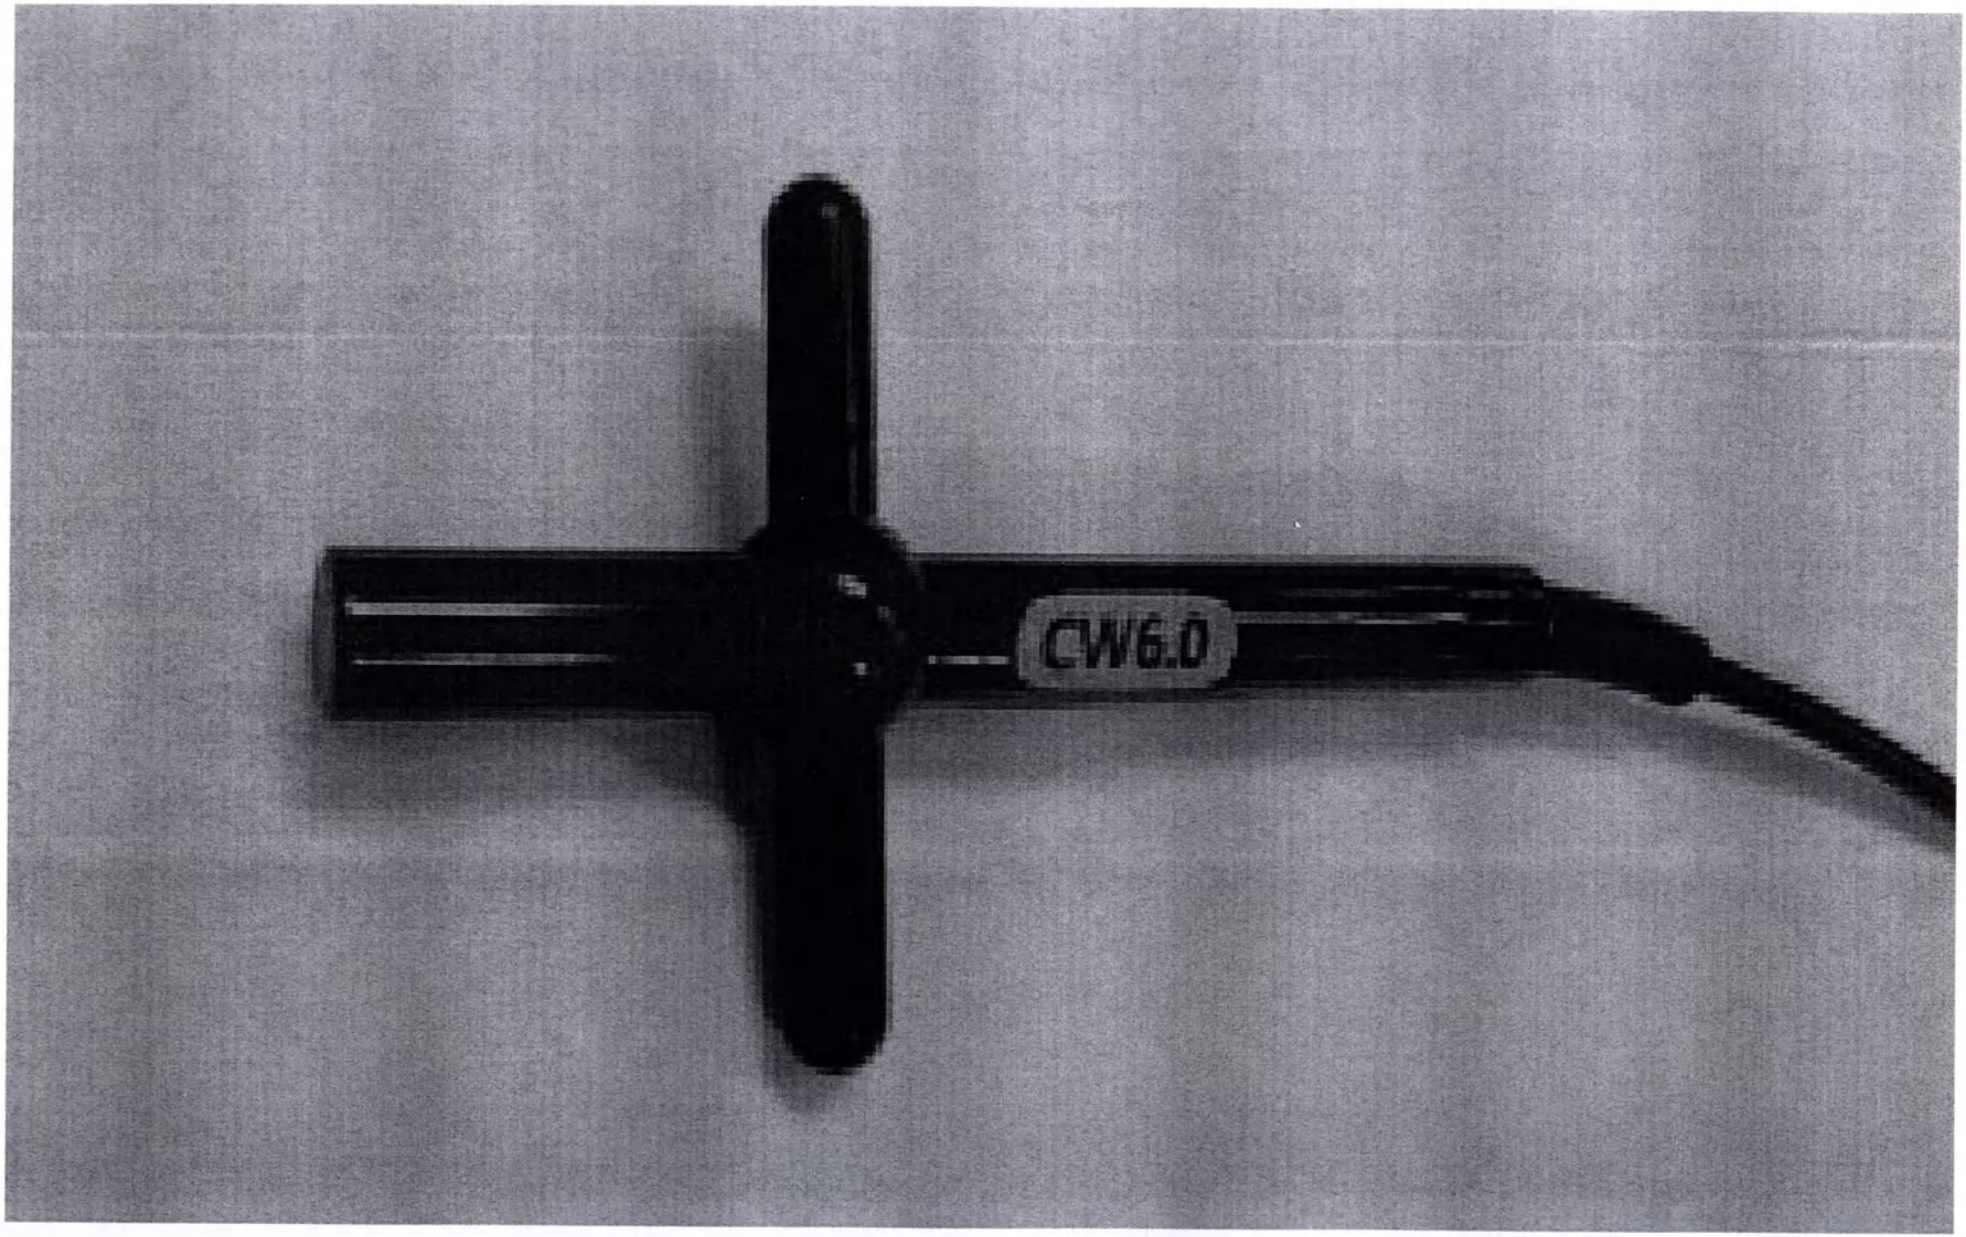

Постоянно-волновой датчик CW6.0

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

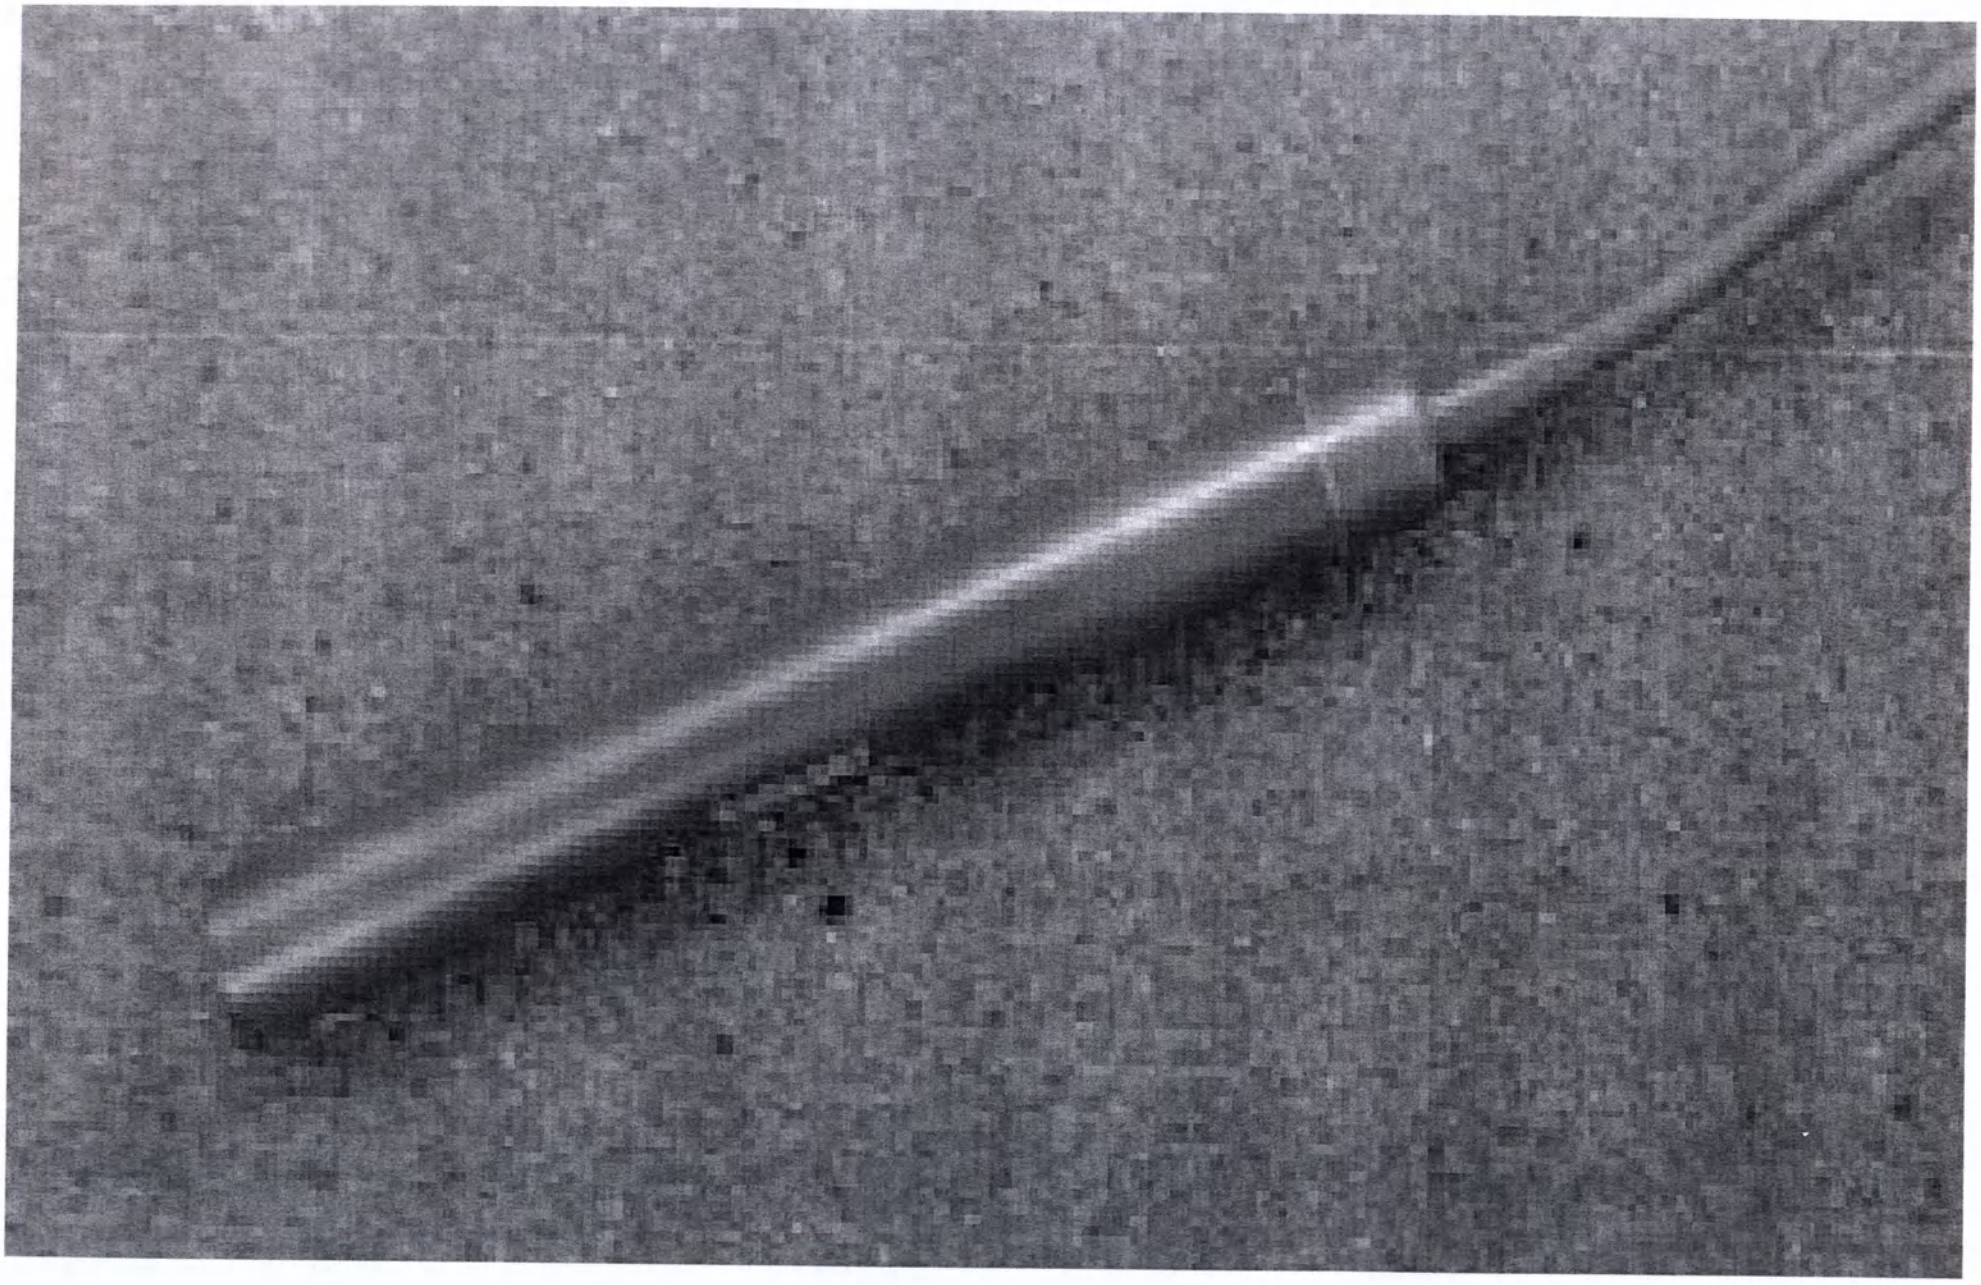

Карандашный датчик DP8B

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

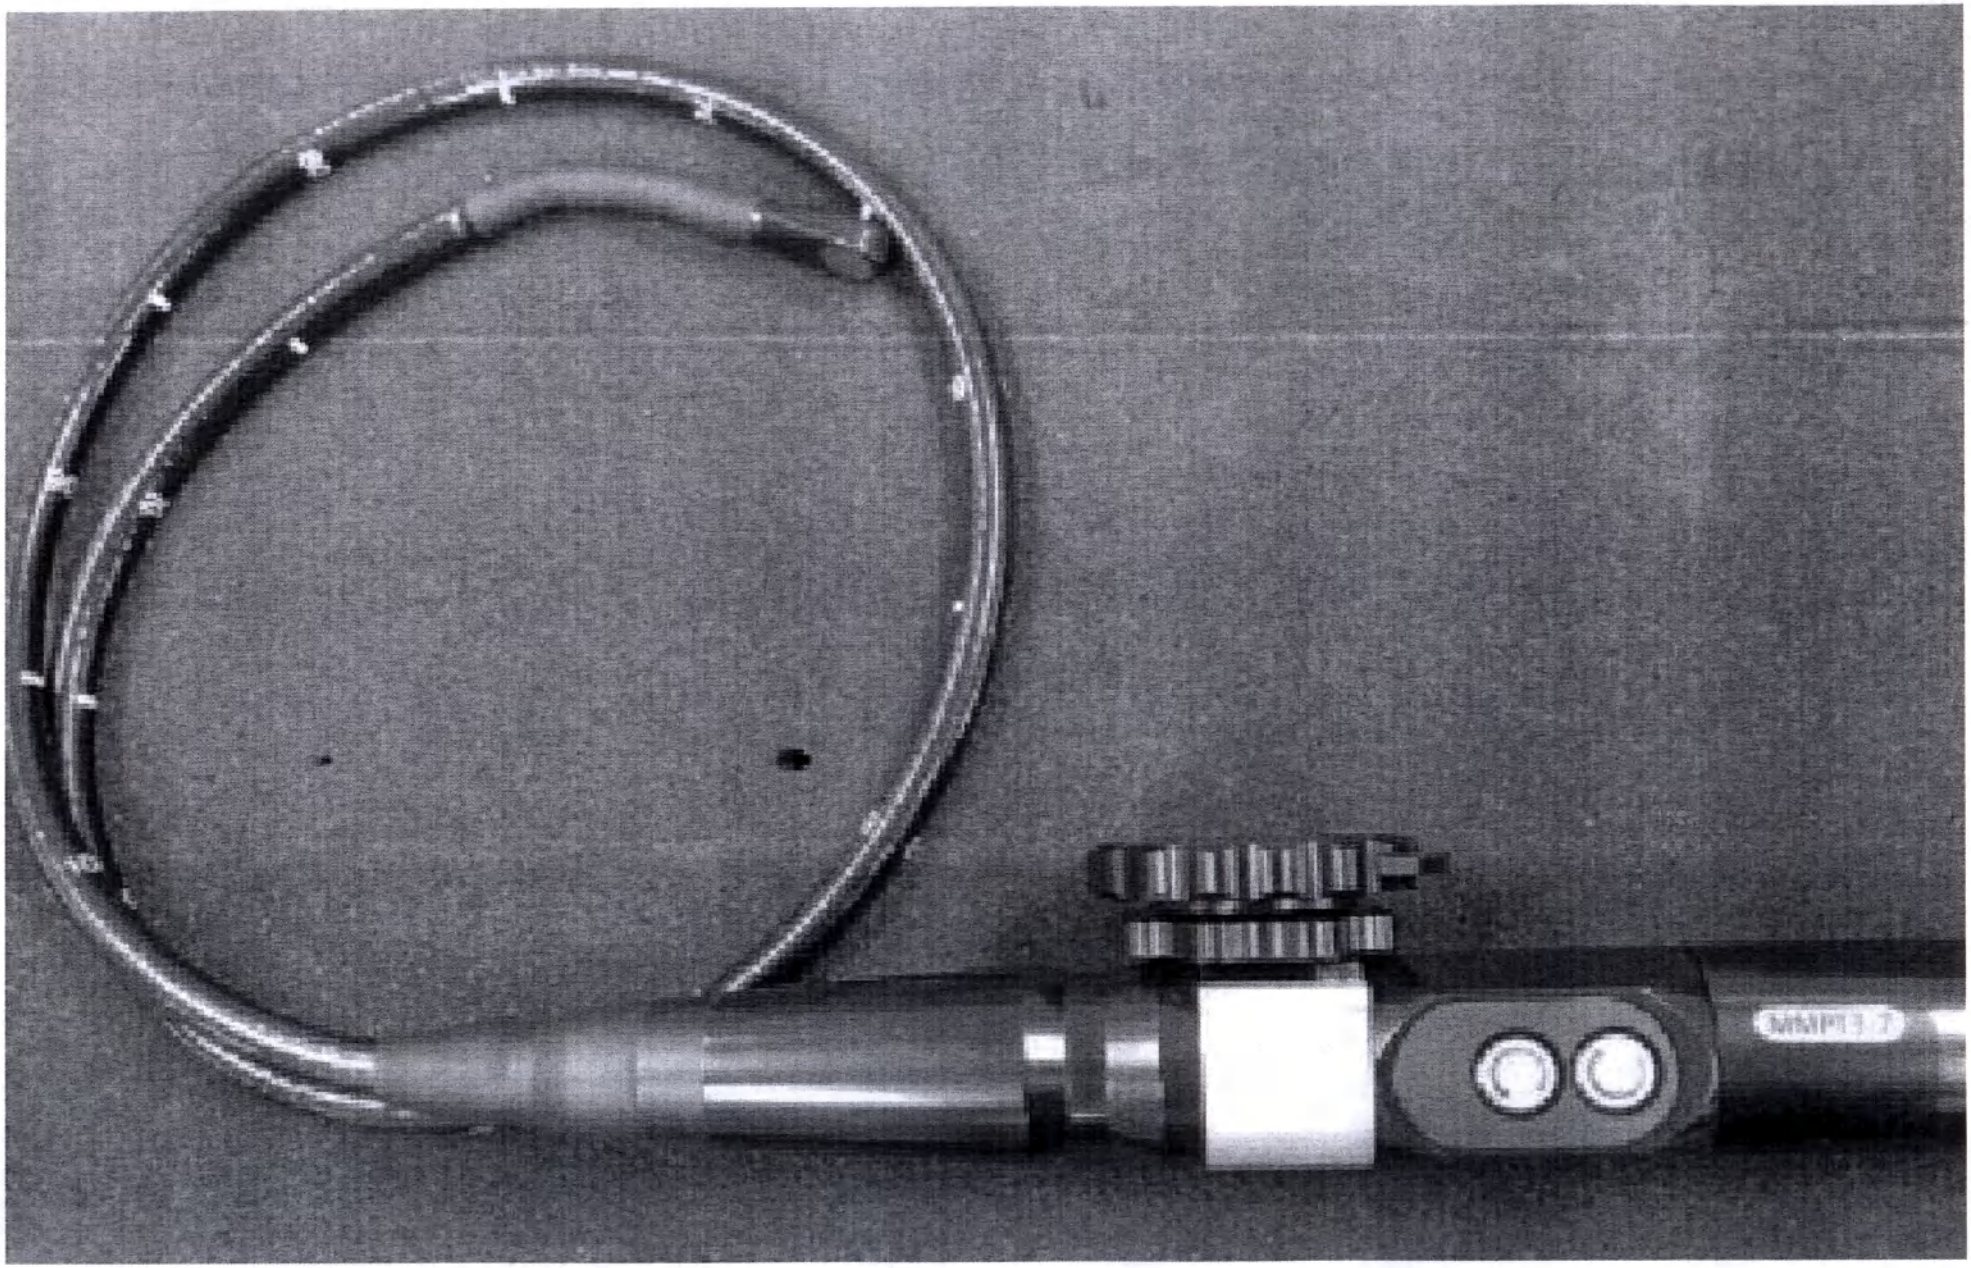

Чреспищеводный датчик: ММРТ3-7

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

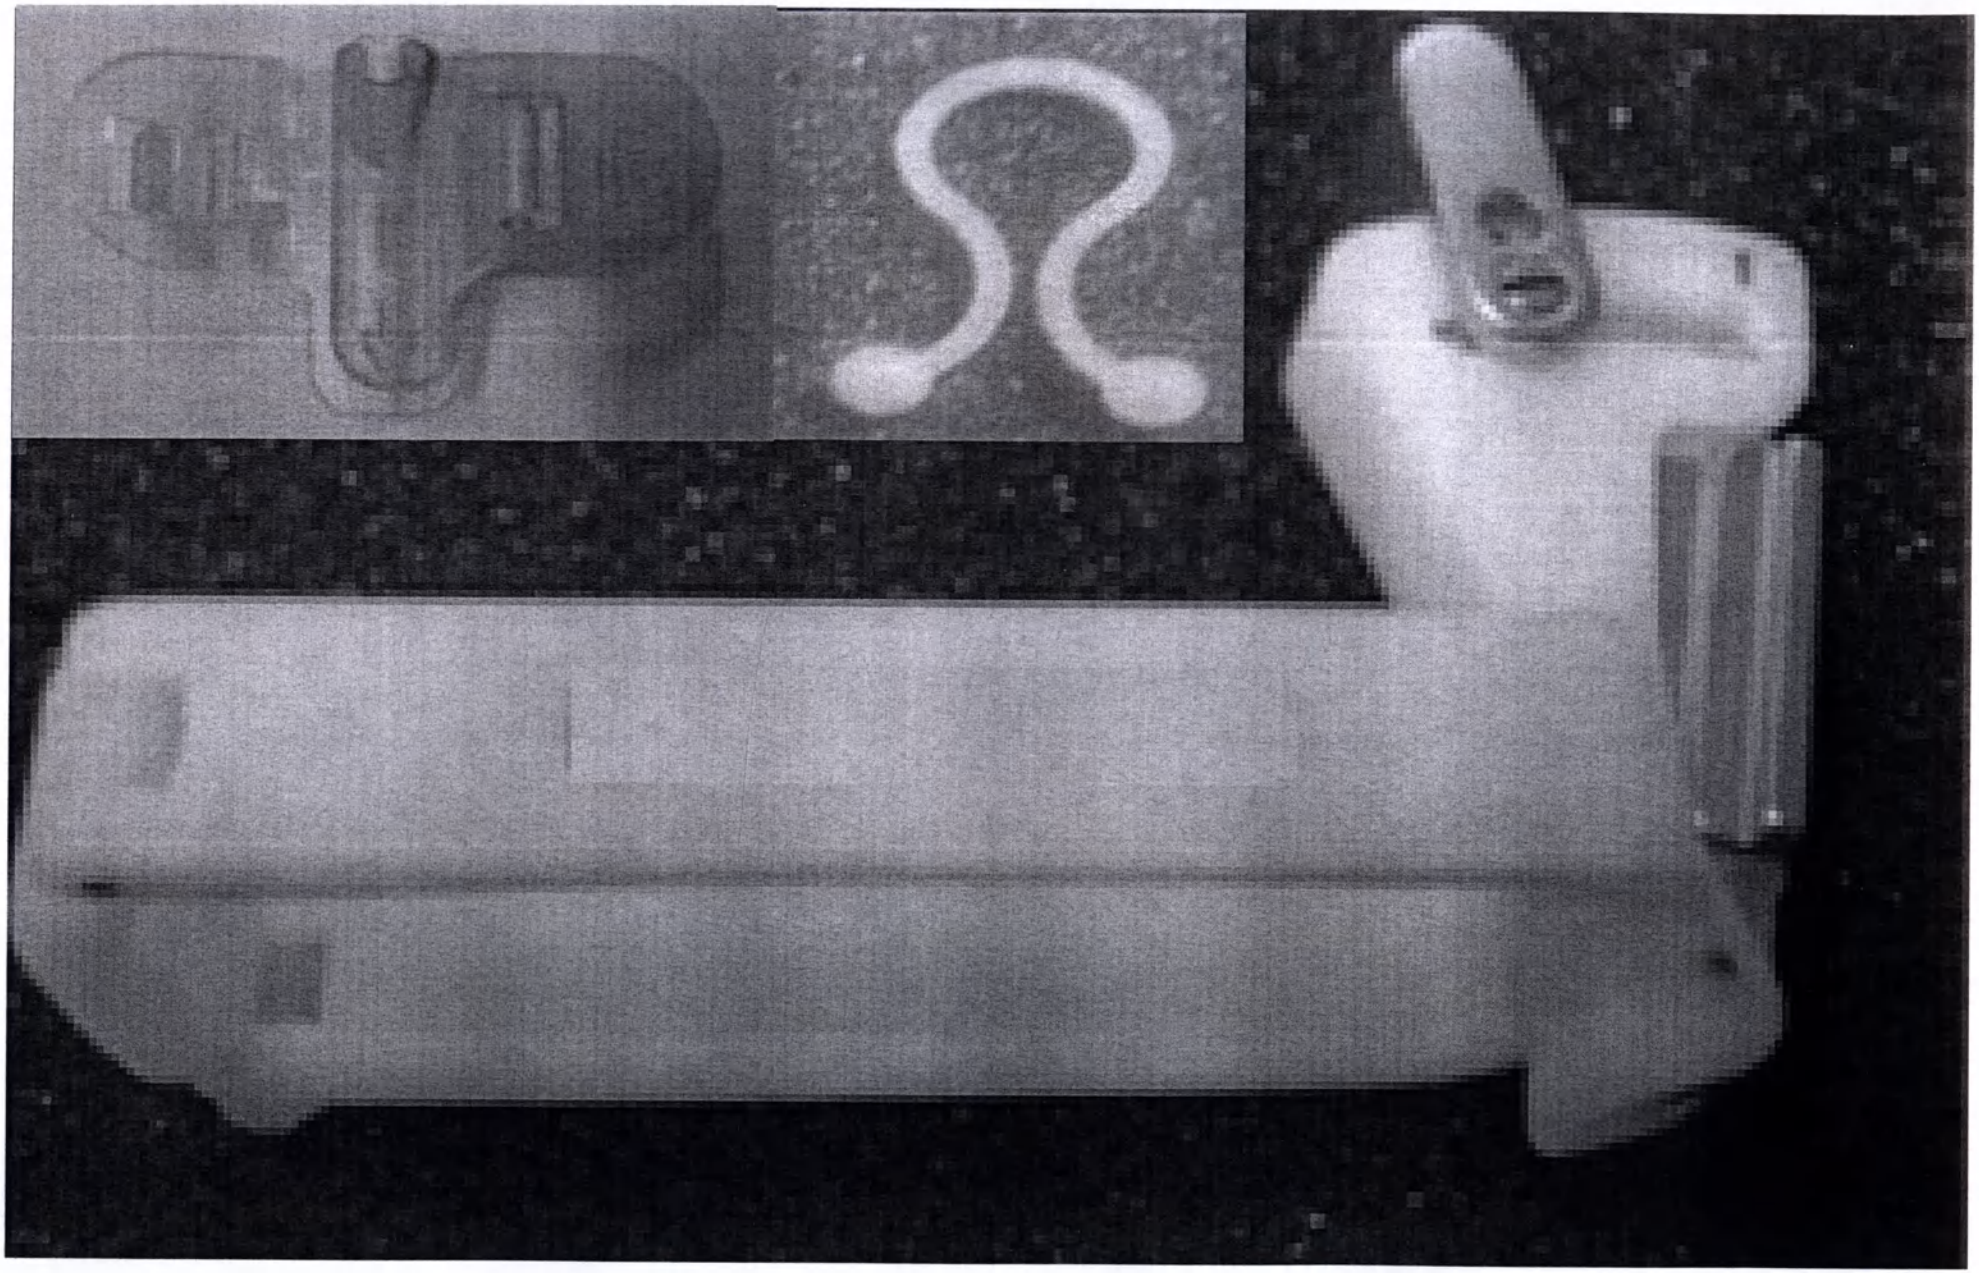

Набор для проведения биопсии,в составе: насадка для биопсии, крепление, направляющая иглы

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

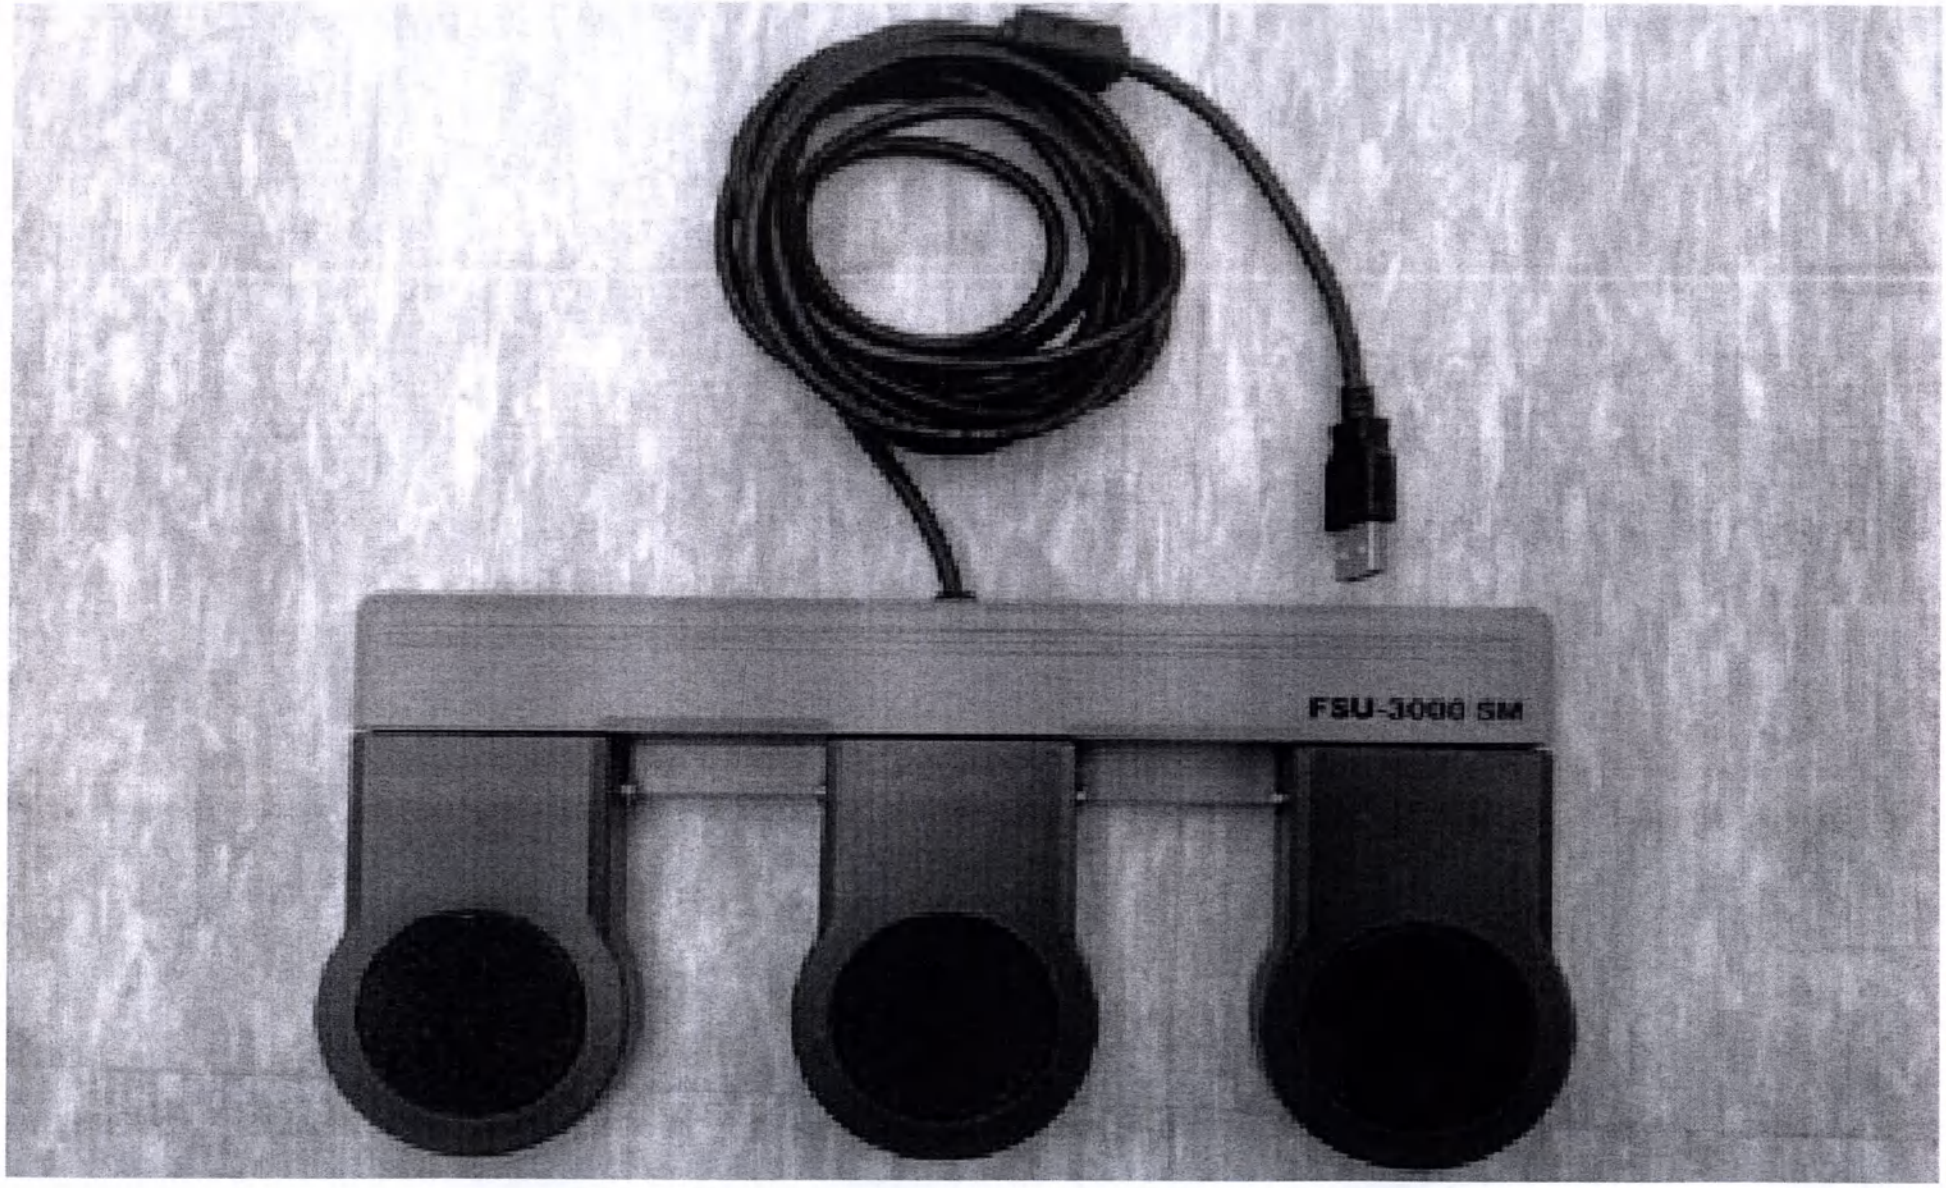

Ножной переключатель

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

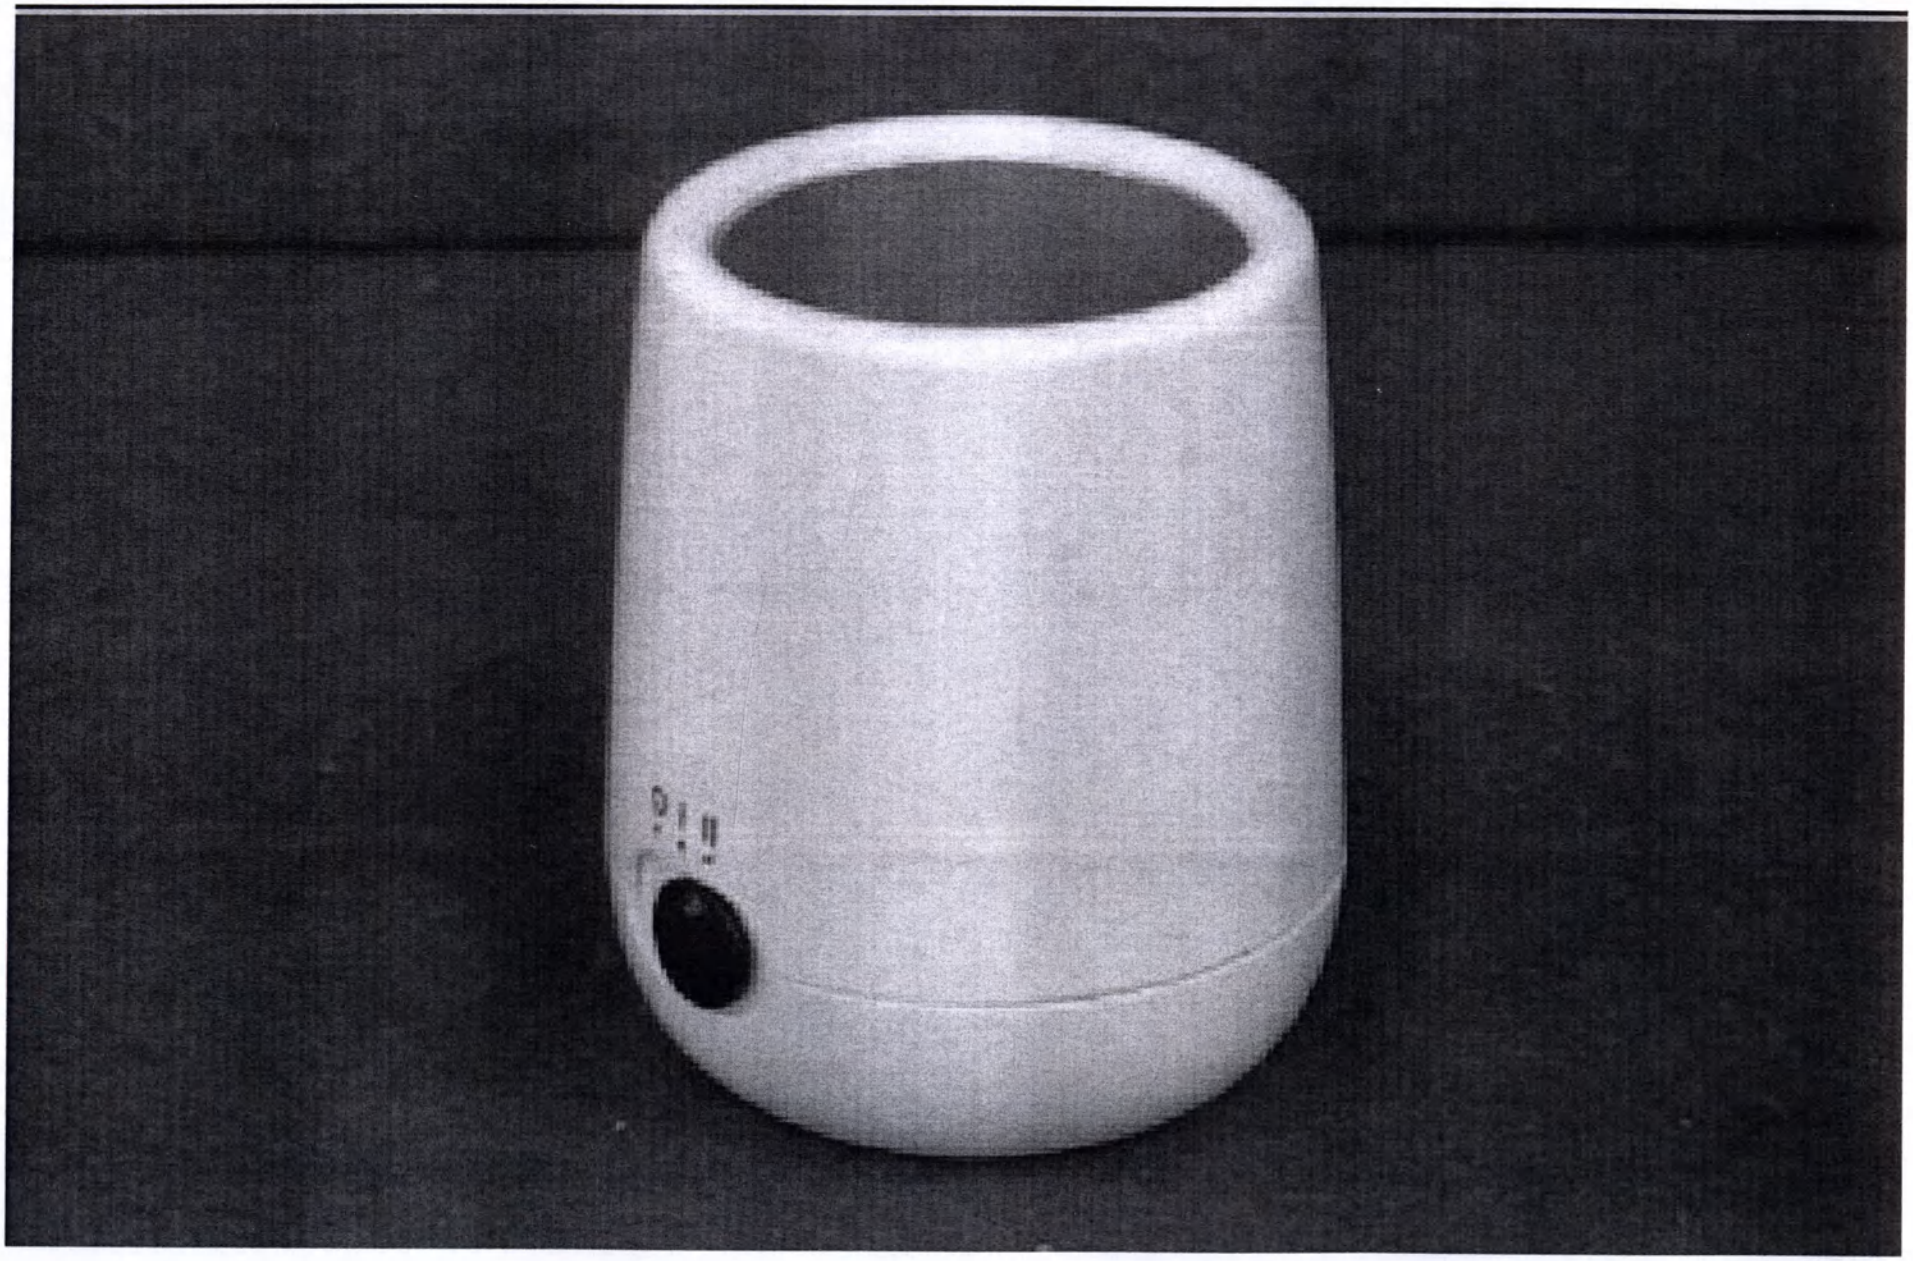

Подогреватель геля

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

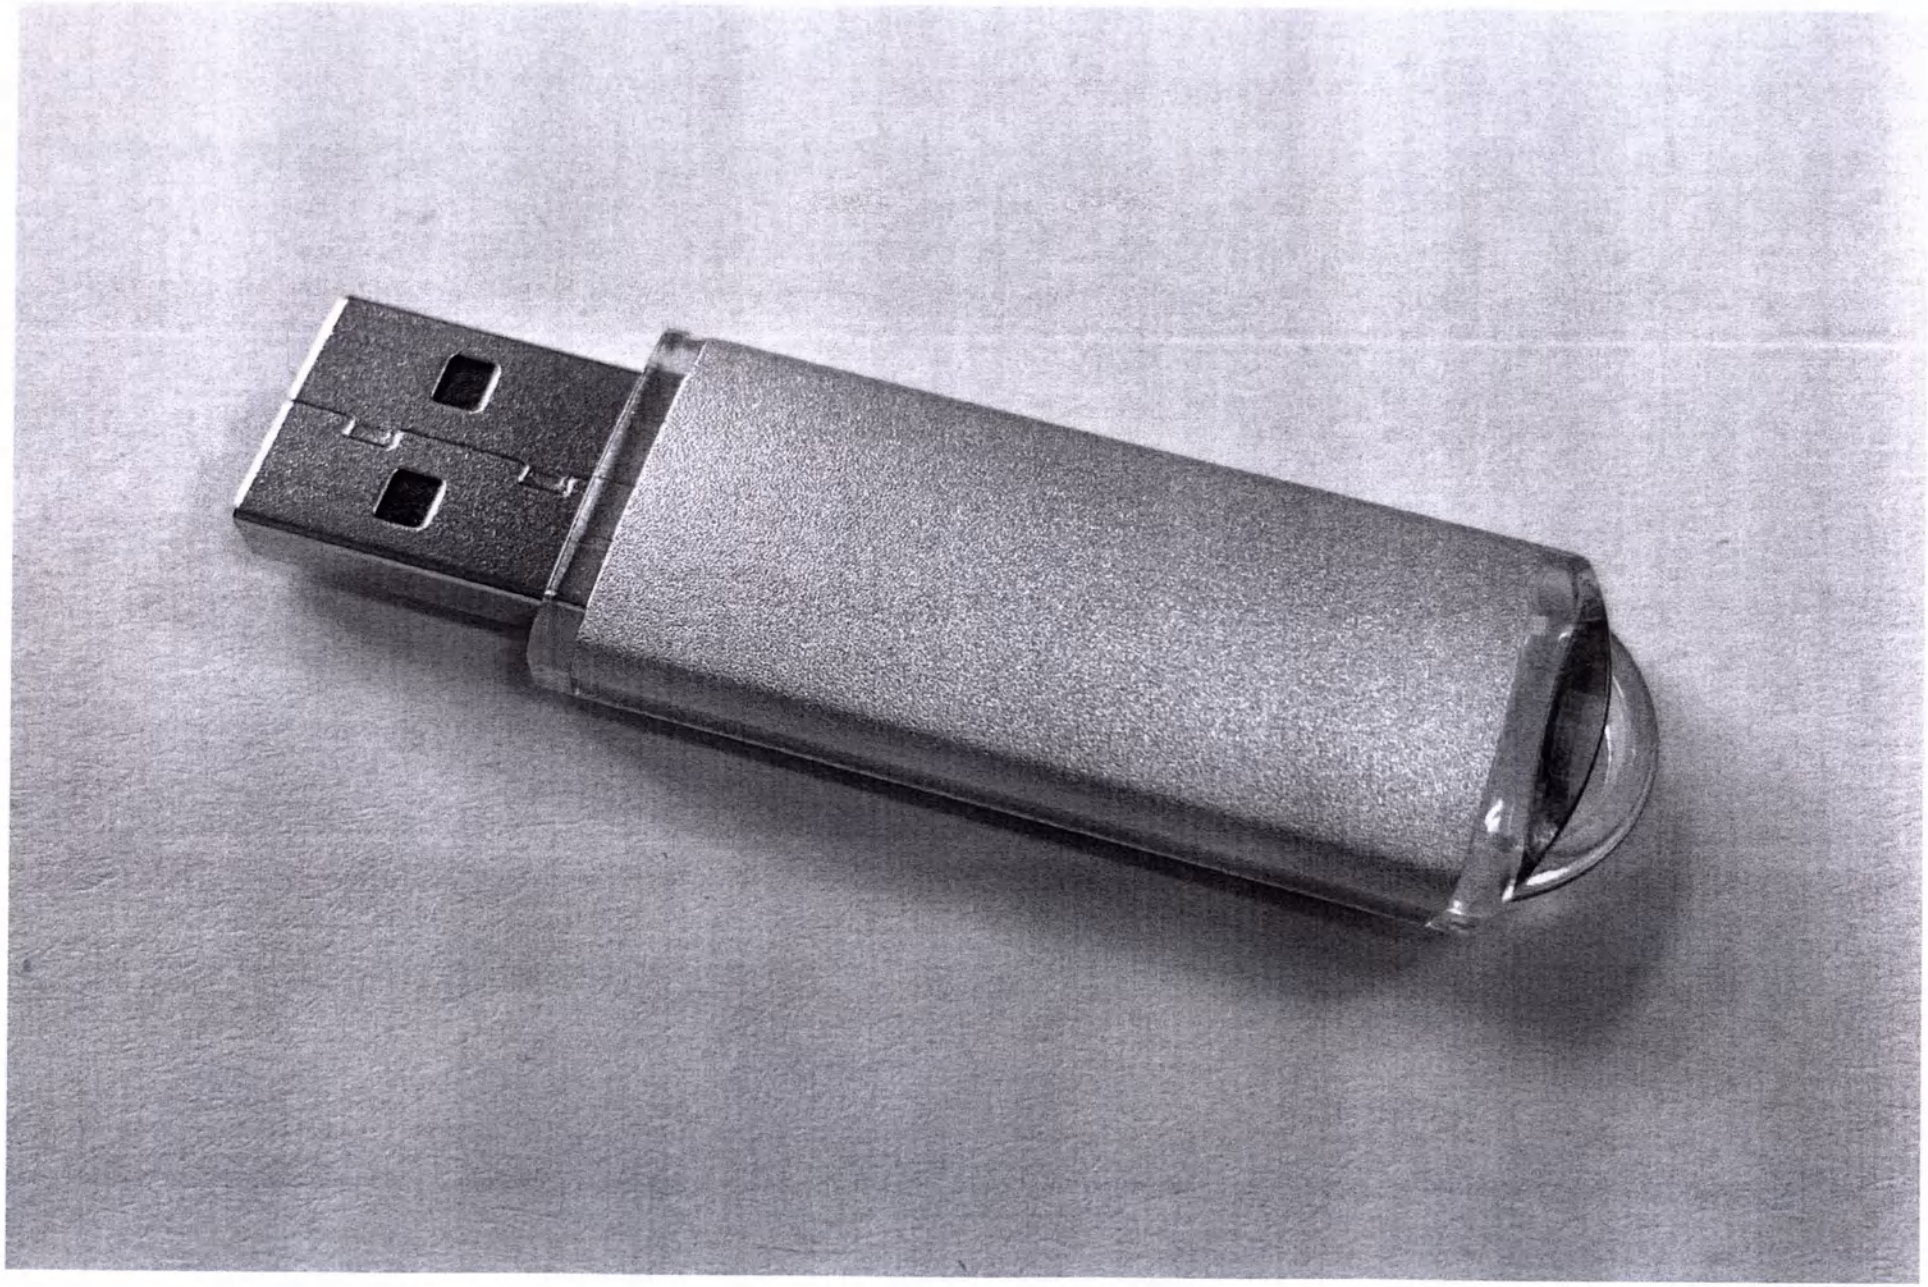

Флеш-накопитель информации

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

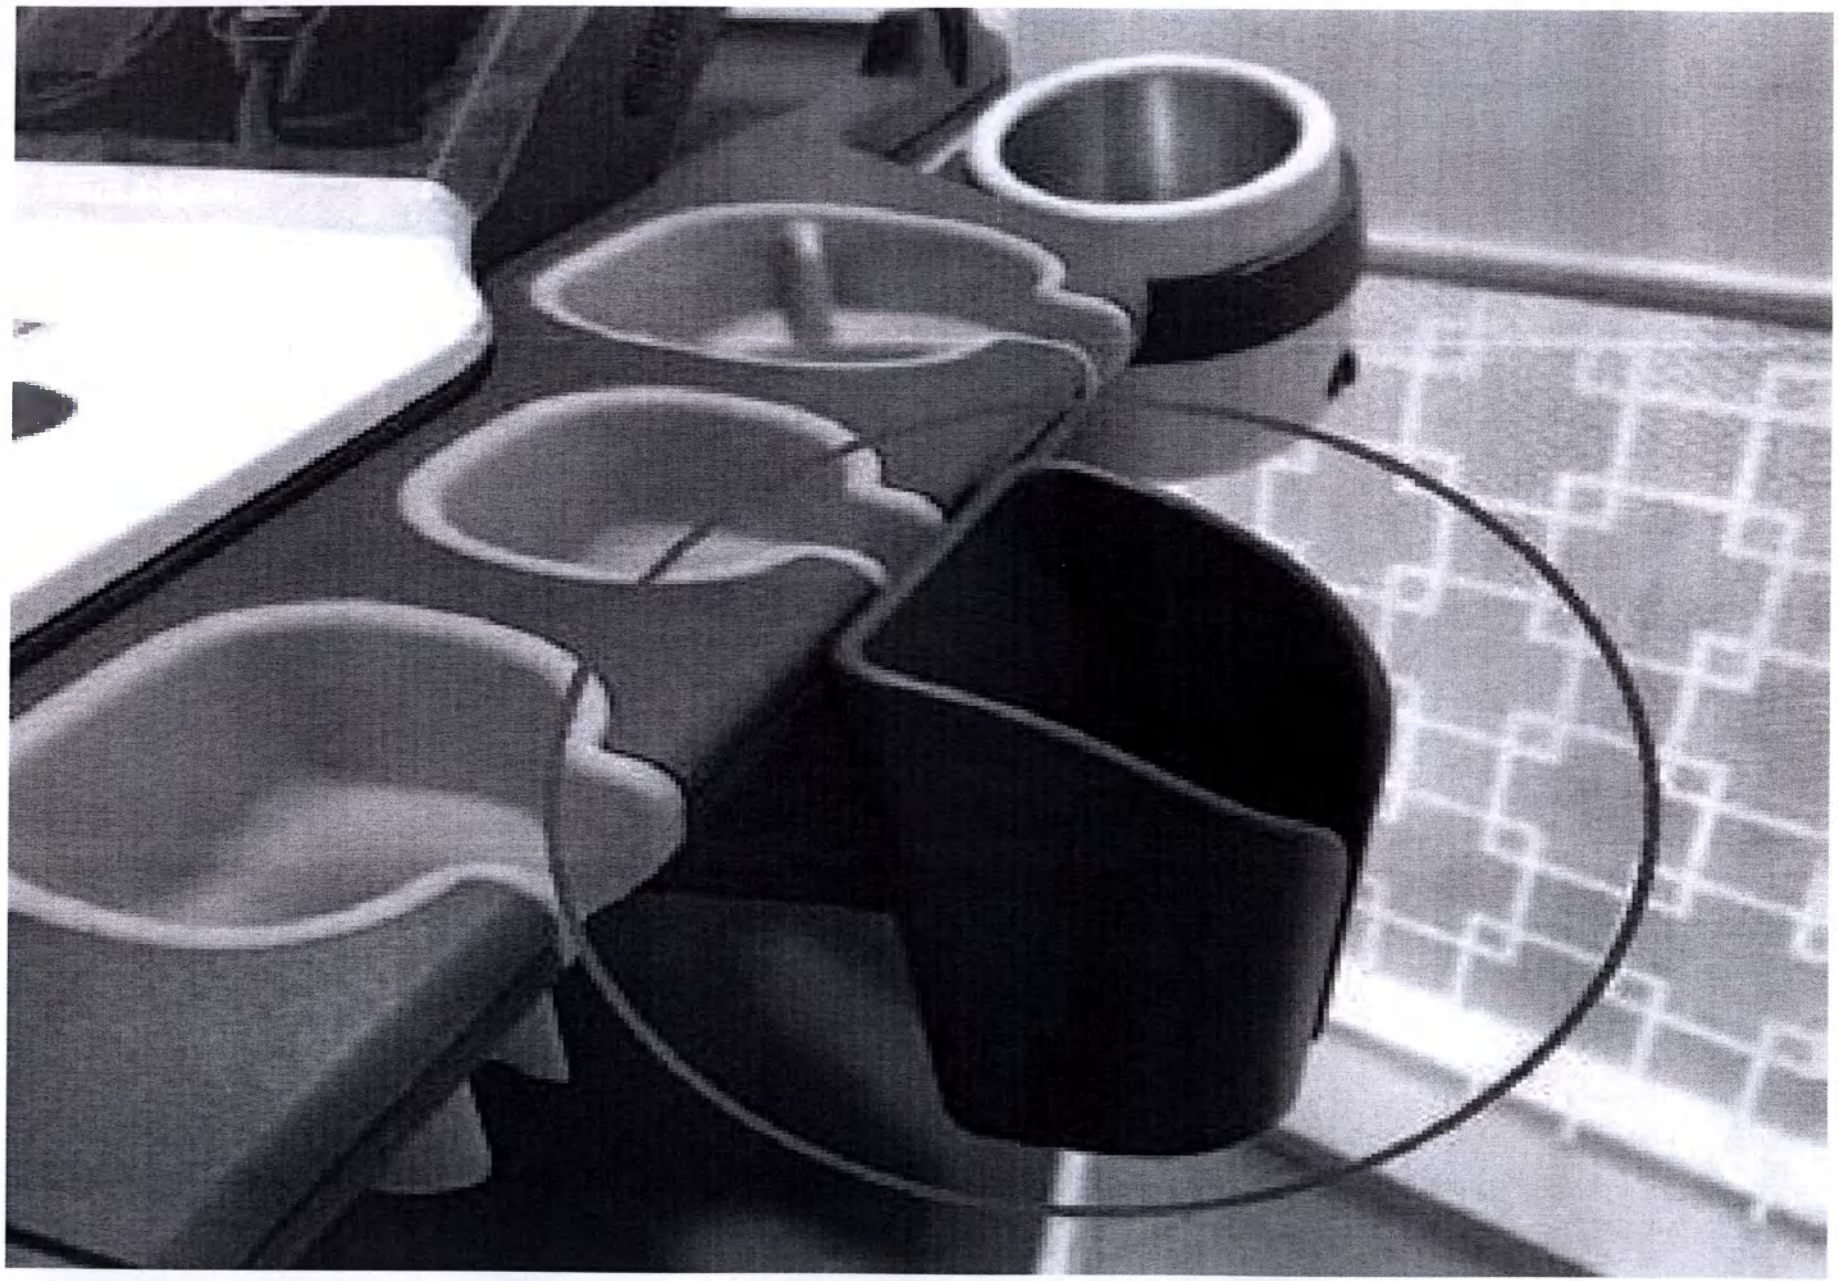

Держатель датчиков ЕС

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

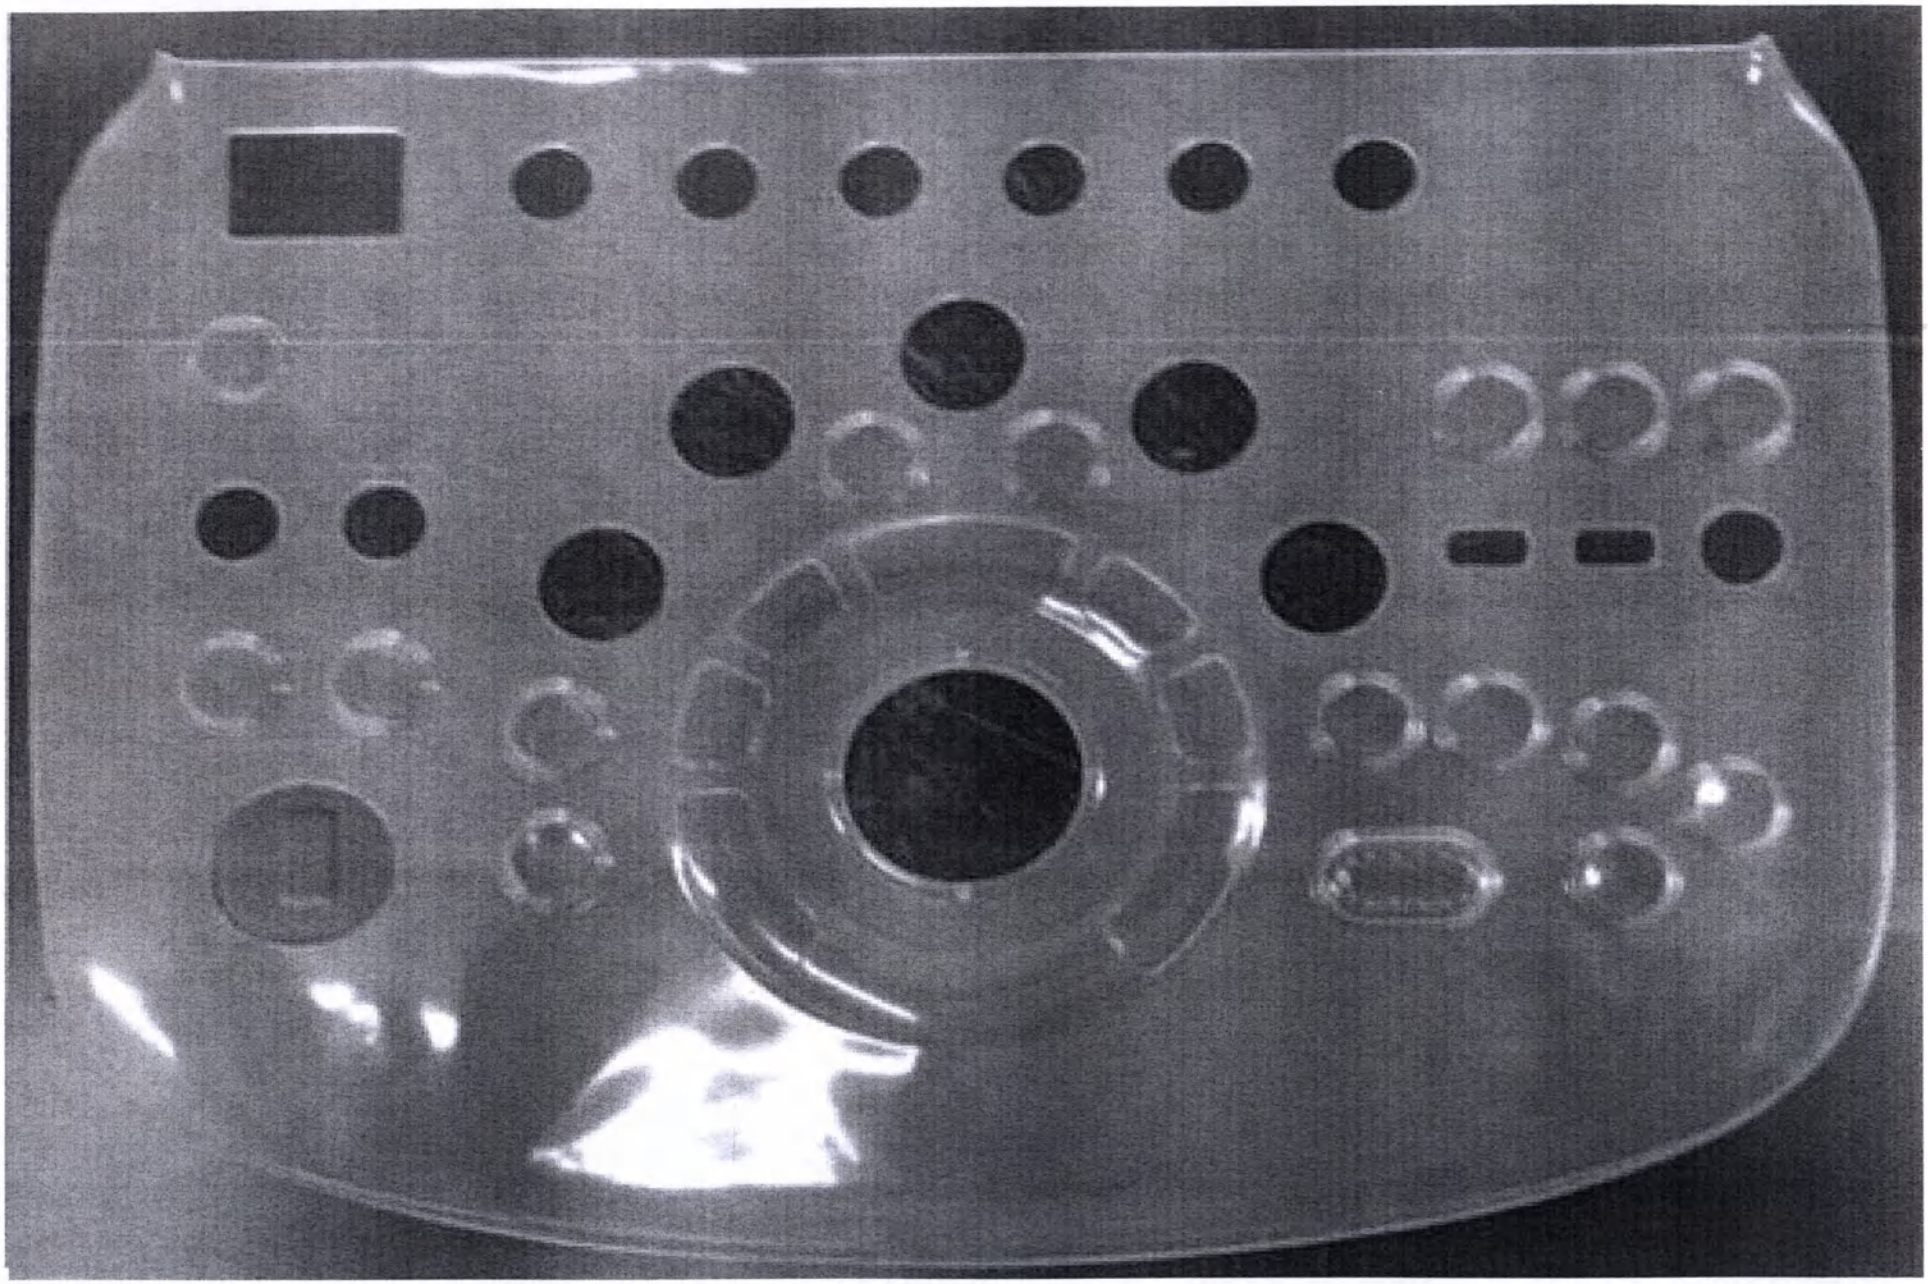

Накладка силиконовая на клавиатуру CP SKIN

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Ультразвуковая диагностическая система
HS70A-RUS
с принадлежностями

SAMSUNG MEDISON CO.,LTD.
(САМСУНГ МЕДИСОН КО., ЛТД.)

Лицензионный ключ для активации функции SMART 4D

454101364AD9E1A4F42A

Пример лицензионного ключа для активации функции

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

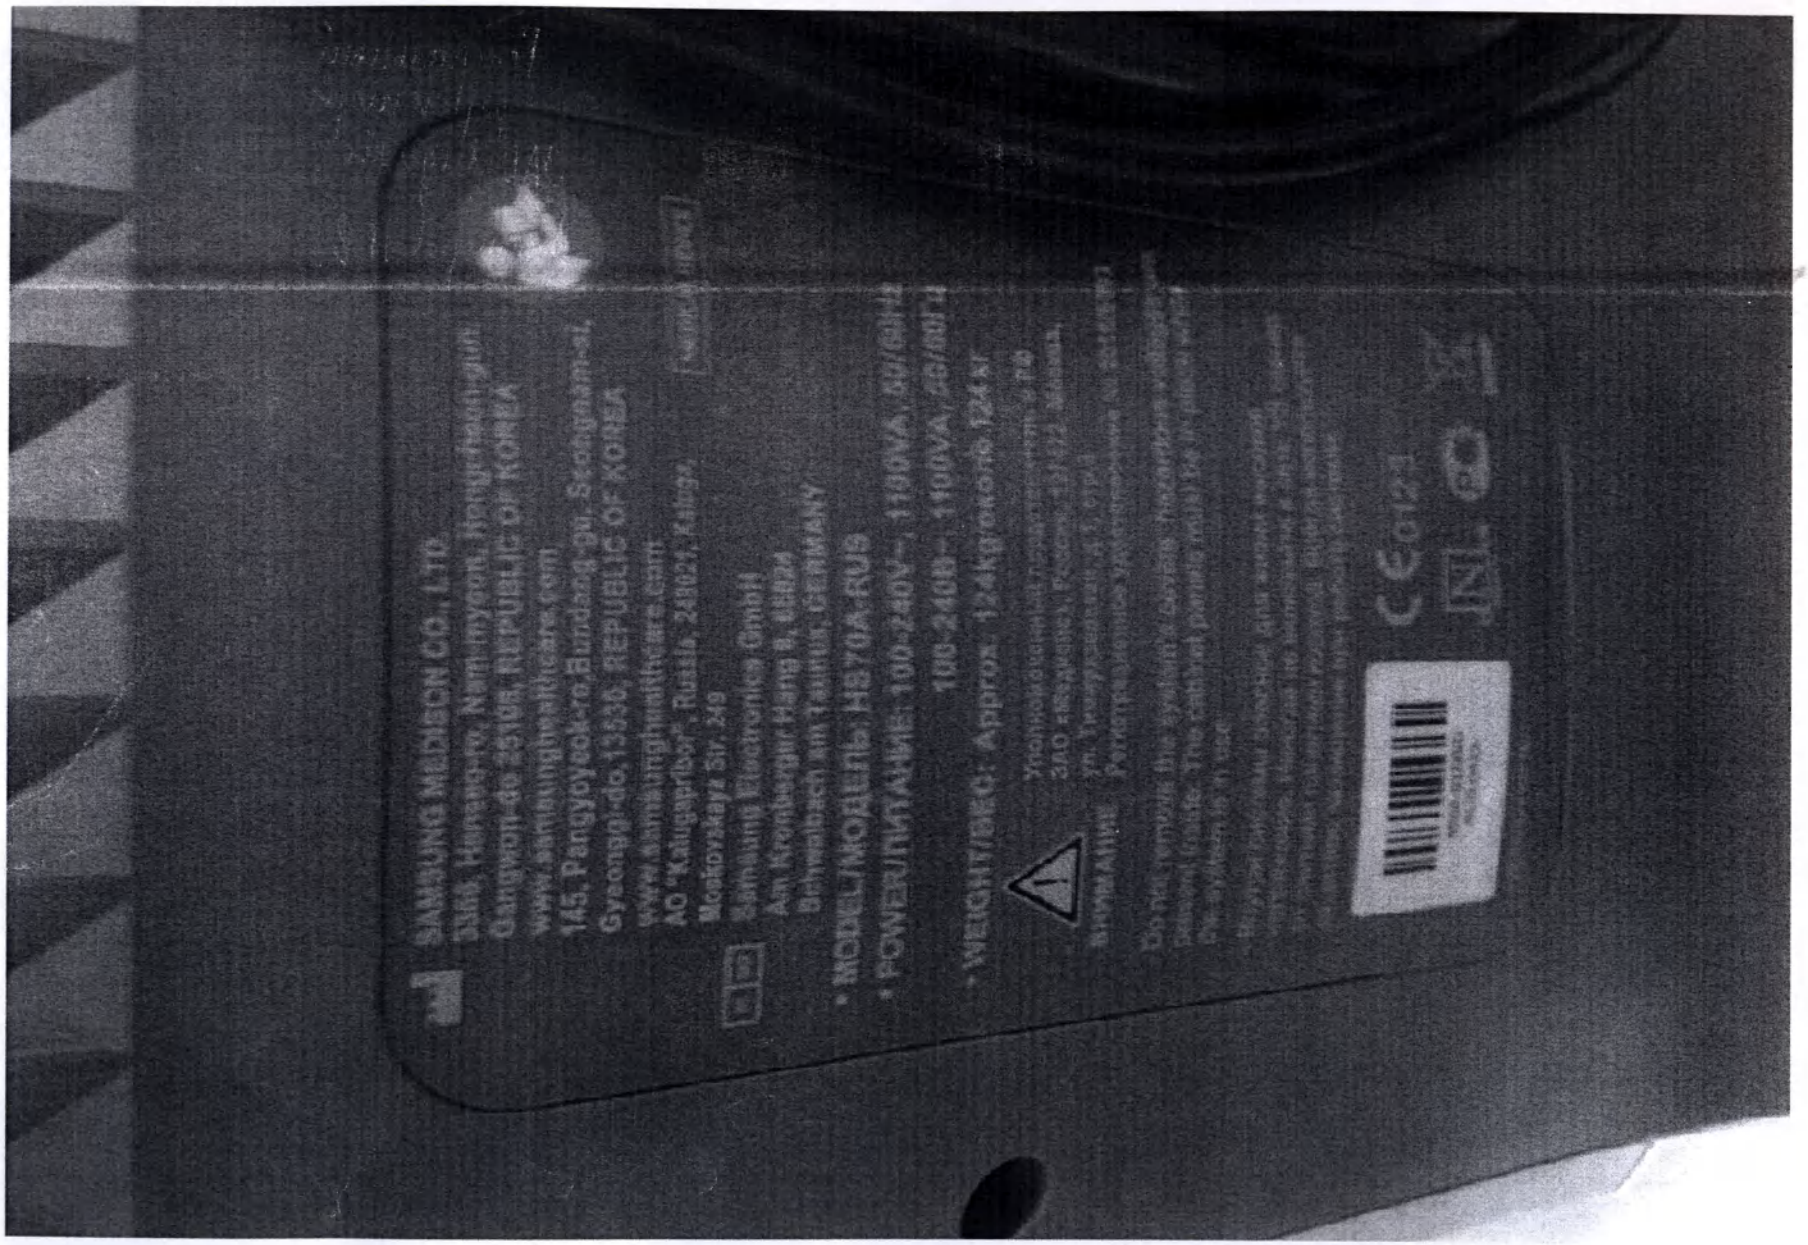

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU