

## **Макет маркировки на медицинское изделие**

**Дилуэнт для ручного разведения образцов при количественном  
определении антител к поверхностному антигену вируса гепатита В  
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови  
человека на иммунохимических анализаторах Alinity i  
«Анти-HBs Дилуэнт образца (Alinity i Anti-HBs Specimen Diluent)»**

Макет маркировки медицинского изделия для пользователей Российской Федерации

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |            |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>REF</b> 07P8942 | <b>IVD</b> |  |
| <p>Дилуэнт для ручного разведения образцов при количественном определении антител к поверхностному антигену вируса гепатита В иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i</p> <p><b>«Анти-НВс Дилуэнт образца (Alinity i Anti-HBs Specimen Diluent)»</b></p> <p>В составе: Дилуэнт образца (Alinity i Anti-HBs Specimen Diluent) - 1 флакон х 100,0 мл; Инструкция по применению / Производитель: Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение, Abbott Ireland Diagnostics Division, Finisklin, Business Park Sligo, Ireland / Место производства: Abbott Ireland Diagnostics Division, Finisklin, Business Park Sligo, Ireland / Страна происхождения: Ирландия/ РУ № ____ / ____ от ____ / Инструкция по применению на русском языке: <a href="http://www.abbottdiagnostics.com/IFU">www.abbottdiagnostics.com/IFU</a> / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.</p> <p>Данное изделие содержит полученные от человека и/или потенциально инфекционные компоненты.</p> <p><b>Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:</b><br/>         ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1<br/>         Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)</p> |                    |            |                                                                                     |

Маркировка медицинского изделия Анти-НВс Дилуэнт образца (Alinity i Anti-HBs Specimen Diluent)



G72070R01


**REF** 07P8942

**SPECIMEN DILUENT**

1 x 100 mL



**CONTAINS: AZIDE**



Abbott Ireland  
Diagnostics Division  
Finisklin Business Park  
Sligo  
Ireland  
+353-71-9171712

**PRODUCT OF IRELAND**



[www.abbottdiagnostics.com/IFU](http://www.abbottdiagnostics.com/IFU)



**Anti-HBs  
Specimen Diluent**

Маркировка компонентов медицинского изделия

Дилуэнт образца (Alinity i Anti-HBs Specimen Diluent) - 1 флакон х 100,0 мл



IVD

**Alinity i**  
**Anti-HBs**  
**Specimen Diluent**

07P89P  
100 mL



**SPECIMEN DILUENT**

G72069R01



ABBOTT

**CONTAINS: AZIDE**

Всего прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью

3 листов


Подпись


United liability company


**Фотографические изображения общего вида  
медицинского изделия**

**Дилуэнт для ручного разведения образцов при количественном  
определении антител к поверхностному антигену вируса гепатита В  
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови  
человека на иммунохимических анализаторах Alinity i  
«Анти-HBs Дилуэнт образца (Alinity i Anti-HBs Specimen Diluent)»**



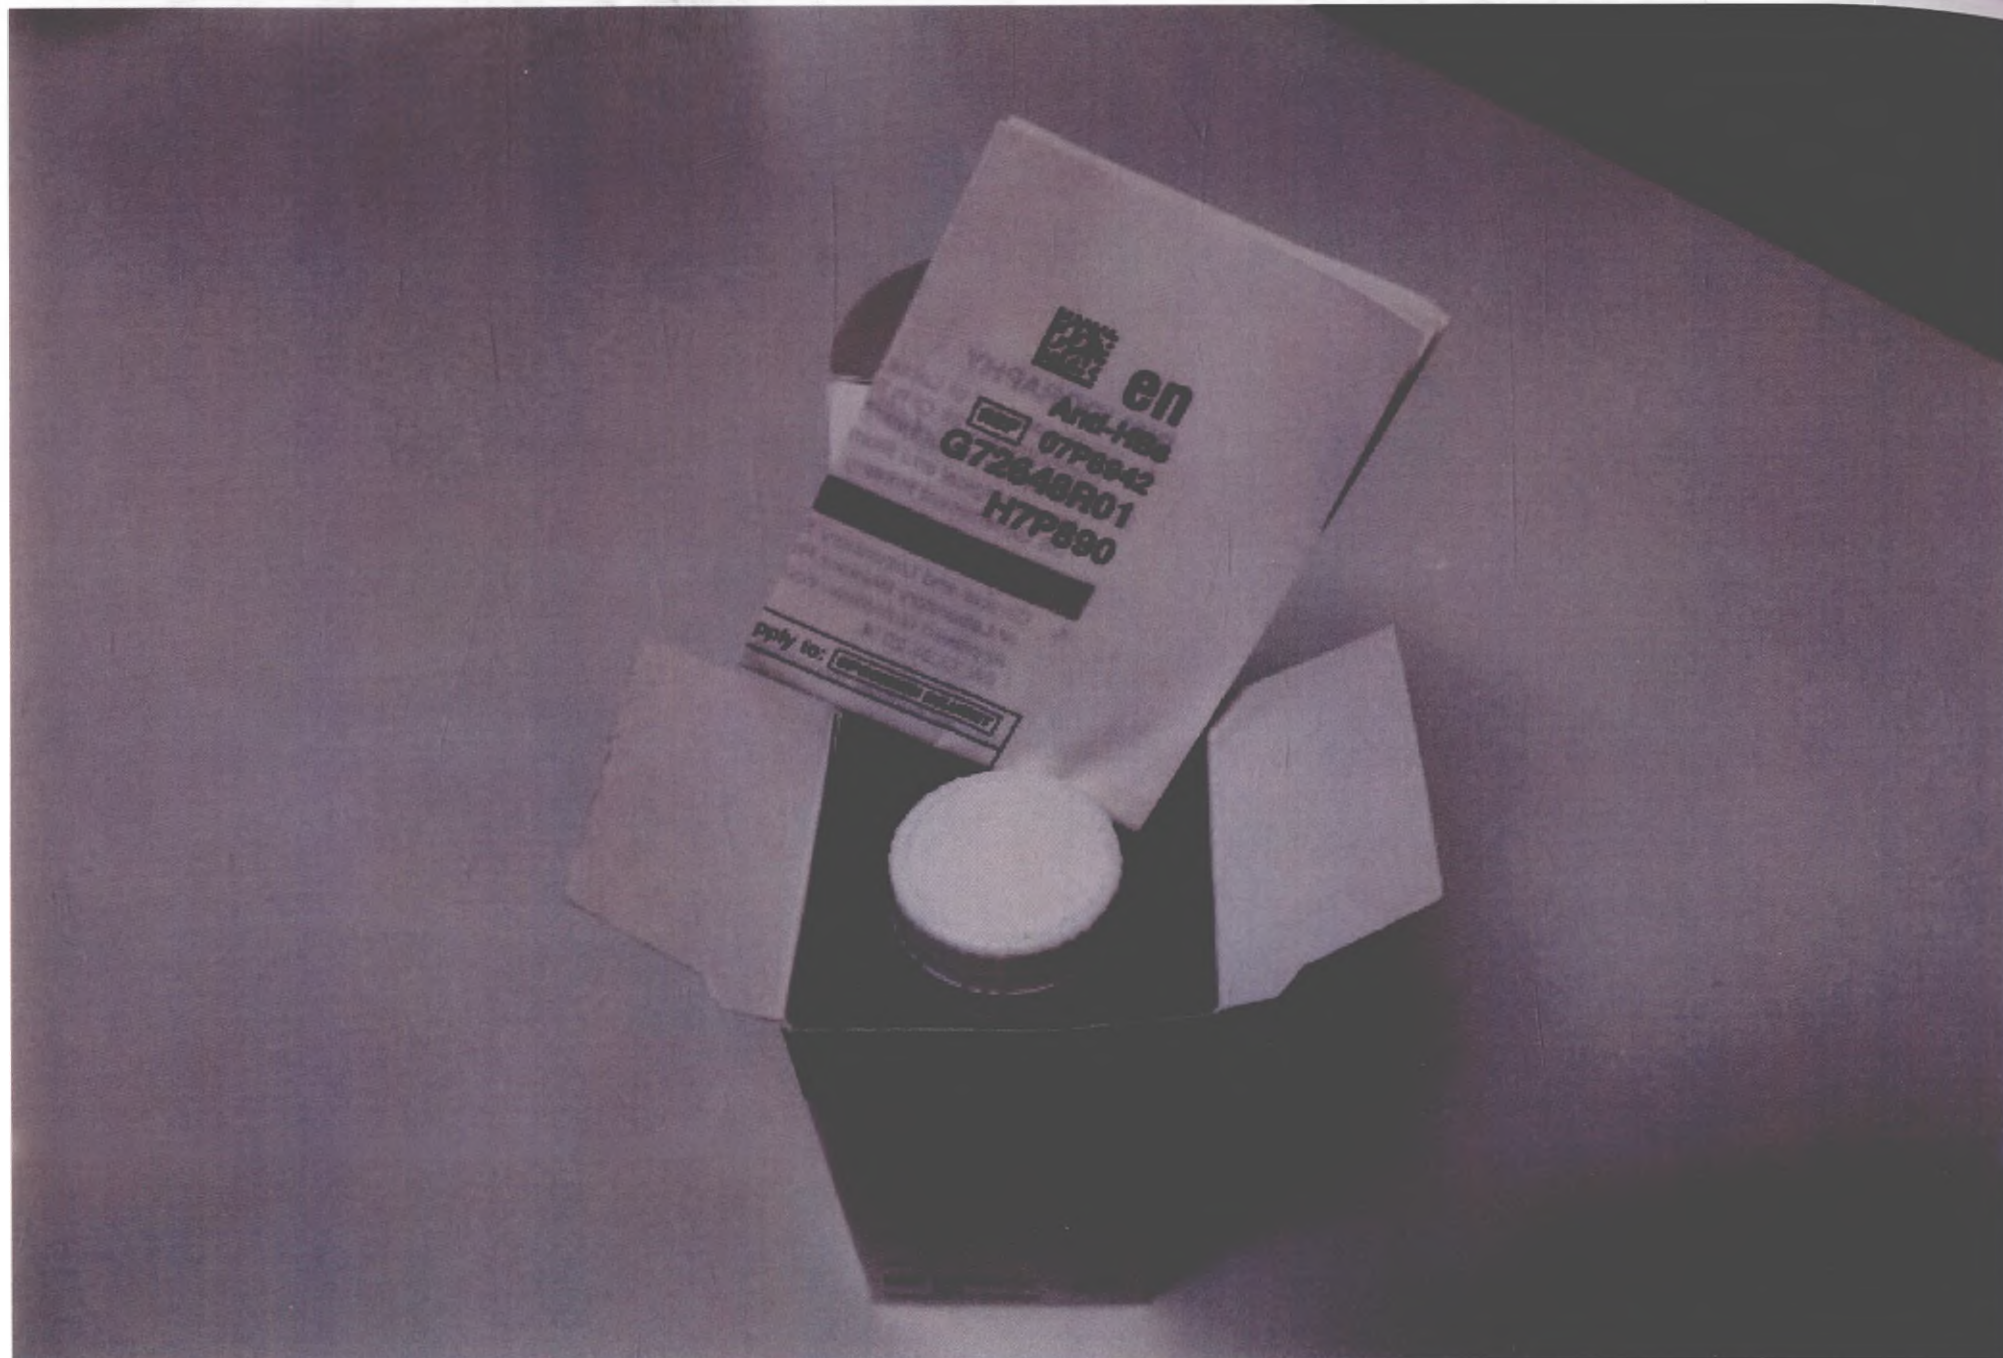

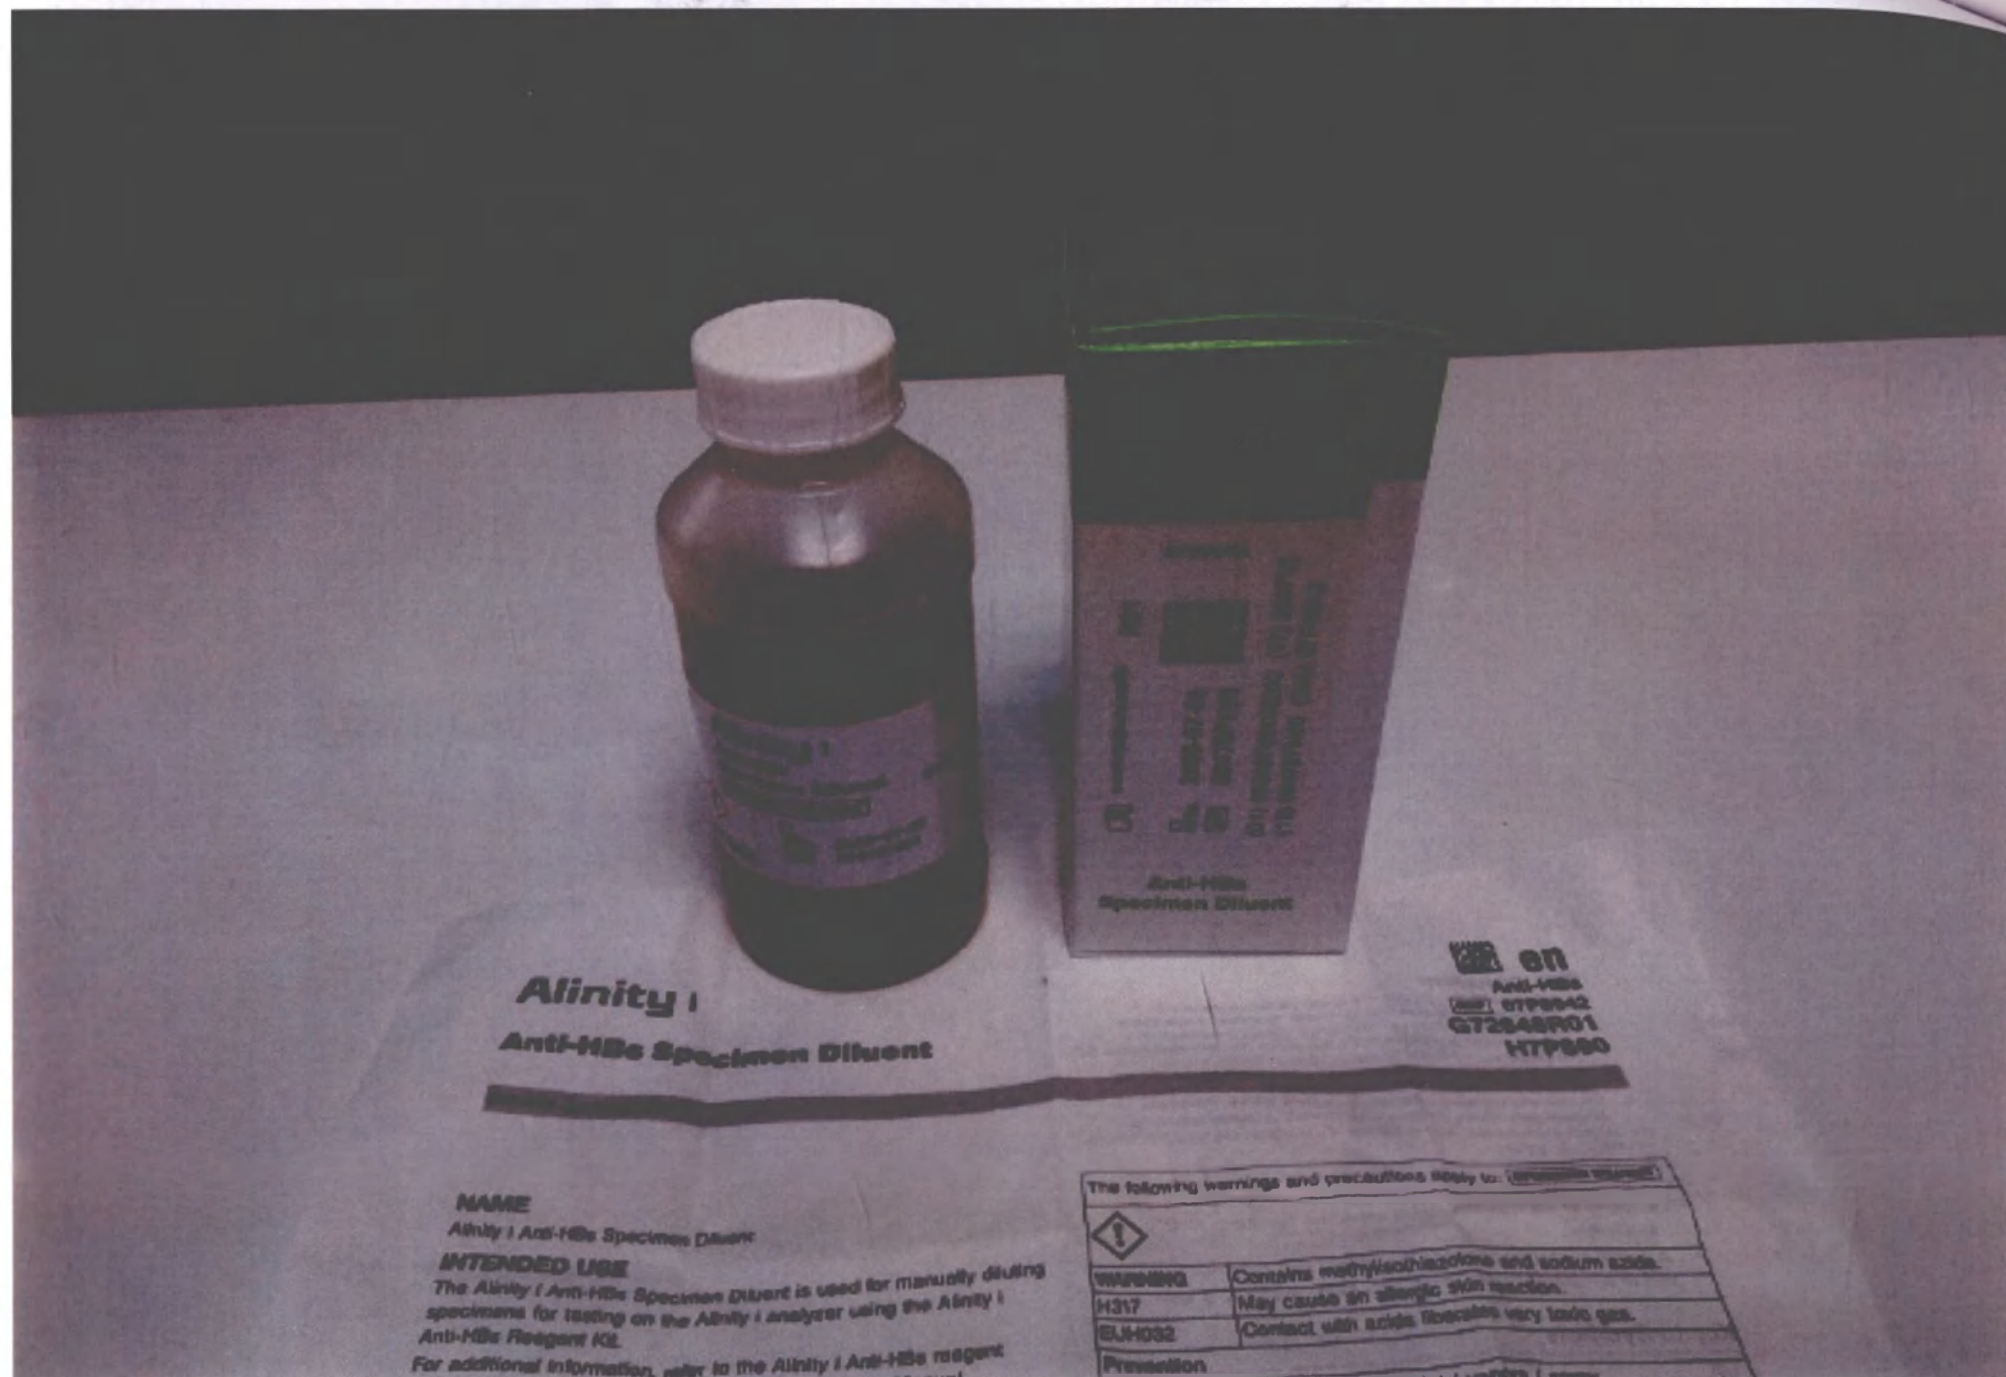

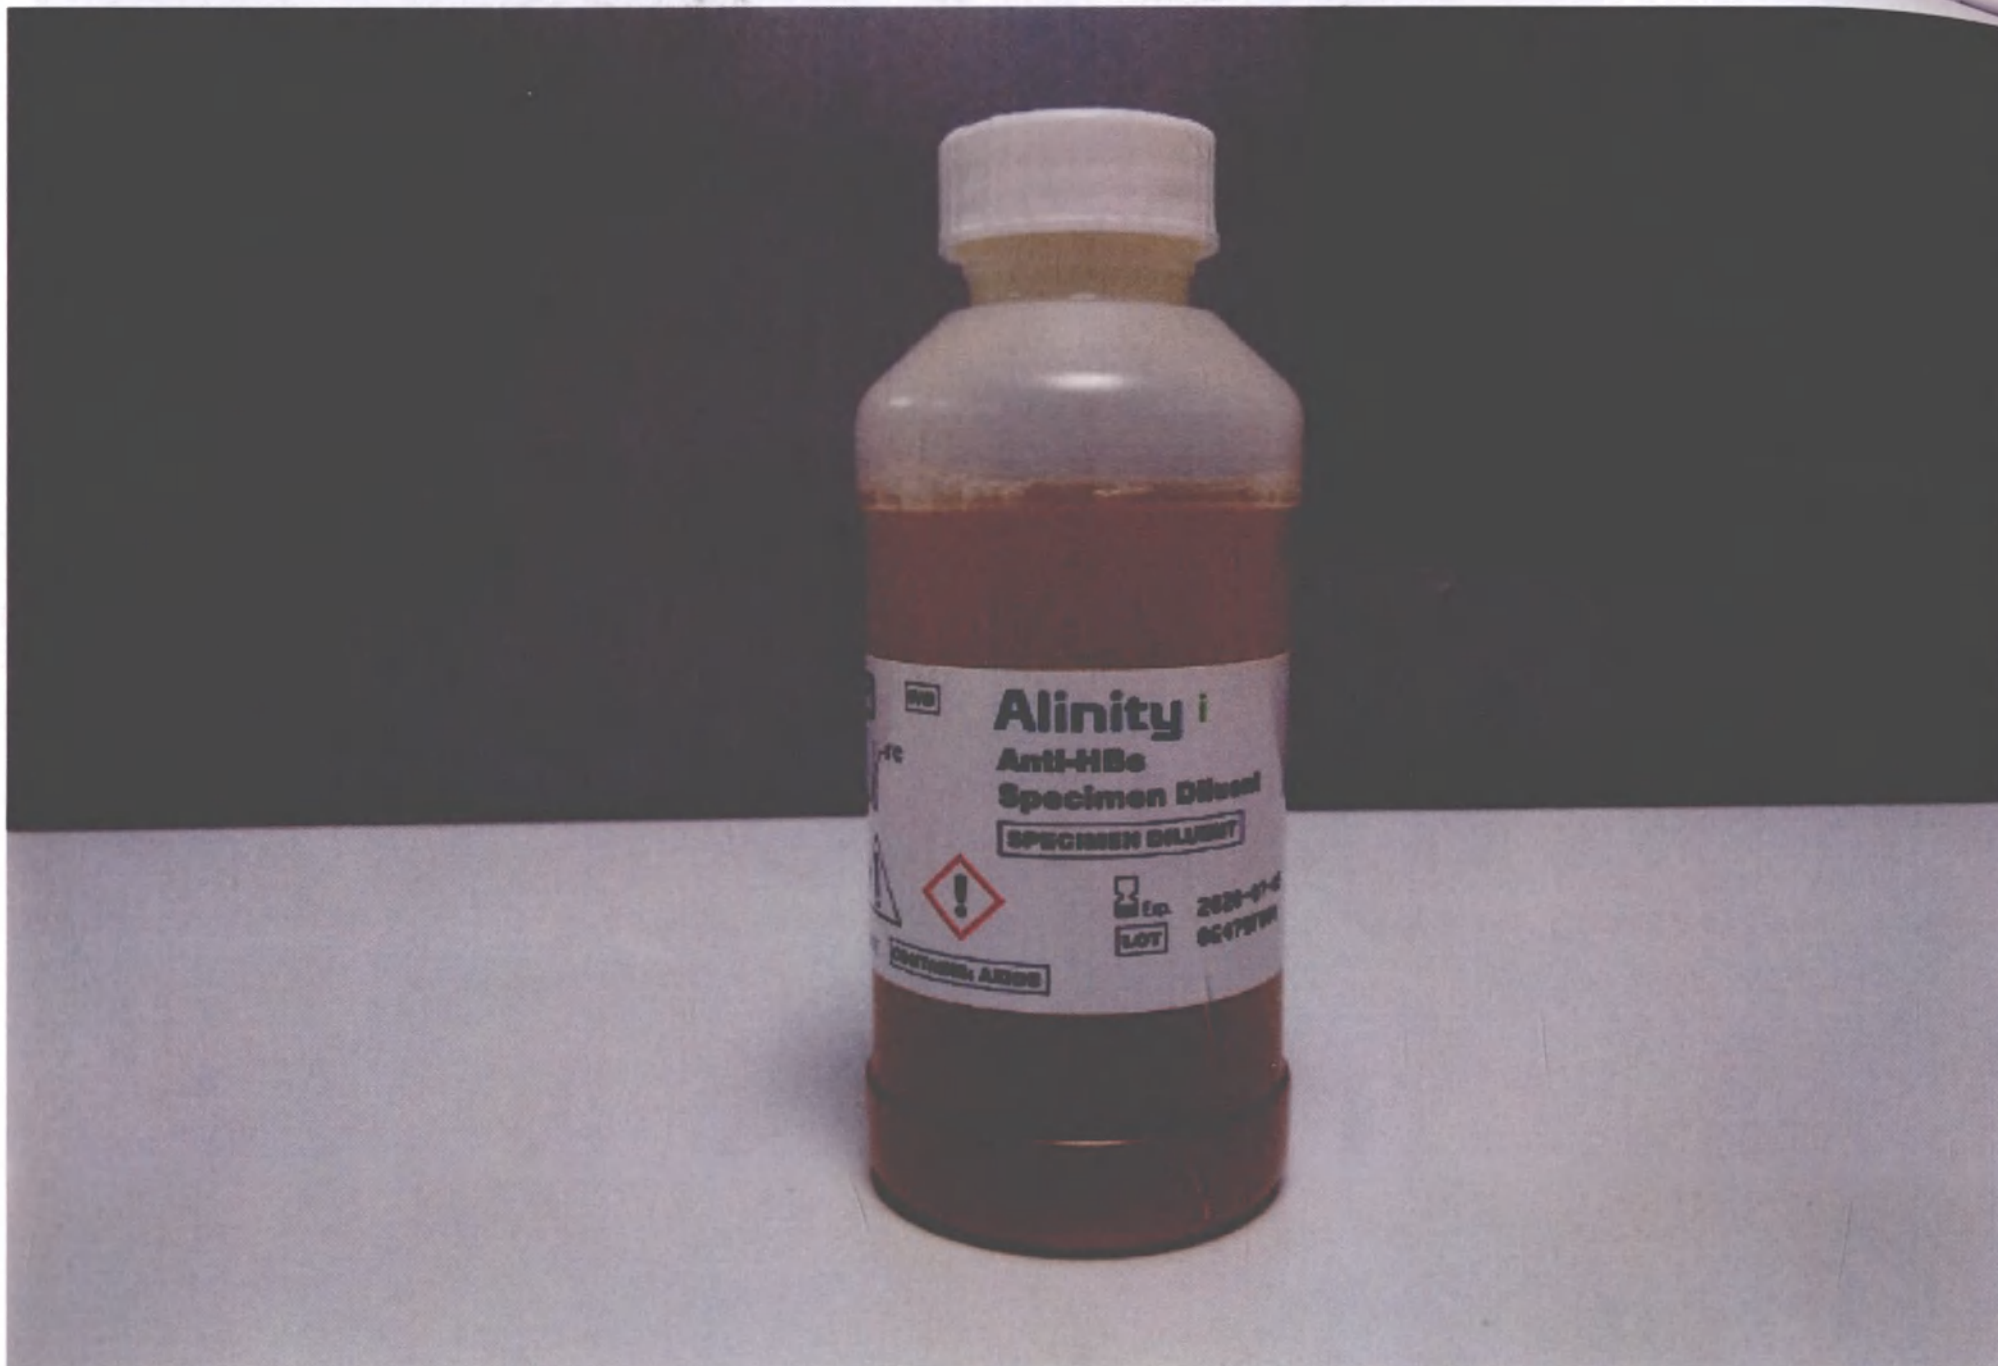

всего прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью

5 ЛИСТОВ



*[Handwritten signature]*