

«УТВЕРЖДАЮ» / “APPROVE”

SFM Hospital Products GmbH GmbH/

СФМ Госпитал Продактс ГмбХ


Managing Director /

Управляющий Директор

(Должность/position)

Lindner Vera/Вера Линднер

(Имя/name)



(подпись/signature)

«02» 08 2021 г.

Инструкция по применению

Система трансфузионная SFM®

2021

Наименование медицинского изделия:

Система трансфузионная SFM® (см. приложение 1)

Фирма-производитель/ Разработчик:

«СФМ Госпитал Продактс ГмбХ» (SFM Hospital Products GmbH)

Segelfliegerdamm 67-89, 12487 Berlin, Germany (Германия)

+49(0)30-63 97 88 25, +49(0)30-63 90 85 19, info@sfm-berlin.de

Адрес места производства

1. SFM Hospital Products GmbH, Segelfliegerdamm 67-89, 12487 Berlin, Germany
2. ЗАО НПО «ГАРАНТ», 129337, Москва, ул. Красная Сосна, д.30, стр.1

Уполномоченный представитель производителя

Закрытое акционерное общество Научно-производственное объединение «ГАРАНТ» (ЗАО НПО «ГАРАНТ»), 129337, Москва, ул. Красная Сосна, д.30, стр.1,
+7(495) 789-38-01, +7 (495) 789-38-02, +7(495) 745-05-56

Назначение медицинского изделия / Показания к применению

Предназначено для внутривенного вливания крови, инфузионных растворов и кровезаменителей из стеклянных флаконов или пластиковых контейнеров

Противопоказания к применению

Нет.

Побочные действия

Нет (при соблюдении мер предосторожности).

Вид контакта

Контакт в соответствии с пп. 8 п.2 приказа Минздрава России от 19.01.2017 г. № 11н: непосредственный.

Контакт в соответствии с ГОСТ ISO 10993-1-2011:

Длительный – для медицинского изделия.

Кратковременный – для защитных колпачков, потребительской упаковки системы.

Примечание:

Основная часть системы и игла инъекционная контактирует с кровью и внутренней средой организма.

Фиксирующая повязка, защитные колпачки, потребительская упаковка системы контактирует с неповрежденной кожей.

Потенциальный потребитель / Квалификация лиц, осуществляющих установку медицинского изделия

Квалифицированный медицинский работник

Принцип действия медицинского изделия:

Гравитационный (внутривенные вливания происходят гравитационным методом).

См. Раздел «Правила эксплуатации изделия».

Описание, технические характеристики, основные принципы, на которых основана работа медицинского изделия

Изделия состоят из многих составляющих, таких как пластиковые шипы, которые вставляются в стеклянный флакон или пластиковый пакет для набора и переливания крови, кровезаменителей. Также в состав входит капельница с воздушным клапаном или без него, фильтр, трубка, могут быть Y-порт и/или порт для дополнительных инъекций, регуляторы скорости потока роликового или барабанного типа, фиксирующие повязки, иглы инъекционные.

Иглы инъекционные изготавливаются из высококачественной стали медицинского назначения, прочной и гипоаллергенной.

Особенности изделий:

- ✓ Тройная лазерная заточка острия иглы.
- ✓ Игла покрывается силиконовой смазкой. Благодаря такой технологии игла входит в ткань не разрезая, а раздвигая волокна. Силиконовое покрытие делает ее продвижение плавным и безболезненным.
- ✓ Использование тонкостенной технологии увеличивает внутренний просвет иглы, обеспечивая более быстрое и безболезненное введение лекарств.
- ✓ Изделие предназначено для стерильного и одноразового использования. Изделие непирогенно, нетоксично.

Широкий выбор игл позволяет каждому пациенту подобрать оптимальную длину иглы.

Комплектность

1. Основная часть
2. Игла инъекционная
3. Фиксирующая повязка*
4. Потребительская упаковка.

*для некоторых вариантов исполнения

Технические характеристики:

- угол заточки игл – 11 ± 2 град.;
- радиус притупления острия – не более 0,03 мм;
- прочность соединения иглы и корпуса – не менее 10 Н.

Параметры шероховатости поверхностей игл не должны превышать значений:

- 0,32 мкм - наружных;
- 0,63 мкм - поверхностей заточки острия иглы;
- 20 мкм – остальных

Параметры повязки фиксирующей:

- Сопротивление отслаиванию клеевого слоя (повязка пластырного типа)
не менее 10 Н/м
не более 1000 Н/м

Размеры повязки фиксирующей:

Ширина от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см +/-0,2 см

Длина от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см +/-0,2 см


Длина колбы капельницы:

Капельница большая - 10 см +/-2 см


Капельница стандартная - 6 см +/- 2 см

Описание основных функциональных элементов / составных частей изделия:

- **Пластиковый шип (№ 1, см. рис. ниже)**
Используется для введения в стеклянный флакон или пластиковый контейнер
- **Капельница (№ 2, см. рис. ниже)**
Используется для заполнения, фильтрации крови, кровезаменителей и инфузионных растворов от возможных нежелательных частиц и визуального контроля уровня жидкости
- **Воздушный клапан (воздуховод) (№ 3, см. рис. ниже)**
Свободно пропускает через изделие кровь, кровезаменители и инфузионные растворы, но препятствующий прохождению воздуха через клапан по мере заканчивания крови, кровезаменителя и инфузионных растворов в емкости. Препятствует образованию в системе отрицательного давления

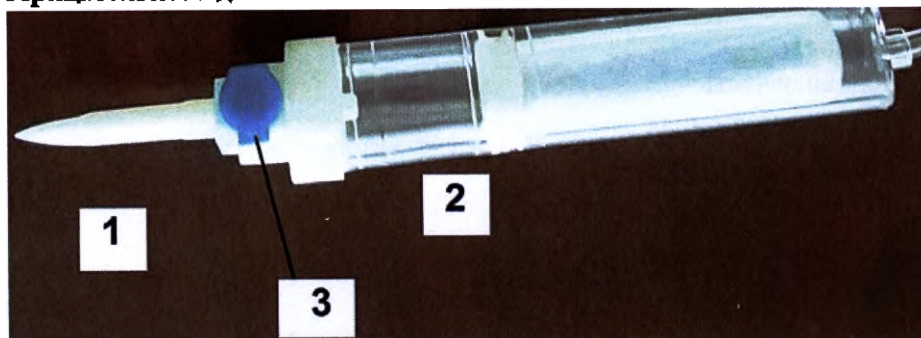

- **Трубка**
Используется для передачи крови, кровезаменителей и инфузионных растворов из капельницы в тело пациента

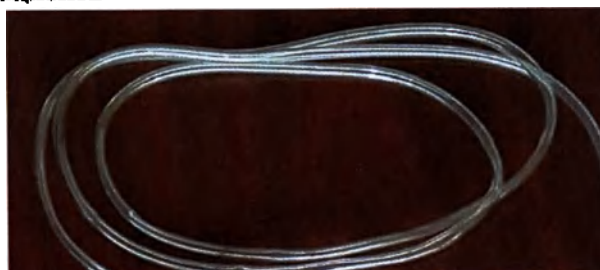

- **Регулятор скорости потока**

Используется для регулирования скорости потока



Регулятор скорости потока роликового типа



Регулятор скорости потока барабанного типа

- Y-порт

Используется для дополнительных инъекций, чтобы не травмировать вены пациента



- Порт для дополнительных инъекций

Используется для дополнительных инъекций, чтобы не травмировать вены пациента



- Коннектор

Используется для соединения трубки капельницы с иглой инъекционной




Коннектор типа Луер



Коннектор типа Луер-Лок

- Игла инъекционная

Используется для инъекции в вены

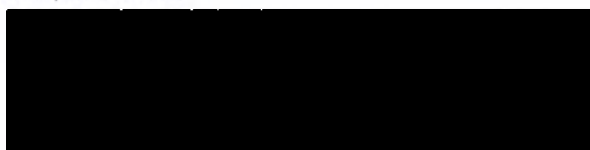

- Фиксирующая повязка

Используется для закрепления иглы инъекционной на теле пациента



Трубка**

Пластиковый шип

Первый шип (шип в проходе контейнера)

Воздушный клапан (воздуховод)

Капельница стандартная

ГОСТ 25047-87		Система трансфузионная SFM®
Трубка**	Диаметр внешний, мм	2,4 +/-0,4, 2,5 +/-0,4, 2,6 +/-0,4, 2,7 +/-0,4, 2,8 +/-0,4, 2,9 +/-0,4, 3 +/-0,4, 3,1 +/-0,5, 3,2 +/-0,5, 3,3 +/-0,5, 3,4 +/-0,5, 3,5 +/-0,5, 3,6 +/-0,5, 3,7 +/-0,5, 3,8 +/-0,5, 3,9 +/-0,5, 4 +/-0,5, 4,1 +/-0,5, 4,2 +/-0,5, 4,3 +/-0,5
	Длина, мм	1000+/-50, 1050+/-70, 1100+/-70, 1150+/-70, 1200+/-70, 1250+/-70, 1300+/-100, 1350+/-100, 1400+/-100, 1450+/-100, 1500+/-100, 1550+/-100, 1600+/-100, 1650+/-100, 1700+/-100, 1750+/-100, 1800+/-100, 1850+/-100, 1900+/-100, 1950+/-100, 2000+/-100, 2050+/-100, 2100+/-100, 2150+/-100, 2200+/-100, 2250+/-100, 2300+/-100, 2350+/-100, 2400+/-100, 2450+/-100, 2500+/-100, 2550+/-100, 2600+/-100, 2650+/-100, 2700+/-100, 2750+/-100, 2800+/-100, 2850+/-100, 2900+/-100, 2950+/-100, 3000+/-100
Пластиковый шип	Количество, шт.	1
Первый шип (шип в пробку / контейнер)	Длина, мм	35+/-5
	Диаметр, мм	6+/-3
	Особенности (заточка / ступени)	копьевидный/двухступенчатый
	Количество каналов	4+/-2
Воздушный клапан (воздуховод)	Воздуховод, особенности	с крышкой
Капельница стандартная	Объем, куб. мм	126000+/-7000

**Капельница
большая**

Высота, мм	85+/-9
Нижний диаметр, мм	20+/-5
Верхний диаметр, мм	25+/-6
Объем, куб. мм	136000+/-10000
Высота, мм	95+/-9
Нижний диаметр, мм	24+/-5
Верхний диаметр, мм	35+/-6
Степень жесткости	полужесткая/жесткая
Фильтр капельницы, наличие	Наличие
Фильтр капельницы, форма	Сетчатый модуль
Фильтр капельницы, размер ячеек, микрон	35+/-8
Особенности	обеспечивать образование 20 капель из (1,0±0,1) г дистиллированной воды температуры (20±2)°C при скорости потока (50±5) капель в минуту.

Регулятор
скорости п
роликового

Регулятор
скорости п
барабанно
типа

Порт для
дополните
инъекций

		Назначение фильтра	удаление микрочастиц размером более 175 мкм с коэффициентом фильтрации не менее 80% при переливании не менее 1 дм консервированной крови 10-14-дневного срока хранения
	Регулятор скорости потока роликового типа	Количество, шт.	1
		Длина, мм	56+/-6
		Диаметр колеса, мм	14+/-4
		Назначение	Регулировка скорости потока жидкости
	Регулятор скорости потока барабанного типа	Количество, шт.	1
		Длина, мм	43+/-17
		Диаметр, мм	43+/-17
		Назначение	Регулировка скорости потока жидкости
	Порт для дополнительных инъекций	Диаметр мм	5+/-2
при скорости		Длина, мм	45+/-5
		Особенности	самозатягиваемость при шестикратном прокалывании иглой диаметром 0,8 мм в разных местах

У-порт	Наличие	наличие/отсутствие
	Форма /размер/материал	круг / 10 +/-3мм x 5 +/-2 мм / натуральный каучук-латекс
Коннектор	Тип крепления	Луер / Луер-Лок
	Форма	Конический переходник с крылышками
	Диаметр, мм	4+/-1
	Длина, мм	27+/-5
Игла инъекционная	Количество игл	1
	Особенности заточки	Трехгранная копыцевидная, лазерная
Защитный колпачок, шт.*	Количество, шт.	2
Потребительская упаковка (Первичная упаковка)	Материал	Прозрачный полиэтиленовый пакет с бумажной полосой / без бумажной полосы

* - указывается максимальное возможное количество колпачков в системе.

** - трубка каждого диаметра (внешнего) выпускается со всеми значениями длин, перечисленными в таблице.

Габаритные размеры медицинского изделия:

- Габаритные размеры основной части рассчитываются арифметическим путем. Размеры изделий, входящих в состав основной части, представлены в таблице выше.

- Габаритные размеры иглы инъекционной представлены в таблице ниже

Варианты исполнения	Габаритные размеры (длина) иглы инъекционной с допуском, мм
0,30 мм x 12,0 мм	От 30,0 до 37,0
0,33 мм x 12,0 мм	От 30,0 до 37,0
0,33 мм x 12,7 мм	От 30,0 до 37,0
0,40 мм x 12,0 мм	От 30,0 до 37,0
0,45 мм x 12,0 мм	От 30,0 до 37,0
0,45 мм x 12,7 мм	От 30,0 до 37,0
0,45 мм x 16,0 мм	От 34,0 до 41,0
0,50 мм x 13,0 мм	От 31,0 до 38,0
0,50 мм x 15,0 мм	От 33,0 до 43,0
0,50 мм x 16,0 мм	От 34,0 до 41,0
0,50 мм x 18,0 мм	От 36,0 до 43,0
0,50 мм x 25,0 мм	От 43,0 до 50,0
0,60 мм x 25,0 мм	От 43,0 до 50,0
0,60 мм x 30,0 мм	От 48,0 до 55,0
0,60 мм x 32,0 мм	От 50,0 до 57,0
0,60 мм x 42,0 мм	От 60,0 до 67,0
0,60 мм x 45,0 мм	От 63,0 до 70,0
0,60 мм x 55,0 мм	От 73,0 до 80,0
0,70 мм x 30,0 мм	От 48,0 до 55,0
0,70 мм x 32,0 мм	От 50,0 до 57,0
0,70 мм x 38,0 мм	От 56,0 до 63,0
0,70 мм x 40,0 мм	От 58,0 до 65,0
0,70 мм x 42,0 мм	От 60,0 до 67,0
0,70 мм x 45,0 мм	От 63,0 до 70,0
0,70 мм x 50,0 мм	От 68,0 до 75,0
0,70 мм x 55,0 мм	От 73,0 до 80,0
0,80 мм x 38,0 мм	От 56,0 до 63,0
0,80 мм x 40,0 мм	От 58,0 до 65,0
0,80 мм x 42,0 мм	От 60,0 до 67,0
0,80 мм x 45,0 мм	От 63,0 до 70,0
0,80 мм x 50,0 мм	От 68,0 до 75,0
0,80 мм x 55,0 мм	От 73,0 до 80,0
0,90 мм x 38,0 мм	От 56,0 до 63,0
0,90 мм x 40,0 мм	От 58,0 до 65,0
0,90 мм x 42,0 мм	От 60,0 до 67,0
0,90 мм x 45,0 мм	От 63,0 до 70,0
0,90 мм x 50,0 мм	От 68,0 до 75,0

0,90 мм x 55,0 мм	От 73,0 до 80,0
1,10 мм x 40,0 мм	От 58,0 до 65,0
1,10 мм x 50,0 мм	От 68,0 до 75,0
1,10 мм x 55,0 мм	От 73,0 до 80,0
1,20 мм x 40,0 мм	От 58,0 до 65,0
1,20 мм x 50,0 мм	От 68,0 до 75,0
1,20 мм x 55,0 мм	От 73,0 до 80,0
1,40 мм x 40,0 мм	От 58,0 до 65,0
1,40 мм x 50,0 мм	От 68,0 до 75,0
1,40 мм x 55,0 мм	От 73,0 до 80,0
1,50 мм x 40,0 мм	От 58,0 до 65,0
1,50 мм x 50,0 мм	От 68,0 до 75,0
1,60 мм x 40,0 мм	От 58,0 до 65,0
1,60 мм x 50,0 мм	От 68,0 до 75,0
1,60 мм x 55,0 мм	От 73,0 до 80,0

Размеры трубок игл

Обозначенный метрический размер, мм	Калибровочный размер	Диапазон наружных диаметров, мм		Внутренний диаметр трубки, мм	
		min	max	Нормальная стенка трубки	Тонкостенная трубка
				min	min
0,3	30	0,298	0,32	0,133	-
0,33	29	0,324	0,351	0,133	-
0,4	27	0,4	0,42	0,184	-
0,45	26	0,44	0,47	0,232	-
0,5	25	0,5	0,53	0,232	-
0,6	23	0,6	0,673	-	0,37
0,7	22	0,698	0,73	-	0,44
0,8	21	0,8	0,83	-	0,547
0,9	20	0,86	0,92	-	0,635
1,1	19	1,03	1,1	-	0,75
1,2	18	1,2	1,3	-	0,91
1,4	17	1,4	1,51	-	1,156
1,6	16	1,6	1,69	-	1,283

Номинальная длина трубки иглы, мм	Допуск
<25	+1/-2
От 25 до 39	+1,5/-2,5
40	0/-4
>40	+1,5/-2,5

Масса изделий

1) Масса иглы инъекционной:

Иглы инъекционные	
Варианты исполнения	Масса, гр.
0,30 мм x 12,0 мм	0,77 +/-0,2
0,33 мм x 12,0 мм	0,77 +/-0,2
0,33 мм x 12,7 мм	0,77 +/-0,2
0,40 мм x 12,0 мм	0,77 +/-0,2
0,45 мм x 12,0 мм	0,77 +/-0,2
0,45 мм x 12,7 мм	0,77 +/-0,2
0,45 мм x 16,0 мм	0,77 +/-0,2
0,50 мм x 13,0 мм	0,77 +/-0,2
0,50 мм x 15,0 мм	0,77 +/-0,2
0,50 мм x 16,0 мм	0,77 +/-0,2
0,50 мм x 18,0 мм	0,77 +/-0,2
0,50 мм x 25,0 мм	0,77 +/-0,2
0,60 мм x 25,0 мм	0,77 +/-0,2
0,60 мм x 30,0 мм	0,77 +/-0,2
0,60 мм x 32,0 мм	0,77 +/-0,2
0,60 мм x 42,0 мм	0,77 +/-0,2
0,60 мм x 45,0 мм	0,77 +/-0,2
0,60 мм x 55,0 мм	0,77 +/-0,2
0,70 мм x 30,0 мм	0,9 +/-0,2
0,70 мм x 32,0 мм	0,9 +/-0,2
0,70 мм x 38,0 мм	0,9 +/-0,2
0,70 мм x 40,0 мм	0,9 +/-0,2
0,70 мм x 42,0 мм	0,9 +/-0,2
0,70 мм x 45,0 мм	0,9 +/-0,2
0,70 мм x 50,0 мм	0,9 +/-0,2
0,70 мм x 55,0 мм	0,9 +/-0,2
0,80 мм x 38,0 мм	0,9 +/-0,2
0,80 мм x 40,0 мм	0,9 +/-0,2
0,80 мм x 42,0 мм	0,9 +/-0,2
0,80 мм x 45,0 мм	0,9 +/-0,2
0,80 мм x 50,0 мм	0,9 +/-0,2
0,80 мм x 55,0 мм	0,9 +/-0,2
0,90 мм x 38,0 мм	0,9 +/-0,2
0,90 мм x 40,0 мм	0,9 +/-0,2
0,90 мм x 42,0 мм	0,9 +/-0,2
0,90 мм x 45,0 мм	0,9 +/-0,2
0,90 мм x 50,0 мм	0,9 +/-0,2
0,90 мм x 55,0 мм	0,9 +/-0,2

1,10 мм x 40,0 мм	0,9 +/-0,2
1,10 мм x 50,0 мм	1,1 +/-0,3
1,10 мм x 55,0 мм	1,1 +/-0,3
1,20 мм x 40,0 мм	1,1 +/-0,3
1,20 мм x 50,0 мм	1,1 +/-0,3
1,20 мм x 55,0 мм	1,1 +/-0,3
1,40 мм x 40,0 мм	1,1 +/-0,3
1,40 мм x 50,0 мм	1,1 +/-0,3
1,40 мм x 55,0 мм	1,1 +/-0,3
1,50 мм x 40,0 мм	1,1 +/-0,3
1,50 мм x 50,0 мм	1,1 +/-0,3
1,60 мм x 40,0 мм	1,1 +/-0,3
1,60 мм x 50,0 мм	1,1 +/-0,3
1,60 мм x 55,0 мм	1,1 +/-0,3

2) Масса основной части системы: 20 +/- 6 г.

3) Масса фиксирующей повязки: 0,5-3,5 г

Материал

Компонент

Пластиковый

Капельница

Капельница

Фильтр в
стаканчике

Воздуховод

Воздуховод

Трубка

Регулятор

Материал

Компонент	Краситель/ Марка	Материал	Марка	Производитель
Пластиковый шип	Remazol Ultra White RGB	АБС-пластик	TERLURAN* GP-22 NATURAL	BASF/Chnagzhou Haidu International trading co. Ltd.
Капельница (нижняя часть)	-	Поливинилхлорид (ПВХ)	CTP PVC	Changzhou Tianlong Plastic Co. Ltd.
Капельница (верхняя часть)	Remazol Ultra White RGB	АБС-пластик	TERLURAN* GP-22 NATURAL	BASF/Chnagzhou Haidu International trading co. Ltd.
Фильтр внутри капельницы (в виде стаканчика)	Remazol Ultra White RGB	АБС-пластик	TERLURAN* GP-22 NATURAL	BASF/Chnagzhou Haidu International trading co. Ltd.
Воздуховод (крышка)	Remazol Blue RGB	Поливинилхлорид (ПВХ)	CTP PVC	Changzhou Tianlong Plastic Co. Ltd.
Воздуховод (фильтр)	Remazol Golden Yellow RGB	Полипропилен	SINOPEC	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LTD.
Трубка	-	Поливинилхлорид (ПВХ)	CTP PVC	Changzhou Tianlong Plastic Co. Ltd.
Регулятор скорости потока роликового типа	Remazol Ultra White RGB или Remazol Red RGB или Imperon Green K-GC или Remazol Blue RGB	АБС-пластик	TERLURAN* GP-22 NATURAL	BASF/Chnagzhou Haidu International trading co. Ltd.

15

Фиксатор трубки (в регуляторе скорости потока роликового типа)	Remazol Ultra White RGB или Remazol Red RGB или Imperon Green K-GC или Remazol Blue RGB	АБС-пластик	TERLURAN* GP- 22 NATURAL	BASF/Chnagzhou Haidu International trading co. Ltd.	Игла инъекционная
Регулятор скорости потока барабанного типа	Remazol Ultra White RGB или Remazol Red RGB или Imperon Green K-GC или Remazol Blue RGB	АБС-пластик	TERLURAN* GP- 22 NATURAL	BASF/Chnagzhou Haidu International trading co. Ltd.	
Порт для дополнительных инъекций	-	Натуральный каучук-латекс	Latex LA	Changzhou Huawei Medical Devices Co. Ltd.	
Y-порт (основание)	-	АБС-пластик	TERLURAN* GP- 22 NATURAL	BASF/Chnagzhou Haidu International trading co. Ltd.	
Y-порт (место дополнительной инъекции)	-	Натуральный каучук-латекс	Latex LA	Changzhou Huawei Medical Devices Co. Ltd.	
Коннектор	Remazol Ultra White RGB	АБС-пластик	TERLURAN* GP- 22 NATURAL	BASF/Chnagzhou Haidu International trading co. Ltd.	
Потребительская (первичная) упаковка	-	Полиэтилен	CHI PE	Chnagzhou Haidu International trading co. Ltd.	
Бумажная полоса (на первичной упаковке)	-	Бумага	SHANYIN	Shanghai Dingjia Packaging Materials Co., Ltd	

	Игла инъекционная (в вену)		Нержавеющая сталь	SUS 304	Zhejiang Oujian Medical devices Co., Ltd.
Haidu g co. Ltd.	0,30 мм x 12,0 мм	Remazol Ultra Yellow RGBN	Полипропилен	LG	LG Chem., Ltd. Densan Plant
	0,33 мм x 12,0 мм / 0,33 мм x 12,7 мм	Remazol Red RGB	Полипропилен	LG	LG Chem., Ltd. Densan Plant
Haidu g co. Ltd.	0,40 мм x 12,0 мм	Remazol Grey RGBN	Полипропилен	LG	LG Chem., Ltd. Densan Plant
Medical	0,45 мм x 12,0 мм / 0,45 мм x 12,7 мм 0,45 мм x 16,0 мм	Remazol Dark Brown RGBN	Полипропилен	LG	LG Chem., Ltd. Densan Plant
	0,50 мм x 13,0 мм / 0,50 мм x 15,0 мм 0,50 мм x 16,0 мм / 0,50 мм x 18,0 мм 0,50 мм x 25,0 мм	Remazol Orang RGBN	Полипропилен	LG	LG Chem., Ltd. Densan Plant
Haidu g co. Ltd.	0,60 мм x 25,0 мм / 0,60 мм x 30,0 мм 0,60 мм x 32,0 мм / 0,60 мм x 42,0 мм 0,60 мм x 45,0 мм / 0,60 мм x 55,0 мм	Remazol Blue RGB	Полипропилен	LG	LG Chem., Ltd. Densan Plant
Medical	0,70 мм x 30,0 мм / 0,70 мм x 32,0 мм 0,70 мм x 38,0 мм / 0,70 мм x 40,0 мм 0,70 мм x 42,0 мм / 0,70 мм x 45,0 мм 0,70 мм x 50,0 мм / 0,70 мм x 55,0 мм	Procion Black PX-N	Полипропилен	LG	LG Chem., Ltd. Densan Plant
Haidu g co. Ltd.	0,80 мм x 38,0 мм / 0,80 мм x 40,0 мм 0,80 мм x 42,0 мм / 0,80 мм x 45,0 мм 0,80 мм x 50,0 мм / 0,80 мм x 55,0 мм	Imperon Green K-GC	Полипропилен	LG	LG Chem., Ltd. Densan Plant
International	0,90 мм x 38,0 мм / 0,90 мм x 40,0 мм 0,90 мм x 42,0 мм / 0,90 мм x 45,0 мм 0,90 мм x 50,0 мм / 0,90 мм x 55,0 мм	Remazol Ultra Yellow RGBN	Полипропилен	LG	LG Chem., Ltd. Densan Plant
Packaging	1,10 мм x 40,0 мм / 1,10 мм x 50,0 мм 1,10 мм x 55,0 мм	Remazol Ultra White RGB	Полипропилен	LG	LG Chem., Ltd. Densan Plant

1,20 мм x 40,0 мм / 1,20 мм x 50,0 мм 1,20 мм x 55,0 мм	Imperon Brilliant Pink K-3BL	Полипропилен	LG	LG Chem., Ltd. Densan Plant
1,40 мм x 40,0 мм / 1,40 мм x 50,0 мм 1,40 мм x 55,0 мм	Imperon Brilliant Pink Dark K-3BL	Полипропилен	LG	LG Chem., Ltd. Densan Plant
1,60 мм x 40,0 мм / 1,60 мм x 50,0 мм 1,60 мм x 55,0 мм	Imperon Blue K-3BL	Полипропилен	LG	LG Chem., Ltd. Densan Plant
Покрытие иглы инъекционной	-	Силиконовое масло ¹⁾	CAS: 63148-62-9	Wuhan Wuzhao Chemical Co., Ltd.
Защитный колпачок иглы инъекционной	Remazol White RGB или Remazol Red RGB или Imperon Green K-GC или без красителя	Полипропилен	LG	LG Chem., Ltd. Densan Plant
Защитный колпачок пластикового шипа	Remazol White RGB или Remazol Red RGB или Imperon Green K-GC или без красителя	Полипропилен	LG	LG Chem., Ltd. Densan Plant
Фиксирующая повязка (нетканая основа)	-	Полиэстер, вискоза	1.56Dtex, 1.67Dtex	Sino Protection (Hefei) Sanitary Material Co. Ltd.
Клей (фиксирующей повязки)	PS 0609	Полиакрилат	1.90 Dtex	Sino Protection (Hefei) Sanitary Material Co. Ltd.

Правила эксплуатации изделия

1. Проверить пригодность раствора к применению. Обработать пробку контейнера (стеклянного флакона или пластикового контейнера) спиртом, йодом или другим антисептиком.
2. Проверить целостность потребительской тары, сроки годности.
3. Вскройте пакет и извлеките изделие.
4. Регулятор скорости потока роликового (или барабанного) типа и воздушный клапан на капельнице закрыть.
5. Ввести заборную иглу (пластиковый шип) в контейнер (стеклянный флакон или пластиковый контейнер).
6. Заполнить капельницу до половины, сдавливая её.
7. При использовании стеклянных флаконов открыть воздушный клапан на капельнице.
8. Открыть роликовый (барабанный) зажим и выпустить воздух.
9. Закрыть зажим.
10. Произвести венопункцию иглой инъекционной.
11. Установить необходимую скорость потока жидкости /крови с помощью регулятора скорости потока роликового (или барабанного) типа.
12. Закрепить иглу фиксирующей повязкой на руке пациента.
13. Через Y-порт и/или порт для дополнительных инъекций ввести дополнительное лекарство (при необходимости).

Упаковка

Упаковка подразделяется на потребительскую (первичную) упаковку (размер: 12см +/- 3 см x 21см +/- 3 см) и на транспортную упаковку; на упаковке есть маркировка.

Игла инъекционная поставляется без индивидуальной упаковки и располагается внутри потребительской (первичной) упаковки системы.

Фиксирующая повязка поставляется без упаковки и располагается внутри потребительской (первичной) упаковки системы.

В транспортную упаковку изделия вложена эксплуатационная документация.

Стерильность

Стерильные. Стерилизация - Оксид-этилена.

Кратность

Однократного использования.

Срок годности


5 лет.

Макет маркировки потребительской (первичной) упаковки

Пример макета

 ПК 23-02 Артикул LOT Партия  	Система трансфузионная SFM®  с портом для дополнительных инъекций Состав: Основная часть: капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная полужесткая, трубка (диаметр внешний 2,4 мм, длина 1000 мм), регулятор скорости потока роликового типа, порт для дополнительных инъекций, коннектор типа Луер; Игла инъекционная, размер 1,20 мм x 40,0 мм, Фиксирующая повязка, размер 0,5 см x 1,0 см Стерильно внутри, апиrogenно, нетоксично. РУ № от , «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ» (SFM Hospital Products GmbH) Адрес: Segelfliegerdamm 67-89, 12487 Berlin, Germany (Германия) Тел.: +49-30-639-78-825 Уполномоченный представитель: ЗАО НПО «ГАРАНТ» Россия, 129337, г. Москва ул. Красная Сосна, д. 30, стр.1 Тел.: +7-495-789-38-01 STERILE EO   +5 °C  +40 °C 45%  85%     
--	--

Маркировка медицинского изделия включает в себя следующую информацию, представленную в таблице

Символы	Наименование символа
	Изготовитель
	Дата изготовления
	Дата истечения срока годности
LOT	Партия
	Защищать от воздействия влаги
	Верхний и нижний пределы температуры
	Верхний и нижний пределы влажности
	Знак CE-mark, соответствие продукции требованиям европейских регламентов

	Знак соответствия РСТ декларирования соответствия товаров
	Беречь от солнечных лучей.
	стерилизация Этиленоксидом
	не использовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке

Условия хранения, транспортировки, эксплуатации

Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями стандартов и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, при температуре от 0°C до +40°C, влажности 45% - 85%, атмосферном давлении 84 кПа - 106,7 кПа (630 - 800 мм рт. ст.).

Хранить в сухом проветриваемом помещении в упакованном виде при температуре от +5°C до +40°C, относительной влажности воздуха 45% - 85%, атмосферном давлении 84 кПа - 106,7 кПа (630 - 800 мм рт. ст.).

Условия эксплуатации: температура от +15°C до +40°C, влажность 45%-80%, атмосферное давление 84 кПа - 106,7 кПа (630 - 800 мм рт. ст.)

Меры предосторожности

- А) Используйте под руководством врача или другого медицинского работника;
- В) Продукт действителен в течение пяти лет после этиленоксидной стерилизации, только для одноразового использования, повторное использование запрещено;
- С) Не пользуйтесь изделием, если упаковка вскрыта или повреждена;
- Д) Нельзя использовать изделие с истекшим сроком годности;
- Е) Данное изделие предназначено только для одноразового использования; используйте сразу после вскрытия. Если игла согнута или повреждена, не используйте ее;
- Ф) Нельзя сгибать иглу или непосредственно контактировать с канюлей;
- Г) Утилизируйте после одноразового использования для предотвращения риска заражения;
- Н) Избегайте возможности укола иглой.

Игла инъекционная предназначена только для одноразового использования. Повторное использование может увеличить риск следующим образом:

- А) Повреждение канюли;
- В) Неточность дозы ;
- С) Утечка из иглы;
- Д) Увеличение сопротивления при введении ;

- Е) Боль при введении;
- Ф) Повреждение тканей и кровотечение.

Запрещается использовать медицинское изделие в случае его неисправности, сбоя в его работе или отклонений от функционирования.

Утилизация

Обращение с отходами должно осуществляться соответственно с национальным законодательством. После применения не выбрасывать в окружающую среду. Утилизацию необходимо осуществлять в соответствии с принятыми в медицинской практике нормами, а также с соответствующими местными, государственными и федеральными законодательными актами и согласно СанПин 2.1.3684-21 класса Б.

Соответствие стандартам

93/42/EEC	Директива Совета ЕС 93/42/EEC в отношении медицинских приборов, изделий, устройств, оборудования
EN ISO13485	Изделия медицинские - Системы менеджмента качества - Системные требования для целей регулирования
EN ISO14971	Медицинские изделия - Применение менеджмента риска к медицинским изделиям
EN ISO10993-1	Оценка биологического действия медицинских изделий - Часть 1: Оценка и исследования
EN ISO10993-5	Оценка биологического действия медицинских изделий - Часть 5: Исследования на цитотоксичность: методы in vitro
EN ISO10993-7	Оценка биологического действия медицинских изделий - Часть 7: Остаточное содержание этиленоксида после стерилизации
EN ISO10993-10	Оценка биологического действия медицинских изделий - Часть 10: Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия
EN ISO10993-11	Оценка биологического действия медицинских изделий - Часть 11: Исследования общетоксического действия
EN ISO10993-12	Оценка биологического действия медицинских изделий - Часть 12: Приготовление проб и контрольные образцы
EN ISO11135-1	Стерилизация медицинской продукции. Этиленоксид. Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий
EN ISO15223-1	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1: Основные требования
EN ISO11737-1	Стерилизация медицинских изделий – Микробиологические методы – Часть 1: Оценка популяции микроорганизмов на продукции
EN ISO11737-2	Стерилизация медицинских изделий – Микробиологические методы – Часть 2: Испытания на стерильность, проводимые при валидации процесса стерилизации
EN ISO11608-2	Шприц-ручки медицинского назначения - Часть 2: Иглы - Требования и методы испытаний
EN ISO 15223-1	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, маркировка
EN ISO11607-1	Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации - Часть 1: Требования к материалам, барьерным системам для стерилизации

	упаковочным системам
EN ISO11607-2	Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации - Часть 2: Требования к валидации процессов формирования, герметизации и сборки
EN ISO14155	Клиническое исследование медицинских изделий для людей - Надлежащая клиническая практика
EN ISO14644-1	Требования к контролю и мониторингу для подтверждения постоянного соответствия стандарту ISO 14644-1

Гарантии


Гарантия распространяется на материальные или производственные неисправности, замеченные при нормальных условиях эксплуатации изделия, начиная с даты поставки и заканчивая датой истечения срока годности, указанной на упаковке.

Информация, регламентирующая конструкцию медицинского изделия

Изделие состоит из основной части, иглы инъекционной, фиксирующей повязки (для некоторых вариантов исполнения), потребительской упаковки.

Чертежи общего вида медицинского изделия

1. Основная часть системы трансфузионной SFM®

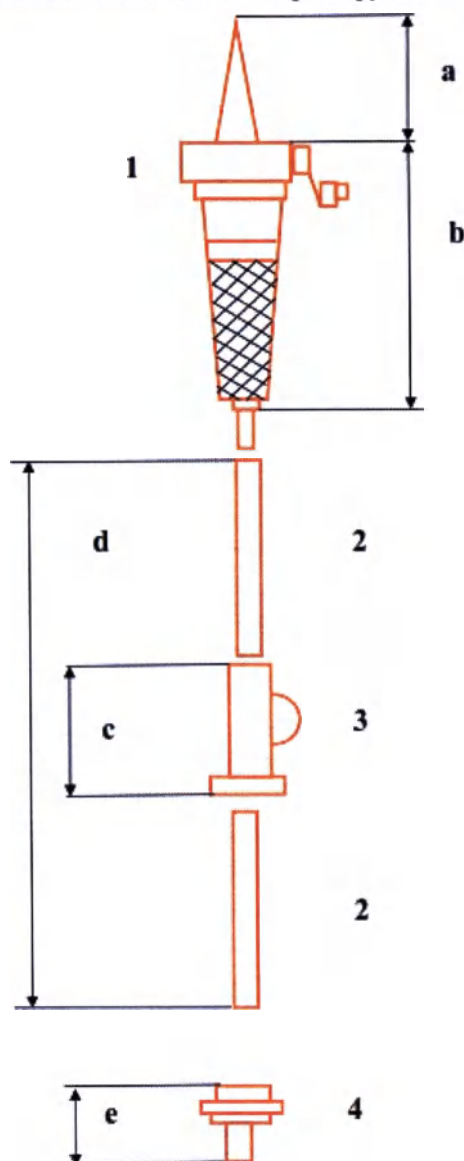


Примечание:

- а – длина шипа
- б – высота капельницы
- с – длина регулятора скорости потока
- д – длина трубки
- е – длина коннектора

- 1 – капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная жесткая или капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная полужесткая или капельница с фильтром с пластиковым шипом большая жесткая или капельница с фильтром с пластиковым шипом большая полужесткая
- 2 – трубка
- 3 – регулятор скорости потока роликового или барабанного типа
- 4 – коннектор типа Луер или типа Луер-Лок

2. Основная часть системы трансфузионной SFM[®], с Y-портом

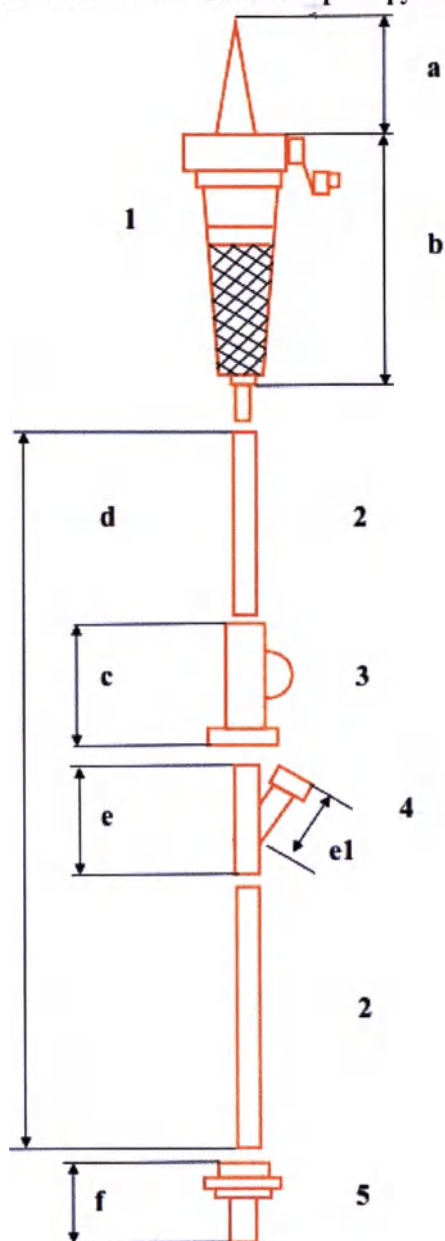


Примечание:

- a – длина шипа
- b – высота капельницы
- c – длина регулятора скорости потока
- d – длина трубки
- e x e1 – размер Y- порта
- f – длина коннектора

- 1 – капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная жесткая или капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная полужесткая или капельница с фильтром с пластиковым шипом большая жесткая или капельница с фильтром с пластиковым шипом большая полужесткая
- 2 – трубка
- 3 – регулятор скорости потока роликового или барабанного типа
- 4 – Y-порт
- 5 – коннектор типа Луер или типа Луер-Лок

3. Основная часть системы трансфузионной SFM[®], с портом для дополнительных инъекций

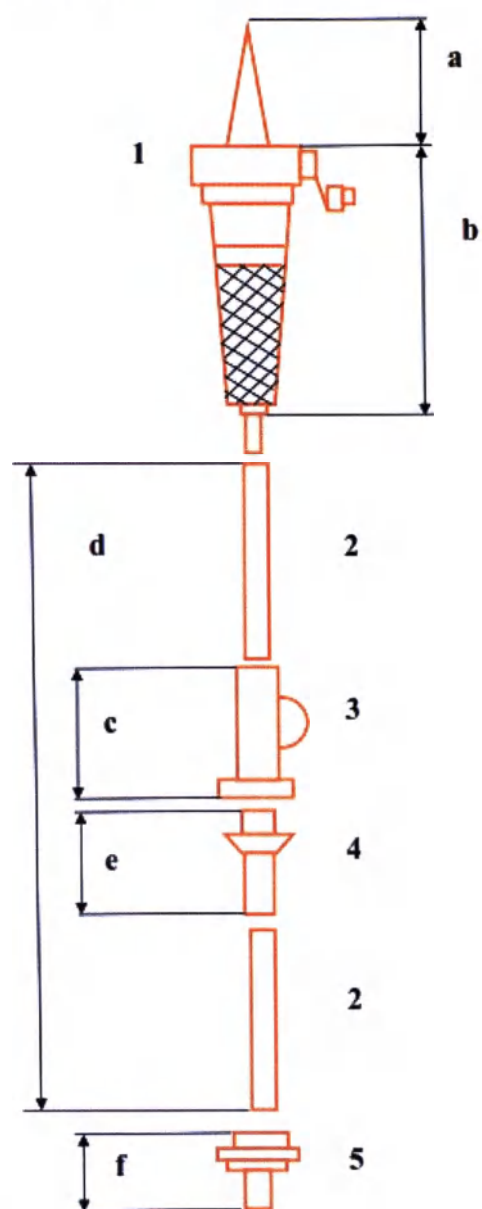


Примечание:

- a – длина шипа
- b – высота капельницы
- c – длина регулятора скорости потока
- d – длина трубки
- e – длина порта для дополнительных инъекций
- f – длина коннектора

- 1 – капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная жесткая или капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная полужесткая или капельница с фильтром с пластиковым шипом большая жесткая или капельница с фильтром с пластиковым шипом большая полужесткая
- 2 – трубка
- 3 – регулятор скорости потока роликового или барабанного типа
- 4 – порт для дополнительных инъекций
- 5 – коннектор типа Луер или типа Луер-Лок

4. Основная часть системы трансфузионной SFM[®], с Y-портом, с портом для дополнительных инъекций

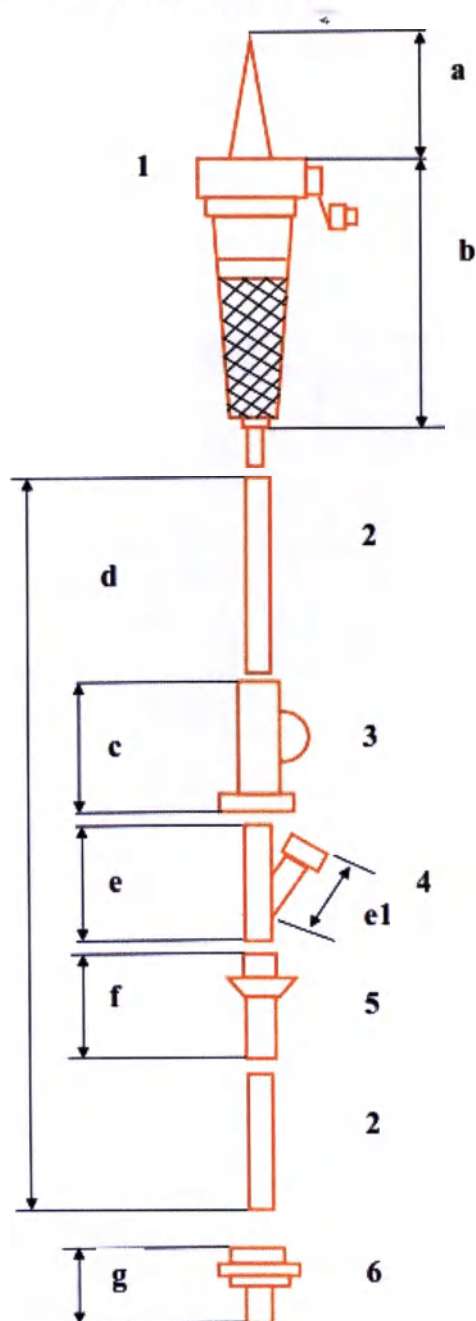

Примечание:


a – длина шипа
b – высота капельницы
c – длина регулятора скорости потока
d – длина трубки
e x e1 – размер Y-порта
f – длина порта для дополнительных инъекций
g – длина коннектора

1 – капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная жесткая или капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная полужесткая или капельница с фильтром с пластиковым шипом большая жесткая или капельница с фильтром с пластиковым шипом большая полужесткая
2 – трубка
3 – регулятор скорости потока роликового или барабанного типа
4 – Y-порт
5 – порт для дополнительных инъекций
6 – коннектор типа Луер или типа Луер-Лок

м шипом
льтром с
ская или
и большая
ым шипом


рабанного

5. Игла инъекционная

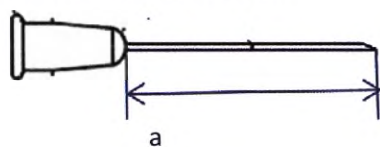

Примечание: а - длина трубки иглы

6. Фиксирующая повязка

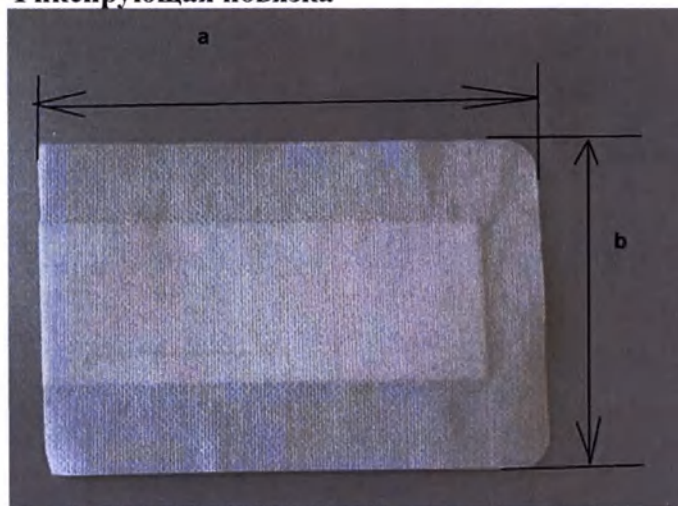

Примечание: а – длина, b - ширина

Система трансфузионная SFM[®], в вариантах исполнения:

I. Система трансфузионная SFM[®], в вариантах исполнения:

1. Система трансфузионная SFM[®], ПК 11-05, в составе:
 - 1.1. Основная часть, в составе:
 - 1.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная жесткая.
 - 1.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
 - 1.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.
 - 1.1.4. Коннектор типа Луер.
 - 1.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.
 - 1.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.
 - 1.4. Потребительская упаковка.
2. Система трансфузионная SFM[®], ПК 11-05, в составе:
 - 2.1. Основная часть, в составе:
 - 2.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная жесткая.
 - 2.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
 - 2.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.
 - 2.1.4. Коннектор типа Луер.
 - 2.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.
 - 2.3. Потребительская упаковка.
3. Система трансфузионная SFM[®], ПК 23-02, в составе:
 - 3.1. Основная часть, в составе:
 - 3.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная полужесткая.
 - 3.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
 - 3.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.
 - 3.1.4. Коннектор типа Луер.
 - 3.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0

- мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.
- 3.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.
- 3.4. Потребительская упаковка.
4. Система трансфузионная SFM[®], ПК 23-02, в составе:
- 4.1. Основная часть, в составе:
- 4.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная полужесткая.
- 4.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
- 4.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.
- 4.1.4. Коннектор типа Луер.
- 4.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.
- 4.3. Потребительская упаковка.
5. Система трансфузионная SFM[®], ПК 11-05, в составе:
- 5.1. Основная часть, в составе:
- 5.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая жесткая.
- 5.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
- 5.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.
- 5.1.4. Коннектор типа Луер.
- 5.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.
- 5.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.
- 5.4. Потребительская упаковка.
6. Система трансфузионная SFM[®], ПК 11-05, в составе:
- 6.1. Основная часть, в составе:
- 6.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая жесткая.
- 6.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до

- 3000 мм с шагом 50 мм.
- 6.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.
- 6.1.4. Коннектор типа Луер.
- 6.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.
- 6.3. Потребительская упаковка.
7. Система трансфузионная SFM[®], ПК 23-02, в составе:
- 7.1. Основная часть, в составе:
- 7.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая полужесткая.
- 7.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
- 7.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.
- 7.1.4. Коннектор типа Луер.
- 7.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.
- 7.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.
- 7.4. Потребительская упаковка.
8. Система трансфузионная SFM[®], ПК 23-02, в составе:
- 8.1. Основная часть, в составе:
- 8.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая полужесткая.
- 8.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
- 8.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.
- 8.1.4. Коннектор типа Луер.
- 8.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.
- 8.3. Потребительская упаковка.

9. Система трансфузионная SFM[®], ПК 11-05, в составе:
 - 9.1. Основная часть, в составе:
 - 9.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная жесткая.
 - 9.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
 - 9.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.
 - 9.1.4. Коннектор типа Луер-Лок.
 - 9.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.
 - 9.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.
 - 9.4. Потребительская упаковка.
10. Система трансфузионная SFM[®], ПК 11-05, в составе:
 - 10.1. Основная часть, в составе:
 - 10.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная жесткая.
 - 10.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
 - 10.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.
 - 10.1.4. Коннектор типа Луер-Лок.
 - 10.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.
 - 10.3. Потребительская упаковка.
11. Система трансфузионная SFM[®], ПК 23-02, в составе:
 - 11.1. Основная часть, в составе:
 - 11.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная полужесткая.
 - 11.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
 - 11.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.
 - 11.1.4. Коннектор типа Луер-Лок.
 - 11.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм.

мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.

11.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.

11.4. Потребительская упаковка.

12. Система трансфузионная SFM[®], ПК 23-02, в составе:

12.1. Основная часть, в составе:

12.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная полужесткая.

12.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.

12.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.

12.1.4. Коннектор типа Луер-Лок.

12.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.

12.3. Потребительская упаковка.

13. Система трансфузионная SFM[®], ПК 11-05, в составе:

13.1. Основная часть, в составе:

13.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая жесткая.

13.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.

13.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.

13.1.4. Коннектор типа Луер-Лок.

13.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.

13.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.

13.4. Потребительская упаковка.

14. Система трансфузионная SFM[®], ПК 11-05, в составе:

14.1. Основная часть, в составе:

14.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая жесткая.

- 14.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
- 14.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.
- 14.1.4. Коннектор типа Луер-Лок.
- 14.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.
- 14.3. Потребительская упаковка.
15. Система трансфузионная SFM[®], ПК 23-02, в составе:
- 15.1. Основная часть, в составе:
- 15.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая полужесткая.
- 15.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
- 15.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.
- 15.1.4. Коннектор типа Луер-Лок.
- 15.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.
- 15.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.
- 15.4. Потребительская упаковка.
16. Система трансфузионная SFM[®], ПК 23-02, в составе:
- 16.1. Основная часть, в составе:
- 16.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая полужесткая.
- 16.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
- 16.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.
- 16.1.4. Коннектор типа Луер-Лок.
- 16.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм;

1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.

16.3. Потребительская упаковка.

17. Система трансфузионная SFM[®], ПК 11-05, в составе:

17.1. Основная часть, в составе:

17.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная жесткая.

17.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.

17.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.

17.1.4. Коннектор типа Луер.

17.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.

17.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.

17.4. Потребительская упаковка.

18. Система трансфузионная SFM[®], ПК 11-05, в составе:

18.1. Основная часть, в составе:

18.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная жесткая.

18.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.

18.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.

18.1.4. Коннектор типа Луер.

18.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.

18.3. Потребительская упаковка.

19. Система трансфузионная SFM[®], ПК 23-02, в составе:

19.1. Основная часть, в составе:

19.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная полужесткая.

19.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.

19.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.

19.1.4. Коннектор типа Луер.

19.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм;

- 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.
- 19.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.
- 19.4. Потребительская упаковка.
20. Система трансфузионная SFM[®], ПК 23-02, в составе:
- 20.1. Основная часть, в составе:
- 20.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная полужесткая.
- 20.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
- 20.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.
- 20.1.4. Коннектор типа Луер.
- 20.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.
- 20.3. Потребительская упаковка.
21. Система трансфузионная SFM[®], ПК 11-05, в составе:
- 21.1. Основная часть, в составе:
- 21.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая жесткая.
- 21.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
- 21.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.
- 21.1.4. Коннектор типа Луер.
- 21.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.
- 21.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.

- 21.4. Потребительская упаковка.
22. Система трансфузионная SFM[®], ПК 11-05, в составе:
- 22.1. Основная часть, в составе:
- 22.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая жесткая.
- 22.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
- 22.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.
- 22.1.4. Коннектор типа Луер.
- 22.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.
- 22.3. Потребительская упаковка.
23. Система трансфузионная SFM[®], ПК 23-02, в составе:
- 23.1. Основная часть, в составе:
- 23.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая полужесткая.
- 23.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
- 23.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.
- 23.1.4. Коннектор типа Луер.
- 23.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.
- 23.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.
- 23.4. Потребительская упаковка.
24. Система трансфузионная SFM[®], ПК 23-02, в составе:
- 24.1. Основная часть, в составе:
- 24.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая полужесткая.
- 24.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
- 24.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.
- 24.1.4. Коннектор типа Луер.
- 24.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60

мм х 45,0 мм; 0,60 мм х 55,0 мм; 0,70 мм х 30,0 мм; 0,70 мм х 32,0 мм; 0,70 мм х 38,0 мм; 0,70 мм х 40,0 мм; 0,70 мм х 42,0 мм; 0,70 мм х 45,0 мм; 0,70 мм х 50,0 мм; 0,70 мм х 55,0 мм; 0,80 мм х 38,0 мм; 0,80 мм х 40,0 мм; 0,80 мм х 42,0 мм; 0,80 мм х 45,0 мм; 0,80 мм х 50,0 мм; 0,80 мм х 55,0 мм; 0,90 мм х 38,0 мм; 0,90 мм х 40,0 мм; 0,90 мм х 42,0 мм; 0,90 мм х 45,0 мм; 0,90 мм х 50,0 мм; 0,90 мм х 55,0 мм; 1,10 мм х 40,0 мм; 1,10 мм х 50,0 мм; 1,10 мм х 55,0 мм; 1,20 мм х 40,0 мм; 1,20 мм х 50,0 мм; 1,20 мм х 55,0 мм; 1,40 мм х 40,0 мм; 1,40 мм х 50,0 мм; 1,40 мм х 55,0 мм; 1,60 мм х 40,0 мм; 1,60 мм х 50,0 мм; 1,60 мм х 55,0 мм.

24.3. Потребительская упаковка.

25. Система трансфузионная SFM[®], ПК 11-05, в составе:

25.1. Основная часть, в составе:

25.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная жесткая.

25.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.

25.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.

25.1.4. Коннектор типа Луер-Лок.

25.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм х 12,0 мм; 0,33 мм х 12,0 мм; 0,33 мм х 12,7 мм; 0,40 мм х 12,0 мм; 0,45 мм х 12,0 мм; 0,45 мм х 12,7 мм; 0,45 мм х 16,0 мм; 0,50 мм х 13,0 мм; 0,50 мм х 15,0 мм; 0,50 мм х 16,0 мм; 0,50 мм х 18,0 мм; 0,50 мм х 25,0 мм; 0,60 мм х 25,0 мм; 0,60 мм х 30,0 мм; 0,60 мм х 32,0 мм; 0,60 мм х 42,0 мм; 0,60 мм х 45,0 мм; 0,60 мм х 55,0 мм; 0,70 мм х 30,0 мм; 0,70 мм х 32,0 мм; 0,70 мм х 38,0 мм; 0,70 мм х 40,0 мм; 0,70 мм х 42,0 мм; 0,70 мм х 45,0 мм; 0,70 мм х 50,0 мм; 0,70 мм х 55,0 мм; 0,80 мм х 38,0 мм; 0,80 мм х 40,0 мм; 0,80 мм х 42,0 мм; 0,80 мм х 45,0 мм; 0,80 мм х 50,0 мм; 0,80 мм х 55,0 мм; 0,90 мм х 38,0 мм; 0,90 мм х 40,0 мм; 0,90 мм х 42,0 мм; 0,90 мм х 45,0 мм; 0,90 мм х 50,0 мм; 0,90 мм х 55,0 мм; 1,10 мм х 40,0 мм; 1,10 мм х 50,0 мм; 1,10 мм х 55,0 мм; 1,20 мм х 40,0 мм; 1,20 мм х 50,0 мм; 1,20 мм х 55,0 мм; 1,40 мм х 40,0 мм; 1,40 мм х 50,0 мм; 1,40 мм х 55,0 мм; 1,60 мм х 40,0 мм; 1,60 мм х 50,0 мм; 1,60 мм х 55,0 мм.

25.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.

25.4. Потребительская упаковка.

26. Система трансфузионная SFM[®], ПК 11-05, в составе:

26.1. Основная часть, в составе:

26.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная жесткая.

26.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.

26.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.

26.1.4. Коннектор типа Луер-Лок.

26.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм х 12,0 мм; 0,33 мм х 12,0 мм; 0,33 мм х 12,7 мм; 0,40 мм х 12,0 мм; 0,45 мм х 12,0 мм; 0,45 мм х 12,7 мм; 0,45 мм х 16,0 мм; 0,50 мм х 13,0 мм; 0,50 мм х 15,0 мм; 0,50 мм х 16,0 мм; 0,50 мм х 18,0 мм; 0,50 мм х 25,0 мм; 0,60 мм х 25,0 мм; 0,60 мм х 30,0 мм; 0,60 мм х 32,0 мм; 0,60 мм х 42,0 мм; 0,60 мм х 45,0 мм; 0,60 мм х 55,0 мм; 0,70 мм х 30,0 мм; 0,70 мм х 32,0 мм; 0,70 мм х 38,0 мм; 0,70 мм х 40,0 мм; 0,70 мм х 42,0 мм; 0,70 мм х 45,0 мм; 0,70 мм х 50,0 мм; 0,70 мм х 55,0 мм; 0,80 мм х 38,0 мм; 0,80 мм х 40,0 мм; 0,80 мм х 42,0 мм; 0,80 мм х 45,0 мм; 0,80 мм х 50,0 мм; 0,80 мм х 55,0 мм; 0,90 мм х 38,0 мм; 0,90 мм х 40,0 мм; 0,90 мм х 42,0 мм; 0,90 мм х 45,0 мм; 0,90 мм х 50,0 мм; 0,90 мм х 55,0 мм; 1,10 мм х 40,0 мм; 1,10 мм х 50,0 мм; 1,10 мм х 55,0 мм; 1,20 мм х 40,0 мм; 1,20 мм х 50,0 мм; 1,20 мм х 55,0 мм; 1,40 мм х 40,0 мм; 1,40 мм х 50,0 мм; 1,40 мм х 55,0 мм; 1,60 мм х 40,0 мм; 1,60 мм х 50,0 мм; 1,60 мм х 55,0 мм.

26.3. Потребительская упаковка.

27. Система трансфузионная SFM[®], ПК 23-02, в составе:

27.1. Основная часть, в составе:

27.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная полужесткая.

- 27.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
- 27.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.
- 27.1.4. Коннектор типа Луер-Лок.
- 27.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.
- 27.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.
- 27.4. Потребительская упаковка.
28. Система трансфузионная SFM[®], ПК 23-02, в составе:
- 28.1. Основная часть, в составе:
- 28.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная полужесткая.
- 28.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
- 28.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.
- 28.1.4. Коннектор типа Луер-Лок.
- 28.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.
- 28.3. Потребительская упаковка.
29. Система трансфузионная SFM[®], ПК 11-05, в составе:
- 29.1. Основная часть, в составе:
- 29.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая жесткая.
- 29.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
- 29.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.
- 29.1.4. Коннектор типа Луер-Лок.
- 29.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм;

- 1,10 мм х 55,0 мм; 1,20 мм х 40,0 мм; 1,20 мм х 50,0 мм; 1,20 мм х 55,0 мм; 1,40 мм х 40,0 мм; 1,40 мм х 50,0 мм; 1,40 мм х 55,0 мм; 1,60 мм х 40,0 мм; 1,60 мм х 50,0 мм; 1,60 мм х 55,0 мм.
- 29.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.
- 29.4. Потребительская упаковка.
30. Система трансфузионная SFM[®], ПК 11-05, в составе:
- 30.1. Основная часть, в составе:
- 30.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая жесткая.
- 30.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
- 30.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.
- 30.1.4. Коннектор типа Луер-Лок.
- 30.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм х 12,0 мм; 0,33 мм х 12,0 мм; 0,33 мм х 12,7 мм; 0,40 мм х 12,0 мм; 0,45 мм х 12,0 мм; 0,45 мм х 12,7 мм; 0,45 мм х 16,0 мм; 0,50 мм х 13,0 мм; 0,50 мм х 15,0 мм; 0,50 мм х 16,0 мм; 0,50 мм х 18,0 мм; 0,50 мм х 25,0 мм; 0,60 мм х 25,0 мм; 0,60 мм х 30,0 мм; 0,60 мм х 32,0 мм; 0,60 мм х 42,0 мм; 0,60 мм х 45,0 мм; 0,60 мм х 55,0 мм; 0,70 мм х 30,0 мм; 0,70 мм х 32,0 мм; 0,70 мм х 38,0 мм; 0,70 мм х 40,0 мм; 0,70 мм х 42,0 мм; 0,70 мм х 45,0 мм; 0,70 мм х 50,0 мм; 0,70 мм х 55,0 мм; 0,80 мм х 38,0 мм; 0,80 мм х 40,0 мм; 0,80 мм х 42,0 мм; 0,80 мм х 45,0 мм; 0,80 мм х 50,0 мм; 0,80 мм х 55,0 мм; 0,90 мм х 38,0 мм; 0,90 мм х 40,0 мм; 0,90 мм х 42,0 мм; 0,90 мм х 45,0 мм; 0,90 мм х 50,0 мм; 0,90 мм х 55,0 мм; 1,10 мм х 40,0 мм; 1,10 мм х 50,0 мм; 1,10 мм х 55,0 мм; 1,20 мм х 40,0 мм; 1,20 мм х 50,0 мм; 1,20 мм х 55,0 мм; 1,40 мм х 40,0 мм; 1,40 мм х 50,0 мм; 1,40 мм х 55,0 мм; 1,60 мм х 40,0 мм; 1,60 мм х 50,0 мм; 1,60 мм х 55,0 мм.
- 30.3. Потребительская упаковка.
31. Система трансфузионная SFM[®], ПК 23-02, в составе:
- 31.1. Основная часть, в составе:
- 31.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая полужесткая.
- 31.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
- 31.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.
- 31.1.4. Коннектор типа Луер-Лок.
- 31.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм х 12,0 мм; 0,33 мм х 12,0 мм; 0,33 мм х 12,7 мм; 0,40 мм х 12,0 мм; 0,45 мм х 12,0 мм; 0,45 мм х 12,7 мм; 0,45 мм х 16,0 мм; 0,50 мм х 13,0 мм; 0,50 мм х 15,0 мм; 0,50 мм х 16,0 мм; 0,50 мм х 18,0 мм; 0,50 мм х 25,0 мм; 0,60 мм х 25,0 мм; 0,60 мм х 30,0 мм; 0,60 мм х 32,0 мм; 0,60 мм х 42,0 мм; 0,60 мм х 45,0 мм; 0,60 мм х 55,0 мм; 0,70 мм х 30,0 мм; 0,70 мм х 32,0 мм; 0,70 мм х 38,0 мм; 0,70 мм х 40,0 мм; 0,70 мм х 42,0 мм; 0,70 мм х 45,0 мм; 0,70 мм х 50,0 мм; 0,70 мм х 55,0 мм; 0,80 мм х 38,0 мм; 0,80 мм х 40,0 мм; 0,80 мм х 42,0 мм; 0,80 мм х 45,0 мм; 0,80 мм х 50,0 мм; 0,80 мм х 55,0 мм; 0,90 мм х 38,0 мм; 0,90 мм х 40,0 мм; 0,90 мм х 42,0 мм; 0,90 мм х 45,0 мм; 0,90 мм х 50,0 мм; 0,90 мм х 55,0 мм; 1,10 мм х 40,0 мм; 1,10 мм х 50,0 мм; 1,10 мм х 55,0 мм; 1,20 мм х 40,0 мм; 1,20 мм х 50,0 мм; 1,20 мм х 55,0 мм; 1,40 мм х 40,0 мм; 1,40 мм х 50,0 мм; 1,40 мм х 55,0 мм; 1,60 мм х 40,0 мм; 1,60 мм х 50,0 мм; 1,60 мм х 55,0 мм.
- 31.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.
- 31.4. Потребительская упаковка.
32. Система трансфузионная SFM[®], ПК 23-02, в составе:
- 32.1. Основная часть, в составе:
- 32.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая полужесткая.
- 32.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
- 32.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.

32.1.4. Коннектор типа Луер-Лок.

- 32.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм х 12,0 мм; 0,33 мм х 12,0 мм; 0,33 мм х 12,7 мм; 0,40 мм х 12,0 мм; 0,45 мм х 12,0 мм; 0,45 мм х 12,7 мм; 0,45 мм х 16,0 мм; 0,50 мм х 13,0 мм; 0,50 мм х 15,0 мм; 0,50 мм х 16,0 мм; 0,50 мм х 18,0 мм; 0,50 мм х 25,0 мм; 0,60 мм х 25,0 мм; 0,60 мм х 30,0 мм; 0,60 мм х 32,0 мм; 0,60 мм х 42,0 мм; 0,60 мм х 45,0 мм; 0,60 мм х 55,0 мм; 0,70 мм х 30,0 мм; 0,70 мм х 32,0 мм; 0,70 мм х 38,0 мм; 0,70 мм х 40,0 мм; 0,70 мм х 42,0 мм; 0,70 мм х 45,0 мм; 0,70 мм х 50,0 мм; 0,70 мм х 55,0 мм; 0,80 мм х 38,0 мм; 0,80 мм х 40,0 мм; 0,80 мм х 42,0 мм; 0,80 мм х 45,0 мм; 0,80 мм х 50,0 мм; 0,80 мм х 55,0 мм; 0,90 мм х 38,0 мм; 0,90 мм х 40,0 мм; 0,90 мм х 42,0 мм; 0,90 мм х 45,0 мм; 0,90 мм х 50,0 мм; 0,90 мм х 55,0 мм; 1,10 мм х 40,0 мм; 1,10 мм х 50,0 мм; 1,10 мм х 55,0 мм; 1,20 мм х 40,0 мм; 1,20 мм х 50,0 мм; 1,20 мм х 55,0 мм; 1,40 мм х 40,0 мм; 1,40 мм х 50,0 мм; 1,40 мм х 55,0 мм; 1,60 мм х 40,0 мм; 1,60 мм х 50,0 мм; 1,60 мм х 55,0 мм.

32.3. Потребительская упаковка.

II. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, в вариантах исполнения:

1. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, ПК 11-05, в составе:

1.1. Основная часть, в составе:

1.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная жесткая.

1.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.

1.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.

1.1.4. Y-порт.

1.1.5. Коннектор типа Луер.

1.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм х 12,0 мм; 0,33 мм х 12,0 мм; 0,33 мм х 12,7 мм; 0,40 мм х 12,0 мм; 0,45 мм х 12,0 мм; 0,45 мм х 12,7 мм; 0,45 мм х 16,0 мм; 0,50 мм х 13,0 мм; 0,50 мм х 15,0 мм; 0,50 мм х 16,0 мм; 0,50 мм х 18,0 мм; 0,50 мм х 25,0 мм; 0,60 мм х 25,0 мм; 0,60 мм х 30,0 мм; 0,60 мм х 32,0 мм; 0,60 мм х 42,0 мм; 0,60 мм х 45,0 мм; 0,60 мм х 55,0 мм; 0,70 мм х 30,0 мм; 0,70 мм х 32,0 мм; 0,70 мм х 38,0 мм; 0,70 мм х 40,0 мм; 0,70 мм х 42,0 мм; 0,70 мм х 45,0 мм; 0,70 мм х 50,0 мм; 0,70 мм х 55,0 мм; 0,80 мм х 38,0 мм; 0,80 мм х 40,0 мм; 0,80 мм х 42,0 мм; 0,80 мм х 45,0 мм; 0,80 мм х 50,0 мм; 0,80 мм х 55,0 мм; 0,90 мм х 38,0 мм; 0,90 мм х 40,0 мм; 0,90 мм х 42,0 мм; 0,90 мм х 45,0 мм; 0,90 мм х 50,0 мм; 0,90 мм х 55,0 мм; 1,10 мм х 40,0 мм; 1,10 мм х 50,0 мм; 1,10 мм х 55,0 мм; 1,20 мм х 40,0 мм; 1,20 мм х 50,0 мм; 1,20 мм х 55,0 мм; 1,40 мм х 40,0 мм; 1,40 мм х 50,0 мм; 1,40 мм х 55,0 мм; 1,60 мм х 40,0 мм; 1,60 мм х 50,0 мм; 1,60 мм х 55,0 мм.

1.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.

1.4. Потребительская упаковка.

2. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, ПК 11-05, в составе:

2.1. Основная часть, в составе:

2.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная жесткая.

2.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.

2.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.

2.1.4. Y-порт.

2.1.5. Коннектор типа Луер.

2.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм х 12,0 мм; 0,33 мм х 12,0 мм; 0,33 мм х 12,7 мм; 0,40 мм х 12,0 мм; 0,45 мм х 12,0 мм; 0,45 мм х 12,7 мм; 0,45 мм х 16,0 мм; 0,50 мм х 13,0 мм; 0,50 мм х 15,0 мм; 0,50 мм х 16,0 мм; 0,50 мм х 18,0 мм; 0,50 мм х 25,0 мм; 0,60 мм х 25,0 мм; 0,60 мм х 30,0 мм; 0,60 мм х 32,0 мм; 0,60 мм х 42,0 мм; 0,60 мм х 45,0 мм; 0,60 мм х 55,0 мм; 0,70 мм х 30,0 мм; 0,70 мм х 32,0 мм; 0,70 мм х 38,0 мм; 0,70 мм х 40,0 мм; 0,70 мм х 42,0 мм; 0,70 мм х 45,0 мм; 0,70 мм х 50,0 мм; 0,70 мм х 55,0 мм; 0,80 мм х 38,0 мм; 0,80 мм х 40,0 мм; 0,80 мм х 42,0 мм; 0,80 мм х 45,0 мм; 0,80 мм х 50,0 мм; 0,80 мм х 55,0 мм; 0,90 мм х 38,0 мм; 0,90 мм х 40,0 мм; 0,90 мм х 42,0 мм; 0,90 мм х 45,0 мм; 0,90 мм х 50,0 мм; 0,90 мм х 55,0 мм; 1,10 мм х 40,0 мм; 1,10 мм х 50,0 мм; 1,10 мм х 55,0 мм; 1,20 мм х 40,0 мм; 1,20 мм х 50,0 мм; 1,20 мм х 55,0 мм; 1,40 мм х 40,0 мм; 1,40 мм х 50,0 мм; 1,40 мм х 55,0 мм.

мм х 50,0 мм; 1,40 мм х 55,0 мм; 1,60 мм х 40,0 мм; 1,60 мм х 50,0 мм; 1,60 мм х 55,0 мм.
2.3. Потребительская упаковка.

3. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, ПК 23-02, в составе:

3.1. Основная часть, в составе:

3.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная полужесткая.

3.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.

3.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.

3.1.4. Y-порт.

3.1.5. Коннектор типа Луер.

3.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм х 12,0 мм; 0,33 мм х 12,0 мм; 0,33 мм х 12,7 мм; 0,40 мм х 12,0 мм; 0,45 мм х 12,0 мм; 0,45 мм х 12,7 мм; 0,45 мм х 16,0 мм; 0,50 мм х 13,0 мм; 0,50 мм х 15,0 мм; 0,50 мм х 16,0 мм; 0,50 мм х 18,0 мм; 0,50 мм х 25,0 мм; 0,60 мм х 25,0 мм; 0,60 мм х 30,0 мм; 0,60 мм х 32,0 мм; 0,60 мм х 42,0 мм; 0,60 мм х 45,0 мм; 0,60 мм х 55,0 мм; 0,70 мм х 30,0 мм; 0,70 мм х 32,0 мм; 0,70 мм х 38,0 мм; 0,70 мм х 40,0 мм; 0,70 мм х 42,0 мм; 0,70 мм х 45,0 мм; 0,70 мм х 50,0 мм; 0,70 мм х 55,0 мм; 0,80 мм х 38,0 мм; 0,80 мм х 40,0 мм; 0,80 мм х 42,0 мм; 0,80 мм х 45,0 мм; 0,80 мм х 50,0 мм; 0,80 мм х 55,0 мм; 0,90 мм х 38,0 мм; 0,90 мм х 40,0 мм; 0,90 мм х 42,0 мм; 0,90 мм х 45,0 мм; 0,90 мм х 50,0 мм; 0,90 мм х 55,0 мм; 1,10 мм х 40,0 мм; 1,10 мм х 50,0 мм; 1,10 мм х 55,0 мм; 1,20 мм х 40,0 мм; 1,20 мм х 50,0 мм; 1,20 мм х 55,0 мм; 1,40 мм х 40,0 мм; 1,40 мм х 50,0 мм; 1,40 мм х 55,0 мм; 1,60 мм х 40,0 мм; 1,60 мм х 50,0 мм; 1,60 мм х 55,0 мм.

3.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.

3.4. Потребительская упаковка.

4. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, ПК 23-02, в составе:

4.1. Основная часть, в составе:

4.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная полужесткая.

4.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.

4.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.

4.1.4. Y-порт.

4.1.5. Коннектор типа Луер.

4.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм х 12,0 мм; 0,33 мм х 12,0 мм; 0,33 мм х 12,7 мм; 0,40 мм х 12,0 мм; 0,45 мм х 12,0 мм; 0,45 мм х 12,7 мм; 0,45 мм х 16,0 мм; 0,50 мм х 13,0 мм; 0,50 мм х 15,0 мм; 0,50 мм х 16,0 мм; 0,50 мм х 18,0 мм; 0,50 мм х 25,0 мм; 0,60 мм х 25,0 мм; 0,60 мм х 30,0 мм; 0,60 мм х 32,0 мм; 0,60 мм х 42,0 мм; 0,60 мм х 45,0 мм; 0,60 мм х 55,0 мм; 0,70 мм х 30,0 мм; 0,70 мм х 32,0 мм; 0,70 мм х 38,0 мм; 0,70 мм х 40,0 мм; 0,70 мм х 42,0 мм; 0,70 мм х 45,0 мм; 0,70 мм х 50,0 мм; 0,70 мм х 55,0 мм; 0,80 мм х 38,0 мм; 0,80 мм х 40,0 мм; 0,80 мм х 42,0 мм; 0,80 мм х 45,0 мм; 0,80 мм х 50,0 мм; 0,80 мм х 55,0 мм; 0,90 мм х 38,0 мм; 0,90 мм х 40,0 мм; 0,90 мм х 42,0 мм; 0,90 мм х 45,0 мм; 0,90 мм х 50,0 мм; 0,90 мм х 55,0 мм; 1,10 мм х 40,0 мм; 1,10 мм х 50,0 мм; 1,10 мм х 55,0 мм; 1,20 мм х 40,0 мм; 1,20 мм х 50,0 мм; 1,20 мм х 55,0 мм; 1,40 мм х 40,0 мм; 1,40 мм х 50,0 мм; 1,40 мм х 55,0 мм; 1,60 мм х 40,0 мм; 1,60 мм х 50,0 мм; 1,60 мм х 55,0 мм.

4.3. Потребительская упаковка.

5. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, ПК 11-05, в составе:

5.1. Основная часть, в составе:

5.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая жесткая.

5.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.

5.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.

5.1.4. Y-порт.

5.1.5. Коннектор типа Луер.

5.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм х 12,0 мм; 0,33 мм х 12,0 мм; 0,33 мм х 12,7 мм; 0,40 мм х 12,0 мм; 0,45 мм х 12,0 мм; 0,45 мм х 12,7 мм; 0,45 мм х 16,0 мм; 0,50 мм х 13,0 мм; 0,50 мм х 15,0 мм; 0,50 мм х 16,0 мм; 0,50 мм х 18,0 мм; 0,50 мм х 25,0 мм; 0,60 мм х 25,0 мм; 0,60 мм х 30,0 мм; 0,60 мм х 32,0 мм; 0,60 мм х 42,0 мм; 0,60 мм х 45,0 мм; 0,60 мм х 55,0 мм; 0,70 мм х 30,0 мм; 0,70 мм х 32,0 мм; 0,70 мм х 38,0 мм; 0,70 мм х 40,0 мм; 0,70 мм х 42,0 мм; 0,70 мм х 45,0 мм; 0,70 мм х 50,0 мм; 0,70 мм х 55,0 мм; 0,80 мм х 38,0 мм; 0,80 мм х 40,0 мм; 0,80 мм х 42,0 мм; 0,80 мм х 45,0 мм; 0,80 мм х 50,0 мм; 0,80 мм х 55,0 мм; 0,90 мм х 38,0 мм; 0,90 мм х 40,0 мм; 0,90 мм х 42,0 мм; 0,90 мм х 45,0 мм; 0,90 мм х 50,0 мм; 0,90 мм х 55,0 мм; 1,10 мм х 40,0 мм; 1,10 мм х 50,0 мм; 1,10 мм х 55,0 мм; 1,20 мм х 40,0 мм; 1,20 мм х 50,0 мм; 1,20 мм х 55,0 мм; 1,40 мм х 40,0 мм; 1,40 мм х 50,0 мм; 1,40 мм х 55,0 мм; 1,60 мм х 40,0 мм; 1,60 мм х 50,0 мм; 1,60 мм х 55,0 мм.

мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.

5.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.

5.4. Потребительская упаковка.

6. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, ПК 11-05, в составе:

6.1. Основная часть, в составе:

6.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая жесткая.

6.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.

6.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.

6.1.4. Y-порт.

6.1.5. Коннектор типа Луер.

6.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.

6.3. Потребительская упаковка.

7. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, ПК 23-02, в составе:

7.1. Основная часть, в составе:

7.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая полужесткая.

7.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.

7.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.

7.1.4. Y-порт.

7.1.5. Коннектор типа Луер.

7.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.

7.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.

7.4. Потребительская упаковка.

8. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, ПК 23-02, в составе:
 - 8.1. Основная часть, в составе:
 - 8.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая полужесткая.
 - 8.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
 - 8.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.
 - 8.1.4. Y-порт.
 - 8.1.5. Коннектор типа Луер.
 - 8.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.
 - 8.3. Потребительская упаковка.
9. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, ПК 11-05, в составе:
 - 9.1. Основная часть, в составе:
 - 9.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная жесткая.
 - 9.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
 - 9.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.
 - 9.1.4. Y-порт.
 - 9.1.5. Коннектор типа Луер-Лок.
 - 9.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.
 - 9.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.
 - 9.4. Потребительская упаковка.
10. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, ПК 11-05, в составе:
 - 10.1. Основная часть, в составе:
 - 10.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная жесткая.
 - 10.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
 - 10.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.
 - 10.1.4. Y-порт.
 - 10.1.5. Коннектор типа Луер-Лок.
 - 10.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм;

0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.

10.3. Потребительская упаковка.

11. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, ПК 23-02, в составе:

11.1. Основная часть, в составе:

11.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная полужесткая.

11.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.

11.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.

11.1.4. Y-порт.

11.1.5. Коннектор типа Луер-Лок.

11.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.

11.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.

11.4. Потребительская упаковка.

12. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, ПК 23-02, в составе:

12.1. Основная часть, в составе:

12.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная полужесткая.

12.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.

12.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.

12.1.4. Y-порт.

12.1.5. Коннектор типа Луер-Лок.

12.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.

12.3. Потребительская упаковка.

13. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, ПК 11-05, в составе:

13.1. Основная часть, в составе:

- 13.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая жесткая.
- 13.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
- 13.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.
- 13.1.4. Y-порт.
- 13.1.5. Коннектор типа Луер-Лок.
- 13.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.
- 13.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.
- 13.4. Потребительская упаковка.
- 14. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, ПК 11-05, в составе:
 - 14.1. Основная часть, в составе:
 - 14.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая жесткая.
 - 14.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
 - 14.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.
 - 14.1.4. Y-порт.
 - 14.1.5. Коннектор типа Луер-Лок.
 - 14.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.
 - 14.3. Потребительская упаковка.
- 15. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, ПК 23-02, в составе:
 - 15.1. Основная часть, в составе:
 - 15.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая полужесткая.
 - 15.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
 - 15.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.
 - 15.1.4. Y-порт.
 - 15.1.5. Коннектор типа Луер-Лок.
 - 15.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм;

- 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.
- 15.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.
- 15.4. Потребительская упаковка.
16. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, ПК 23-02, в составе:
- 16.1. Основная часть, в составе:
- 16.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая полужесткая.
- 16.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
- 16.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.
- 16.1.4. Y-порт.
- 16.1.5. Коннектор типа Луер-Лок.
- 16.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.
- 16.3. Потребительская упаковка.
17. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, ПК 11-05, в составе:
- 17.1. Основная часть, в составе:
- 17.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная жесткая.
- 17.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
- 17.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.
- 17.1.4. Y-порт.
- 17.1.5. Коннектор типа Луер.
- 17.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.
- 17.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.
- 17.4. Потребительская упаковка.

18. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, ПК 11-05, в составе:

18.1. Основная часть, в составе:

18.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная жесткая.

18.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.

18.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.

18.1.4. Y-порт.

18.1.5. Коннектор типа Луер.

18.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.

18.3. Потребительская упаковка.

19. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, ПК 23-02, в составе:

19.1. Основная часть, в составе:

19.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная полужесткая.

19.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.

19.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.

19.1.4. Y-порт.

19.1.5. Коннектор типа Луер.

19.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.

19.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.

19.4. Потребительская упаковка.

20. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, ПК 23-02, в составе:

20.1. Основная часть, в составе:

20.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная полужесткая.

20.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.

20.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.

20.1.4. Y-порт.

20.1.5. Коннектор типа Луер.

20.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.

25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.

20.3. Потребительская упаковка.

21. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, ПК 11-05, в составе:

21.1. Основная часть, в составе:

21.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая жесткая.

21.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.

21.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.

21.1.4. Y-порт.

21.1.5. Коннектор типа Луер.

21.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.

21.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.

21.4. Потребительская упаковка.

22. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, ПК 11-05, в составе:

22.1. Основная часть, в составе:

22.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая жесткая.

22.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.

22.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.

22.1.4. Y-порт.

22.1.5. Коннектор типа Луер.

22.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.

22.3. Потребительская упаковка.

23. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, ПК 23-02, в составе:

23.1. Основная часть, в составе:

23.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая полужесткая.

23.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.

23.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.

23.1.4. Y-порт.

23.1.5. Коннектор типа Луер.

23.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.

23.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.

23.4. Потребительская упаковка.

24. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, ПК 23-02, в составе:

24.1. Основная часть, в составе:

24.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая полужесткая.

24.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.

24.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.

24.1.4. Y-порт.

24.1.5. Коннектор типа Луер.

24.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.

24.3. Потребительская упаковка.

25. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, ПК 11-05, в составе:

25.1. Основная часть, в составе:

25.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная жесткая.

25.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.

25.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.

25.1.4. Y-порт.

25.1.5. Коннектор типа Луер-Лок.

25.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x

- 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.
- 25.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.
- 25.4. Потребительская упаковка.
26. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, ПК 11-05, в составе:
- 26.1. Основная часть, в составе:
- 26.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная жесткая.
- 26.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
- 26.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.
- 26.1.4. Y-порт.
- 26.1.5. Коннектор типа Луер-Лок.
- 26.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.
- 26.3. Потребительская упаковка.
27. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, ПК 23-02, в составе:
- 27.1. Основная часть, в составе:
- 27.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная полужесткая.
- 27.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
- 27.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.
- 27.1.4. Y-порт.
- 27.1.5. Коннектор типа Луер-Лок.
- 27.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.
- 27.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.

- 27.4. Потребительская упаковка.
28. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, ПК 23-02, в составе:
- 28.1. Основная часть, в составе:
- 28.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная полужесткая.
- 28.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
- 28.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.
- 28.1.4. Y-порт.
- 28.1.5. Коннектор типа Луер-Лок.
- 28.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.
- 28.3. Потребительская упаковка.
29. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, ПК 11-05, в составе:
- 29.1. Основная часть, в составе:
- 29.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая жесткая.
- 29.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
- 29.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.
- 29.1.4. Y-порт.
- 29.1.5. Коннектор типа Луер-Лок.
- 29.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.
- 29.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.
- 29.4. Потребительская упаковка.
30. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, ПК 11-05, в составе:
- 30.1. Основная часть, в составе:
- 30.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая жесткая.
- 30.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
- 30.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.
- 30.1.4. Y-порт.
- 30.1.5. Коннектор типа Луер-Лок.
- 30.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм;

0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.

30.3. Потребительская упаковка.

31. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, ПК 23-02, в составе:

31.1. Основная часть, в составе:

31.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая полужесткая.

31.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.

31.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.

31.1.4. Y-порт.

31.1.5. Коннектор типа Луер-Лок.

31.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.

31.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.

31.4. Потребительская упаковка.

32. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, ПК 23-02, в составе:

32.1. Основная часть, в составе:

32.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая полужесткая.

32.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.

32.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.

32.1.4. Y-порт.

32.1.5. Коннектор типа Луер-Лок.

32.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.

32.3. Потребительская упаковка.

III. Система трансфузионная SFM[®], с портом для дополнительных инъекций, в вариантах исполнения:

1. Система трансфузионная SFM[®], с портом для дополнительных инъекций, ПК 11-05, в составе:

1.1. Основная часть, в составе:

1.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная жесткая.

1.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.

1.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.

1.1.4. Порт для дополнительных инъекций.

1.1.5. Коннектор типа Луер.

1.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.

1.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.

1.4. Потребительская упаковка.

2. Система трансфузионная SFM[®], с портом для дополнительных инъекций, ПК 11-05, в составе:

2.1. Основная часть, в составе:

2.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная жесткая.

2.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.

2.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.

2.1.4. Порт для дополнительных инъекций.

2.1.5. Коннектор типа Луер.

2.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.

2.3. Потребительская упаковка.

3. Система трансфузионная SFM[®], с портом для дополнительных инъекций, ПК 23-02, в составе:

3.1. Основная часть, в составе:

3.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная полужесткая.

3.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.

3.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.

3.1.4. Порт для дополнительных инъекций.

3.1.5. Коннектор типа Луер.

3.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм

х 12,7 мм; 0,40 мм х 12,0 мм; 0,45 мм х 12,0 мм; 0,45 мм х 12,7 мм; 0,45 мм х 16,0 мм; 0,50 мм х 13,0 мм; 0,50 мм х 15,0 мм; 0,50 мм х 16,0 мм; 0,50 мм х 18,0 мм; 0,50 мм х 25,0 мм; 0,60 мм х 25,0 мм; 0,60 мм х 30,0 мм; 0,60 мм х 32,0 мм; 0,60 мм х 42,0 мм; 0,60 мм х 45,0 мм; 0,60 мм х 55,0 мм; 0,70 мм х 30,0 мм; 0,70 мм х 32,0 мм; 0,70 мм х 38,0 мм; 0,70 мм х 40,0 мм; 0,70 мм х 42,0 мм; 0,70 мм х 45,0 мм; 0,70 мм х 50,0 мм; 0,70 мм х 55,0 мм; 0,80 мм х 38,0 мм; 0,80 мм х 40,0 мм; 0,80 мм х 42,0 мм; 0,80 мм х 45,0 мм; 0,80 мм х 50,0 мм; 0,80 мм х 55,0 мм; 0,90 мм х 38,0 мм; 0,90 мм х 40,0 мм; 0,90 мм х 42,0 мм; 0,90 мм х 45,0 мм; 0,90 мм х 50,0 мм; 0,90 мм х 55,0 мм; 1,10 мм х 40,0 мм; 1,10 мм х 50,0 мм; 1,10 мм х 55,0 мм; 1,20 мм х 40,0 мм; 1,20 мм х 50,0 мм; 1,20 мм х 55,0 мм; 1,40 мм х 40,0 мм; 1,40 мм х 50,0 мм; 1,40 мм х 55,0 мм; 1,60 мм х 40,0 мм; 1,60 мм х 50,0 мм; 1,60 мм х 55,0 мм.

3.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.

3.4. Потребительская упаковка.

4. Система трансфузионная SFM[®], с портом для дополнительных инъекций, ПК 23-02, в составе:

4.1. Основная часть, в составе:

4.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная полужесткая.

4.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.

4.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.

4.1.4. Порт для дополнительных инъекций.

4.1.5. Коннектор типа Луер.

4.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм х 12,0 мм; 0,33 мм х 12,0 мм; 0,33 мм х 12,7 мм; 0,40 мм х 12,0 мм; 0,45 мм х 12,0 мм; 0,45 мм х 12,7 мм; 0,45 мм х 16,0 мм; 0,50 мм х 13,0 мм; 0,50 мм х 15,0 мм; 0,50 мм х 16,0 мм; 0,50 мм х 18,0 мм; 0,50 мм х 25,0 мм; 0,60 мм х 25,0 мм; 0,60 мм х 30,0 мм; 0,60 мм х 32,0 мм; 0,60 мм х 42,0 мм; 0,60 мм х 45,0 мм; 0,60 мм х 55,0 мм; 0,70 мм х 30,0 мм; 0,70 мм х 32,0 мм; 0,70 мм х 38,0 мм; 0,70 мм х 40,0 мм; 0,70 мм х 42,0 мм; 0,70 мм х 45,0 мм; 0,70 мм х 50,0 мм; 0,70 мм х 55,0 мм; 0,80 мм х 38,0 мм; 0,80 мм х 40,0 мм; 0,80 мм х 42,0 мм; 0,80 мм х 45,0 мм; 0,80 мм х 50,0 мм; 0,80 мм х 55,0 мм; 0,90 мм х 38,0 мм; 0,90 мм х 40,0 мм; 0,90 мм х 42,0 мм; 0,90 мм х 45,0 мм; 0,90 мм х 50,0 мм; 0,90 мм х 55,0 мм; 1,10 мм х 40,0 мм; 1,10 мм х 50,0 мм; 1,10 мм х 55,0 мм; 1,20 мм х 40,0 мм; 1,20 мм х 50,0 мм; 1,20 мм х 55,0 мм; 1,40 мм х 40,0 мм; 1,40 мм х 50,0 мм; 1,40 мм х 55,0 мм; 1,60 мм х 40,0 мм; 1,60 мм х 50,0 мм; 1,60 мм х 55,0 мм.

4.3. Потребительская упаковка.

5. Система трансфузионная SFM[®], с портом для дополнительных инъекций, ПК 11-05, в составе:

5.1. Основная часть, в составе:

5.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая жесткая.

5.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.

5.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.

5.1.4. Порт для дополнительных инъекций.

5.1.5. Коннектор типа Луер.

5.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм х 12,0 мм; 0,33 мм х 12,0 мм; 0,33 мм х 12,7 мм; 0,40 мм х 12,0 мм; 0,45 мм х 12,0 мм; 0,45 мм х 12,7 мм; 0,45 мм х 16,0 мм; 0,50 мм х 13,0 мм; 0,50 мм х 15,0 мм; 0,50 мм х 16,0 мм; 0,50 мм х 18,0 мм; 0,50 мм х 25,0 мм; 0,60 мм х 25,0 мм; 0,60 мм х 30,0 мм; 0,60 мм х 32,0 мм; 0,60 мм х 42,0 мм; 0,60 мм х 45,0 мм; 0,60 мм х 55,0 мм; 0,70 мм х 30,0 мм; 0,70 мм х 32,0 мм; 0,70 мм х 38,0 мм; 0,70 мм х 40,0 мм; 0,70 мм х 42,0 мм; 0,70 мм х 45,0 мм; 0,70 мм х 50,0 мм; 0,70 мм х 55,0 мм; 0,80 мм х 38,0 мм; 0,80 мм х 40,0 мм; 0,80 мм х 42,0 мм; 0,80 мм х 45,0 мм; 0,80 мм х 50,0 мм; 0,80 мм х 55,0 мм; 0,90 мм х 38,0 мм; 0,90 мм х 40,0 мм; 0,90 мм х 42,0 мм; 0,90 мм х 45,0 мм; 0,90 мм х 50,0 мм; 0,90 мм х 55,0 мм; 1,10 мм х 40,0 мм; 1,10 мм х 50,0 мм; 1,10 мм х 55,0 мм; 1,20 мм х 40,0 мм; 1,20 мм х 50,0 мм; 1,20 мм х 55,0 мм; 1,40 мм х 40,0 мм; 1,40 мм х 50,0 мм; 1,40 мм х 55,0 мм; 1,60 мм х 40,0 мм; 1,60 мм х 50,0 мм; 1,60 мм х 55,0 мм.

5.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.

5.4. Потребительская упаковка.

6. Система трансфузионная SFM[®], с портом для дополнительных инъекций, ПК 11-05, в составе:
 - 6.1. Основная часть, в составе:
 - 6.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая жесткая.
 - 6.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
 - 6.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.
 - 6.1.4. Порт для дополнительных инъекций.
 - 6.1.5. Коннектор типа Луер.
 - 6.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.
 - 6.3. Потребительская упаковка.
7. Система трансфузионная SFM[®], с портом для дополнительных инъекций, ПК 23-02, в составе:
 - 7.1. Основная часть, в составе:
 - 7.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая полужесткая.
 - 7.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
 - 7.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.
 - 7.1.4. Порт для дополнительных инъекций.
 - 7.1.5. Коннектор типа Луер.
 - 7.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.
 - 7.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.
 - 7.4. Потребительская упаковка.
8. Система трансфузионная SFM[®], с портом для дополнительных инъекций, ПК 23-02, в составе:
 - 8.1. Основная часть, в составе:
 - 8.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая полужесткая.
 - 8.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
 - 8.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.
 - 8.1.4. Порт для дополнительных инъекций.
 - 8.1.5. Коннектор типа Луер.
 - 8.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм;

мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.

8.3. Потребительская упаковка.

9. Система трансфузионная SFM[®], с портом для дополнительных инъекций, ПК 11-05, в составе:

9.1. Основная часть, в составе:

9.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная жесткая.

9.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.

9.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.

9.1.4. Порт для дополнительных инъекций.

9.1.5. Коннектор типа Луер-Лок.

9.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.

9.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.

9.4. Потребительская упаковка.

10. Система трансфузионная SFM[®], с портом для дополнительных инъекций, ПК 11-05, в составе:

10.1. Основная часть, в составе:

10.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная жесткая.

10.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.

10.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.

10.1.4. Порт для дополнительных инъекций.

10.1.5. Коннектор типа Луер-Лок.

10.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.

10.3. Потребительская упаковка.

11. Система трансфузионная SFM[®], с портом для дополнительных инъекций, ПК 23-02, в составе:

11.1. Основная часть, в составе:

11.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная полужесткая.

- 11.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
- 11.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.
- 11.1.4. Порт для дополнительных инъекций.
- 11.1.5. Коннектор типа Луер-Лок.
- 11.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.
- 11.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.
- 11.4. Потребительская упаковка.
12. Система трансфузионная SFM[®], с портом для дополнительных инъекций, ПК 23-02, в составе:
 - 12.1. Основная часть, в составе:
 - 12.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная полужесткая.
 - 12.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
 - 12.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.
 - 12.1.4. Порт для дополнительных инъекций.
 - 12.1.5. Коннектор типа Луер-Лок.
 - 12.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.
 - 12.3. Потребительская упаковка.
13. Система трансфузионная SFM[®], с портом для дополнительных инъекций, ПК 11-05, в составе:
 - 13.1. Основная часть, в составе:
 - 13.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая жесткая.
 - 13.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
 - 13.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.
 - 13.1.4. Порт для дополнительных инъекций.
 - 13.1.5. Коннектор типа Луер-Лок.
 - 13.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм.

- мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.
- 13.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.
- 13.4. Потребительская упаковка.
14. Система трансфузионная SFM[®], с портом для дополнительных инъекций, ПК 11-05, в составе:
- 14.1. Основная часть, в составе:
- 14.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая жесткая.
- 14.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
- 14.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.
- 14.1.4. Порт для дополнительных инъекций.
- 14.1.5. Коннектор типа Луер-Лок.
- 14.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.
- 14.3. Потребительская упаковка.
15. Система трансфузионная SFM[®], с портом для дополнительных инъекций, ПК 23-02, в составе:
- 15.1. Основная часть, в составе:
- 15.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая полужесткая.
- 15.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
- 15.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.
- 15.1.4. Порт для дополнительных инъекций.
- 15.1.5. Коннектор типа Луер-Лок.
- 15.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.
- 15.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.
- 15.4. Потребительская упаковка.
16. Система трансфузионная SFM[®], с портом для дополнительных инъекций, ПК 23-02, в составе:

- 16.1. Основная часть, в составе:
 - 16.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая полужесткая.
 - 16.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
 - 16.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.
 - 16.1.4. Порт для дополнительных инъекций.
 - 16.1.5. Коннектор типа Луер-Лок.
 - 16.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.
 - 16.3. Потребительская упаковка.
17. Система трансфузионная SFM[®], с портом для дополнительных инъекций, ПК 11-05, в составе:
 - 17.1. Основная часть, в составе:
 - 17.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная жесткая.
 - 17.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
 - 17.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.
 - 17.1.4. Порт для дополнительных инъекций.
 - 17.1.5. Коннектор типа Луер.
 - 17.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.
 - 17.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.
 - 17.4. Потребительская упаковка.
 18. Система трансфузионная SFM[®], с портом для дополнительных инъекций, ПК 11-05, в составе:
 - 18.1. Основная часть, в составе:
 - 18.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная жесткая.
 - 18.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
 - 18.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.
 - 18.1.4. Порт для дополнительных инъекций.
 - 18.1.5. Коннектор типа Луер.
 - 18.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.

мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.

18.3. Потребительская упаковка.

19. Система трансфузионная SFM[®], с портом для дополнительных инъекций, ПК 23-02, в составе:

19.1. Основная часть, в составе:

19.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная полужесткая.

19.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.

19.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.

19.1.4. Порт для дополнительных инъекций.

19.1.5. Коннектор типа Луер.

19.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.

19.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.

19.4. Потребительская упаковка.

20. Система трансфузионная SFM[®], с портом для дополнительных инъекций, ПК 23-02, в составе:

20.1. Основная часть, в составе:

20.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная полужесткая.

20.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.

20.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.

20.1.4. Порт для дополнительных инъекций.

20.1.5. Коннектор типа Луер.

20.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.

20.3. Потребительская упаковка.

21. Система трансфузионная SFM[®], с портом для дополнительных инъекций, ПК 11-05, в составе:

- 21.1. Основная часть, в составе:
 - 21.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая жесткая.
 - 21.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
 - 21.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.
 - 21.1.4. Порт для дополнительных инъекций.
 - 21.1.5. Коннектор типа Луер.
 - 21.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.
 - 21.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.
 - 21.4. Потребительская упаковка.
22. Система трансфузионная SFM[®], с портом для дополнительных инъекций, ПК 11-05, в составе:
- 22.1. Основная часть, в составе:
 - 22.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая жесткая.
 - 22.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
 - 22.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.
 - 22.1.4. Порт для дополнительных инъекций.
 - 22.1.5. Коннектор типа Луер.
 - 22.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.
 - 22.3. Потребительская упаковка.
23. Система трансфузионная SFM[®], с портом для дополнительных инъекций, ПК 23-02, в составе:
- 23.1. Основная часть, в составе:
 - 23.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая полужесткая.
 - 23.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
 - 23.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.
 - 23.1.4. Порт для дополнительных инъекций.
 - 23.1.5. Коннектор типа Луер.
 - 23.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60

- мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.
- 23.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.
- 23.4. Потребительская упаковка.
24. Система трансфузионная SFM[®], с портом для дополнительных инъекций, ПК 23-02, в составе:
- 24.1. Основная часть, в составе:
- 24.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая полужесткая.
- 24.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
- 24.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.
- 24.1.4. Порт для дополнительных инъекций.
- 24.1.5. Коннектор типа Луер.
- 24.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.
- 24.3. Потребительская упаковка.
25. Система трансфузионная SFM[®], с портом для дополнительных инъекций, ПК 11-05, в составе:
- 25.1. Основная часть, в составе:
- 25.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная жесткая.
- 25.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
- 25.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.
- 25.1.4. Порт для дополнительных инъекций.
- 25.1.5. Коннектор типа Луер-Лок.
- 25.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.
- 25.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.
- 25.4. Потребительская упаковка.

26. Система трансфузионная SFM[®], с портом для дополнительных инъекций, ПК 11-05, в составе:
- 26.1. Основная часть, в составе:
 - 26.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная жесткая.
 - 26.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
 - 26.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.
 - 26.1.4. Порт для дополнительных инъекций.
 - 26.1.5. Коннектор типа Луер-Лок.
 - 26.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.
 - 26.3. Потребительская упаковка.
27. Система трансфузионная SFM[®], с портом для дополнительных инъекций, ПК 23-02, в составе:
- 27.1. Основная часть, в составе:
 - 27.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная полужесткая.
 - 27.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
 - 27.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.
 - 27.1.4. Порт для дополнительных инъекций.
 - 27.1.5. Коннектор типа Луер-Лок.
 - 27.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.
 - 27.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.
 - 27.4. Потребительская упаковка.
28. Система трансфузионная SFM[®], с портом для дополнительных инъекций, ПК 23-02, в составе:
- 28.1. Основная часть, в составе:
 - 28.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная полужесткая.
 - 28.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
 - 28.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.
 - 28.1.4. Порт для дополнительных инъекций.
 - 28.1.5. Коннектор типа Луер-Лок.
 - 28.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.

мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.

28.3. Потребительская упаковка.

29. Система трансфузионная SFM[®], с портом для дополнительных инъекций, ПК 11-05, в составе:

29.1. Основная часть, в составе:

29.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая жесткая.

29.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.

29.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.

29.1.4. Порт для дополнительных инъекций.

29.1.5. Коннектор типа Луер-Лок.

29.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.

29.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.

29.4. Потребительская упаковка.

30. Система трансфузионная SFM[®], с портом для дополнительных инъекций, ПК 11-05, в составе:

30.1. Основная часть, в составе:

30.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая жесткая.

30.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.

30.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.

30.1.4. Порт для дополнительных инъекций.

30.1.5. Коннектор типа Луер-Лок.

30.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.

30.3. Потребительская упаковка.

31. Система трансфузионная SFM[®], с портом для дополнительных инъекций, ПК 23-02, в составе:

31.1. Основная часть, в составе:

31.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая полужесткая.

31.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.

31.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.

31.1.4. Порт для дополнительных инъекций.

31.1.5. Коннектор типа Луер-Лок.

31.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.

31.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.

31.4. Потребительская упаковка.

32. Система трансфузионная SFM[®], с портом для дополнительных инъекций, ПК 23-02, в составе:

32.1. Основная часть, в составе:

32.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая полужесткая.

32.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.

32.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.

32.1.4. Порт для дополнительных инъекций.

32.1.5. Коннектор типа Луер-Лок.

32.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.

32.3. Потребительская упаковка.

IV. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, с портом для дополнительных инъекций, в вариантах исполнения:

1. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, с портом для дополнительных инъекций, ПК 11-05, в составе:

1.1. Основная часть, в составе:

1.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная жесткая.

1.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.

1.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.

1.1.4. Y-порт.

1.1.5. Порт для дополнительных инъекций.

1.1.6. Коннектор типа Луер.

1.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.

1.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.

1.4. Потребительская упаковка.

2. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, с портом для дополнительных инъекций, ПК 11-05, в составе:

2.1. Основная часть, в составе:

2.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная жесткая.

2.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.

2.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.

2.1.4. Y-порт.

2.1.5. Порт для дополнительных инъекций.

2.1.6. Коннектор типа Луер.

2.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.

2.3. Потребительская упаковка.

3. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, с портом для дополнительных инъекций, ПК 23-02, в составе:

3.1. Основная часть, в составе:

3.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная полужесткая.

3.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.

3.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.

3.1.4. Y-порт.

3.1.5. Порт для дополнительных инъекций.

3.1.6. Коннектор типа Луер.

3.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм;

- 0,80 мм х 55,0 мм; 0,90 мм х 38,0 мм; 0,90 мм х 40,0 мм; 0,90 мм х 42,0 мм; 0,90 мм х 45,0 мм; 0,90 мм х 50,0 мм; 0,90 мм х 55,0 мм; 1,10 мм х 40,0 мм; 1,10 мм х 50,0 мм; 1,10 мм х 55,0 мм; 1,20 мм х 40,0 мм; 1,20 мм х 50,0 мм; 1,20 мм х 55,0 мм; 1,40 мм х 40,0 мм; 1,40 мм х 50,0 мм; 1,40 мм х 55,0 мм; 1,60 мм х 40,0 мм; 1,60 мм х 50,0 мм; 1,60 мм х 55,0 мм.
- 3.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.
- 3.4. Потребительская упаковка.
4. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, с портом для дополнительных инъекций, ПК 23-02, в составе:
- 4.1. Основная часть, в составе:
- 4.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная полужесткая.
- 4.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
- 4.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.
- 4.1.4. Y-порт.
- 4.1.5. Порт для дополнительных инъекций.
- 4.1.6. Коннектор типа Луер.
- 4.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм х 12,0 мм; 0,33 мм х 12,0 мм; 0,33 мм х 12,7 мм; 0,40 мм х 12,0 мм; 0,45 мм х 12,0 мм; 0,45 мм х 12,7 мм; 0,45 мм х 16,0 мм; 0,50 мм х 13,0 мм; 0,50 мм х 15,0 мм; 0,50 мм х 16,0 мм; 0,50 мм х 18,0 мм; 0,50 мм х 25,0 мм; 0,60 мм х 25,0 мм; 0,60 мм х 30,0 мм; 0,60 мм х 32,0 мм; 0,60 мм х 42,0 мм; 0,60 мм х 45,0 мм; 0,60 мм х 55,0 мм; 0,70 мм х 30,0 мм; 0,70 мм х 32,0 мм; 0,70 мм х 38,0 мм; 0,70 мм х 40,0 мм; 0,70 мм х 42,0 мм; 0,70 мм х 45,0 мм; 0,70 мм х 50,0 мм; 0,70 мм х 55,0 мм; 0,80 мм х 38,0 мм; 0,80 мм х 40,0 мм; 0,80 мм х 42,0 мм; 0,80 мм х 45,0 мм; 0,80 мм х 50,0 мм; 0,80 мм х 55,0 мм; 0,90 мм х 38,0 мм; 0,90 мм х 40,0 мм; 0,90 мм х 42,0 мм; 0,90 мм х 45,0 мм; 0,90 мм х 50,0 мм; 0,90 мм х 55,0 мм; 1,10 мм х 40,0 мм; 1,10 мм х 50,0 мм; 1,10 мм х 55,0 мм; 1,20 мм х 40,0 мм; 1,20 мм х 50,0 мм; 1,20 мм х 55,0 мм; 1,40 мм х 40,0 мм; 1,40 мм х 50,0 мм; 1,40 мм х 55,0 мм; 1,60 мм х 40,0 мм; 1,60 мм х 50,0 мм; 1,60 мм х 55,0 мм.
- 4.3. Потребительская упаковка.
5. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, с портом для дополнительных инъекций, ПК 11-05, в составе:
- 5.1. Основная часть, в составе:
- 5.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая жесткая.
- 5.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
- 5.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.
- 5.1.4. Y-порт.
- 5.1.5. Порт для дополнительных инъекций.
- 5.1.6. Коннектор типа Луер.
- 5.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм х 12,0 мм; 0,33 мм х 12,0 мм; 0,33 мм х 12,7 мм; 0,40 мм х 12,0 мм; 0,45 мм х 12,0 мм; 0,45 мм х 12,7 мм; 0,45 мм х 16,0 мм; 0,50 мм х 13,0 мм; 0,50 мм х 15,0 мм; 0,50 мм х 16,0 мм; 0,50 мм х 18,0 мм; 0,50 мм х 25,0 мм; 0,60 мм х 25,0 мм; 0,60 мм х 30,0 мм; 0,60 мм х 32,0 мм; 0,60 мм х 42,0 мм; 0,60 мм х 45,0 мм; 0,60 мм х 55,0 мм; 0,70 мм х 30,0 мм; 0,70 мм х 32,0 мм; 0,70 мм х 38,0 мм; 0,70 мм х 40,0 мм; 0,70 мм х 42,0 мм; 0,70 мм х 45,0 мм; 0,70 мм х 50,0 мм; 0,70 мм х 55,0 мм; 0,80 мм х 38,0 мм; 0,80 мм х 40,0 мм; 0,80 мм х 42,0 мм; 0,80 мм х 45,0 мм; 0,80 мм х 50,0 мм; 0,80 мм х 55,0 мм; 0,90 мм х 38,0 мм; 0,90 мм х 40,0 мм; 0,90 мм х 42,0 мм; 0,90 мм х 45,0 мм; 0,90 мм х 50,0 мм; 0,90 мм х 55,0 мм; 1,10 мм х 40,0 мм; 1,10 мм х 50,0 мм; 1,10 мм х 55,0 мм; 1,20 мм х 40,0 мм; 1,20 мм х 50,0 мм; 1,20 мм х 55,0 мм; 1,40 мм х 40,0 мм; 1,40 мм х 50,0 мм; 1,40 мм х 55,0 мм; 1,60 мм х 40,0 мм; 1,60 мм х 50,0 мм; 1,60 мм х 55,0 мм.
- 5.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.
- 5.4. Потребительская упаковка.
6. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, с портом для дополнительных инъекций, ПК 11-

05, в составе:

6.1. Основная часть, в составе:

6.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая жесткая.

6.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.

6.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.

6.1.4. Y-порт.

6.1.5. Порт для дополнительных инъекций.

6.1.6. Коннектор типа Луер.

6.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.

6.3. Потребительская упаковка.

7. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, с портом для дополнительных инъекций, ПК 23-02, в составе:

7.1. Основная часть, в составе:

7.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая полужесткая.

7.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.

7.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.

7.1.4. Y-порт.

7.1.5. Порт для дополнительных инъекций.

7.1.6. Коннектор типа Луер.

7.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.

7.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.

7.4. Потребительская упаковка.

8. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, с портом для дополнительных инъекций, ПК 23-02, в составе:

8.1. Основная часть, в составе:

8.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая полужесткая.

8.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.

8.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.

8.1.4. Y-порт.

8.1.5. Порт для дополнительных инъекций.

8.1.6. Коннектор типа Луер.

- 8.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.
- 8.3. Потребительская упаковка.
9. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, с портом для дополнительных инъекций, ПК 11-05, в составе:
- 9.1. Основная часть, в составе:
- 9.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная жесткая.
- 9.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
- 9.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.
- 9.1.4. Y-порт.
- 9.1.5. Порт для дополнительных инъекций.
- 9.1.6. Коннектор типа Луер-Лок.
- 9.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.
- 9.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.
- 9.4. Потребительская упаковка.
10. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, с портом для дополнительных инъекций, ПК 11-05, в составе:
- 10.1. Основная часть, в составе:
- 10.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная жесткая.
- 10.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
- 10.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.
- 10.1.4. Y-порт.
- 10.1.5. Порт для дополнительных инъекций.
- 10.1.6. Коннектор типа Луер-Лок.
- 10.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.

1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.

10.3. Потребительская упаковка.

11. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, с портом для дополнительных инъекций, ПК 23-02, в составе:

11.1. Основная часть, в составе:

11.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная полужесткая.

11.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.

11.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.

11.1.4. Y-порт.

11.1.5. Порт для дополнительных инъекций.

11.1.6. Коннектор типа Луер-Лок.

11.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.

11.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.

11.4. Потребительская упаковка.

12. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, с портом для дополнительных инъекций, ПК 23-02, в составе:

12.1. Основная часть, в составе:

12.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная полужесткая.

12.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.

12.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.

12.1.4. Y-порт.

12.1.5. Порт для дополнительных инъекций.

12.1.6. Коннектор типа Луер-Лок.

12.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.

12.3. Потребительская упаковка.

13. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, с портом для дополнительных инъекций, ПК 11-05, в составе:

- 13.1. Основная часть, в составе:
 - 13.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая жесткая.
 - 13.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
 - 13.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.
 - 13.1.4. Y-порт.
 - 13.1.5. Порт для дополнительных инъекций.
 - 13.1.6. Коннектор типа Луер-Лок.
 - 13.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.
 - 13.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.
 - 13.4. Потребительская упаковка.
14. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, с портом для дополнительных инъекций, ПК 11-05, в составе:
- 14.1. Основная часть, в составе:
 - 14.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая жесткая.
 - 14.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
 - 14.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.
 - 14.1.4. Y-порт.
 - 14.1.5. Порт для дополнительных инъекций.
 - 14.1.6. Коннектор типа Луер-Лок.
 - 14.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.
 - 14.3. Потребительская упаковка.
15. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, с портом для дополнительных инъекций, ПК 23-02, в составе:
- 15.1. Основная часть, в составе:
 - 15.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая полужесткая.
 - 15.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
 - 15.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.
 - 15.1.4. Y-порт.
 - 15.1.5. Порт для дополнительных инъекций.

15.1.6. Коннектор типа Луер-Лок.

- 15.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.

- 15.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.

- 15.4. Потребительская упаковка.

16. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, с портом для дополнительных инъекций, ПК 23-02, в составе:

- 16.1. Основная часть, в составе:

16.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая полужесткая.

16.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.

16.1.3. Регулятор скорости потока роликового типа.

16.1.4. Y-порт.

16.1.5. Порт для дополнительных инъекций.

16.1.6. Коннектор типа Луер-Лок.

- 16.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.

- 16.3. Потребительская упаковка.

17. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, с портом для дополнительных инъекций, ПК 11-05, в составе:

- 17.1. Основная часть, в составе:

17.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная жесткая.

17.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.

17.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.

17.1.4. Y-порт.

17.1.5. Порт для дополнительных инъекций.

17.1.6. Коннектор типа Луер.

- 17.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм.

- мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.
- 17.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.
- 17.4. Потребительская упаковка.
18. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, с портом для дополнительных инъекций, ПК 11-05, в составе:
- 18.1. Основная часть, в составе:
- 18.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная жесткая.
- 18.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
- 18.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.
- 18.1.4. Y-порт.
- 18.1.5. Порт для дополнительных инъекций.
- 18.1.6. Коннектор типа Луер.
- 18.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.
- 18.3. Потребительская упаковка.
19. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, с портом для дополнительных инъекций, ПК 23-02, в составе:
- 19.1. Основная часть, в составе:
- 19.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная полужесткая.
- 19.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
- 19.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.
- 19.1.4. Y-порт.
- 19.1.5. Порт для дополнительных инъекций.
- 19.1.6. Коннектор типа Луер.
- 19.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.

- 19.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.
 - 19.4. Потребительская упаковка.
20. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, с портом для дополнительных инъекций, ПК 23-02, в составе:
- 20.1. Основная часть, в составе:
 - 20.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная полужесткая.
 - 20.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
 - 20.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.
 - 20.1.4. Y-порт.
 - 20.1.5. Порт для дополнительных инъекций.
 - 20.1.6. Коннектор типа Луер.
 - 20.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.
 - 20.3. Потребительская упаковка.
21. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, с портом для дополнительных инъекций, ПК 11-05, в составе:
- 21.1. Основная часть, в составе:
 - 21.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая жесткая.
 - 21.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
 - 21.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.
 - 21.1.4. Y-порт.
 - 21.1.5. Порт для дополнительных инъекций.
 - 21.1.6. Коннектор типа Луер.
 - 21.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.
 - 21.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.
 - 21.4. Потребительская упаковка.
22. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, с портом для дополнительных инъекций, ПК 11-05, в составе:
- 22.1. Основная часть, в составе:

- 22.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая жесткая.
- 22.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
- 22.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.
- 22.1.4. Y-порт.
- 22.1.5. Порт для дополнительных инъекций.
- 22.1.6. Коннектор типа Луер.
- 22.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.
- 22.3. Потребительская упаковка.
- 23. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, с портом для дополнительных инъекций, ПК 23-02, в составе:
 - 23.1. Основная часть, в составе:
 - 23.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая полужесткая.
 - 23.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
 - 23.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.
 - 23.1.4. Y-порт.
 - 23.1.5. Порт для дополнительных инъекций.
 - 23.1.6. Коннектор типа Луер.
 - 23.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.
 - 23.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.
 - 23.4. Потребительская упаковка.
- 24. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, с портом для дополнительных инъекций, ПК 23-02, в составе:
 - 24.1. Основная часть, в составе:
 - 24.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая полужесткая.
 - 24.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
 - 24.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.
 - 24.1.4. Y-порт.
 - 24.1.5. Порт для дополнительных инъекций.
 - 24.1.6. Коннектор типа Луер.

- 24.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.

24.3. Потребительская упаковка.

25. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, с портом для дополнительных инъекций, ПК 11-05, в составе:

25.1. Основная часть, в составе:

25.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная жесткая.

25.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.

25.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.

25.1.4. Y-порт.

25.1.5. Порт для дополнительных инъекций.

25.1.6. Коннектор типа Луер-Лок.

- 25.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.

25.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.

25.4. Потребительская упаковка.

26. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, с портом для дополнительных инъекций, ПК 11-05, в составе:

26.1. Основная часть, в составе:

26.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная жесткая.

26.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.

26.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.

26.1.4. Y-порт.

26.1.5. Порт для дополнительных инъекций.

26.1.6. Коннектор типа Луер-Лок.

- 26.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x

50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.

26.3. Потребительская упаковка.

27. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, с портом для дополнительных инъекций, ПК 23-02, в составе:

27.1. Основная часть, в составе:

27.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная полужесткая.

27.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.

27.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.

27.1.4. Y-порт.

27.1.5. Порт для дополнительных инъекций.

27.1.6. Коннектор типа Луер-Лок.

27.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.

27.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.

27.4. Потребительская упаковка.

28. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, с портом для дополнительных инъекций, ПК 23-02, в составе:

28.1. Основная часть, в составе:

28.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом стандартная полужесткая.

28.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.

28.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.

28.1.4. Y-порт.

28.1.5. Порт для дополнительных инъекций.

28.1.6. Коннектор типа Луер-Лок.

28.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.

28.3. Потребительская упаковка.

29. Система трансфузионная SFM®, с Y-портом, с портом для дополнительных инъекций, ПК 11-05, в составе:
- 29.1. Основная часть, в составе:
 - 29.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая жесткая.
 - 29.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
 - 29.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.
 - 29.1.4. Y-порт.
 - 29.1.5. Порт для дополнительных инъекций.
 - 29.1.6. Коннектор типа Луер-Лок.
 - 29.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.
 - 29.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.
 - 29.4. Потребительская упаковка.
30. Система трансфузионная SFM®, с Y-портом, с портом для дополнительных инъекций, ПК 11-05, в составе:
- 30.1. Основная часть, в составе:
 - 30.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая жесткая.
 - 30.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
 - 30.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.
 - 30.1.4. Y-порт.
 - 30.1.5. Порт для дополнительных инъекций.
 - 30.1.6. Коннектор типа Луер-Лок.
 - 30.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.
 - 30.3. Потребительская упаковка.
31. Система трансфузионная SFM®, с Y-портом, с портом для дополнительных инъекций, ПК 23-02, в составе:
- 31.1. Основная часть, в составе:
 - 31.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая полужесткая.
 - 31.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
 - 31.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.

- 31.1.4. Y-порт.
- 31.1.5. Порт для дополнительных инъекций.
- 31.1.6. Коннектор типа Луер-Лок.
- 31.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.
- 31.3. Фиксирующая повязка, шириной от 0,5 см до 15 см с шагом 0,5 см, длиной от 1 см до 12 см с шагом 0,5 см.
- 31.4. Потребительская упаковка.
- 32. Система трансфузионная SFM[®], с Y-портом, с портом для дополнительных инъекций, ПК 23-02, в составе:
 - 32.1. Основная часть, в составе:
 - 32.1.1. Капельница с фильтром с пластиковым шипом большая полужесткая.
 - 32.1.2. Трубка, диаметр внешний от 2,4 мм до 4,3 мм с шагом 0,1 мм, длина от 1000 мм до 3000 мм с шагом 50 мм.
 - 32.1.3. Регулятор скорости потока барабанного типа.
 - 32.1.4. Y-порт.
 - 32.1.5. Порт для дополнительных инъекций.
 - 32.1.6. Коннектор типа Луер-Лок.
 - 32.2. Игла инъекционная, в вариантах исполнения: 0,30 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,0 мм; 0,33 мм x 12,7 мм; 0,40 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,0 мм; 0,45 мм x 12,7 мм; 0,45 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 13,0 мм; 0,50 мм x 15,0 мм; 0,50 мм x 16,0 мм; 0,50 мм x 18,0 мм; 0,50 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 25,0 мм; 0,60 мм x 30,0 мм; 0,60 мм x 32,0 мм; 0,60 мм x 42,0 мм; 0,60 мм x 45,0 мм; 0,60 мм x 55,0 мм; 0,70 мм x 30,0 мм; 0,70 мм x 32,0 мм; 0,70 мм x 38,0 мм; 0,70 мм x 40,0 мм; 0,70 мм x 42,0 мм; 0,70 мм x 45,0 мм; 0,70 мм x 50,0 мм; 0,70 мм x 55,0 мм; 0,80 мм x 38,0 мм; 0,80 мм x 40,0 мм; 0,80 мм x 42,0 мм; 0,80 мм x 45,0 мм; 0,80 мм x 50,0 мм; 0,80 мм x 55,0 мм; 0,90 мм x 38,0 мм; 0,90 мм x 40,0 мм; 0,90 мм x 42,0 мм; 0,90 мм x 45,0 мм; 0,90 мм x 50,0 мм; 0,90 мм x 55,0 мм; 1,10 мм x 40,0 мм; 1,10 мм x 50,0 мм; 1,10 мм x 55,0 мм; 1,20 мм x 40,0 мм; 1,20 мм x 50,0 мм; 1,20 мм x 55,0 мм; 1,40 мм x 40,0 мм; 1,40 мм x 50,0 мм; 1,40 мм x 55,0 мм; 1,60 мм x 40,0 мм; 1,60 мм x 50,0 мм; 1,60 мм x 55,0 мм.
 - 32.3. Потребительская упаковка.

Urkundenrolle-Nr.

379/2021

Vorstehende, vor mir vollzogene Unterschrift der

Frau Vera Lindner, geb. am 25.05.1961,

wohnhaft: Friedenstr. 6, 15713 Königs Wusterhausen OT Niederlehme,

ausgewiesen durch Vorlage eines gültigen Personaldokumentes mit Lichtbild,
beglaubige ich hiermit.

Der Notar fragte die Erschienene, ob er oder eine der mit ihm beruflich verbundenen
Personen in der Angelegenheit, die Gegenstand dieser Beglaubigung ist, außerhalb
des Notaramtes tätig war oder ist. Die Frage wurde verneint.

Der Notar wies die Erschienene darauf hin, dass die Daten der Beteiligten in
Übereinstimmung mit den datenschutzrechtlichen Bestimmungen beim Notar
gespeichert und bearbeitet werden.

Die Erschienene erklärte, dass gegen die Speicherung der Daten keine Einwände
bestehen.

Die Notwendigkeit der Unterschriftsbeglaubigung sowie der Verwendungszweck der
Urkunde wurden mir, dem Notar, glaubhaft gemacht. Vom Inhalt des Dokuments
selbst konnte ich mich nicht unterrichten, da ich die Sprache des Dokuments nicht
beherrsche. Die Beglaubigung bezieht sich nicht auf die Richtigkeit des Dokumentes,
sondern auf die vor mir anerkannte Unterschrift.

Berlin 02.08.2021

Notar





Номер в реестре нотариальных действий 379/2021

Настоящим я свидетельствую подлинность проставленной в моем присутствии подписи

г-жи Веры Линднер, дата рождения: 25.05.1961

**адрес места жительства: Фриденштрассе, д. 6, 15713 Кёнигс Вустерхаузен, ОТ
Нидерлейме**

личность которой была установлена на основании предъявленного действующего удостоверения личности с фотографией.

Нотариус задал лицу, обратившемуся за совершением нотариального действия, вопрос о том, не выступал ли он или другие лица, связанные с ним в рамках профессиональной деятельности, в качестве, отличном от нотариуса, в отношении предмета настоящего нотариального действия, на что указанное лицо ответило отрицательно.

Нотариус уведомил лицо, обратившееся за совершением нотариального действия, что данные участвующих сторон будут сохранены и обработаны в соответствии с правилами защиты данных у нотариуса.

Лицо, обратившееся за совершением нотариального действия, заявило, что не возражает против хранения данных.

Я, нотариус, убедился в необходимости удостоверения подписи и цели документа. Мне неизвестно содержание документа, так как я не владею языком, на котором составлен настоящий документ. Заверение относится не к верности документа, а к удостоверенной мной подписи.

Берлин, 02 августа 2021 г.

/подписано/

Ральф Траутманн

Нотариус

Гербовая печать: /Нотариус г. Берлин * Ральф Траутманн/

Тисненая печать: /Нотариус г. Берлин * Ральф Траутманн/

Перевод выполнил переводчик Лисицкая Дарья Юрьевна

Лисицкая Дарья Юрьевна

Российская Федерация

Город Москва.

Девятого августа две тысячи двадцать первого года.

Я, Жлобо Игорь Геннадьевич, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Лисицкой Дарьи Юрьевны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 50/372-н/77-2021- 20-250.

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.



И.Г. Жлобо

Всего прошнуровано, пронумеровано и

скреплено печатью

42 (сорок два)

лист(-а, -ов)

Нотариус

[Signature]