

Дополнение к фотографическим изображениям на медицинское изделие

«Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas c 311, Cobas c 111, Cobas c 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000»

производства

«Рош Диагностикас ГмбХ» («Roche Diagnostics GmbH»), Германия

ООО «Рош Диагностика Рус»

Россия, 115114, Москва
ул. Летниковская, дом 2, стр. 2
Бизнес-центр "Вивальди Плаза"

Тел.: +7 (495) 229 69 99
Факс: +7 (495) 229 62 64

www.roche.ru



Roche Diagnostics Rus LLC

2, Letnikovskaya street, bld.2
Business Center "Vivaldi Plaza"
115114, Moscow, Russia



Tel.: +7 (495) 229 69 99
Fax: +7 (495) 229 62 64

www.roche.ru

133. Калибратор для автоматизированных систем (Calibrator for automated systems (C.f.a.s.)). Общий вид.

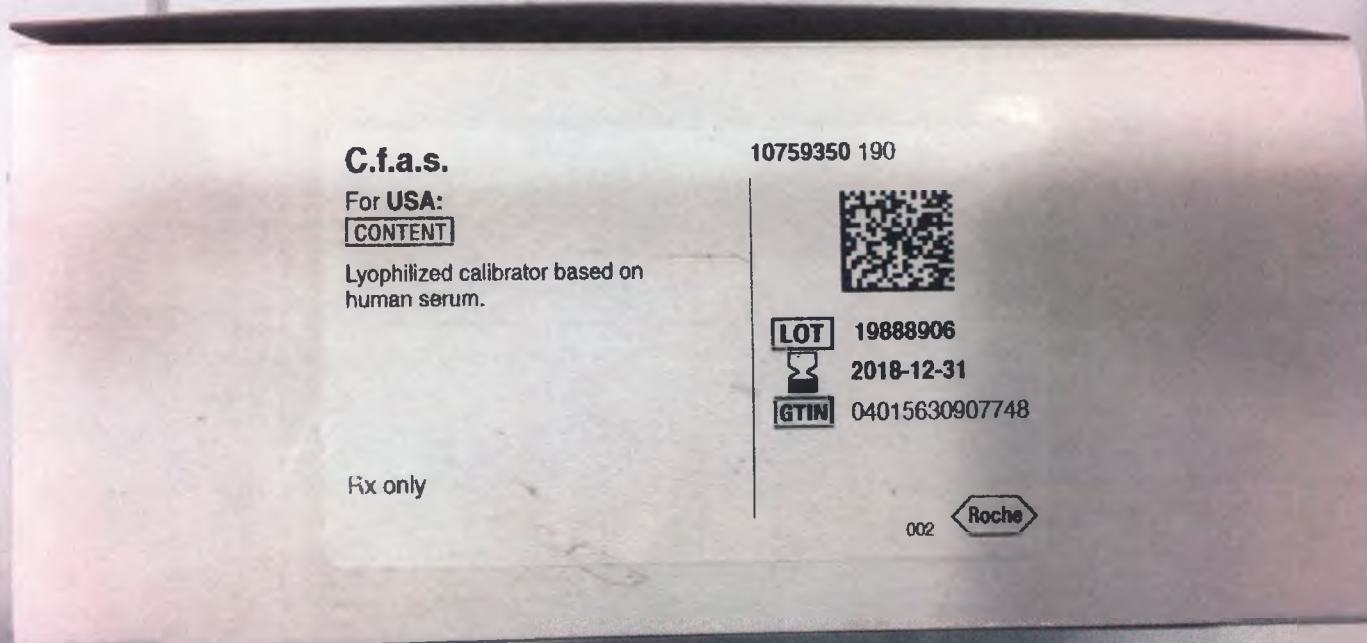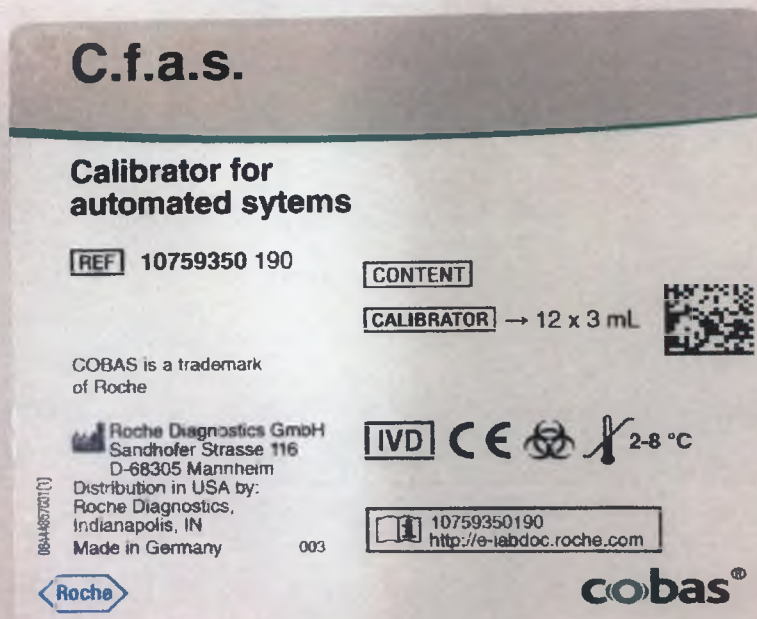

133. Калибратор для автоматизированных систем (Calibrator for automated systems (C.f.a.s.)). Флакон с калибратором.

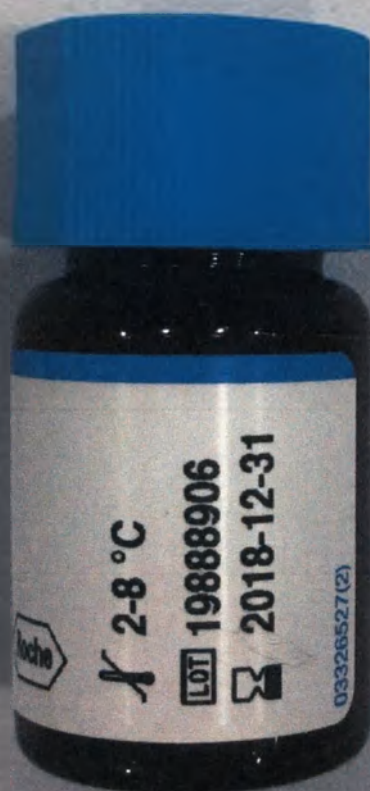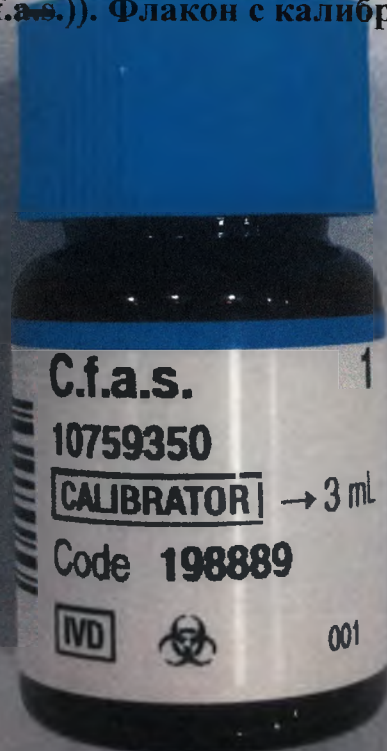

133. Калибратор для автоматизированных систем (Calibrator for automated systems (C.f.a.s.)). Маркировка на русском языке.

Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas c 311, Cobas c 111, Cobas c 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000

Калибратор для автоматизированных систем (Calibrator for automated systems (C.f.a.s.)).

Регистрационное удостоверение № 2010/07525 от 28.06.2018

Срок годности см. на упаковке (максимальный срок годности – 24 месяца. Дату производства см. в сертификате анализа (по запросу))

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностика ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, D- 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in-vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99,

факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception_dis@roche.com

Кат. номер 10759350190

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

177. Контроль универсальный Г (20x5 мл) (PreciControl ClinChem Multi 1 (20x5 ml)). Общий вид.

PreciControl ClinChem Multi 1

Roche systems

REF 05117003 190

CONTENT


CONTROL → 20 x 5 mL



COBAS is a trademark
of Roche

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
D-68305 Mannheim

Distribution in USA by:
Roche Diagnostics, Indianapolis, IN
Made in Germany



05117003190
<http://e-labdoc.roche.com>

001



cobas®

PreciControl ClinChem Multi 1


05117003 190

LOT 16040101



2019-06-30

GTIN 04015630925643

002



177. Контроль универсальный I (20x5 мл) (PreciControl ClinChem Multi 1 (20x5 ml)). Флакон с контрольным материалом.

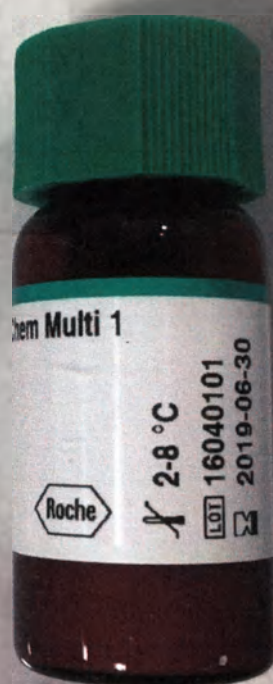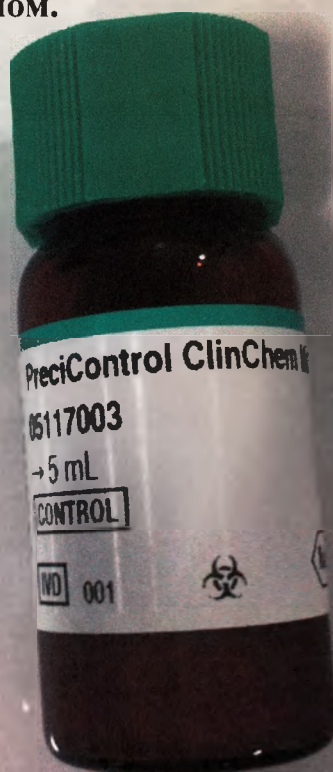

177. Контроль универсальный I (20x5 мл) (PreciControl ClinChem Multi 1 (20x5 ml)). Маркировка на русском языке.

Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas c 311, Cobas c 111, Cobas c 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000

Контроль универсальный I (20x5 мл) (PreciControl ClinChem Multi 1 (20x5 ml))

Регистрационное удостоверение № 2010/07525 от _____

Срок годности см. на упаковке (максимальный срок годности – 36 месяцев. Дату производства см. в сертификате анализа (по запросу))

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностикас ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, D- 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in-vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99.

факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception_dia@roche.com

Кат. номер 05117003190

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

178. Контроль универсальный II (20x5 мл) (PeciControl ClinChem Multi 2 (20x5 ml)). Общий вид.

PeciControl ClinChem Multi 2

Roche systems

REF 05117216 190

CONTENT

CONTROL → 20 x 5 mL

COBAS is a trademark
of Roche

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 118
D-68305 Mannheim

Distribution in USA by:
Roche Diagnostics, Indianapolis, IN
Made in Germany 001

IVD CE  2-8 °C

05117216190
<http://e-labdoc.roche.com>



cobas®

PeciControl ClinChem Multi 2

05117216 190


LOT 16038602



2019-08-31

GTIN 04015630925667

001



178. Контроль универсальный II (20x5 мл) (PreciControl ClinChem Multi 2 (20x5 ml)). Флакон с контрольным материалом.



Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы
биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas c
311, Cobas c 111, Cobas c 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформы
модульных MODULAR ANALYTICS, Cobas 6000
Контроль универсальный II (20x5 мл) (PaciiControl ClinChem Multi 2 (20x5
Регистрационное удостоверение № 2010/07525 от _____
Срок годности см. на упаковке (максимальный срок годности – 36 месяцев, Дату
производства см. в сертификате анализа (по запросу))
Температура хранения см. на упаковке
Номер лота см. на упаковке
Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностикас ГмбХ"), Sandhofer
Strasse 116, D-68305 Mannheim, Germany, Германия
Изделие предназначено только для диагностики in-vitro
Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с
ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика
Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел. +7 495 229-69-99,
факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception_dia@roche.com
Кат. номер 05117216190
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют



Лучинский А.
Руководитель отдела Логистики
и качества доставки от:

02 ИЮЛ 2018