

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
медицинского изделия
для диагностики in vitro

**«Центрифуга для карт гелевых Across для in vitro иммуногематологических
исследований методом колоночной агглютинации»
производства**

Dia Pro Tıbbi Ürünler San. Ve Tic. A.Ş. (Диа Про Тибби Урюнлер Сан. Ве Тик. А.С.), Турция

Утверждено:

Полное имя: Мокеев Д.В.

Должность: Генеральный директор ООО «Адвенсум»


Название компании: ООО «Адвенсум»

Подпись:


Дата:

Печать:



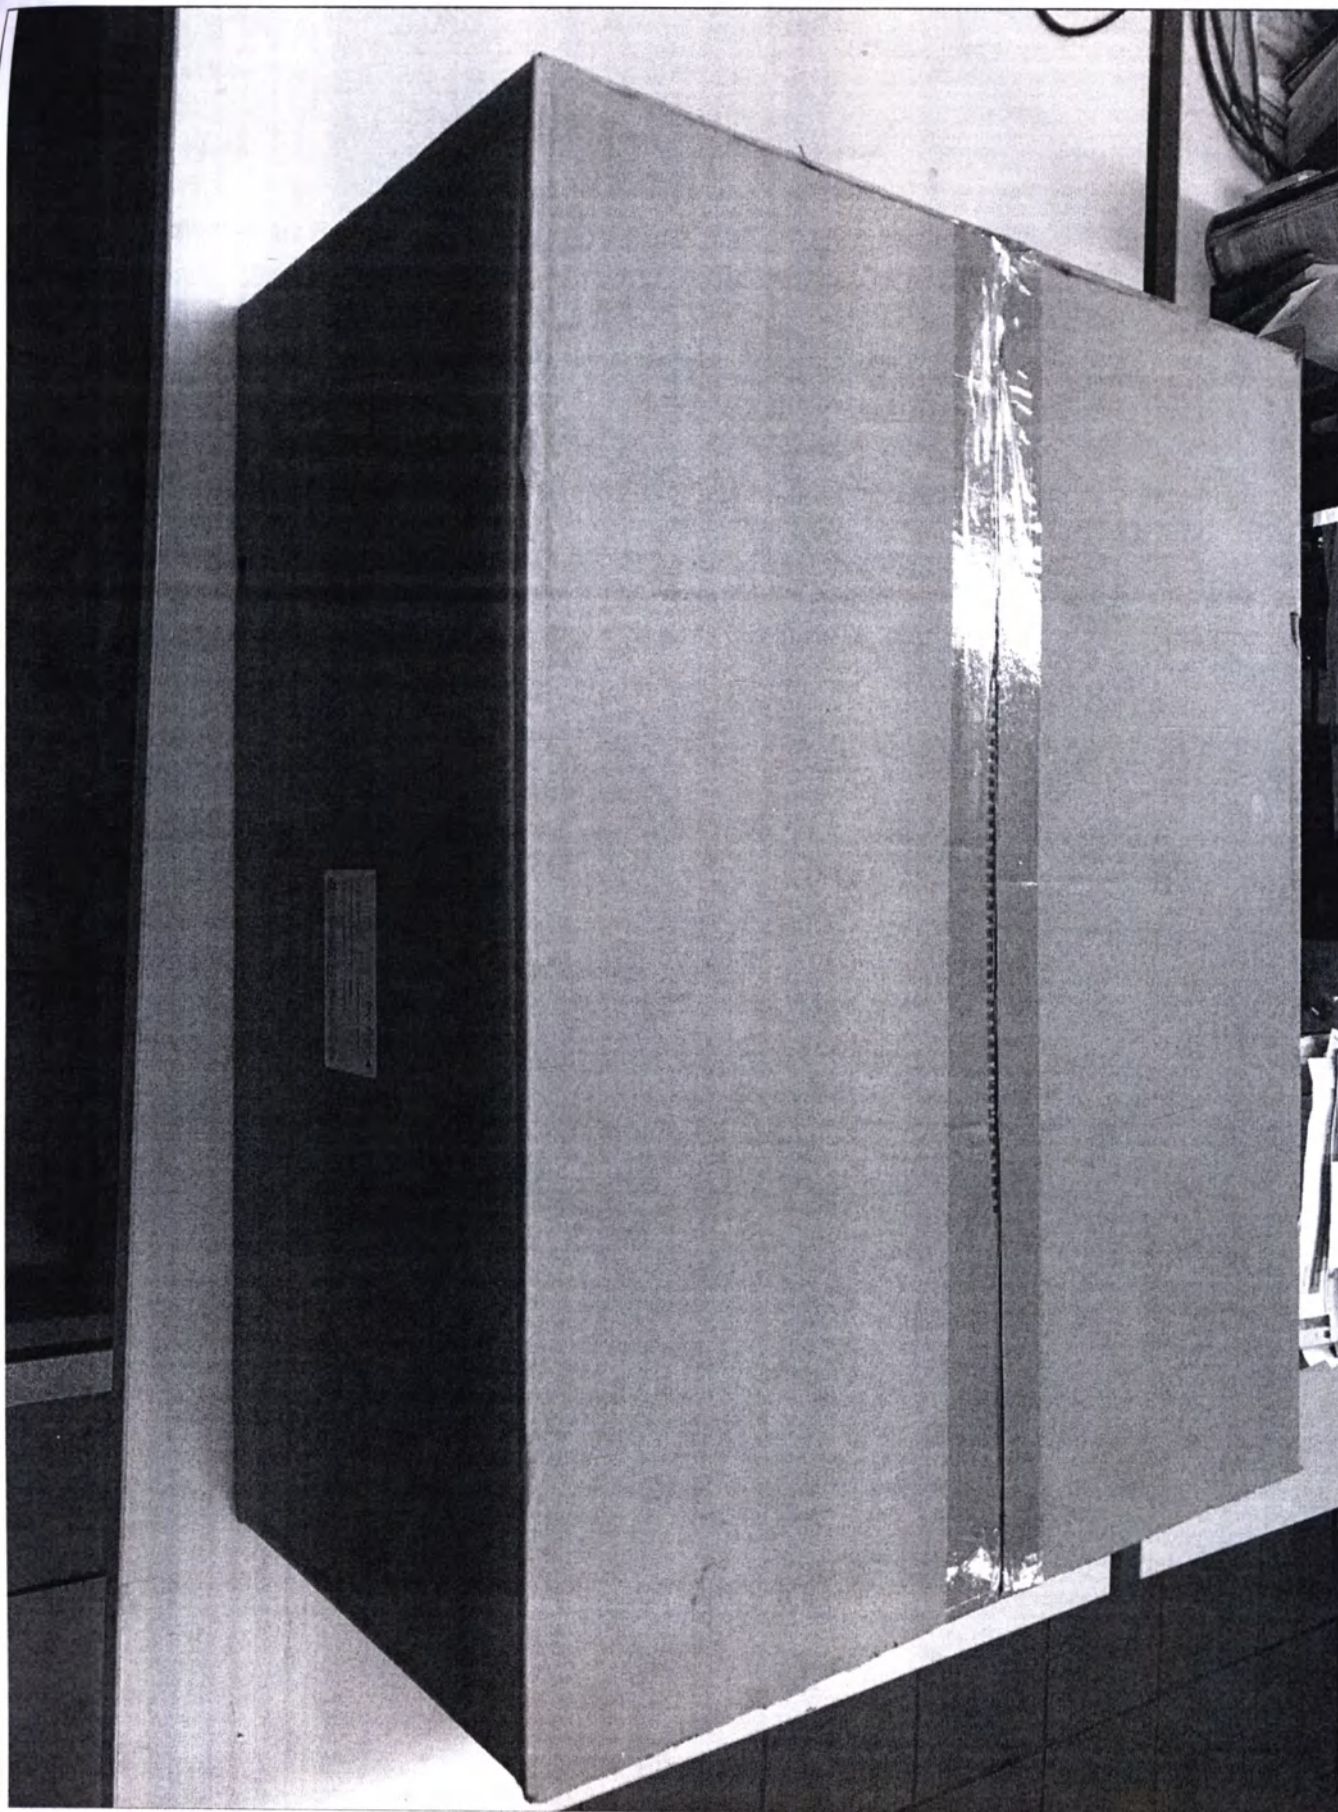

Групповая упаковка медицинского изделия «Центрифуга для карт гелевых Across для in vitro иммуногематологических исследований методом колоночной агглютинации»

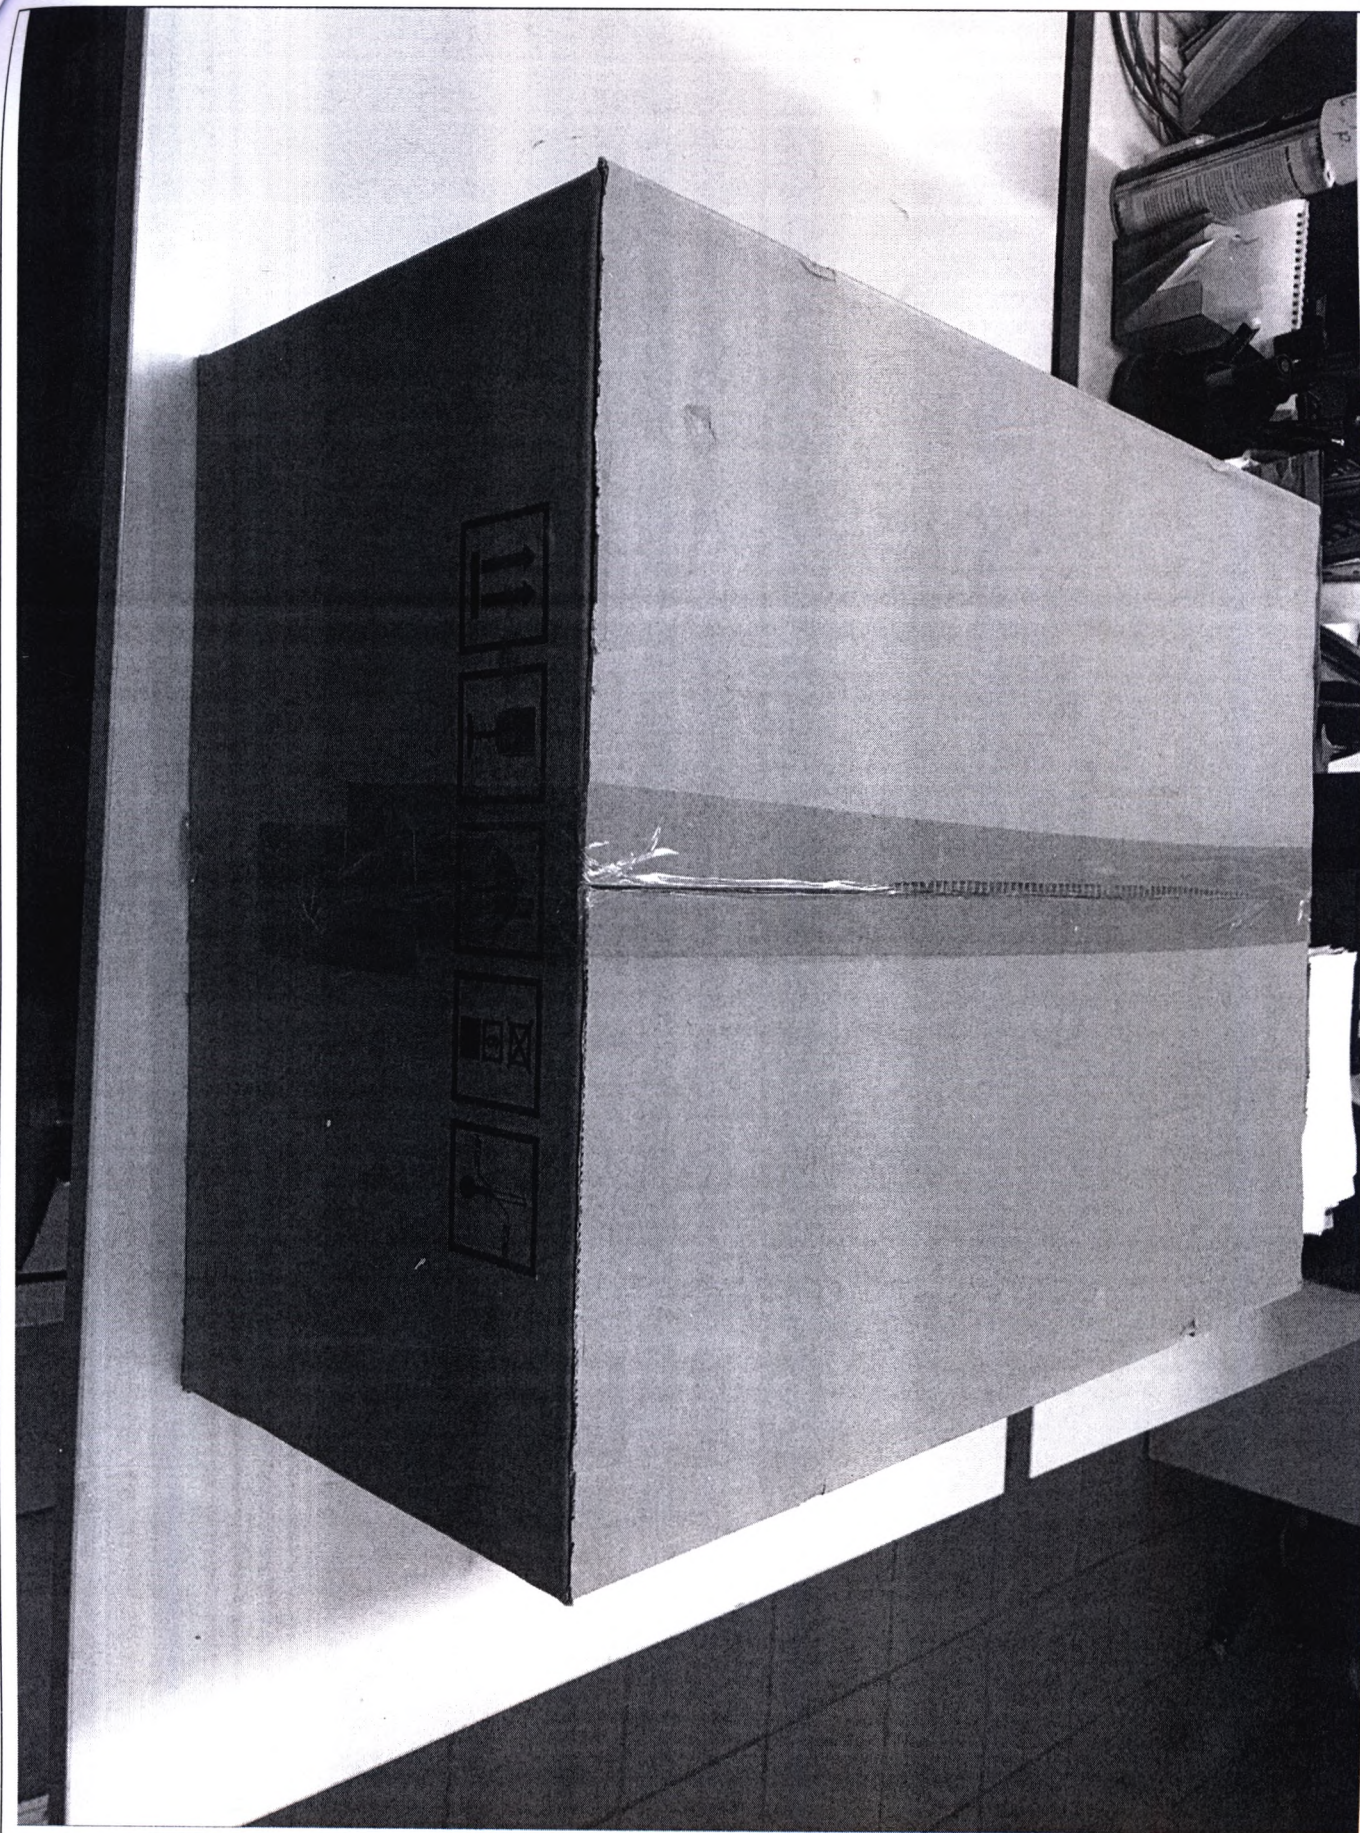

Групповая упаковка медицинского изделия «Центрифуга для карт гелевых Across для in vitro иммуногематологических исследований методом колоночной агглютинации»

Dia Pro ▼

Ürün Adı / Product Name : Across System Card Centrifuge

Referans Numarası / Reference Number: 900100

Seri Numarası / Serial Number : AS-CI-2016

 Dia Pro Tıbbi Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Fabrika: İnönü Mah. Gebze Plastikçiler OSB Atatürk Biv. No:25/1 Gebze/Kocaeli/Türkiye

Merkez: Barbaros Mah. Tophaneliöğlü Cad. Işık Apt. No:70/1 Üsküdar/İstanbul/Türkiye


www.diaapro.com.tr

► TK0809/01


Маркировка на групповой упаковке медицинского изделия «Центрифуга для карт гелевых Across для in vitro иммуногематологических исследований методом колоночной агглютинации»



Общий вид медицинского изделия «Центрифуга для карт гелевых Across для in vitro иммуногематологических исследований методом колоночной агглютинации»

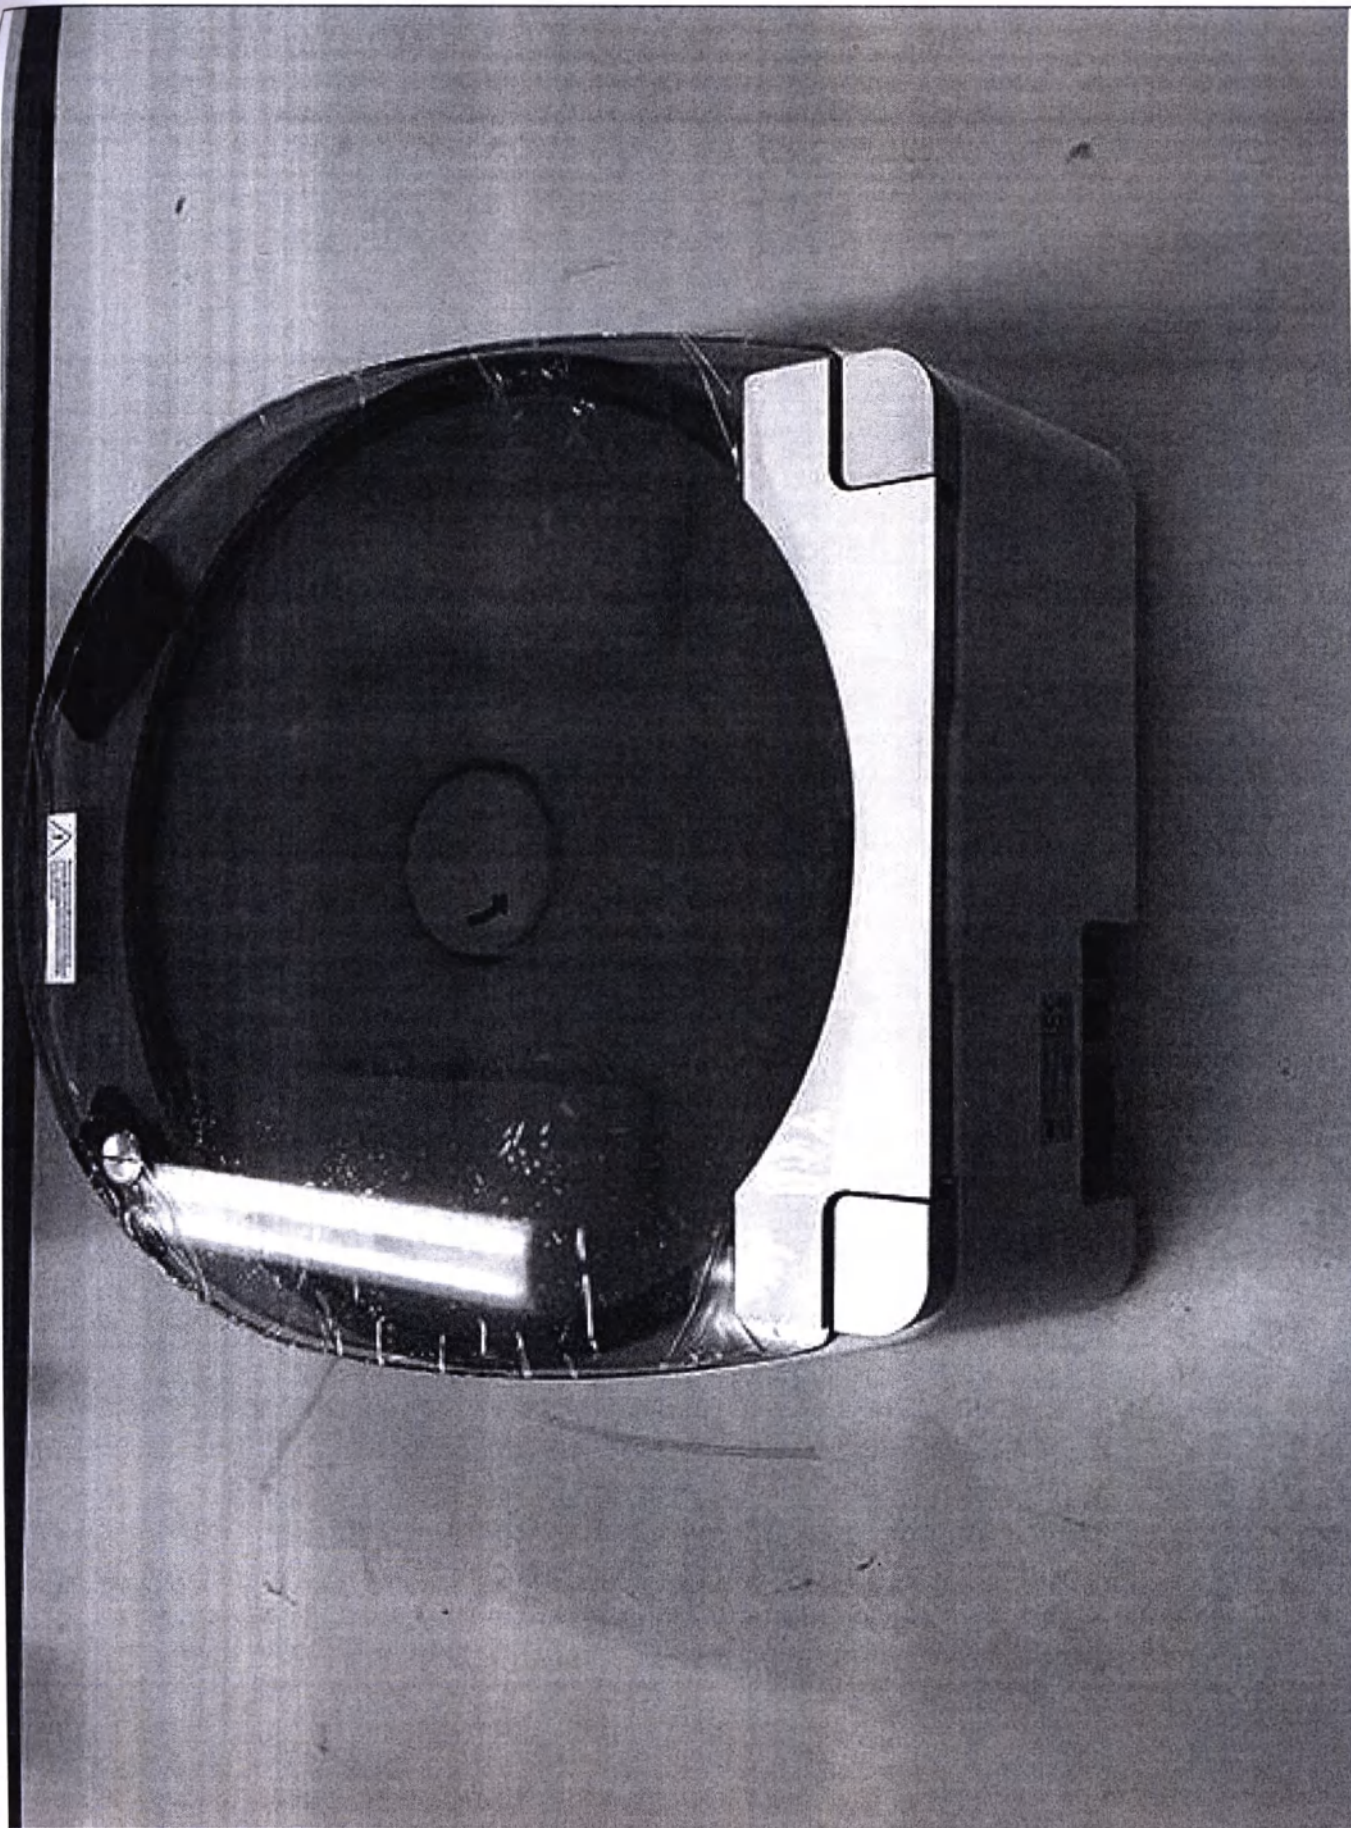

Центрифуга для карт гелевых Across для *in vitro* иммуногематологических исследований методом колоночной агглютинации

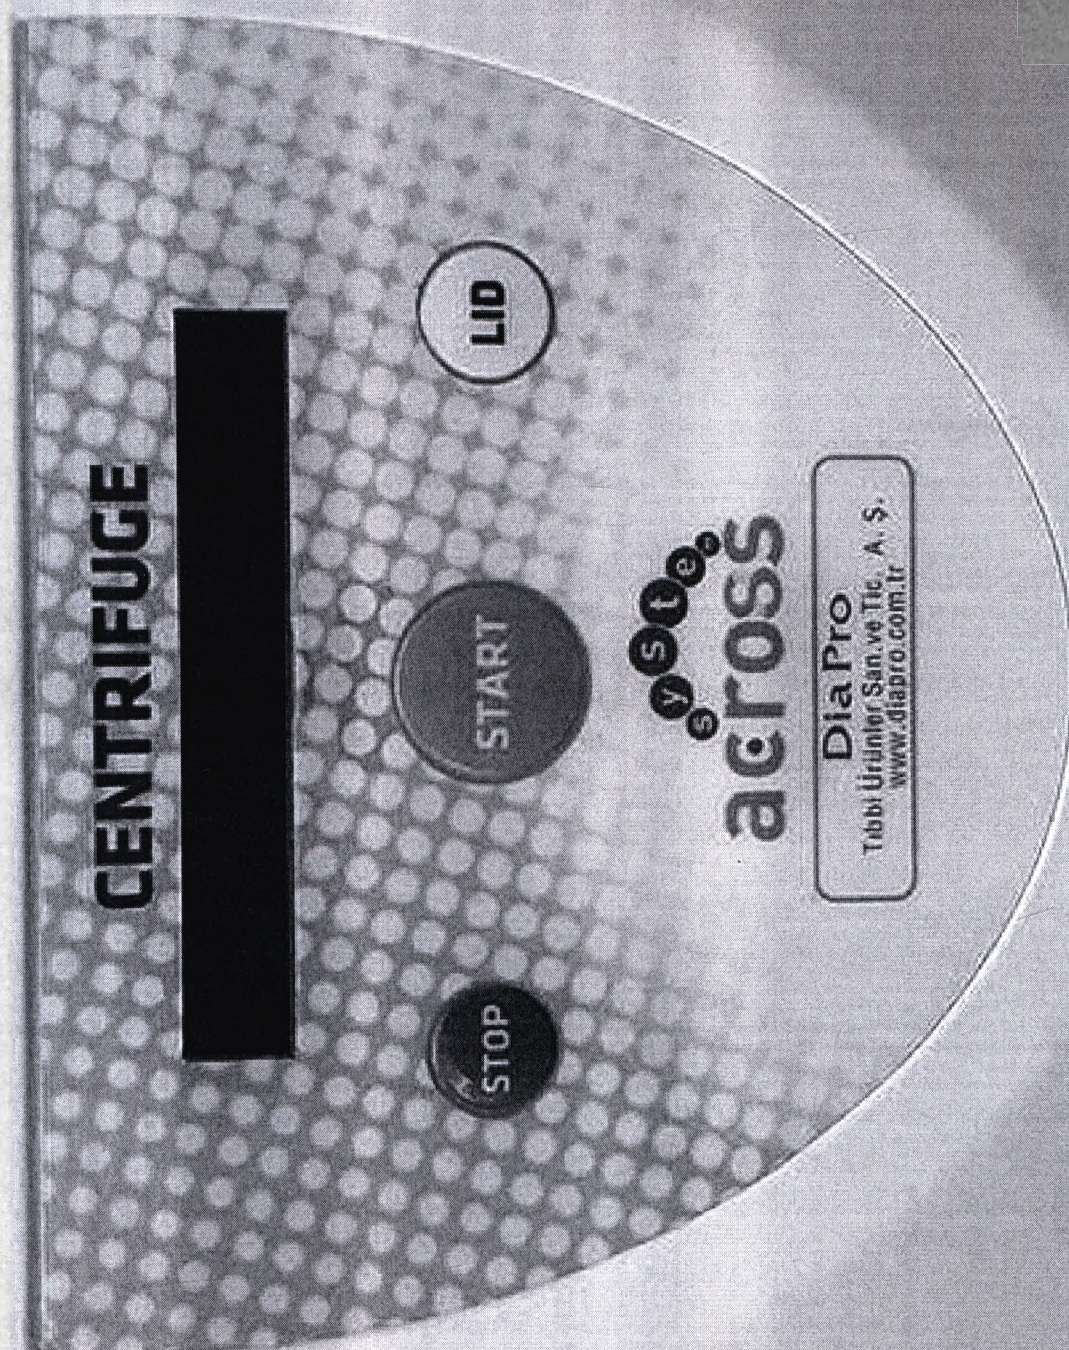


Маркировка медицинского изделия «Центрифуга для карт гелевых Across для in vitro иммуногематологических исследований методом колоночной агглютинации»




DiaPro Tıbbi Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İnönü Mah. Gebze Plastikçiler OSB
Atatürk Blv. No:25 / 1
Gebze / Kocaeli / Türkiye

Across System Card Centrifuge



AS-CI-2018



2018



KLAS VITE
DIAGNOSTIC

REF 900100

AC 100-240V


50-60 Hz

85W

F2A 250V

TK0405/00

Маркировка медицинского изделия «Центрифуга для карт гелевых Across для in vitro иммуногематологических исследований методом колоночной агглютинации»

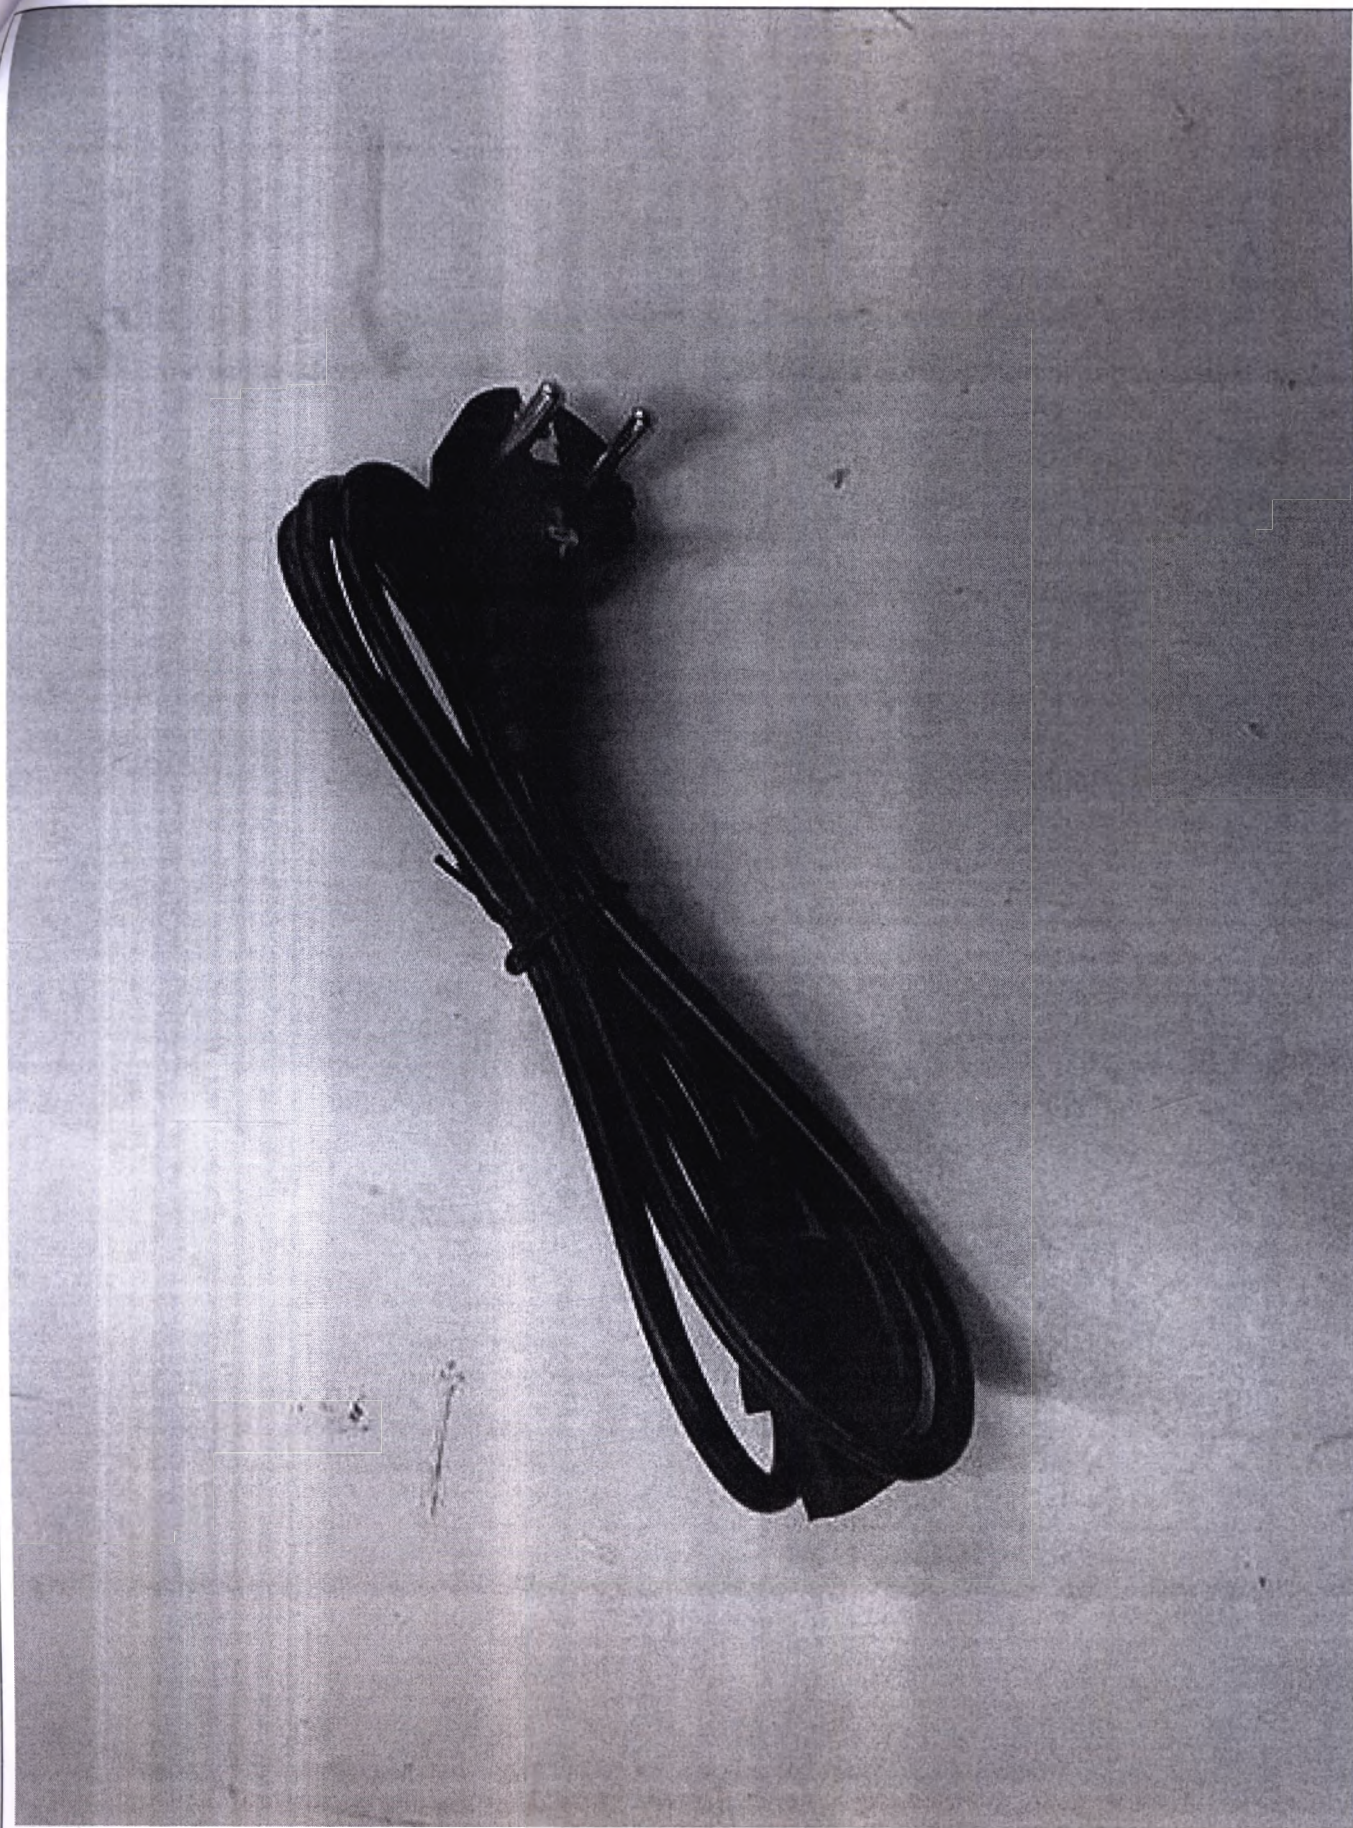

Шнур питания

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
медицинского изделия
для диагностики in vitro

«Центрифуга для карт гелевых Across для in vitro иммуногематологических исследований методом колоночной агглютинации»

производства
Dia Pro Tibbi Ürünler San. Ve Tic. A.Ş. (Диа Про Тибби Урюнлер Сан. Ве Тик. А.С.),
Турция

Руководство пользователя

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 10
(десять) л.

Генеральный директор
ООО «Адвенсум» _____ Д.В. Мокеев

