

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

(Адаптер для взятия и посева крови одноразового использования, производства SARSTEDT AG & Co. KG («САРШТЕДТ АГ & Ко. КГ», Германия))



Рис 1. Переходник мульти-адаптер

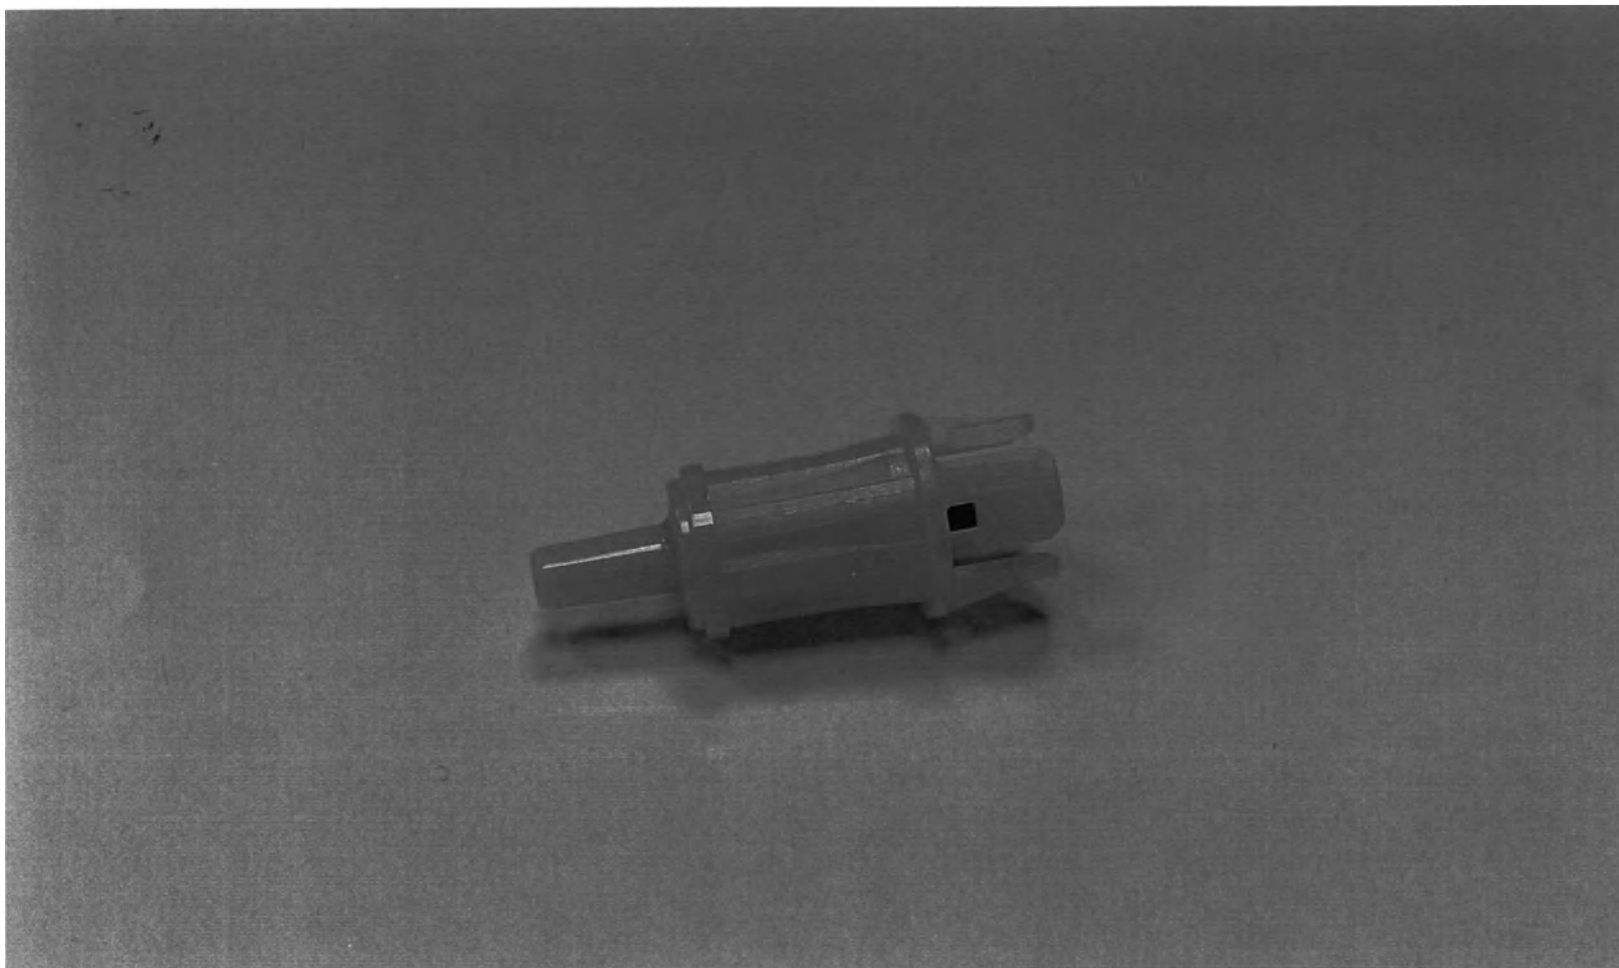


Рис 2. Переходник мульти-адаптер с укороченным наконечником

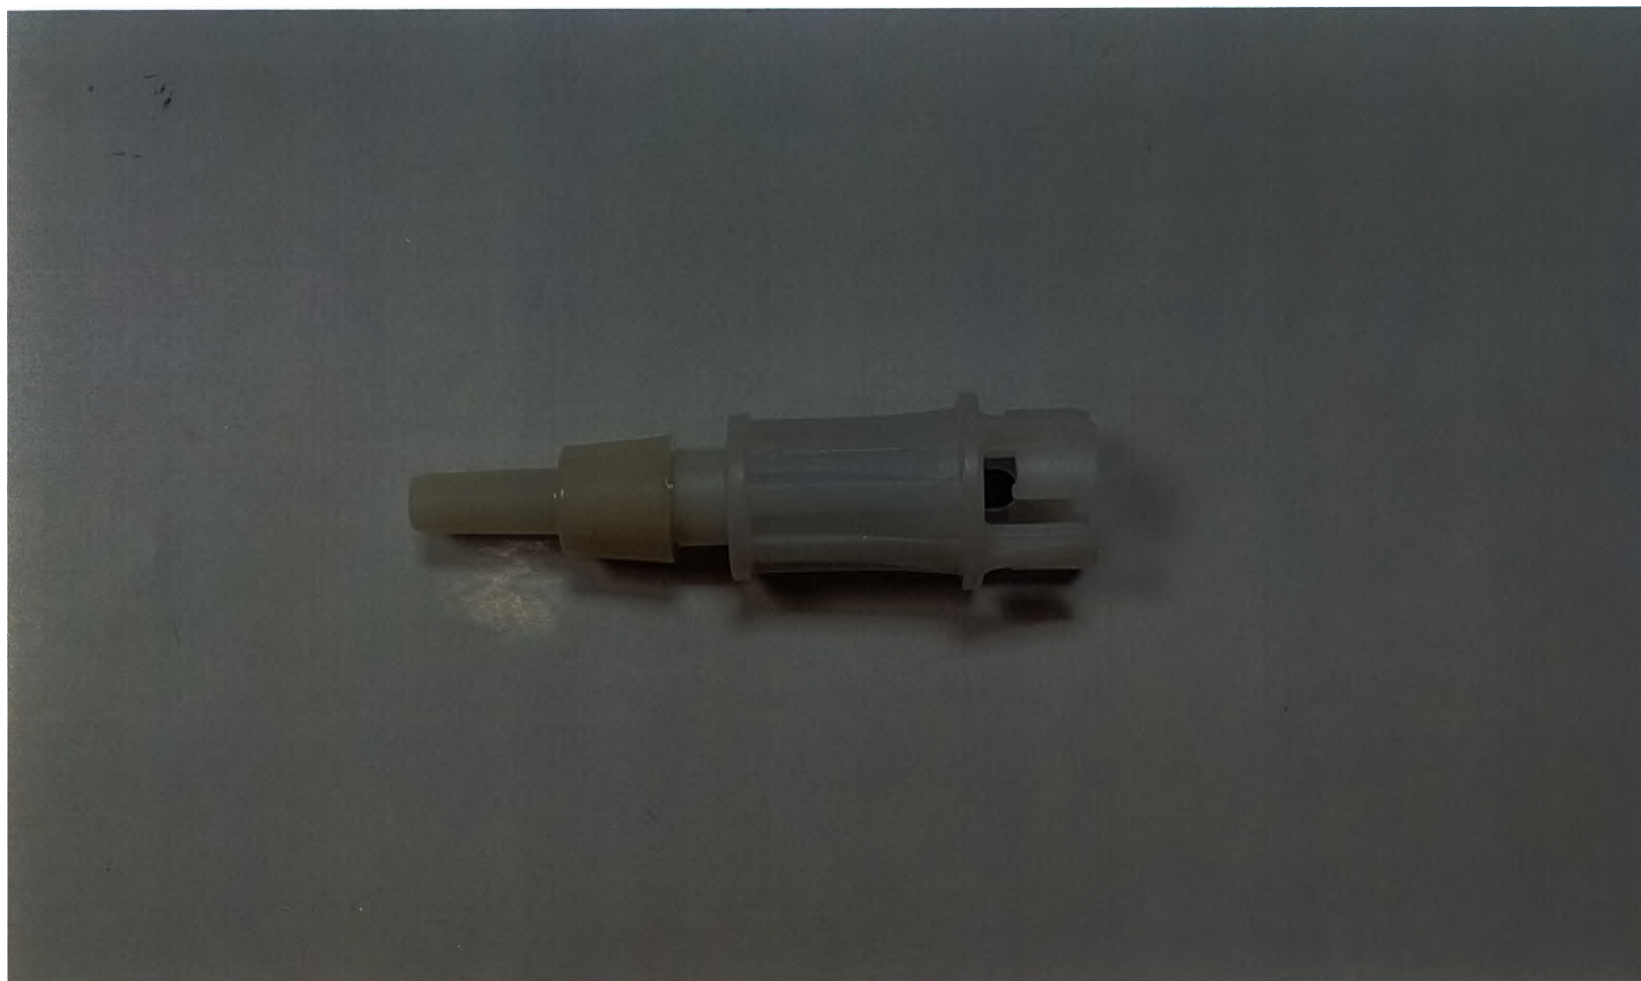


Рис 3. Переходник мульти-адаптер с отщипывающимся наконечником



Рис 4. Переходник мульти-адаптер с Луер-Лок



Рис 5. Переходник (адаптер) мембранный



Рис 6. Переходник (адаптер) мембранный для держателя вакуумных пробирок



Рис 7. Переходник (адаптер) для посева крови универсальный

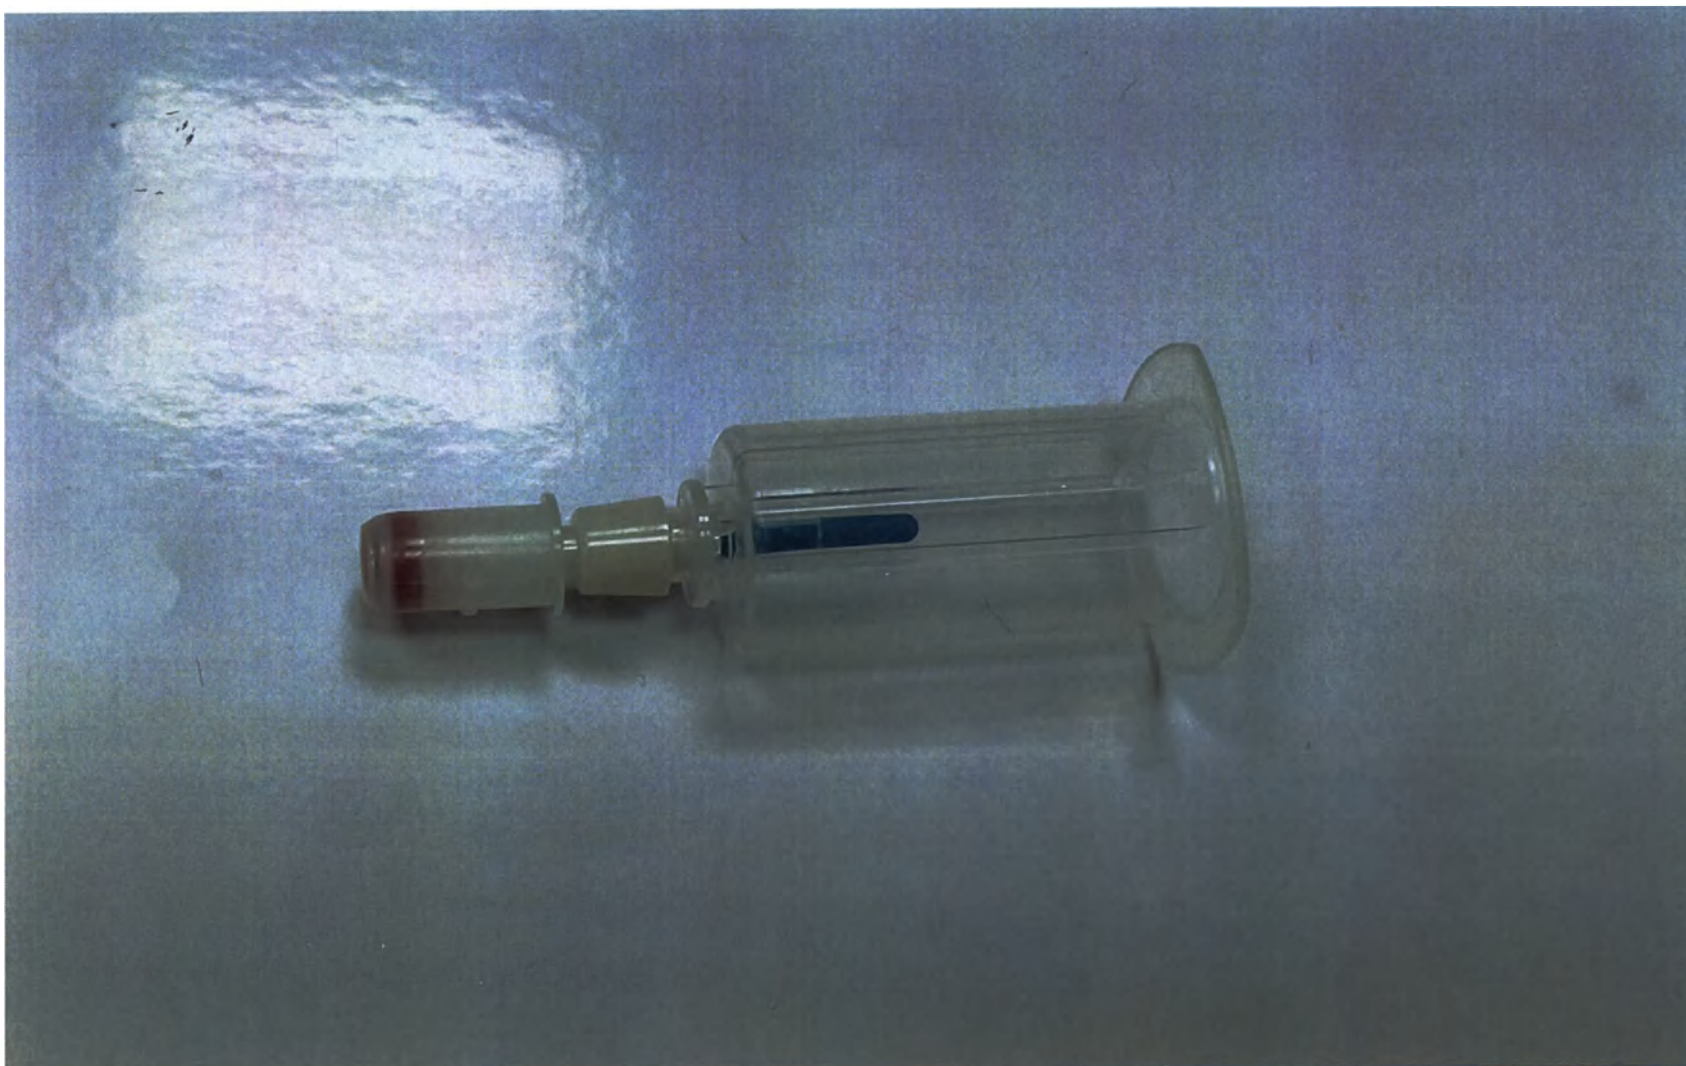


Рис 8. Переходник (адаптер) для посева крови LongNeck

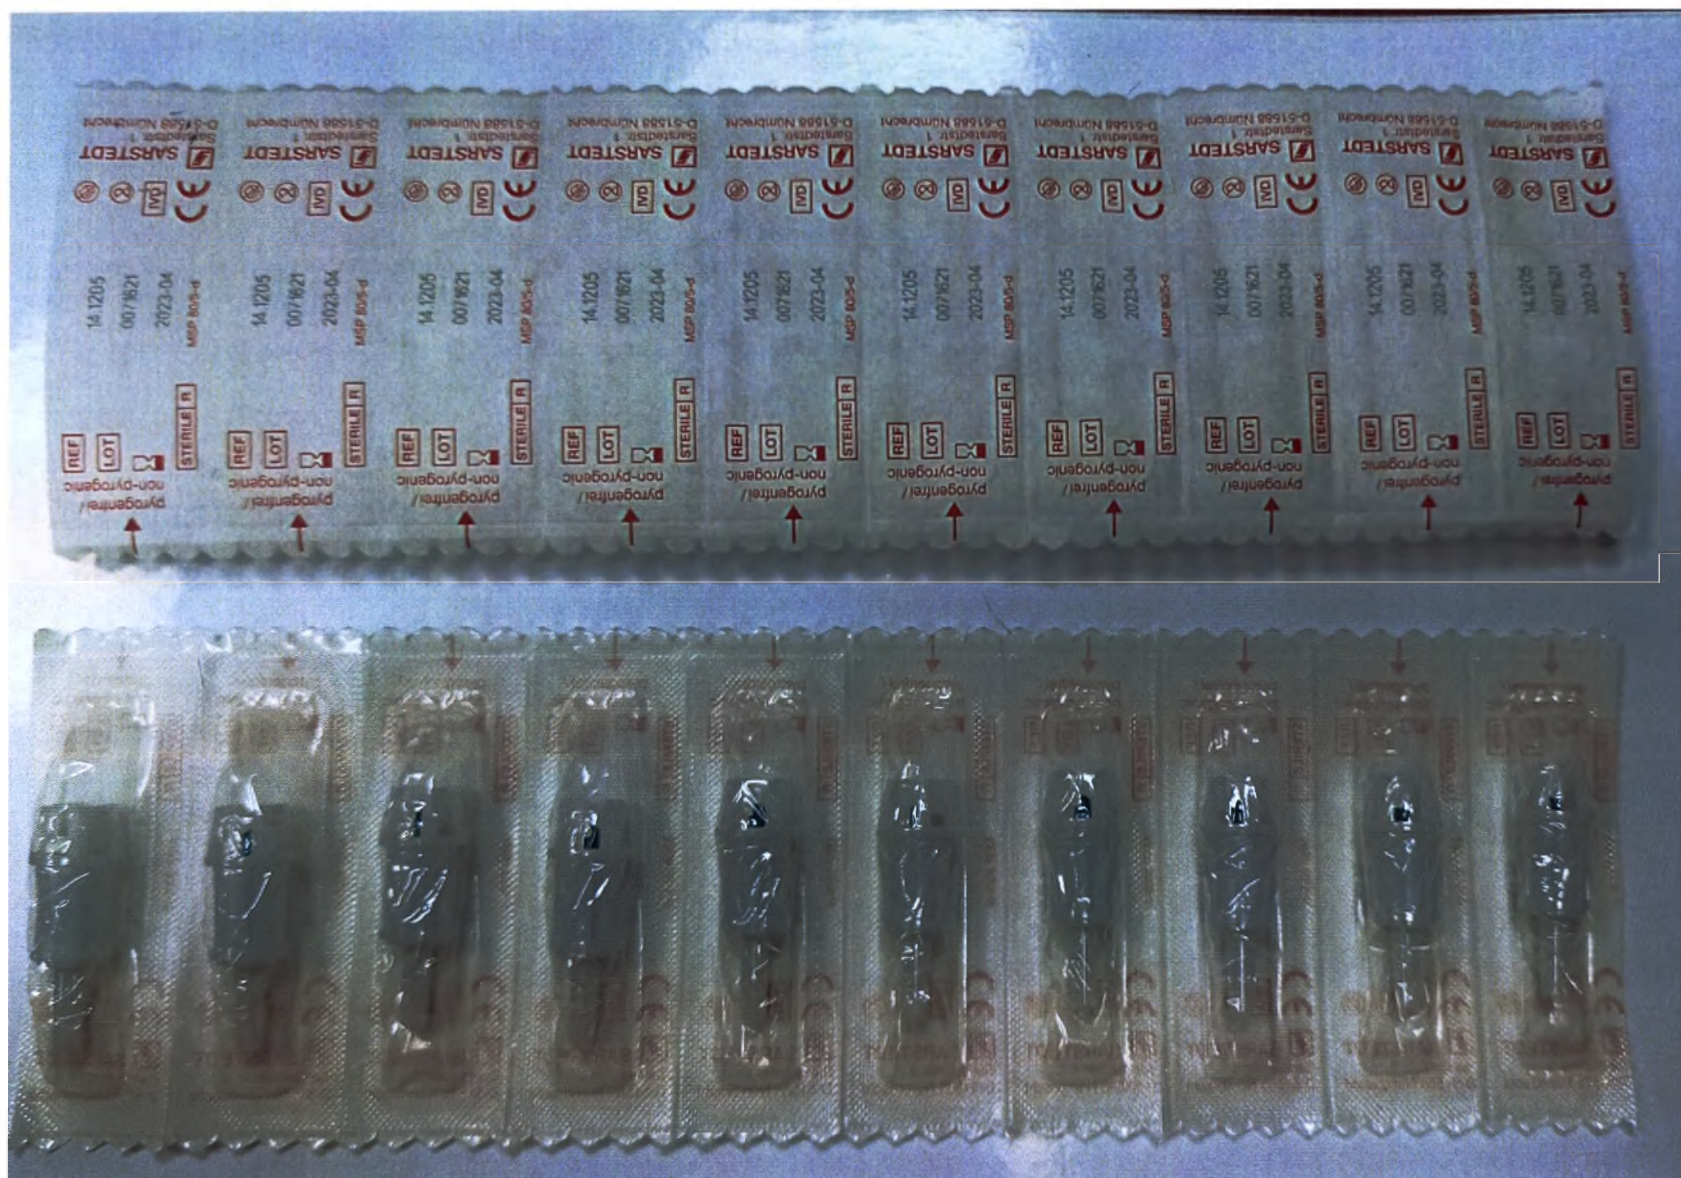


Рис 9. Индивидуальная упаковка. Переходник мульти-адаптер

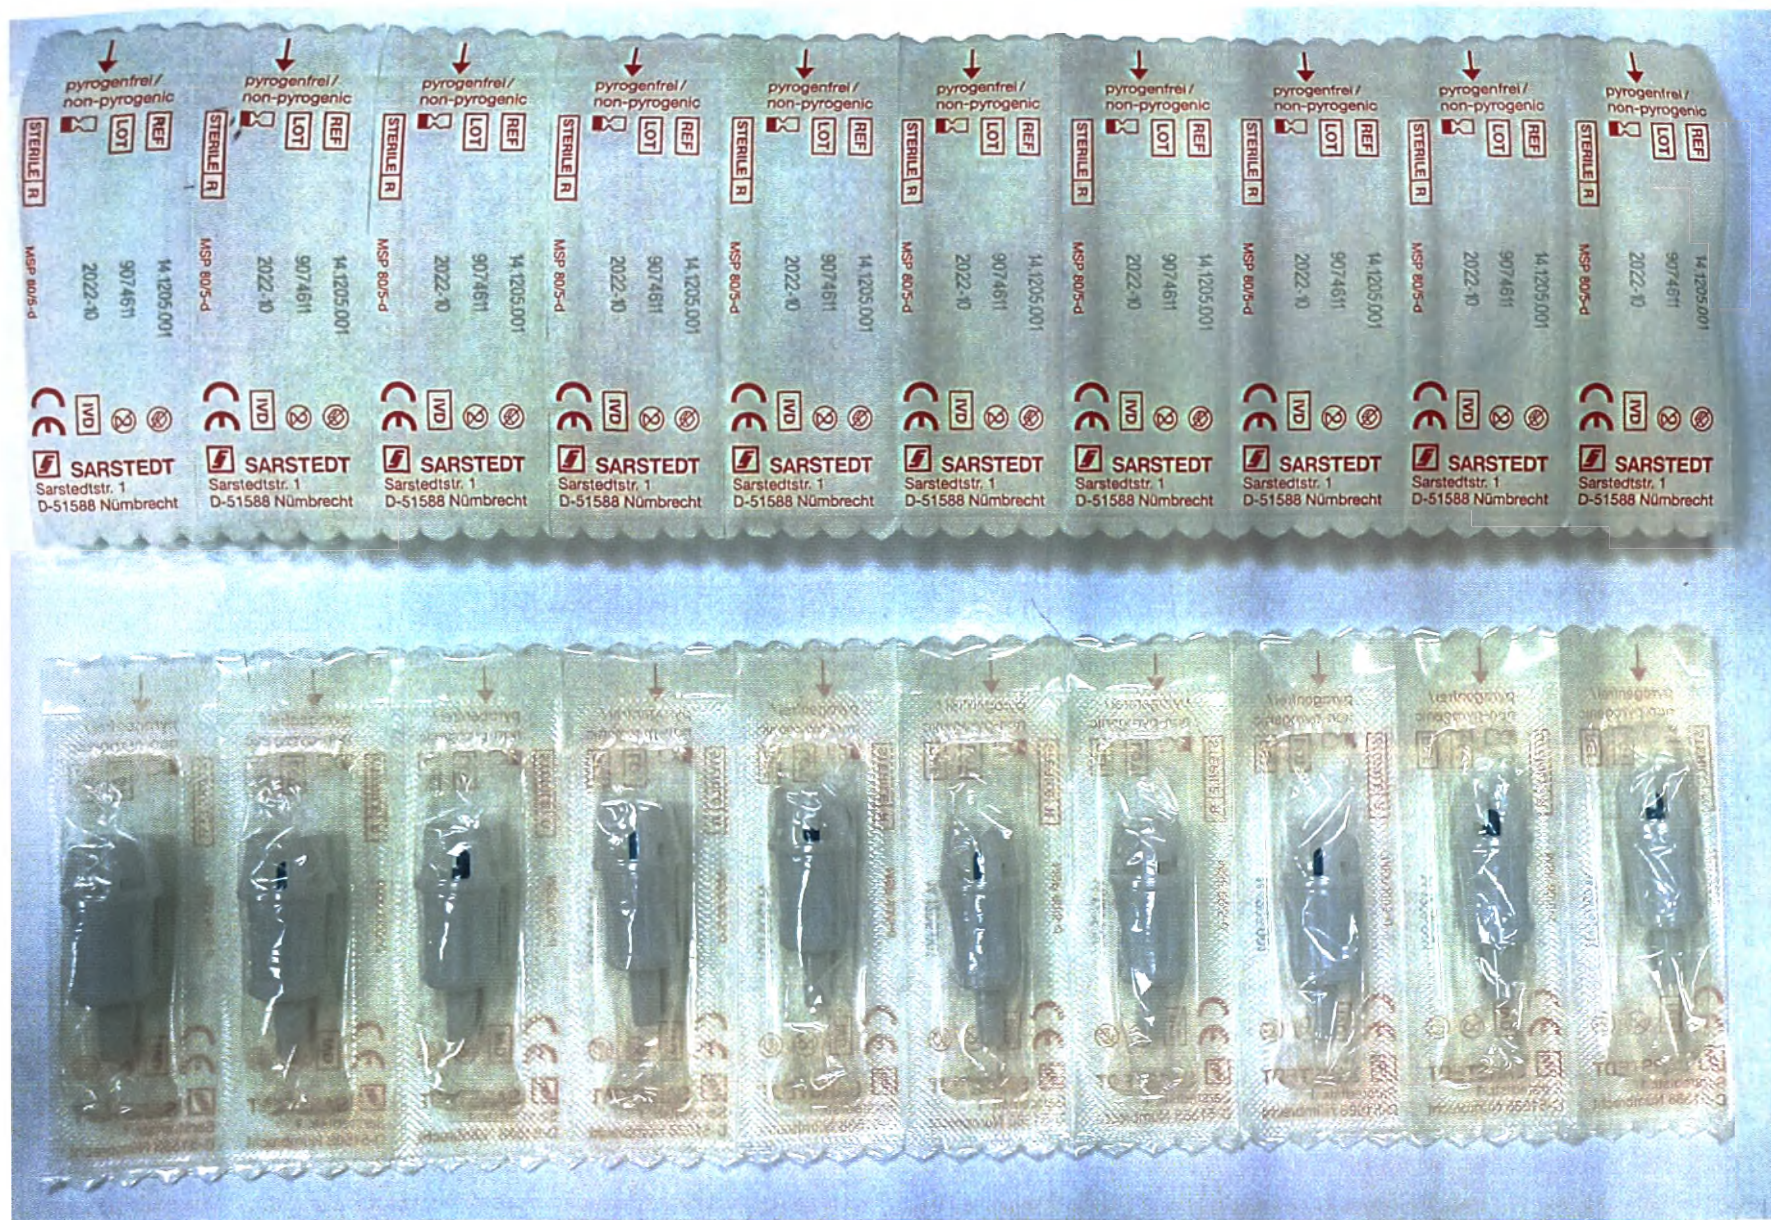


Рис 10. Индивидуальная упаковка. Переходник мульти-адаптер с укороченным наконечником

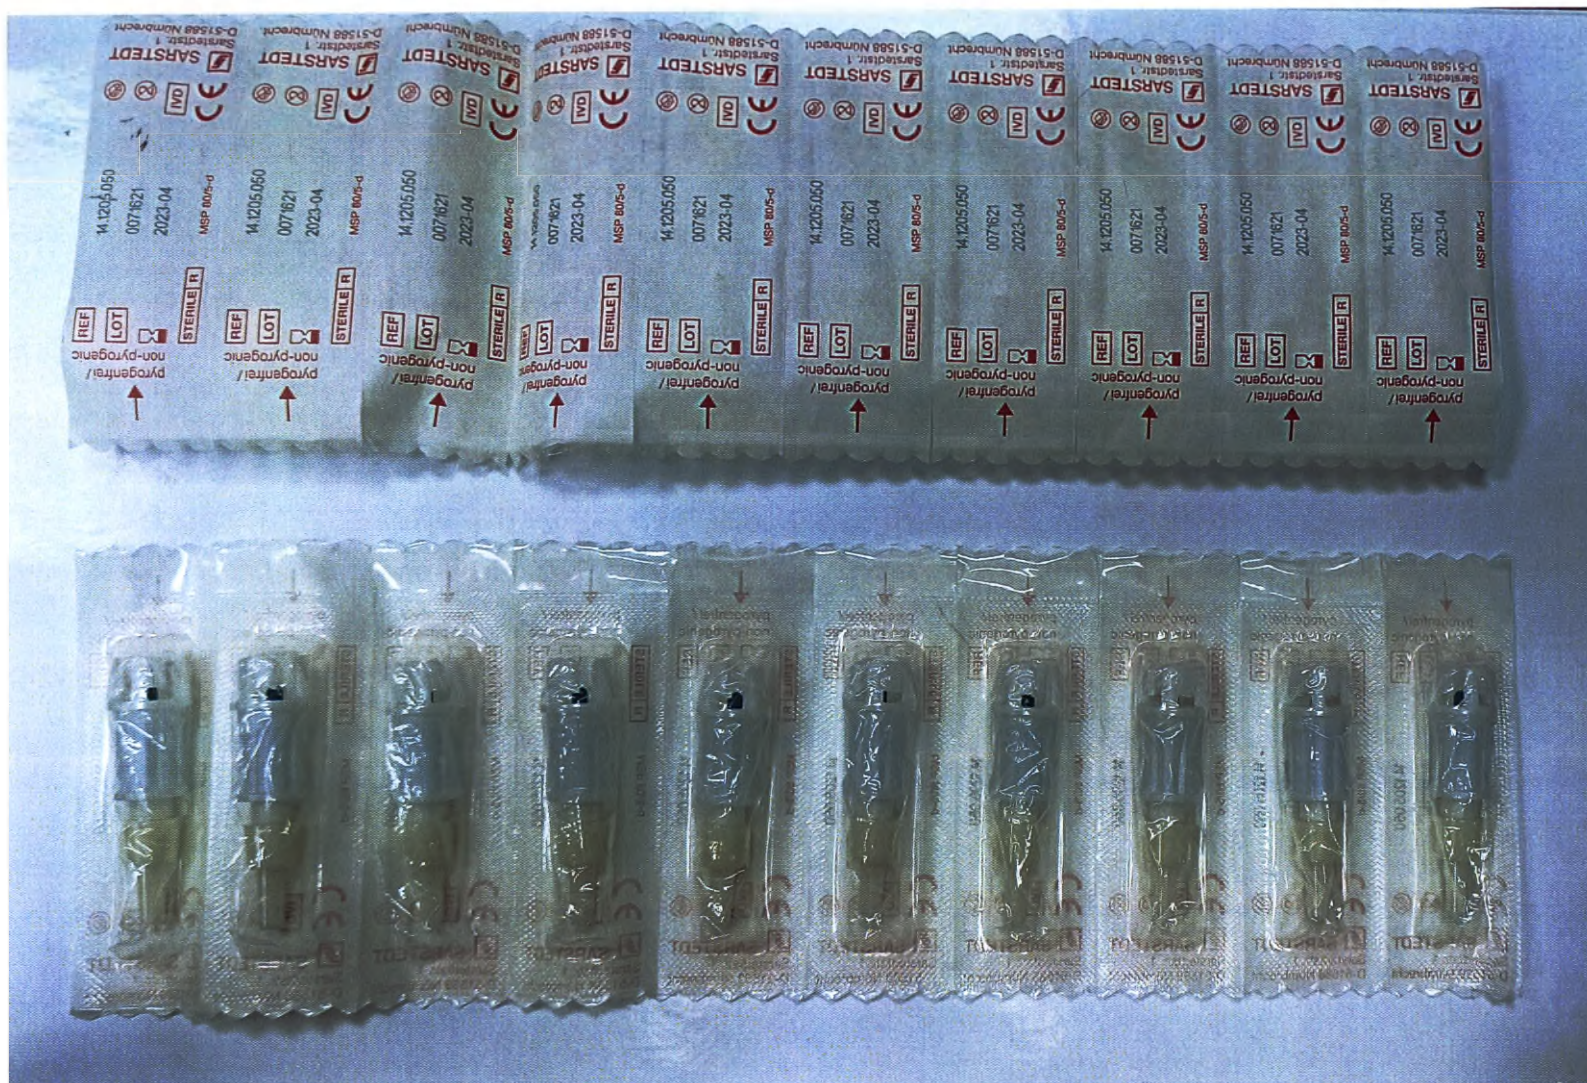


Рис 11. Индивидуальная упаковка. Переходник мульти-адаптер с отвинчивающимся наконечником

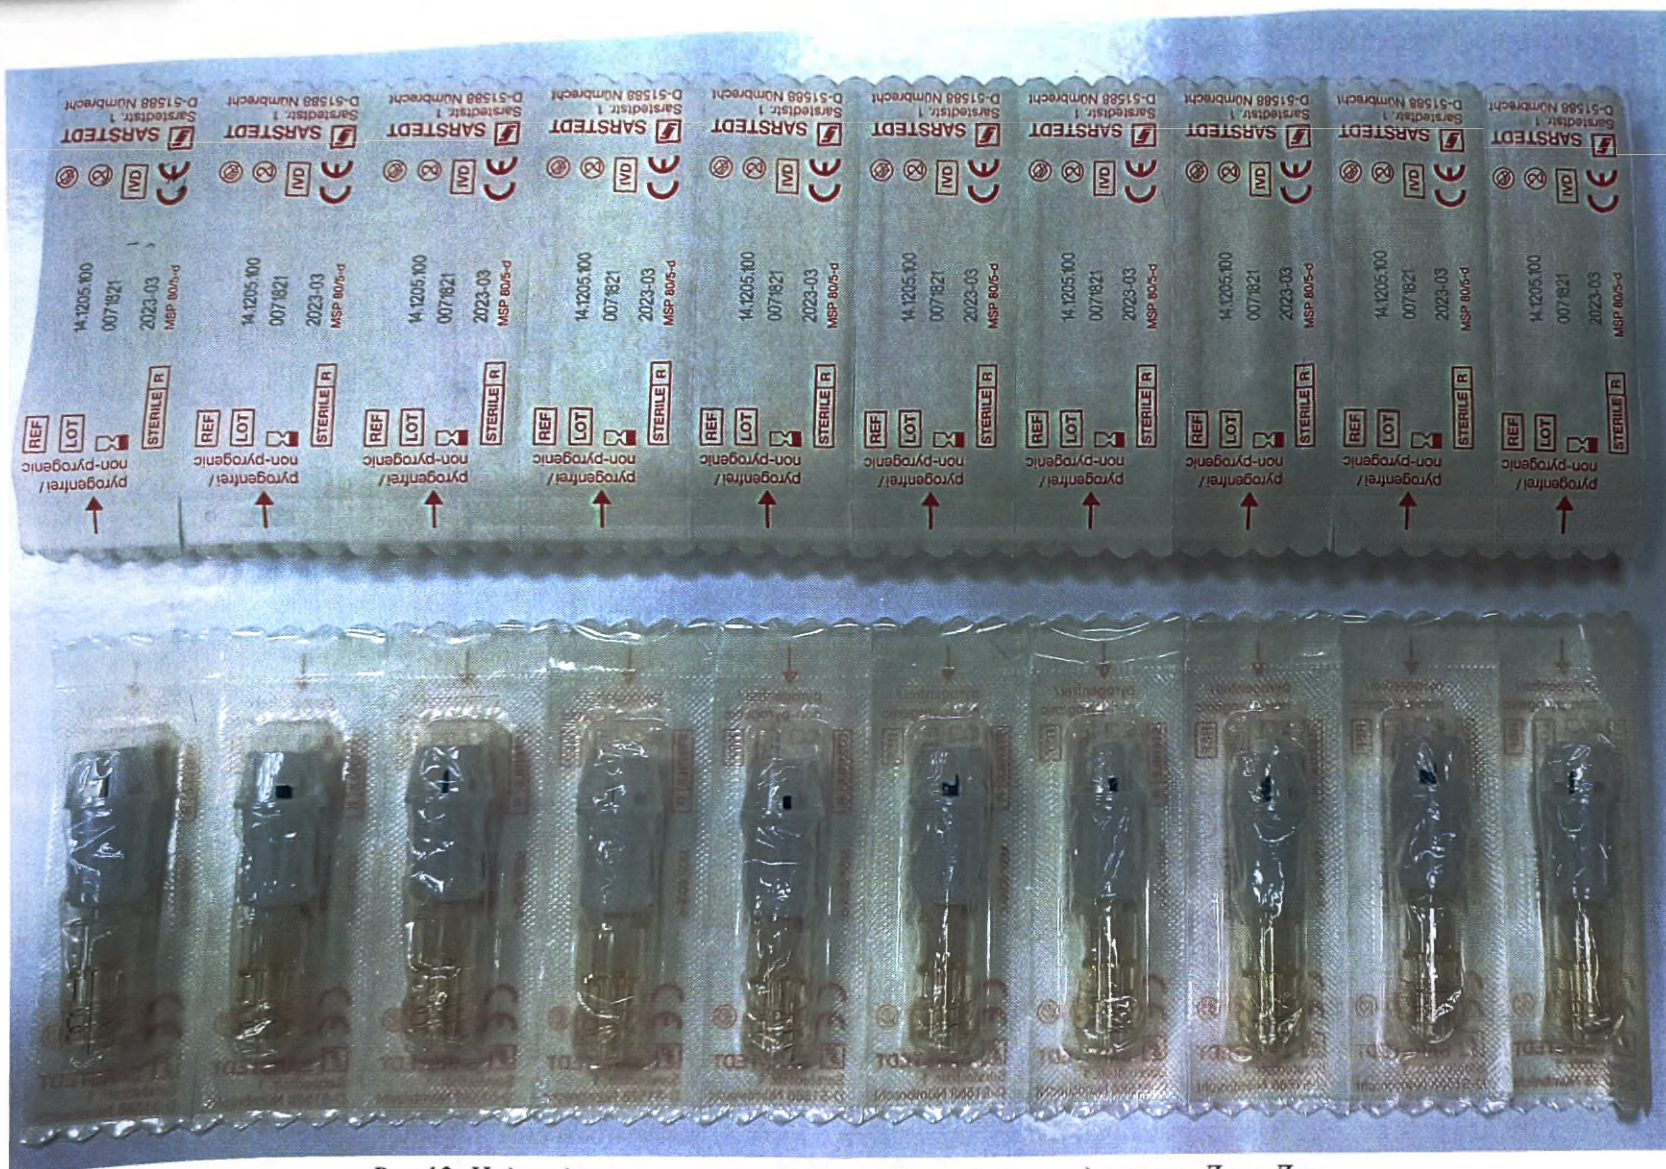


Рис 12. Индивидуальная упаковка. Переходник мульти-адаптер с Луер-Лок

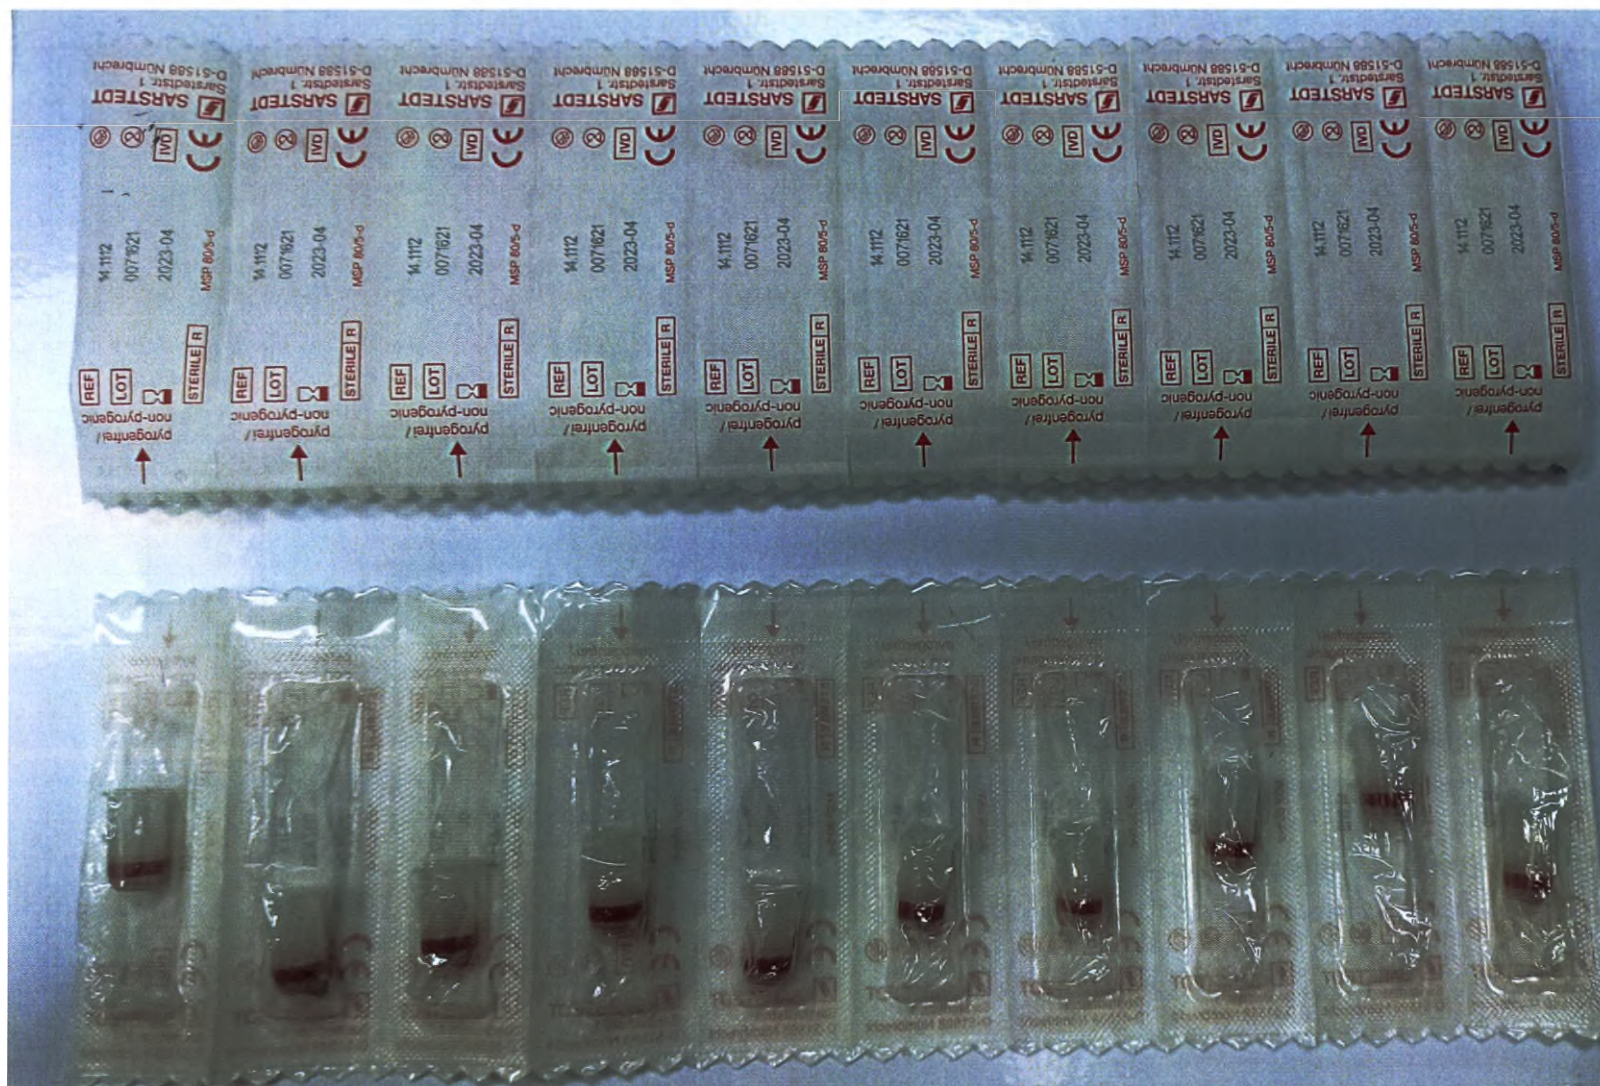


Рис 13. Индивидуальная упаковка. Переходник (адаптер) мембранный

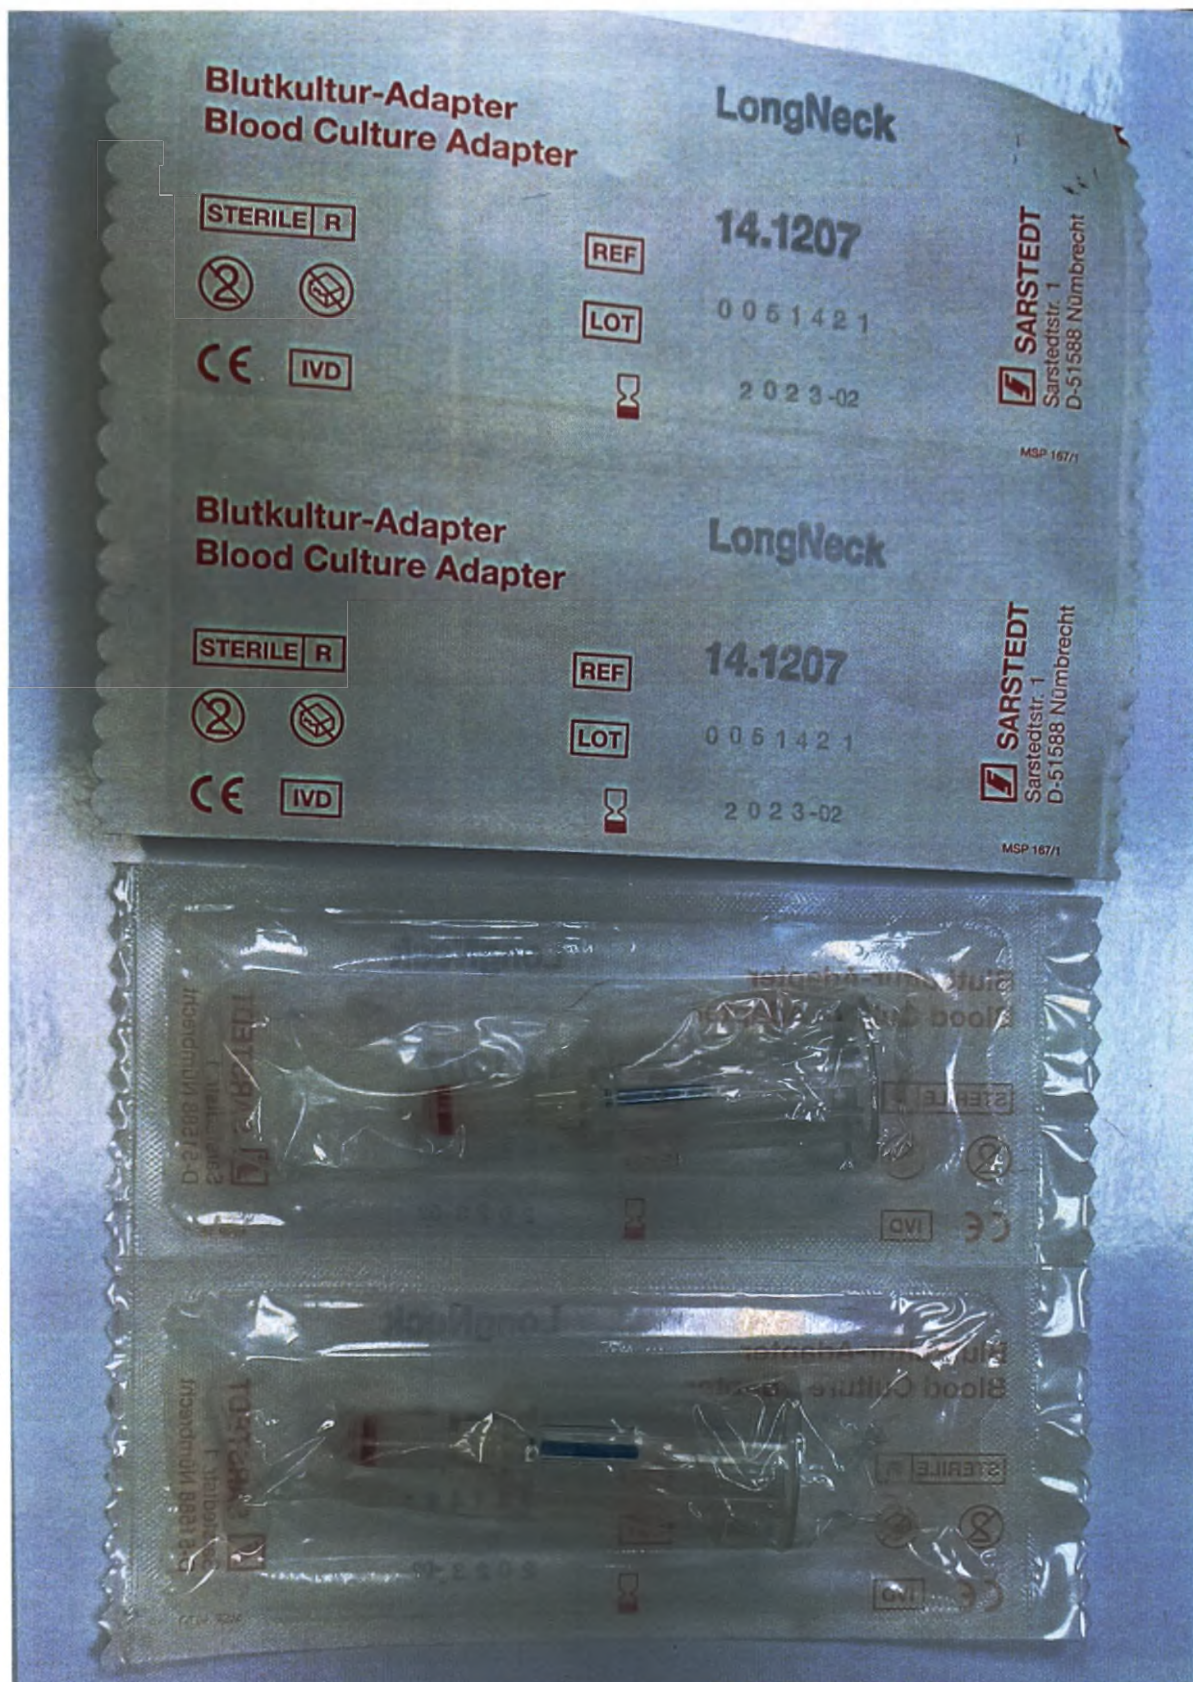


Рис 14. Индивидуальная упаковка. Переходник (адаптер) мембранный для держателя вакуумных пробирок



Рис 15. Индивидуальная упаковка. Переходник (адаптер) для посева крови универсальный

Рис 16. Индивидуальная упаковка. Переходник (адаптер) для посева крови LongNeck





Made in Germany

REF

14.1205

Адаптер для взятия и посева крови одноразового использования. Переходник мульти-адаптер

Номер партии: см. на упаковке.

Срок годности: см. на упаковке.

Условия хранения, транспортирования и эксплуатации при температуре от +5 до +40°C, относительной влажности не более 80%.

Апирогенно. Нетоксично.

РУ № РЗН 20XX/XXXXXX от XX.XX.20XX г.

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: ООО «САРШТЕДТ» Россия, 198510, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф,

ул. Новые Заводы, д.50, корп.5, стр.1, офис 44

Тел. +7 495 937 52 28 Факс: +7 495 937 52 28

e-mail: info.ru@sarstedt.com

На территории Российской Федерации не является IVD



SARSTEDT AG&Co.KG/«Сарштедт АГ и Ко.КГ»

Германия



Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

Рис 17. Маркировка групповой упаковки на русском языке. Переходник мульти-адаптер

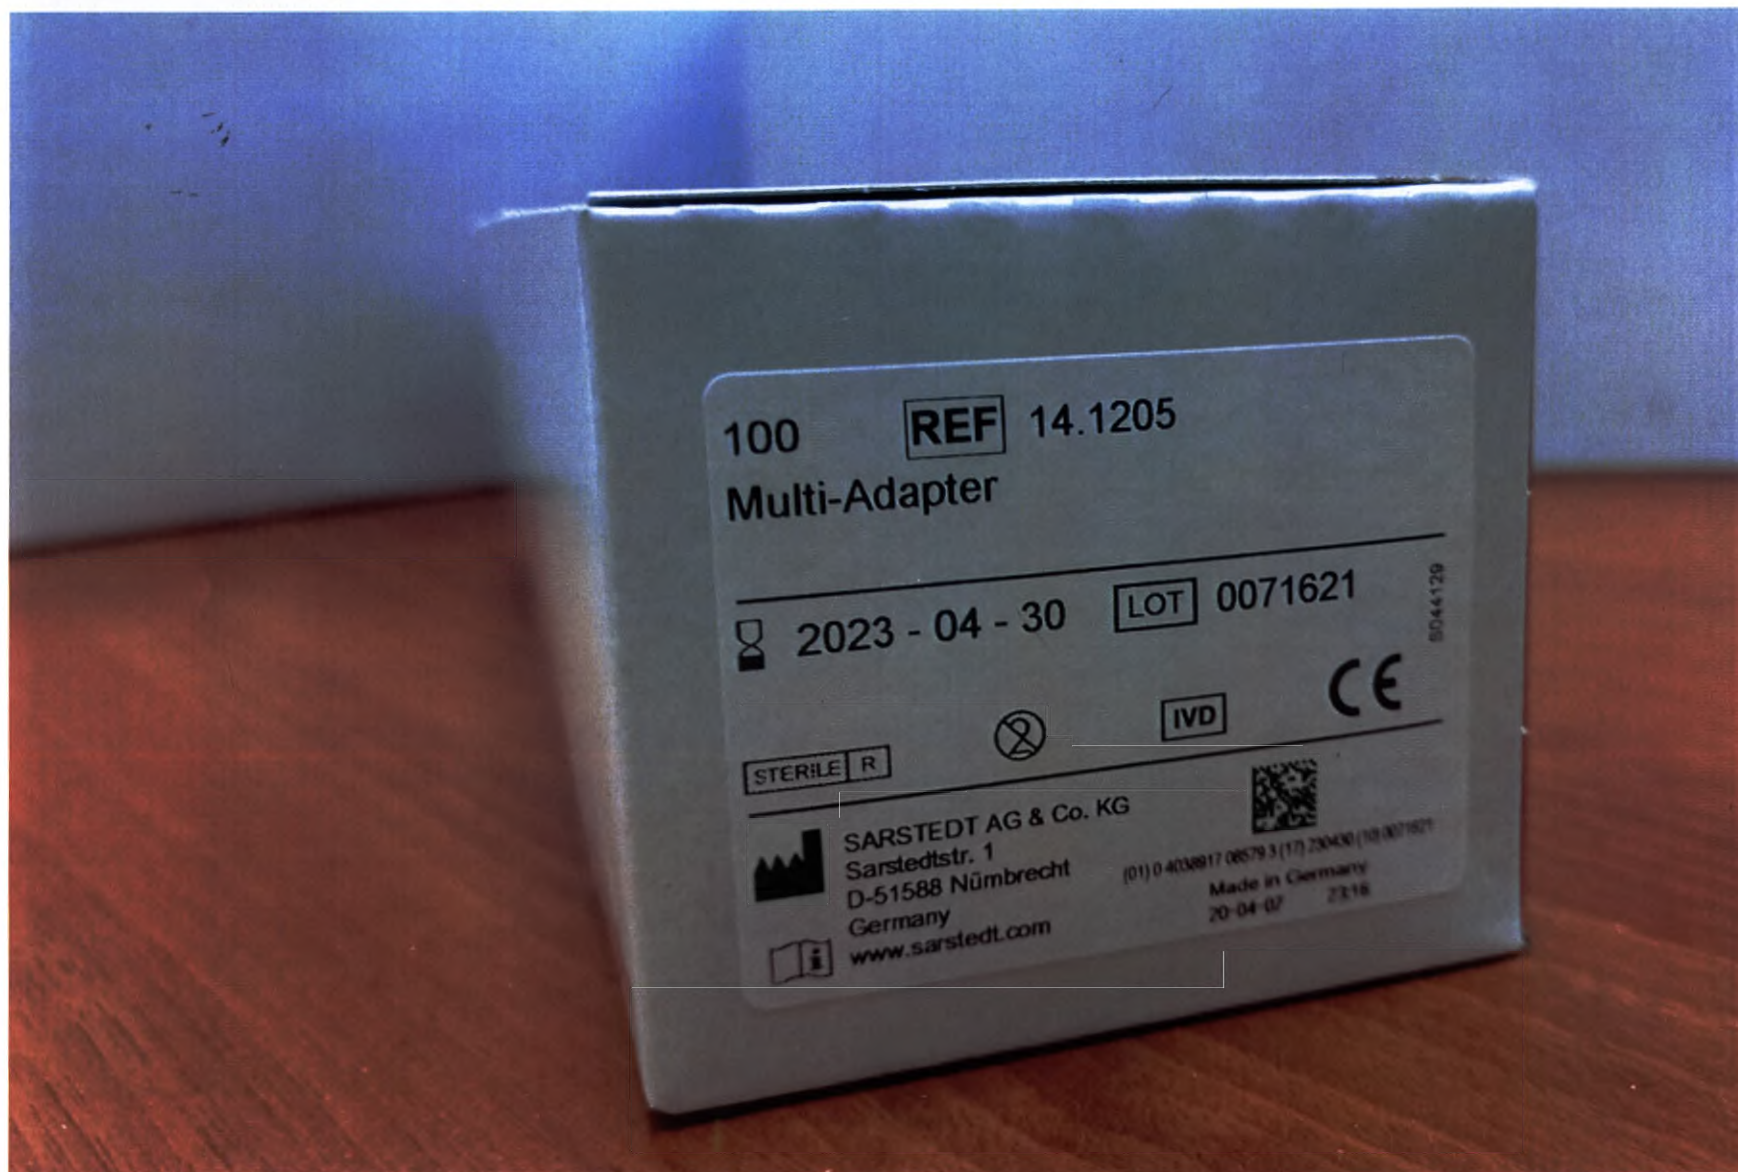


Рис 18. Маркировка групповой упаковки оригинальная. Переходник мульти-адаптер



Made in Germany

REF

14.1205.001

Адаптер для взятия и посева крови одноразового использования. Переходник мульти-адаптер с укороченным наконечником

Номер партии: см. на упаковке.

Срок годности: см. на упаковке.

Условия хранения, транспортирования и эксплуатации при температуре от +5 до +40°C, относительной влажности не более 80%.

Апирогенно. Нетоксично.

РУ № РЗН 20XX/XXXXXX от XX.XX.20XX г.

Уполномоченный представитель производителя на

территории РФ: ООО «САРШТЕДТ» Россия,

198510, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф,

ул. Новые Заводы, д.50, корп.5, стр.1, офис 44

Тел. +7 495 937 52 28 Факс: +7 495 937 52 28

e-mail: info.ru@sarstedt.com

На территории Российской Федерации не является IVD



SARSTEDT AG&Co.KG/«Сарштедт АГ и Ко.КГ»

Германия



Перед использованием ознакомьтесь
с инструкцией.

Рис. 20. Маркировка групповой упаковки на русском языке. Переходник мульти-адаптер с укороченным наконечником

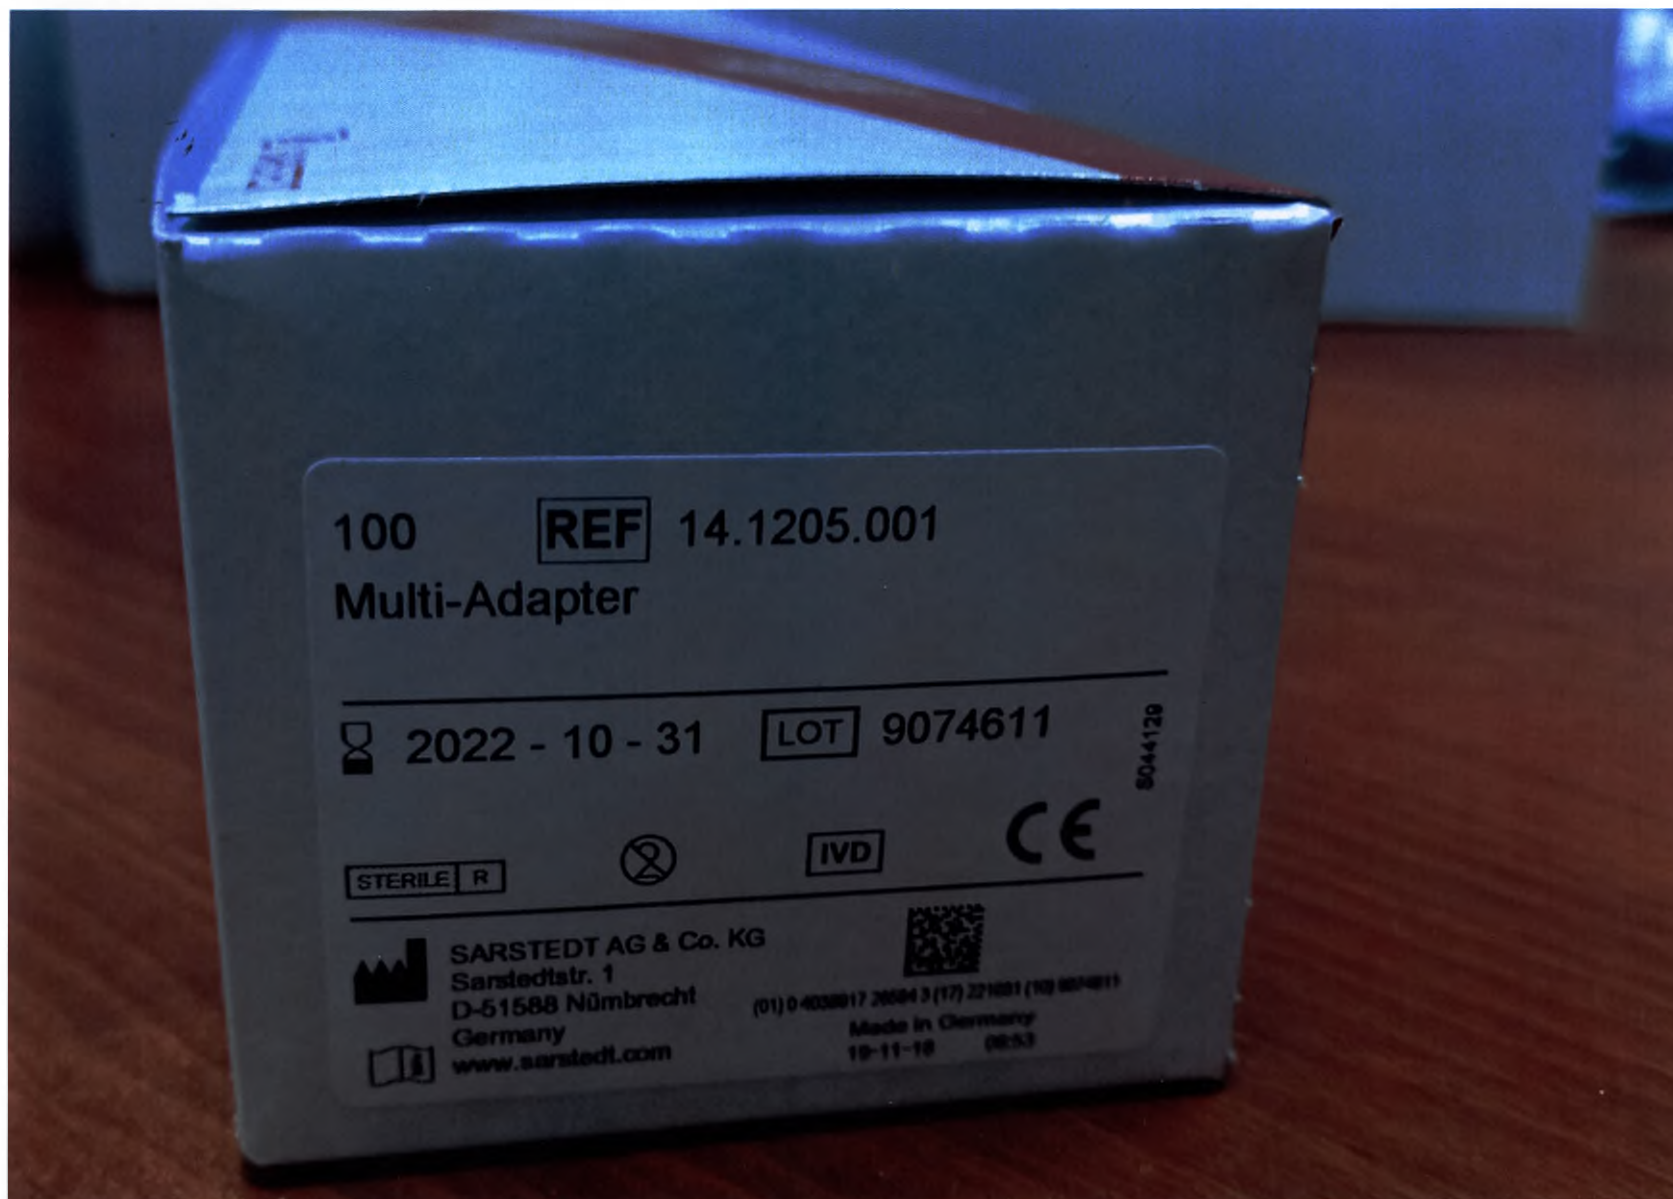


Рис 21. Маркировка групповой упаковки оригинальная. Переходник мульти-адаптер с укороченным наконечником

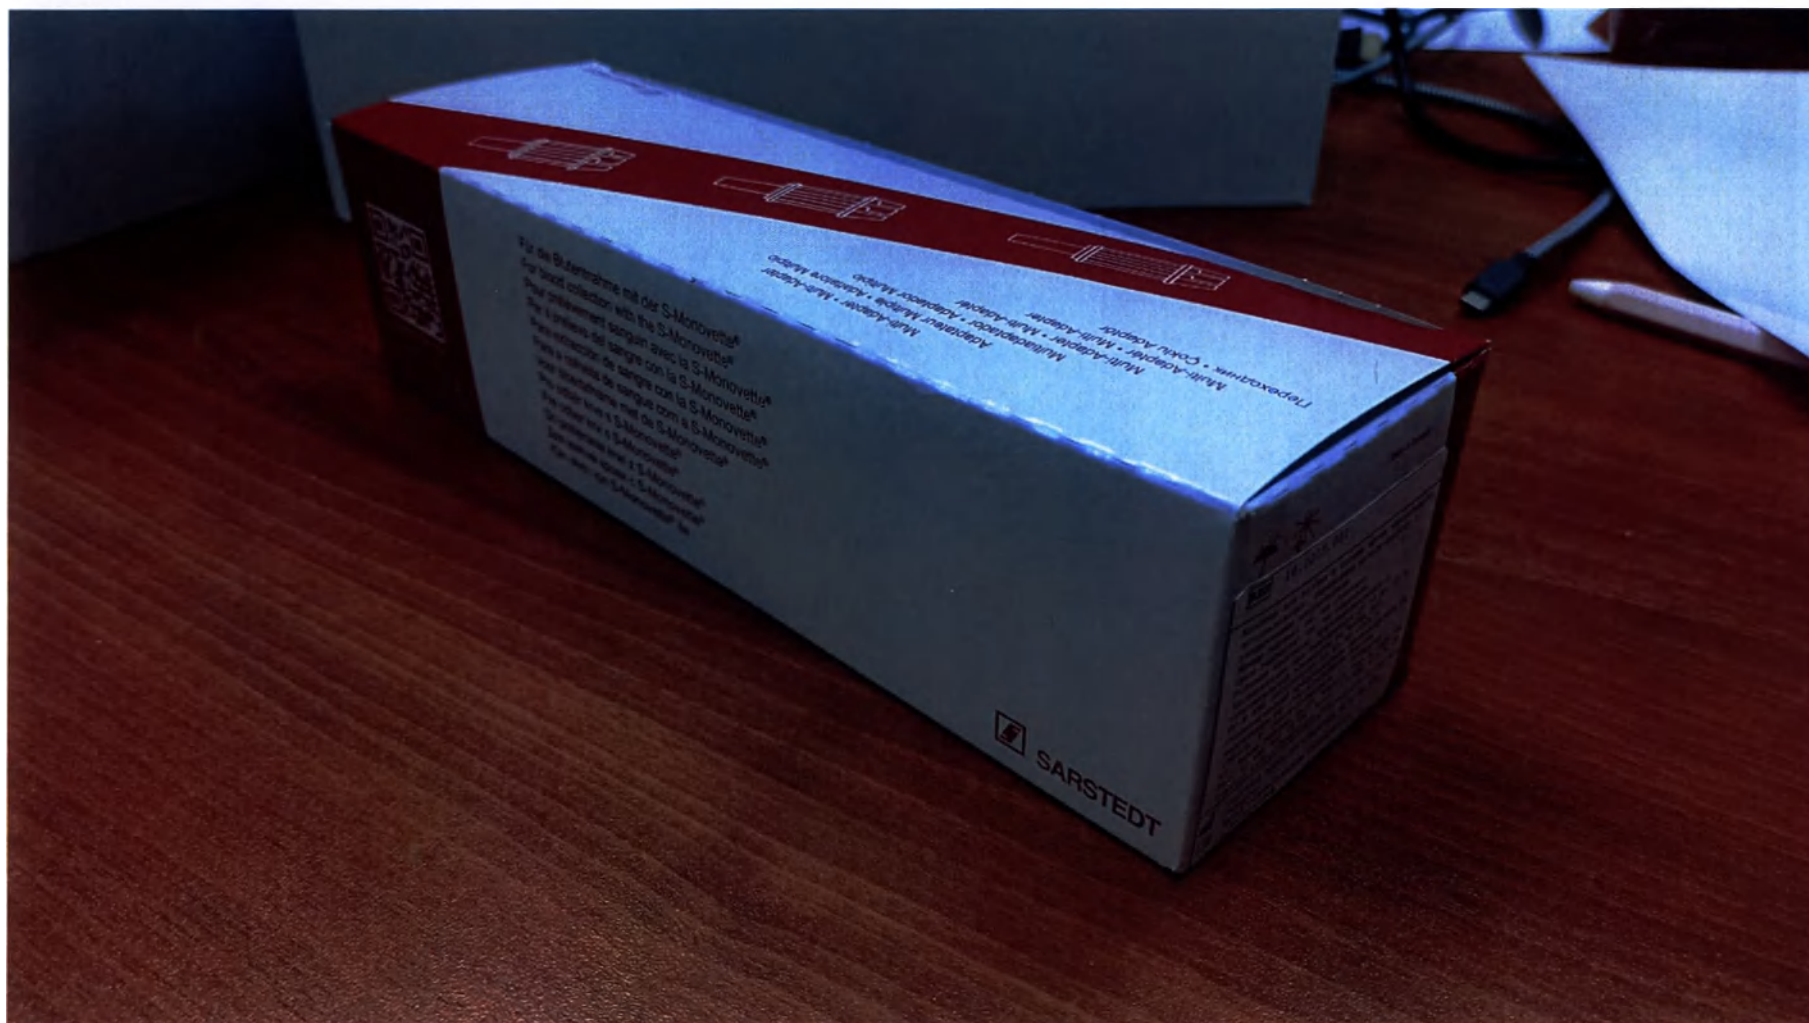


Рис 22. Групповая упаковка. Переходник мульти-адаптер с укороченным наконечником

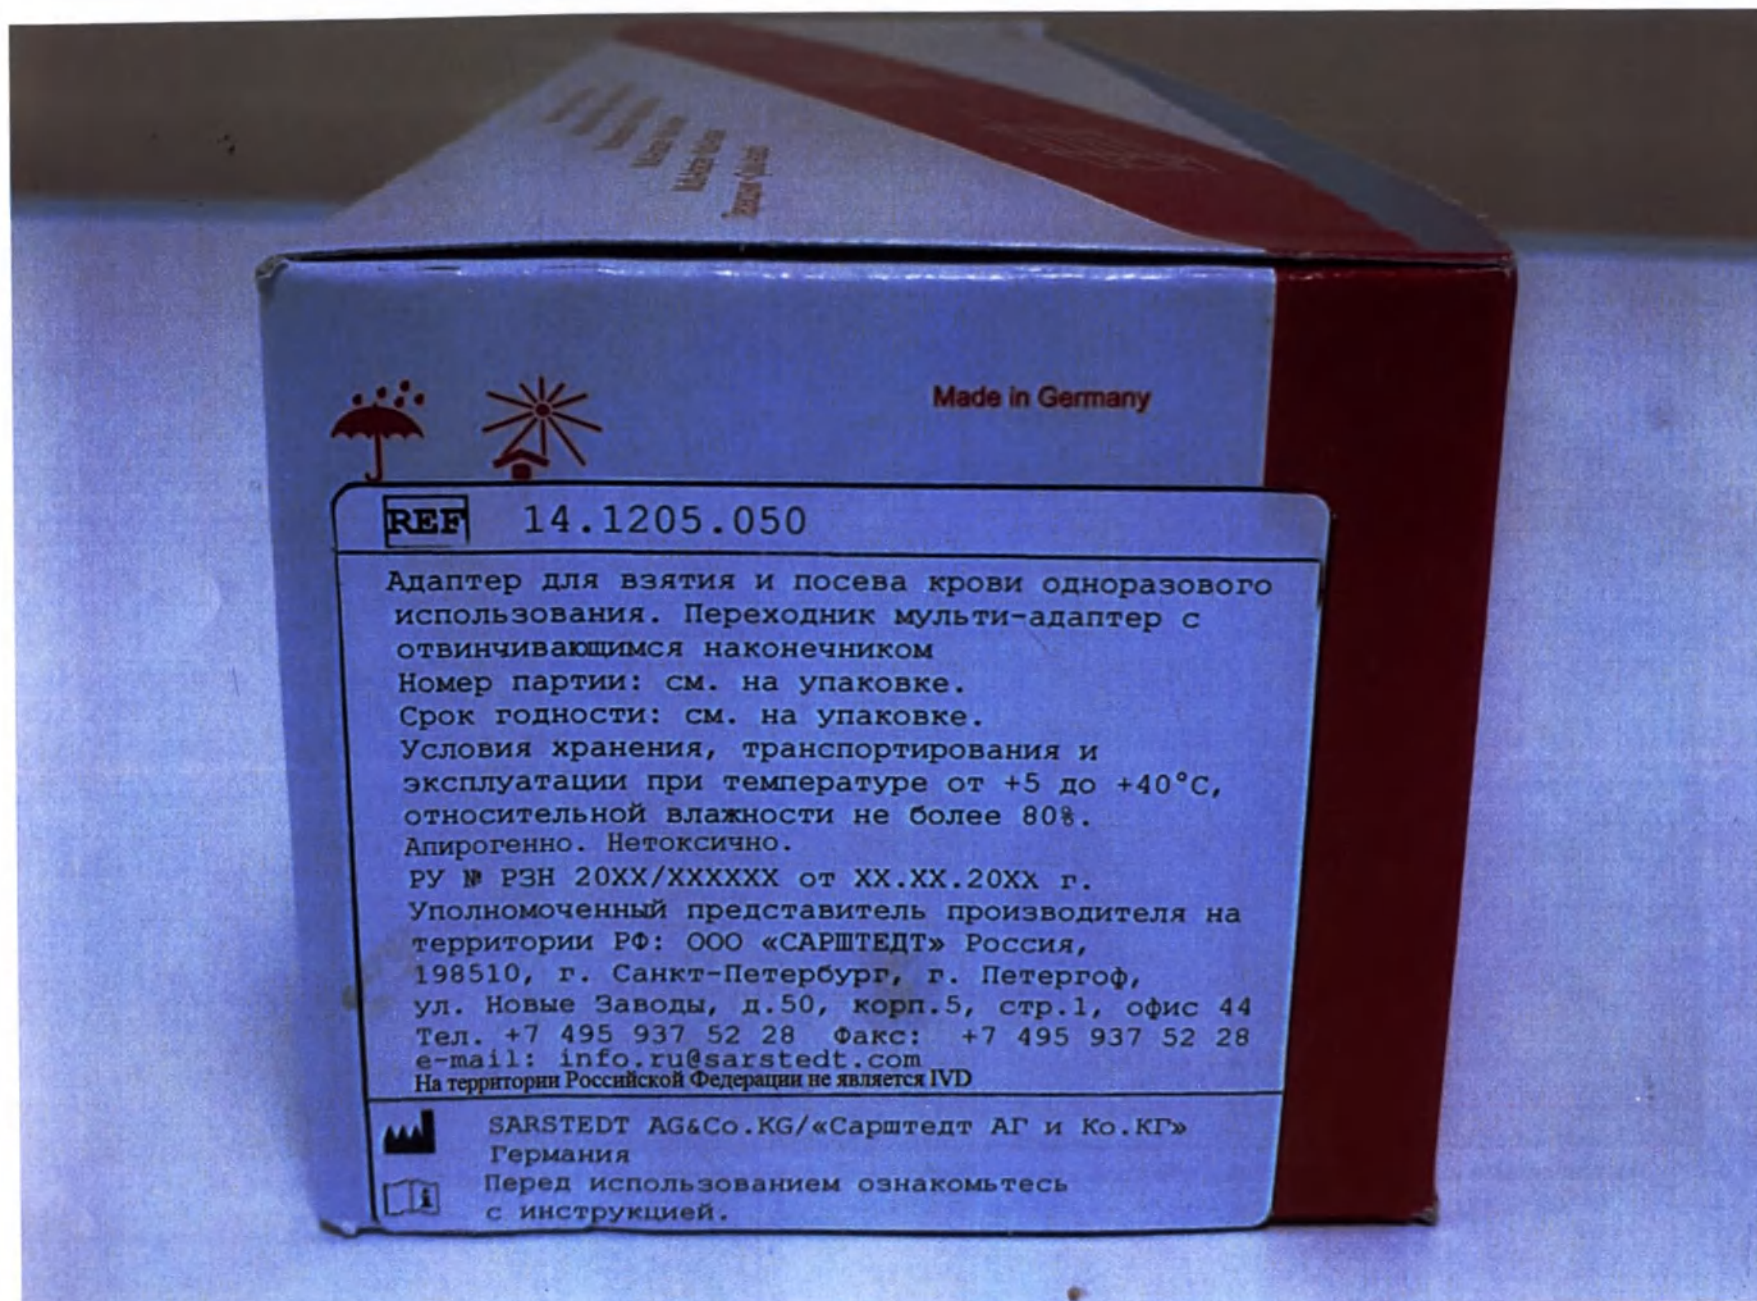


Рис 23. Маркировка групповой упаковки на русском языке. Переходник мульти-адаптер с отвинчивающимся наконечником



Рис 24. Маркировка групповой упаковки оригинальная. Переходник мульти-адаптер с отвинчивающимся наконечником



Рис 25. Групповая упаковка. Переходник мульти-адаптер с отвинчивающимся наконечником

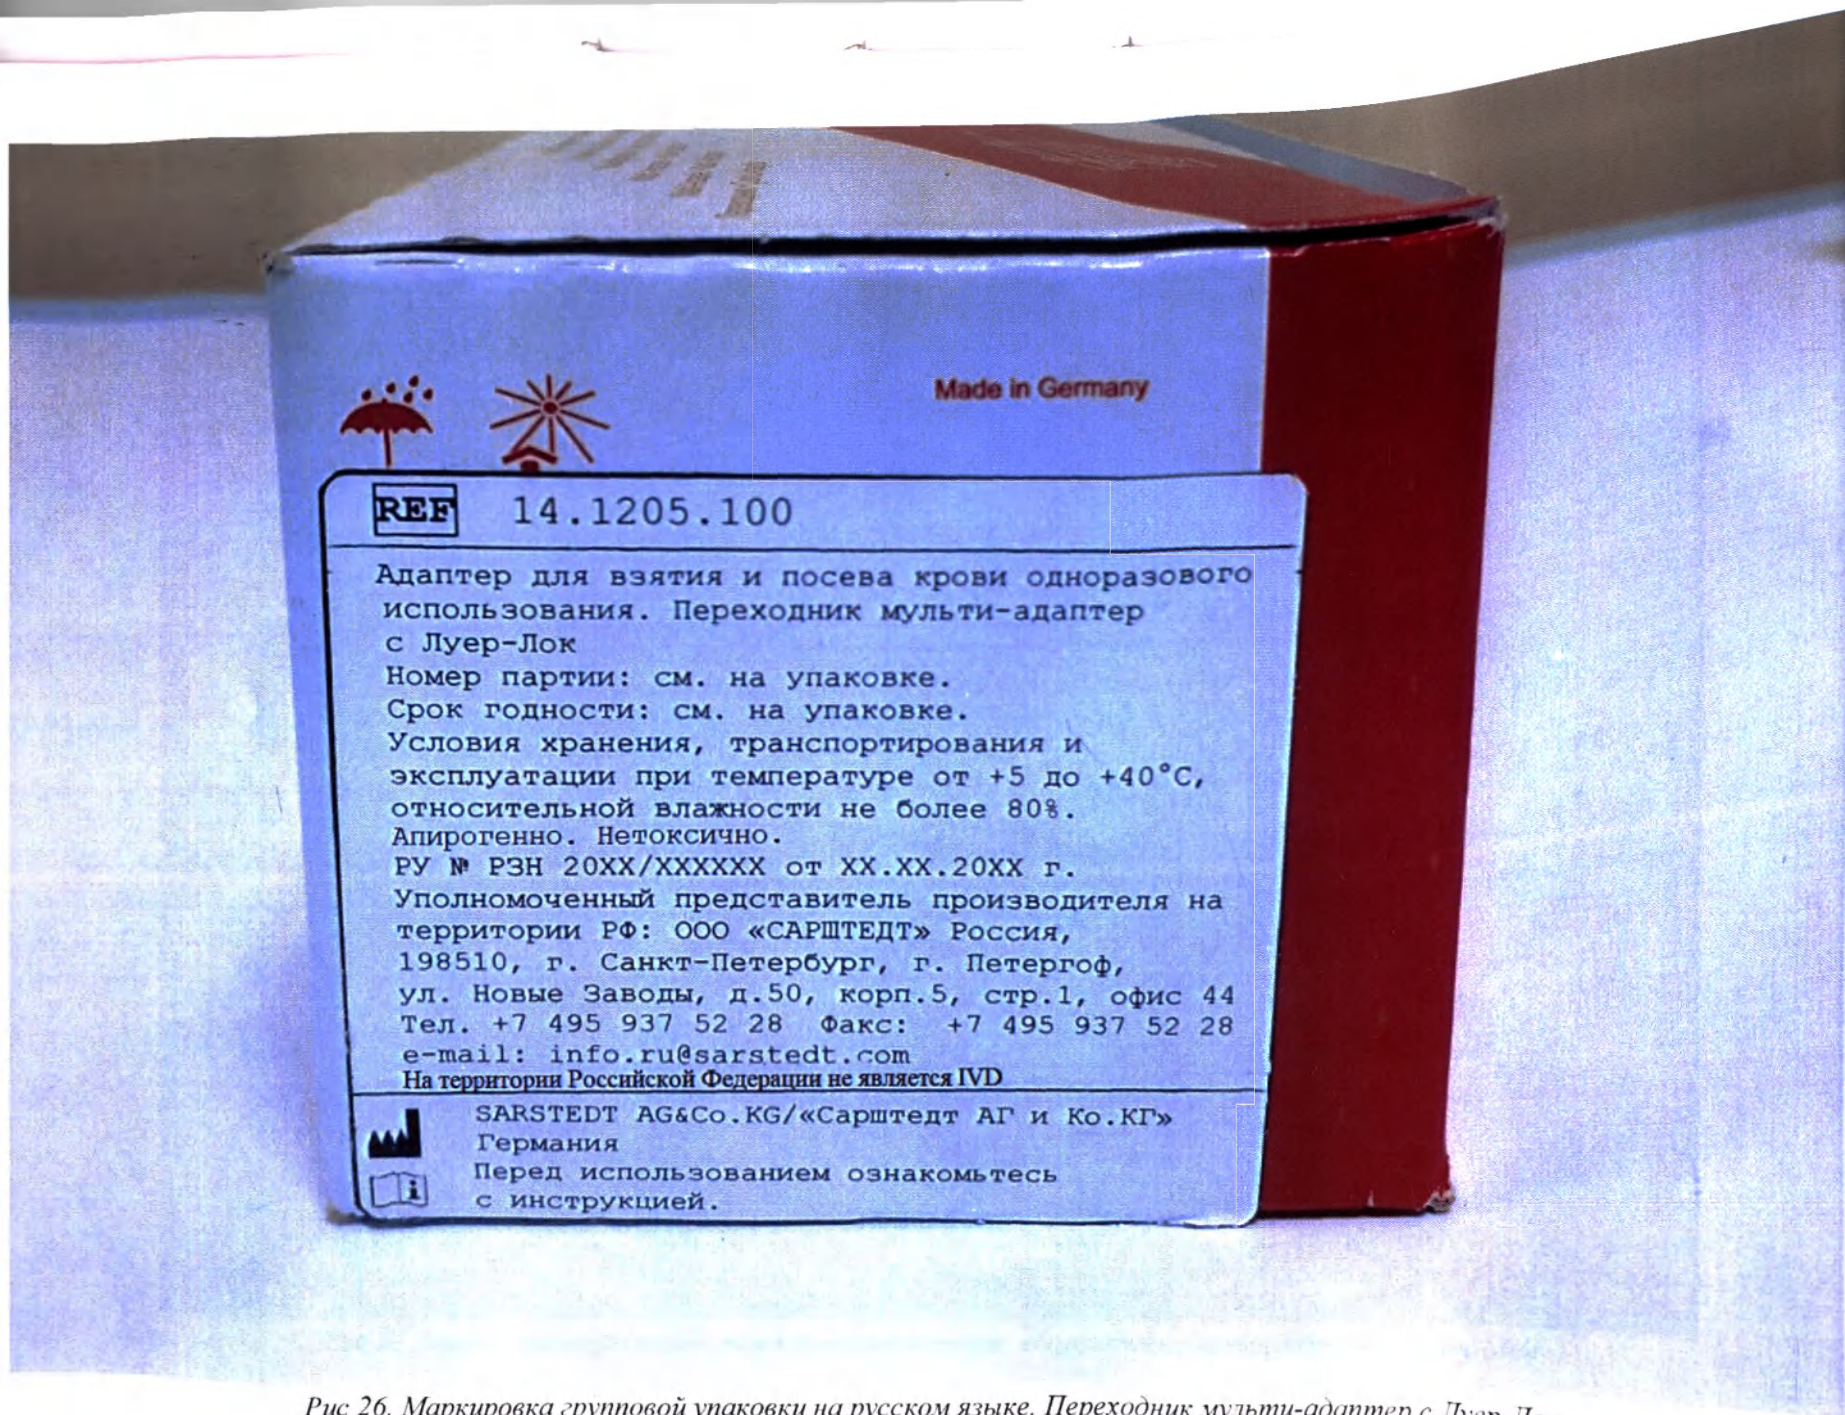


Рис 26. Маркировка групповой упаковки на русском языке. Переходник мульти-адаптер с Луер-Лок



Рис 27. Маркировка групповой упаковки оригинальная. Переходник мульти-адаптер с Луер-Лок



Рис 28. Групповая упаковка. Переходник мульти-адаптер с Луер-Лок



REF

14.1112

Адаптер для взятия и посева крови одноразового использования. Переходник (адаптер) мембранный
Номер партии: см. на упаковке.

Срок годности: см. на упаковке.

Условия хранения, транспортирования и эксплуатации при температуре от +5 до +40°C, относительной влажности не более 80%.

Апирогенно. Нетоксично.

РУ № РЗН 20XX/XXXXXX от XX.XX.20XX г.

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: ООО «САРШТЕДТ» Россия, 198510, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Новые Заводы, д.50, корп.5, стр.1, офис 44
Тел. +7 495 937 52 28 Факс: +7 495 937 52 28
e-mail: info.ru@sarstedt.com

На территории Российской Федерации не является IVD



SARSTEDT AG&Co.KG/«Сарштедт АГ и Ко.КГ»
Германия

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.



Рис 30. Маркировка групповой упаковки оригинальная. Переходник (адаптер) мембранный



Рис 31. Групповая упаковка. Переходник (адаптер) мембранный

REF 14.1110

Адаптер для взятия и посева крови одноразового использования. Переходник (адаптер) мембранный для держателя вакуумных пробирок

Номер партии: см. на упаковке.

Срок годности: см. на упаковке.

Условия хранения, транспортирования и эксплуатации при температуре от +5 до +40°C, относительной влажности не более 80%.

Апирогенно. Нетоксично.

РУ № РЗН 20XX/XXXXXX от XX.XX.20XX г.

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: ООО «САРШТЕДТ» Россия, 198510, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Новые Заводы, д.50, корп.5, стр.1, офис 44
Тел. +7 495 937 52 28 Факс: +7 495 937 52 28
e-mail: info.ru@sarstedt.com

На территории Российской Федерации не является IVD



SARSTEDT AG & Co. KG / «Сарштедт АГ и Ко.КГ»
Германия



Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

Рис 32. Маркировка групповой упаковки на русском языке. Переходник (адаптер) мембранный для держателя вакуумных пробирок



Рис 33. Маркировка групповой упаковки оригинальная. Переходник (адаптер) мембранный для держателя вакуумных пробирок

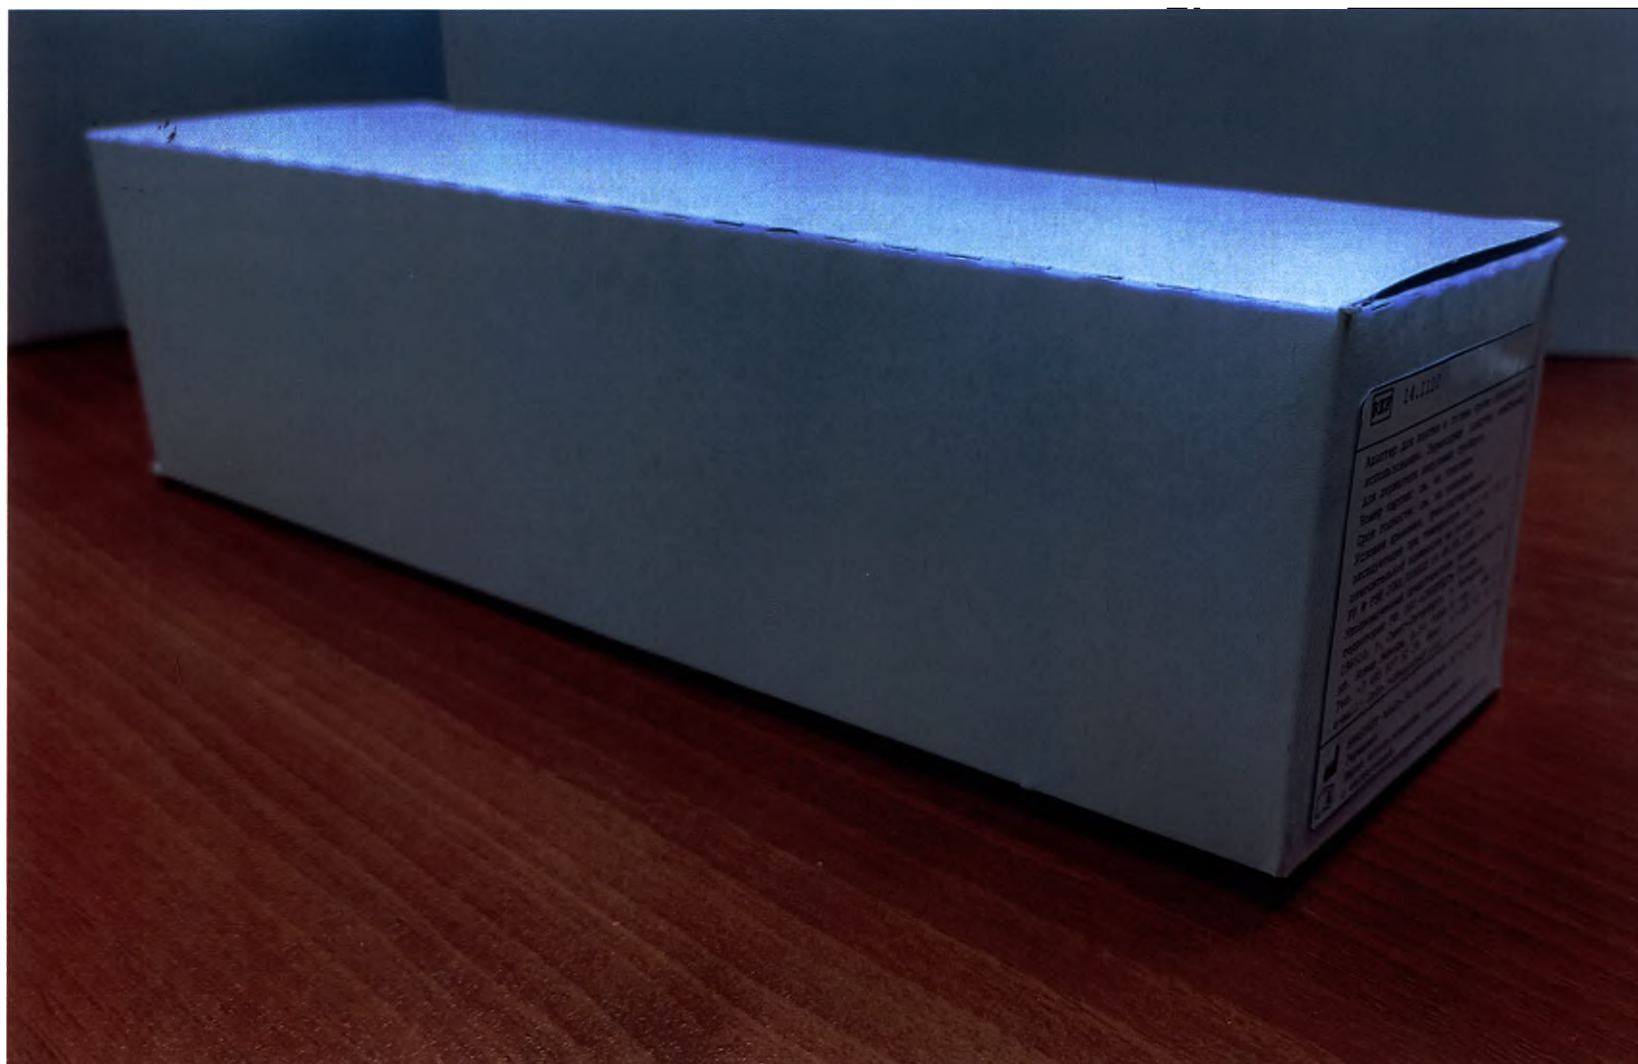


Рис 34. Групповая упаковка. Переходник (адаптер) мембранный для держателя вакуумных пробирок

Рис 35. Маркировка грунтовой упаковки. Переходник (адаптер) для посева крови универсальный

REF 14.1209

Адаптер для взятия и посева крови одноразового использования. Переходник (адаптер) для посева крови универсальный

Номер партии: см. на упаковке.

Срок годности: см. на упаковке.

Условия хранения, транспортирования и эксплуатации при температуре от +5 до +40°C, относительной влажности не более 80%.

Апирогенно. Нетоксично.

РУ № РЗН 20XX/XXXXXX от XX.XX.20XX г.

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: ООО «САРШТЕДТ» Россия, 198510, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Новые Заводы, д.50, корп.5, стр.1, офис 44
Тел. +7 495 937 52 28 Факс: +7 495 937 52 28
e-mail: info.ru@sarstedt.com

На территории Российской Федерации не является IVD



SARSTEDT AG & Co. KG / «Сарштедт АГ и Ко.КГ»
Германия

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

20

REF 14.1209

Blutkultur-Adapter Universal

BloodCulture Adapter Universal



2023 - 01 - 31

LOT

0051921

STERILE R



IVD



SARSTEDT AG & Co. KG

Sarstedtstr. 1

D-51588 Nümbrecht

Germany

www.sarstedt.com



(01) 0 4038917 35477 8 (17) 230131 (10) 0051921

Made in Germany
20-05-04 08:21

S044176

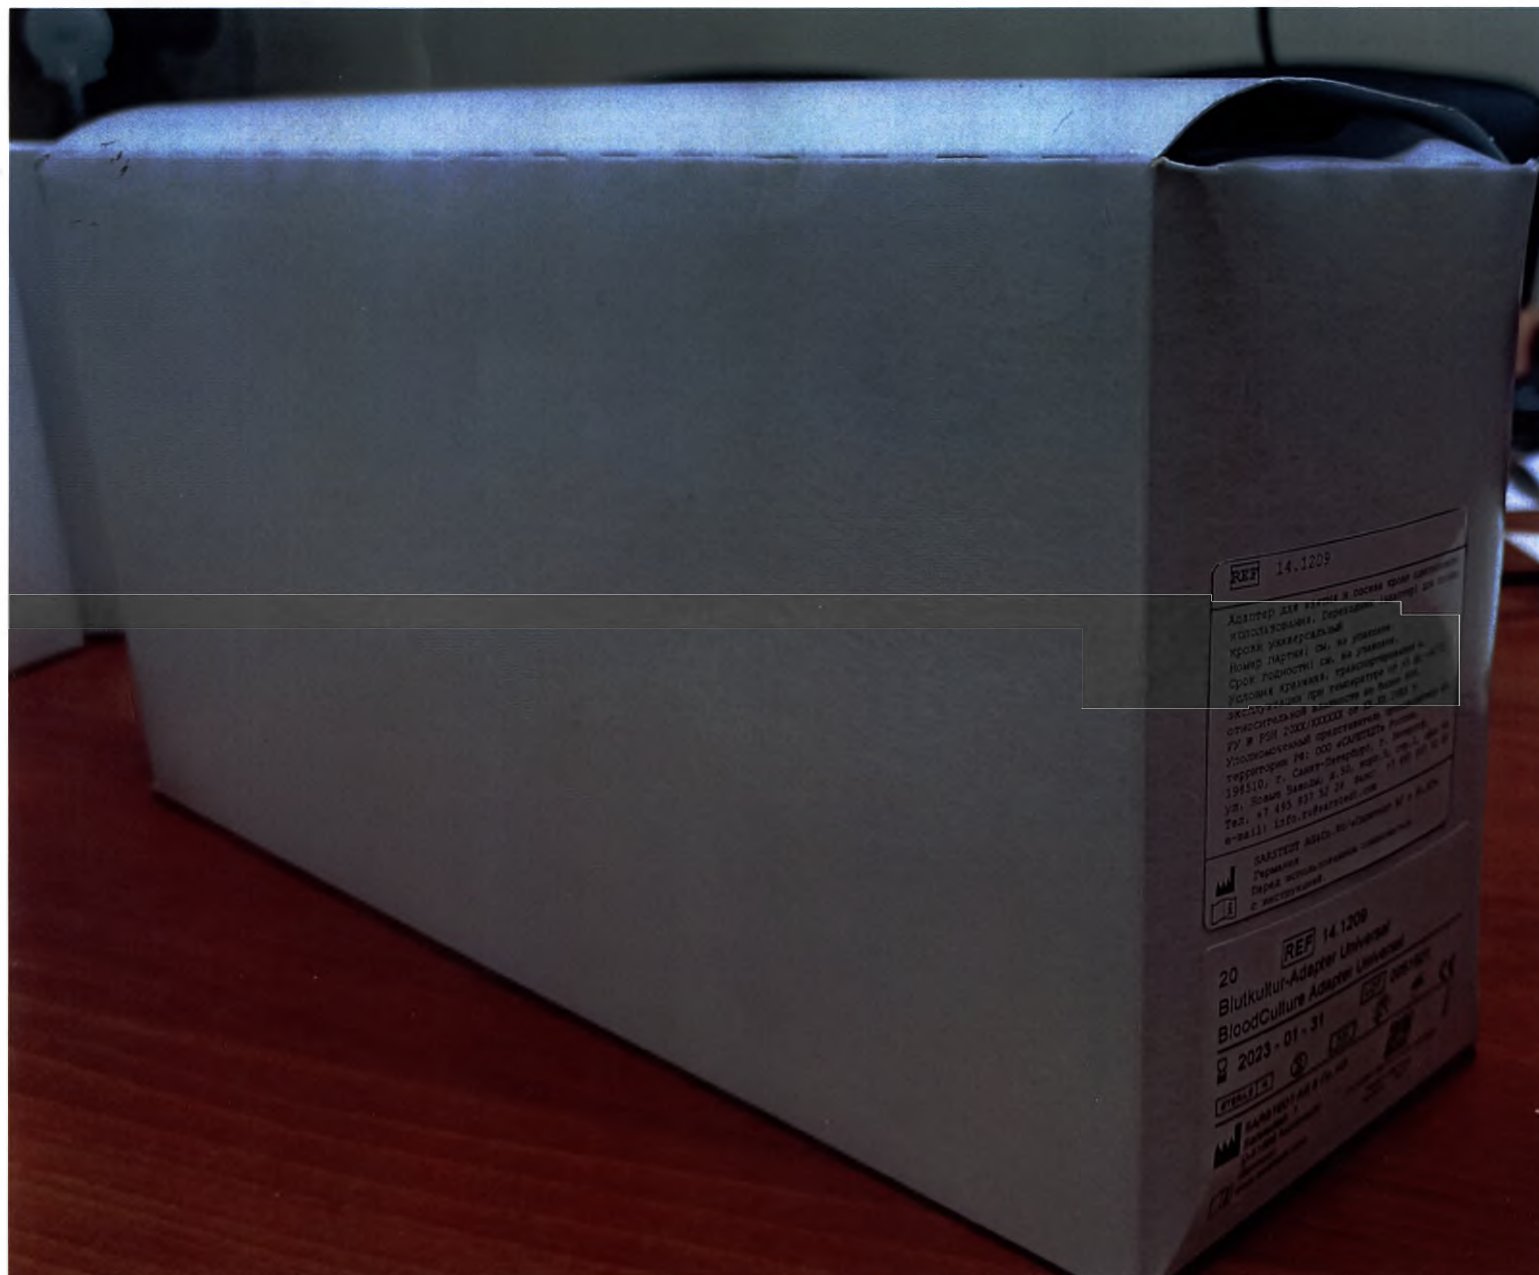


Рис 36. Групповая упаковка. Переходник (адаптер) для посева крови универсальный

Рис 37. Маркировка групповой упаковки. Переходник (адаптер) для посева крови LongNeck

REF 14.1207

Адаптер для взятия и посева крови одноразового использования. Переходник (адаптер) для посева крови LongNeck

Номер партии: см. на упаковке.

Срок годности: см. на упаковке.

Условия хранения, транспортирования и эксплуатации при температуре от +5 до +40°C, относительной влажности не более 80%.

Апирогенно. Нетоксично.

РУ № РЗН 20XX/XXXXXX от XX.XX.20XX г.

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: ООО «САРШТЕДТ» Россия, 198510, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Новые Заводы, д.50, корп.5, стр.1, офис 44

Тел. +7 495 937 52 28 Факс: +7 495 937 52 28

e-mail: info.ru@sarstedt.com

На территории Российской Федерации не является IVD

 SARSTEDT AG & Co. KG / «Сарштедт АГ и Ко.КГ» Германия

 Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

50 **REF** 14.1207

Blutkultur-Adapter LongNeck

Blood Culture Adapter LongNeck

 2023 - 02 - 28 **LOT** 0051421

STERILE  **IVD**   **CE**

 SARSTEDT AG & Co. KG
Sarstedtstr. 1
D-51588 Nümbrecht
Germany
 www.sarstedt.com

(01) 0 4038917 38418 8 (17) 230226 (10) 0051421

Made in Germany
20-03-30 07:52

S044176



Рис 38. Групповая упаковка. Переходник (адаптер) для посева крови LongNeck

Пронумеровано прошито и
скреплено печатью

38 (тридцать восемь) листа(-ов)

Генеральный директор
ООО «САРШТЕДТ»

Белунин А.В.

