




Фотографии медицинского изделия
Видеокомплекс эндоскопический для гибкой
эндоскопии «Эндовижн-МТ»,
производства АО «МТЛ», Россия

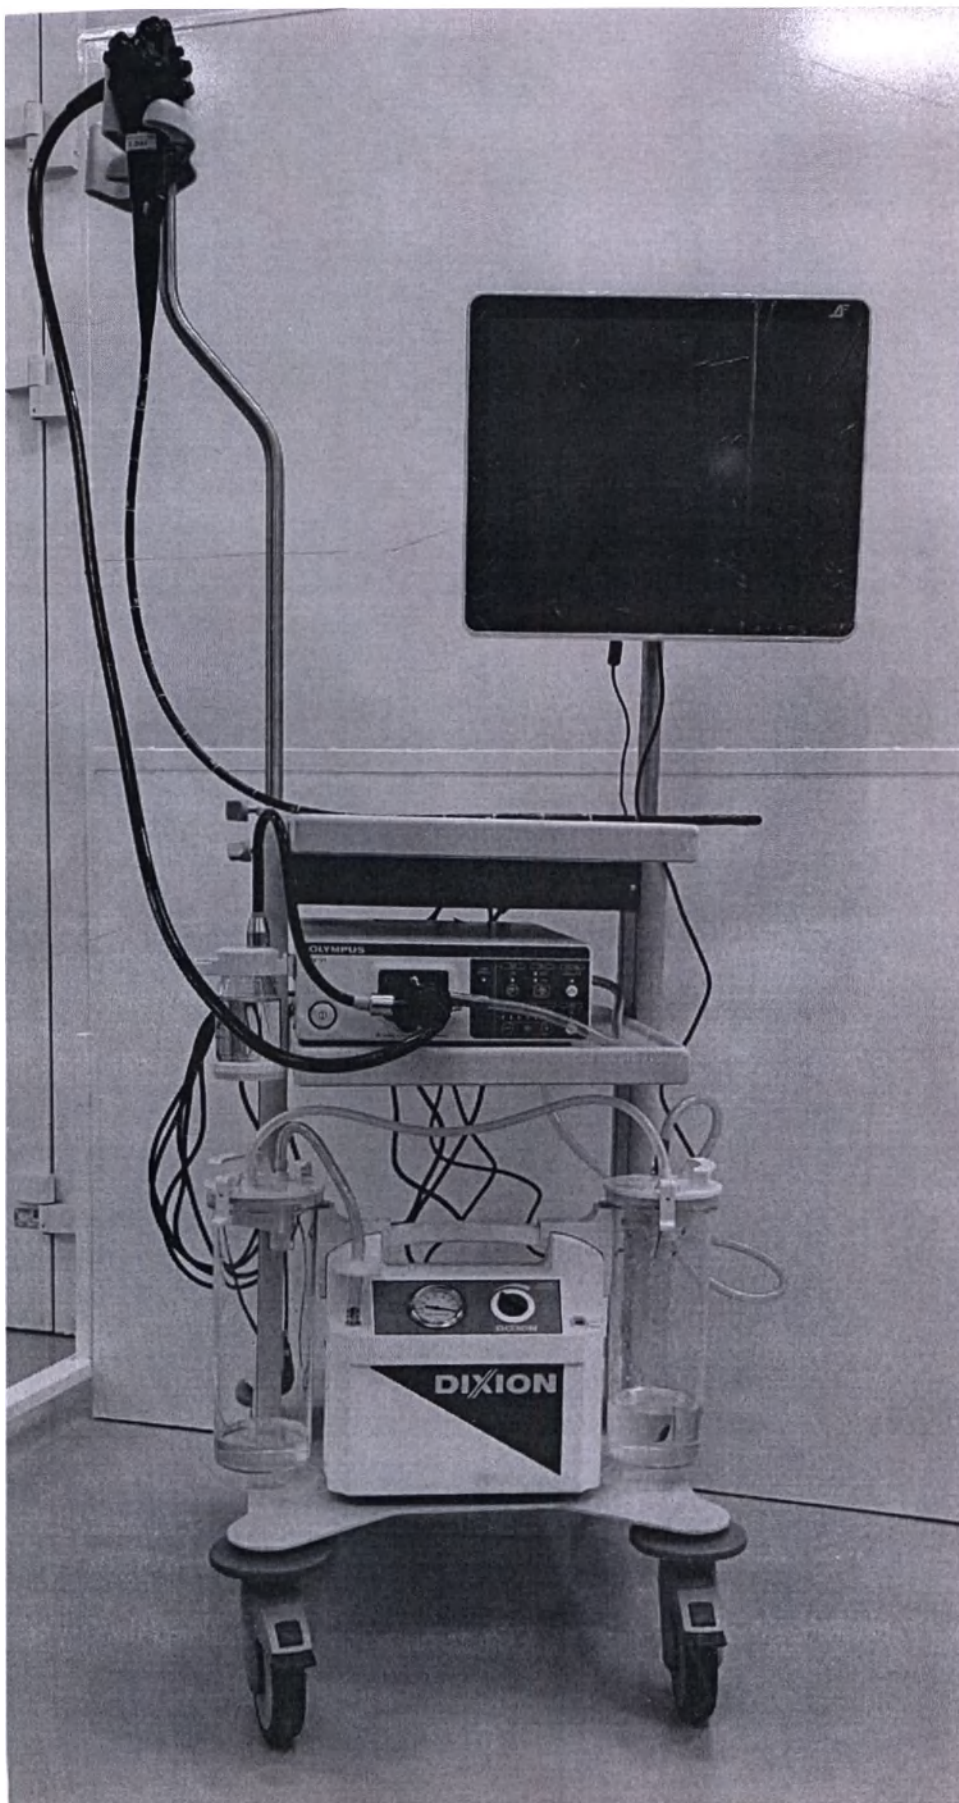


Видеокomплекс эндоскопический для гибкой эндоскопии
«Эндовижн-МТ», производства АО «МТЛ», Россия

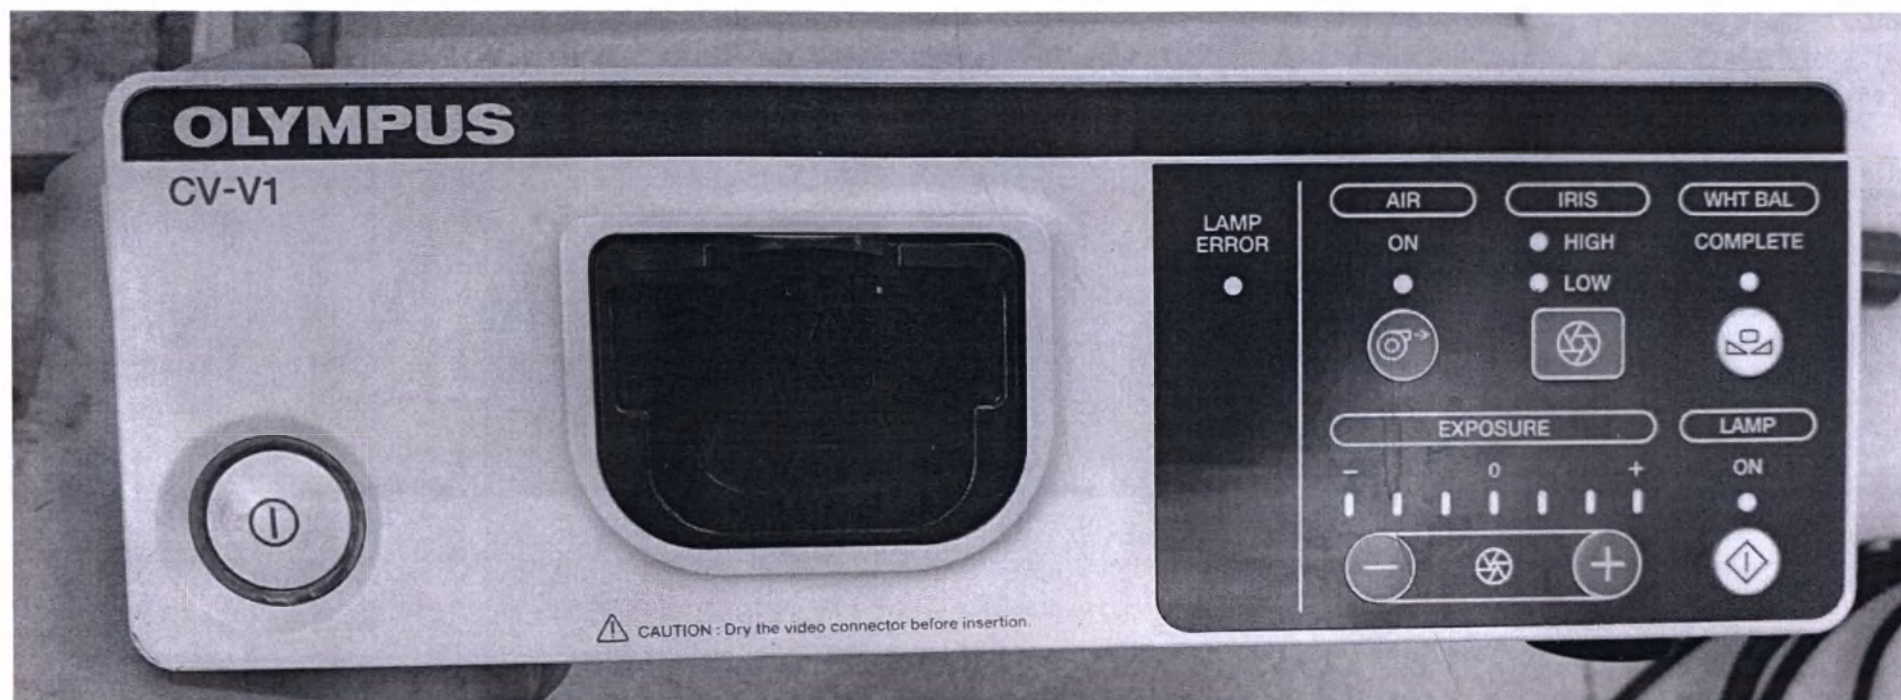

Эндоскопический видеоинформационный центр с принадлежностями CV-V1, производства Olympus Medical Systems Corporation, Япония (ПУ №ФСЗ 2012/12491)

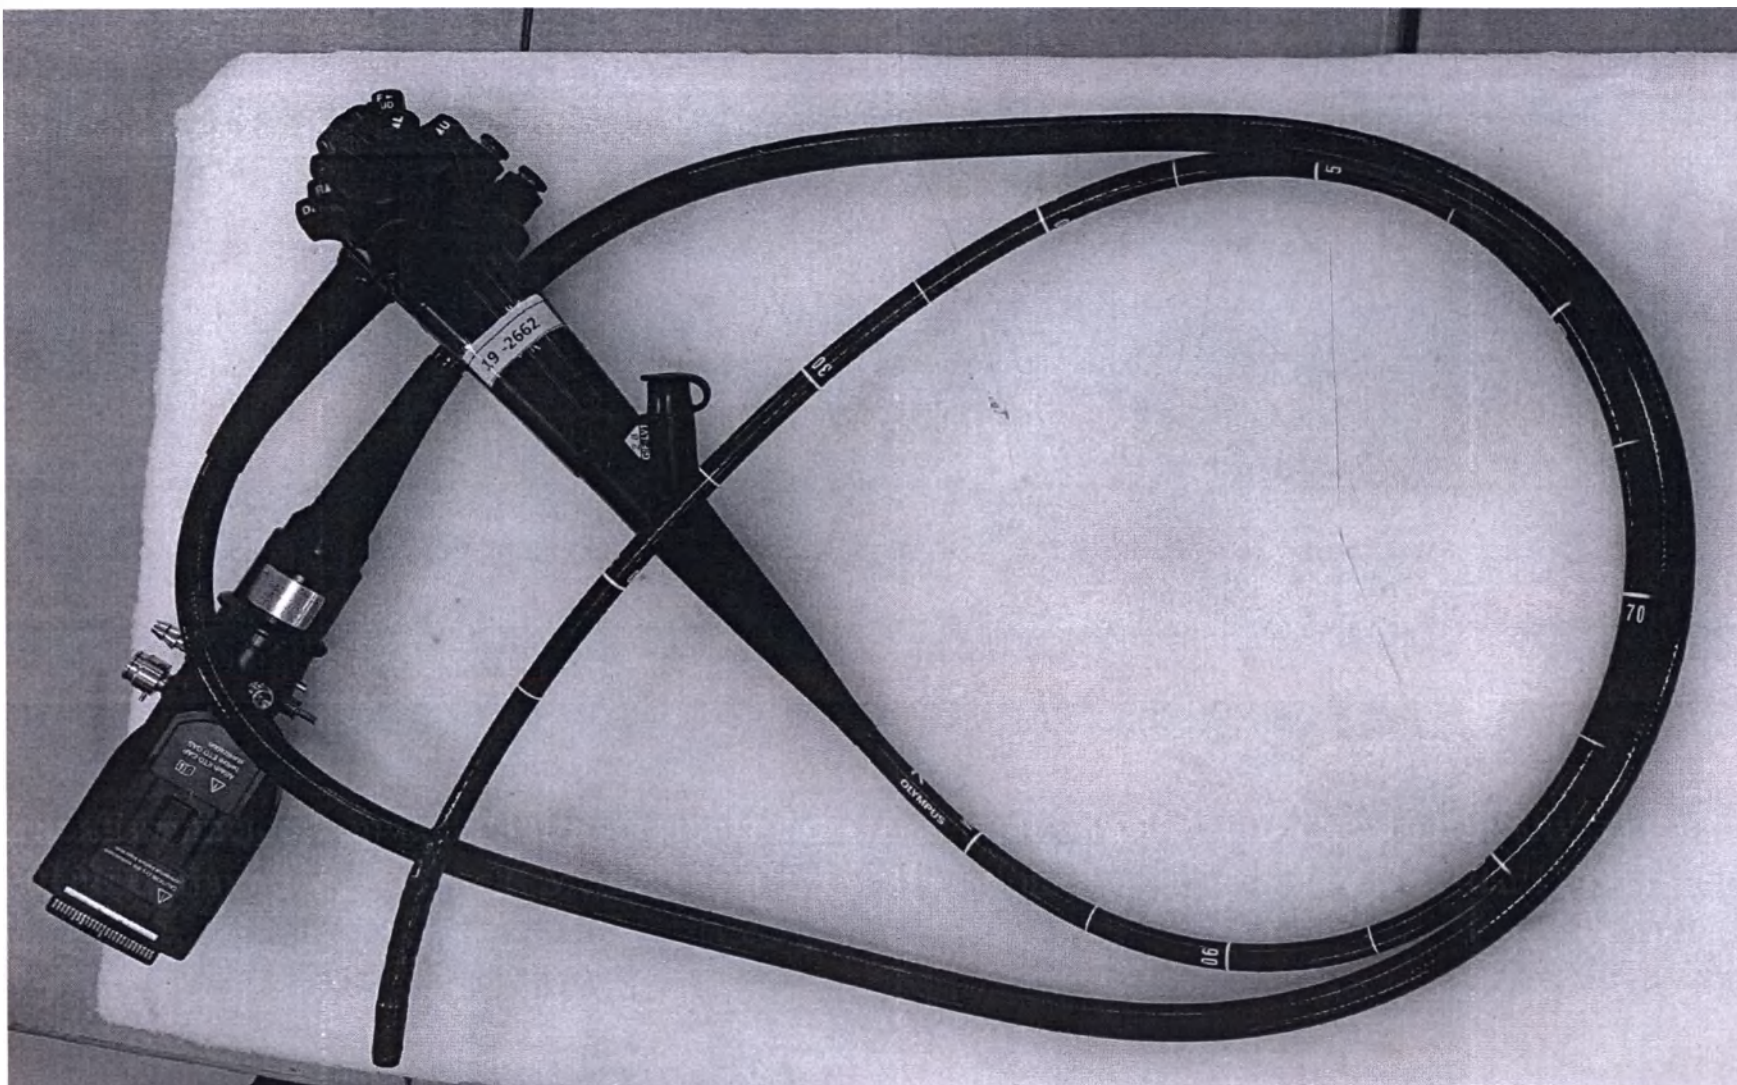


Гастроинтестинальный видеоэндоскоп GIF-LV1, производства Olympus Medical Systems Corporation, Япония (РУ № ФСЗ 2012/12490)

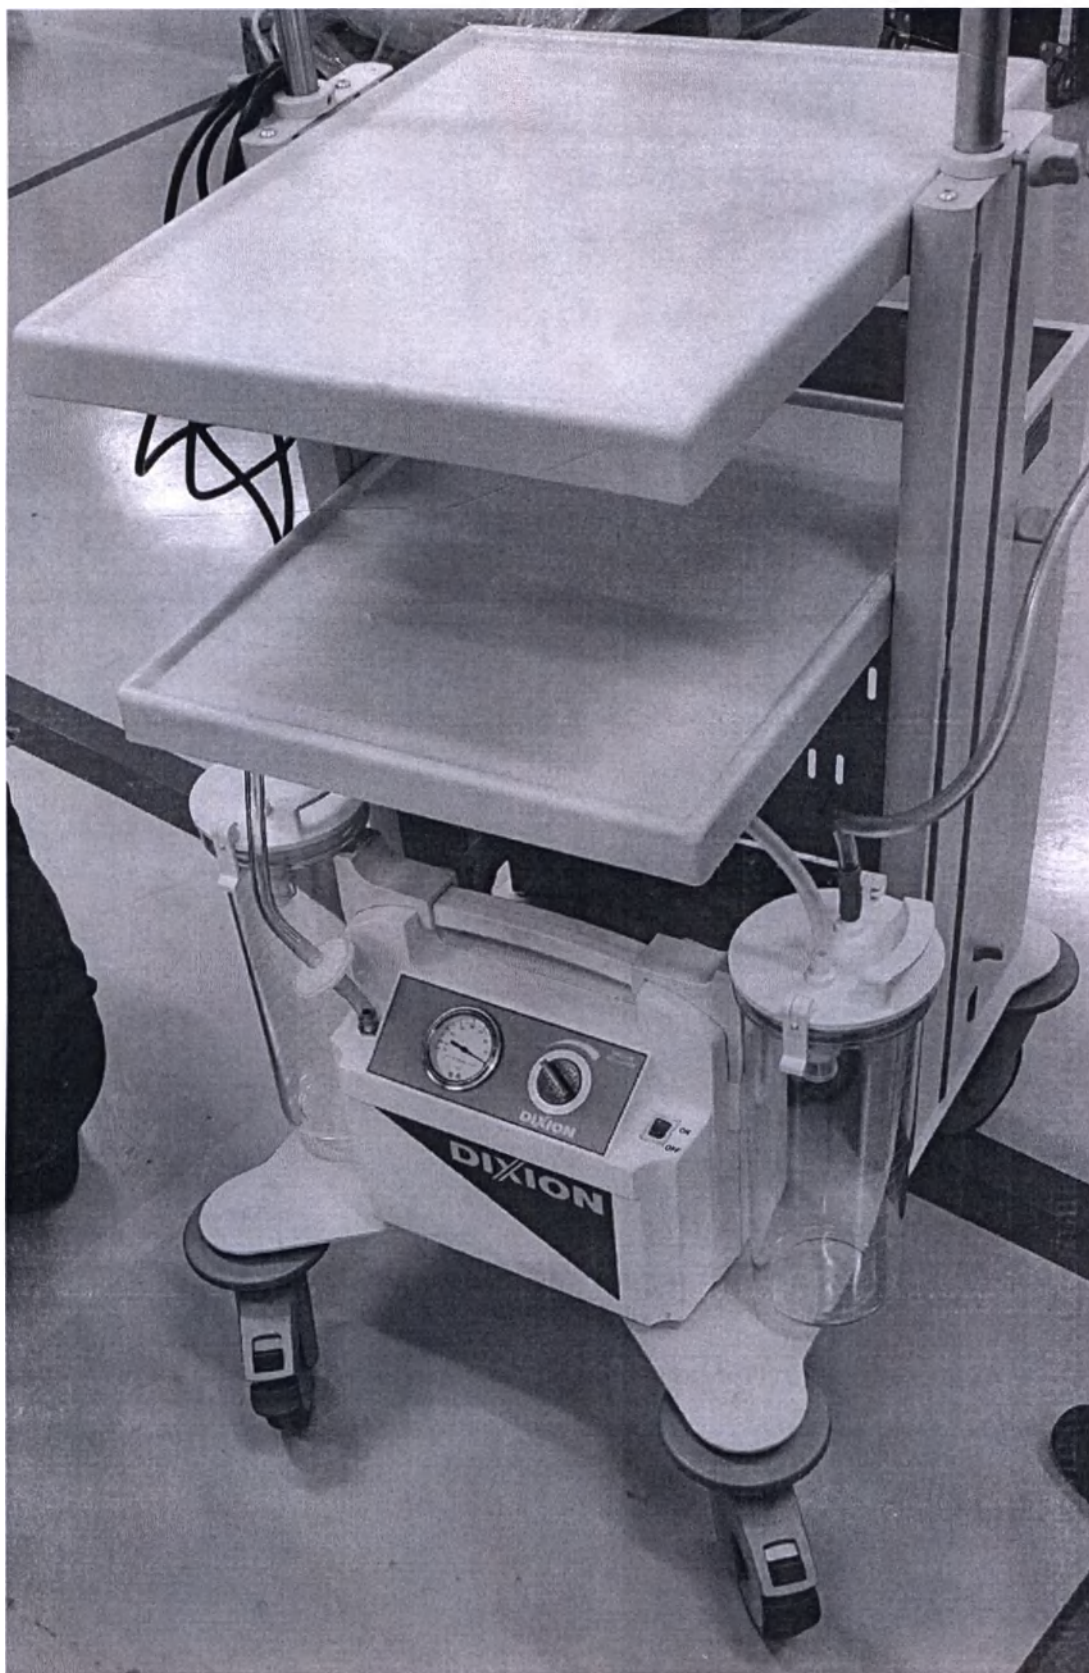

Стойка медицинская для аппаратуры СА-4, производства ООО «Мединдустрия сервис», Республика Беларусь (ПУ № РЗН 2015/3533)



Экстрактор вакуумный "Вакус" по ТУ 9444-005-74487176-2010, Вакус-7032, производства ООО "ДИКСИОН", Россия (РУ № ФСР 2010/08658)

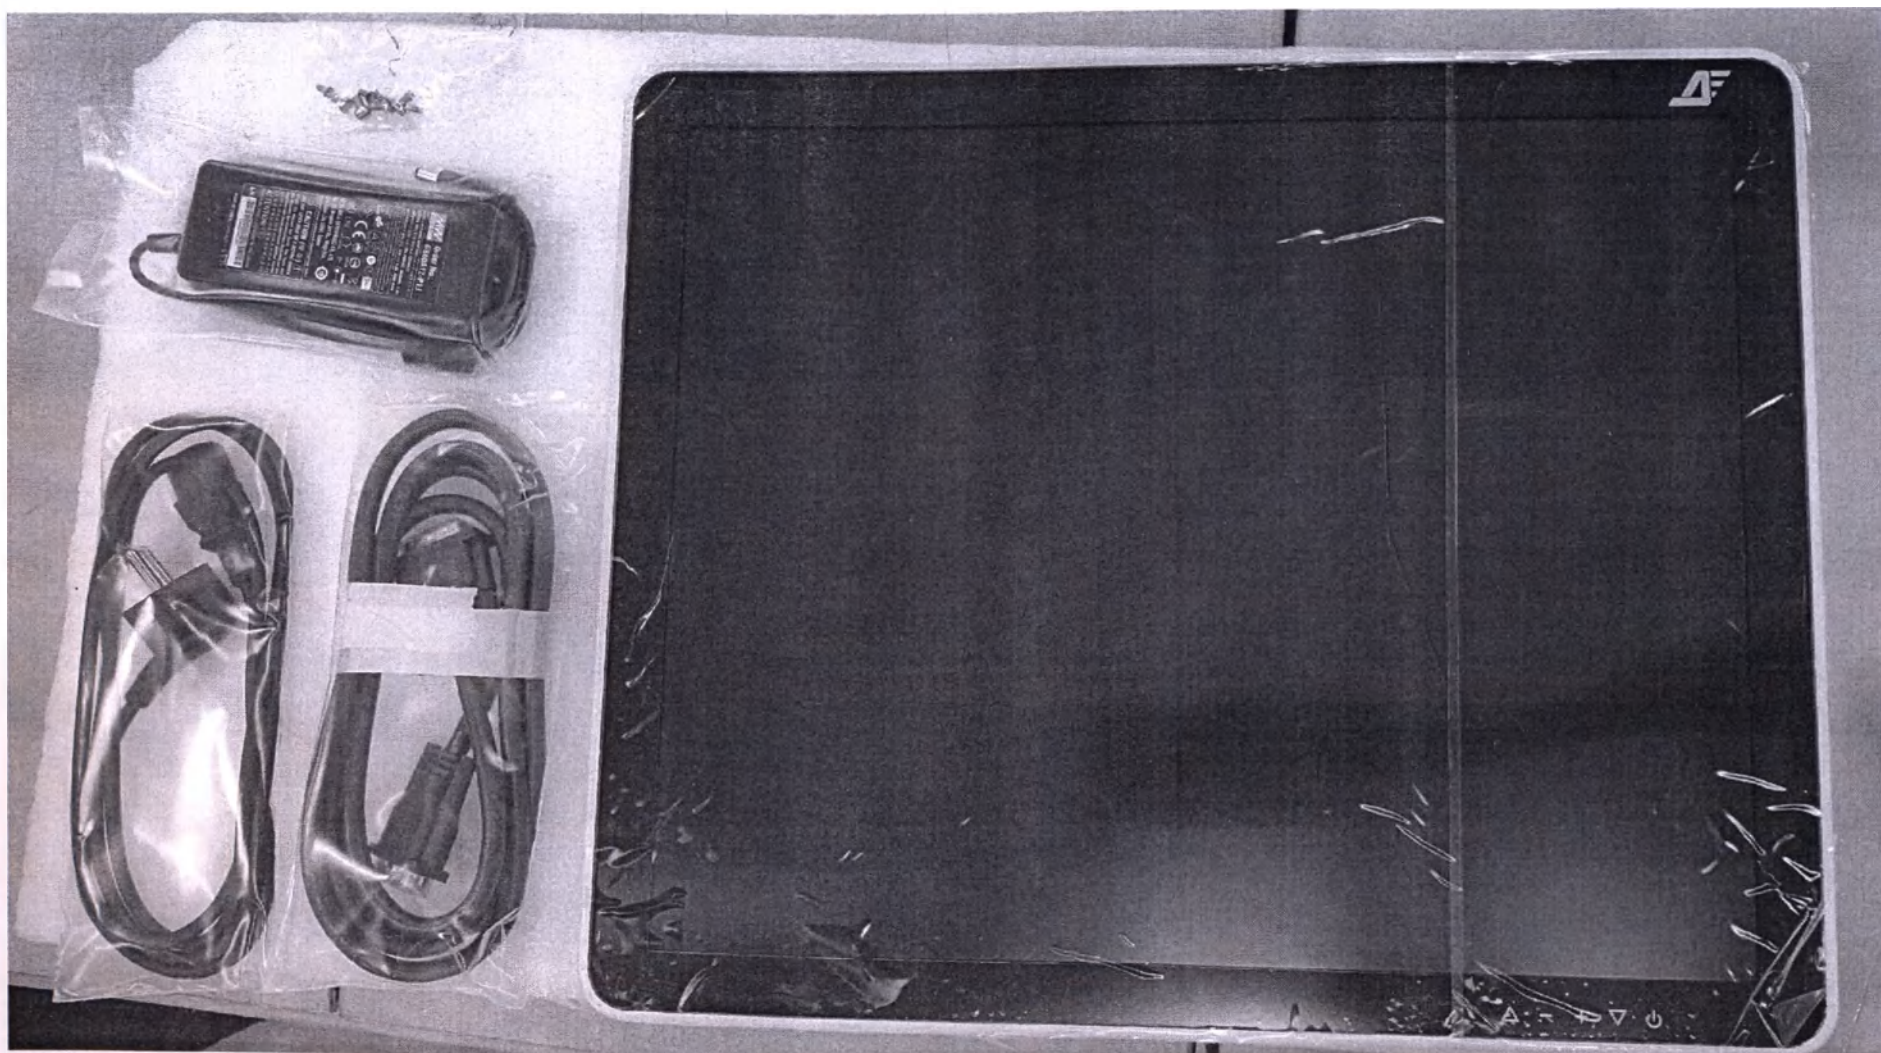

Дисплей медицинский от 15 до 42 дюймов ДМ, производства ЗАО «Аксиома-Сервис», Россия (РУ № РЗН 2013/855)

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 4 листов
Генеральный директор
И.В. Эйлазов



**Фотографии упаковки и макета маркировки
медицинского изделия**


**«Видеокомплекс эндоскопический для
гибкой эндоскопии «Эндовижн-МТ»,**

производства

АО «МТЛ», Россия

Комплекс упакован в 5 коробок:


1. Эндоскопический видеоинформационный центр Olympus CV-V1

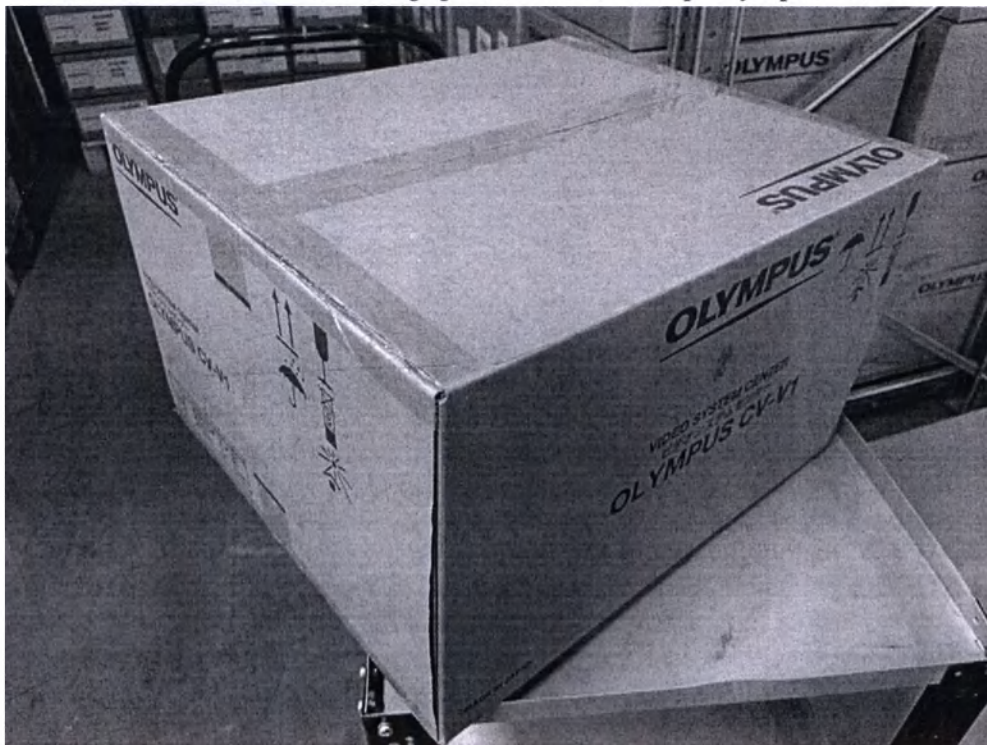


2. Экстрактор вакуумный "Вакус"



3. Гастроинтестинальный видеоэндоскоп GIF-LV1

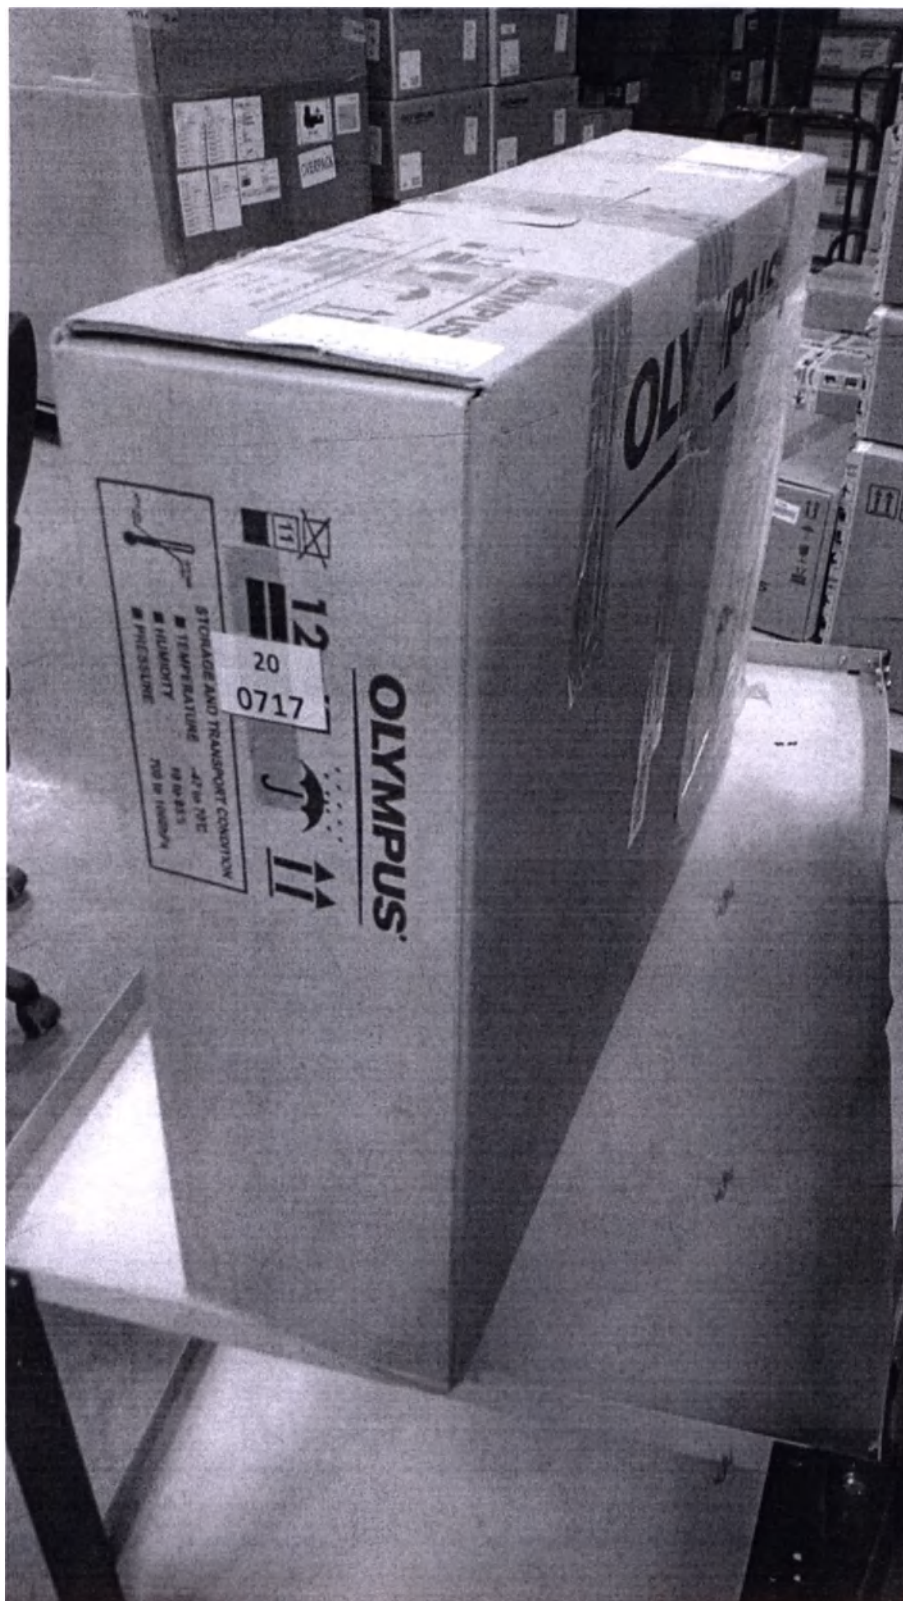


4. Дисплей медицинский ДМ

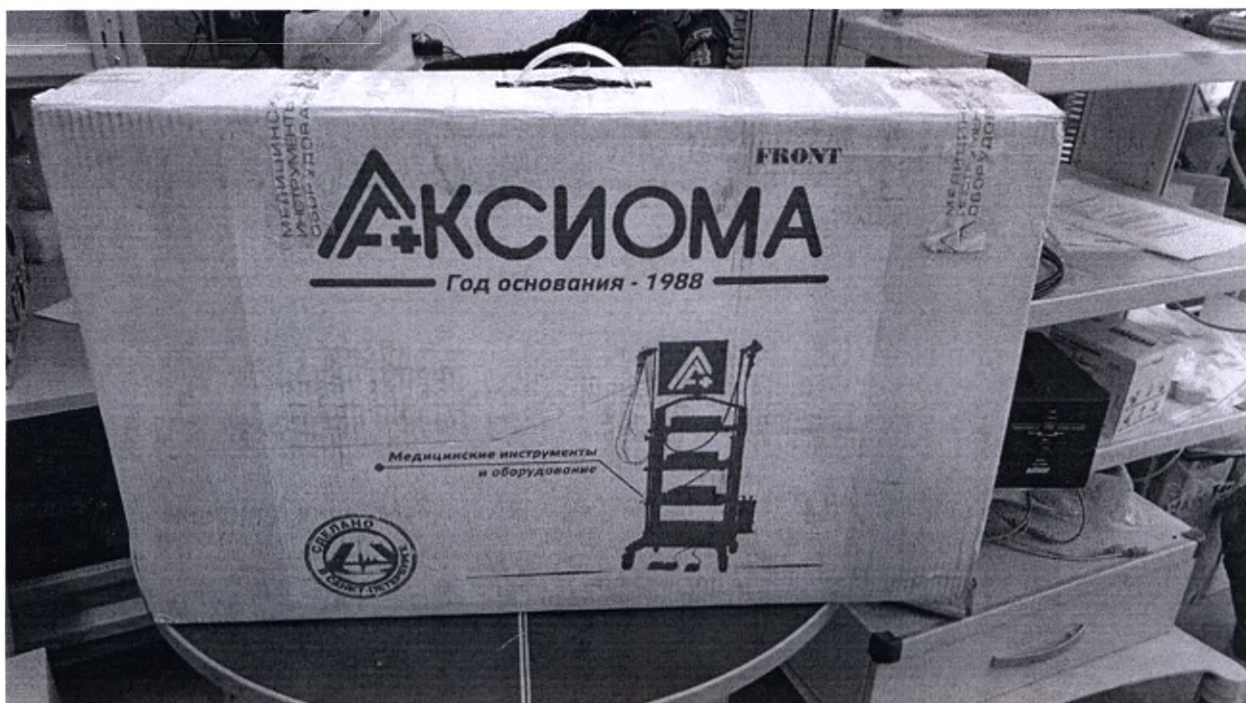

5. Стойка медицинская для аппаратуры СА



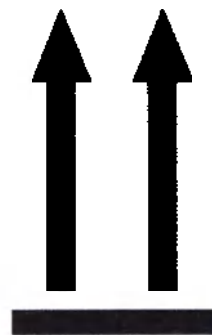

Видеокomплекс эндоскопический для гибкой эндоскопии «Эндовижн-МТ»

Заводской номер:



Макет маркировки изделия

АО «МТЛ»	
Видеокомплекс эндоскопический для гибкой эндоскопии «Эндовижн-МТ»	
Зав. номер	Питание: 1 ~ 220 В ± 10% 50 Гц ± 0,5Гц 60 Гц ± 0,6Гц
Дата выпуска	
ТУ 26.60.12-065-47245915-2020	
РУ	
Класс I Тип BF	
Сделано в России	

8

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью _____ листов
Генеральный директор _____

