



Общество с ограниченной ответственностью
«НПФ «МЕДТЕХМАРКЕТ» (ООО «НПФ «МЕДТЕХМАРКЕТ»)

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «НПФ «МЕДТЕХМАРКЕТ»


Б.С. Хышиктуев

2021г



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

**Станция стыковочная для инфузионных насосов SN, варианты
исполнения: SN-U4A, SN-U6, SN-U8, SN-W100, SN-W100H, SN-W100D, SN-
W100HD**

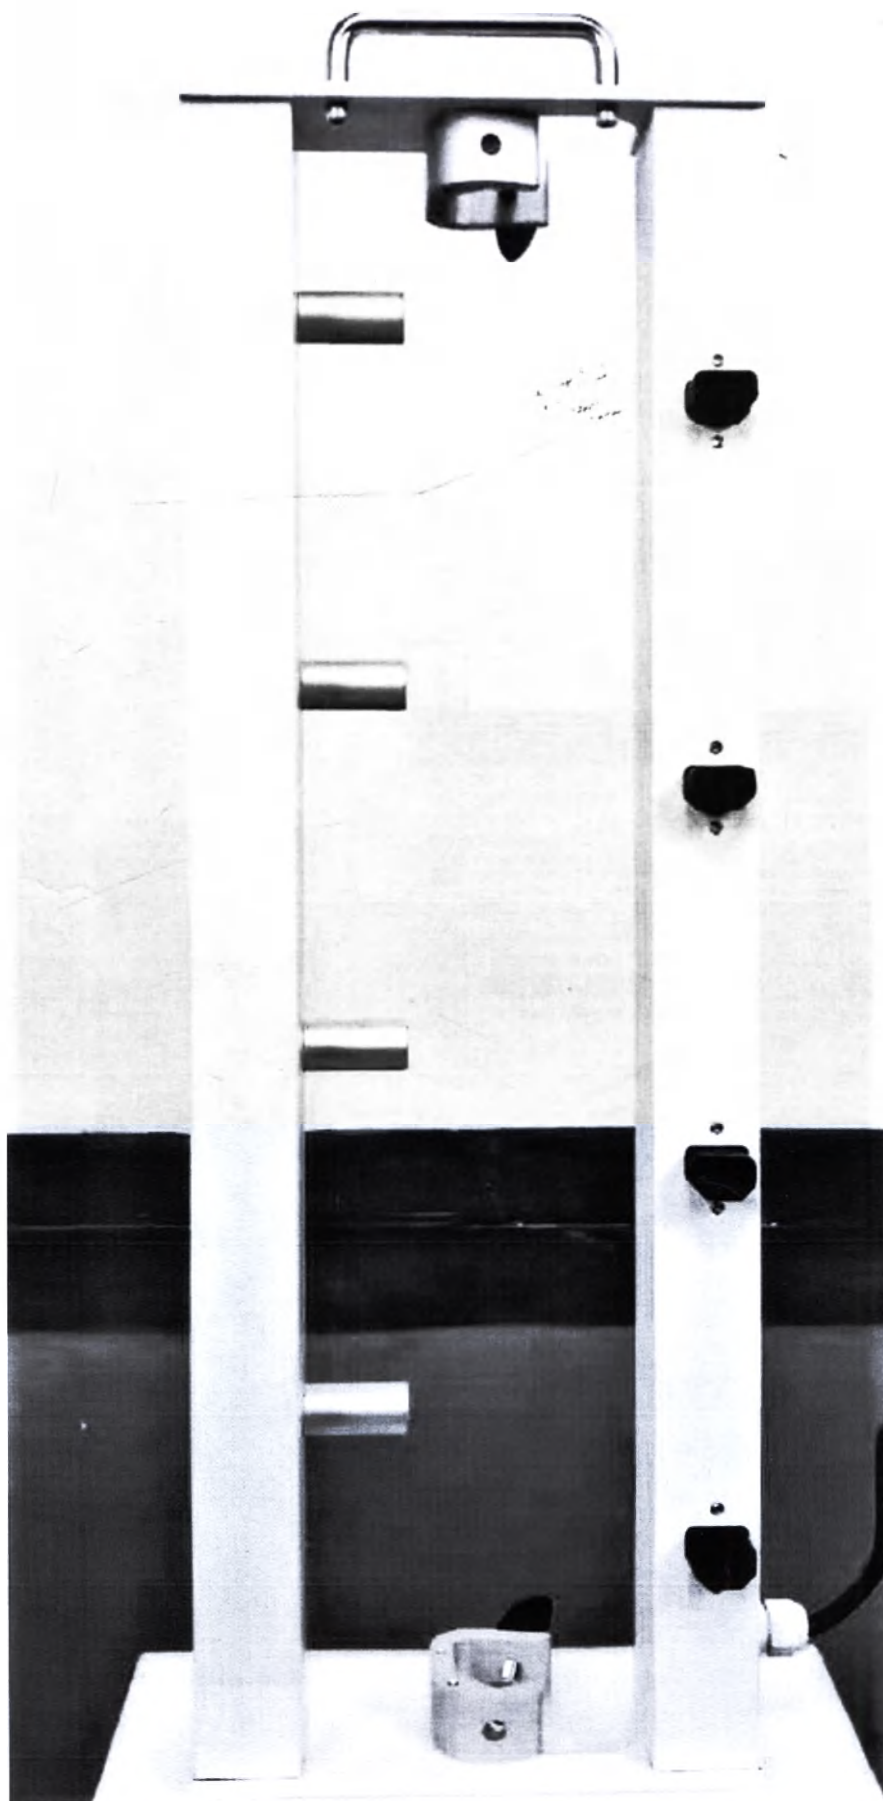

Фотографическое изображение станции стыковочной для инфузионных насосов SN-U4A.

1

2

Станция стыковочная
для инфузионных насосов

Модель: SN-U8

Безопасность: Class I IPX2

Sino Medical Device Technology Co., Ltd
Add: 6th Floor, Building 15, No 1408, Guanghua Road,
Nanshan District, Shenzhen City, P.R. China

Питание: AC 100В-240В

Частота питания: 50/60Гц

Потребляемая мощность: 330 Вт



2019-07-08



7419190714A00029



Фирма-изготовитель, уполномоченная на проведение сертификации ООО "ИВРО ТЕХНОЛОГИИ" г.
143519, Россия, Московская обл., г. Истрин, т. Истринское, ул. Пересыпская д. 19
этаж 5 кв. 2, телефон +7 (495) 636-66-11, адрес электронной почты: info@ivro.ru

Фотографическое изображение станции стыковочной для инфузионных насосов SN-U4A (1) вид
сбоку и информационного шильдика (2).



Фотографическое изображение станции стыковочной для инфузионных насосов SN-U6/SN-U8 в сборе.



2

Станция стыковочная
для инфузионных насосов
Модель: SN-U8
Безопасность: Class I IPX2

Sino Medical Device Technology Co., Ltd
Add: 9th Floor, Building 15, No 1009, Songhu Road,
Nanhai District, Shenzhen City, P.R.China


Организация, уполномоченная на проведение процедуры ООО "МЕДИТЕХМАРКЕТ"
143510 Россия Московская обл. г. Истрин, с. Истринское шоссе ул. Паромовский д. 29
тел 3, эл 2 телефон +7 (519) 435-00-12 адрес электронной почты info@meditehmarket.ru

2019-08-08

7419190714A00029


Питание: AC 100В-240В
Частота питания: 50/60Гц
Потребляемая мощность: 330 Вт

Фотографическое изображение станции стыковочной для инфузионных насосов SN-U6/SN-U8 в сборе (1) вид сбоку и информационного шильдика (2).

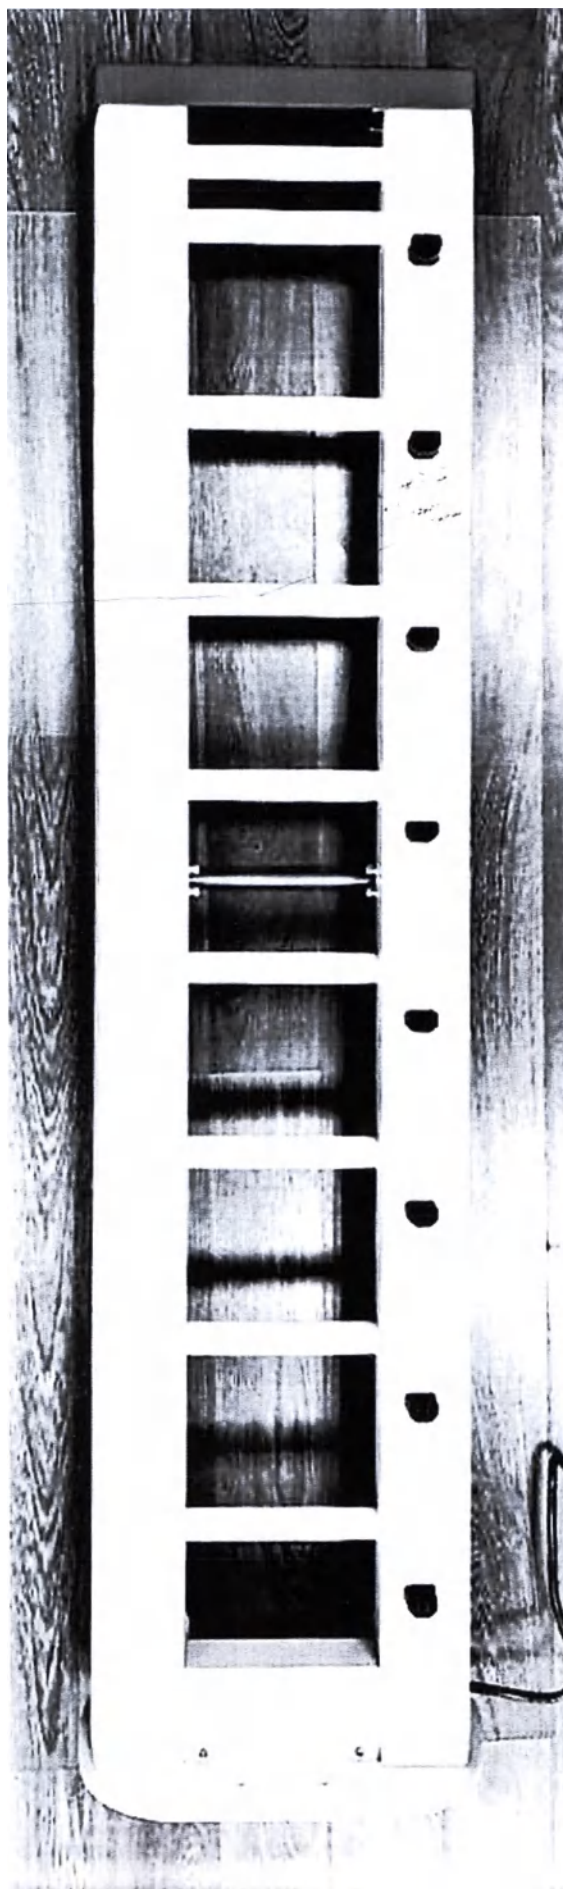


Фотографическое изображение коммуникационного модуля станции стыковочной для инфузионных насосов SN-U6/SN-U8.


1

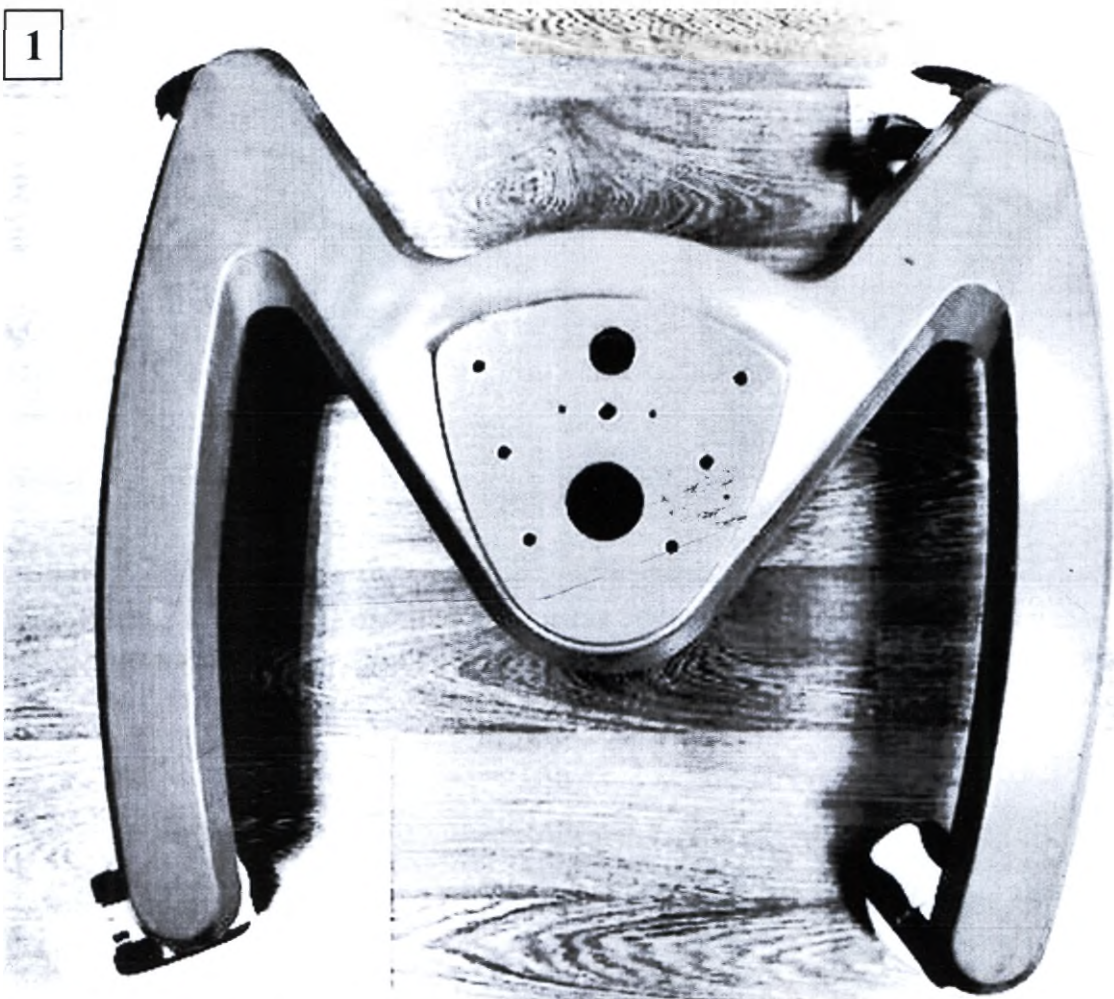


2

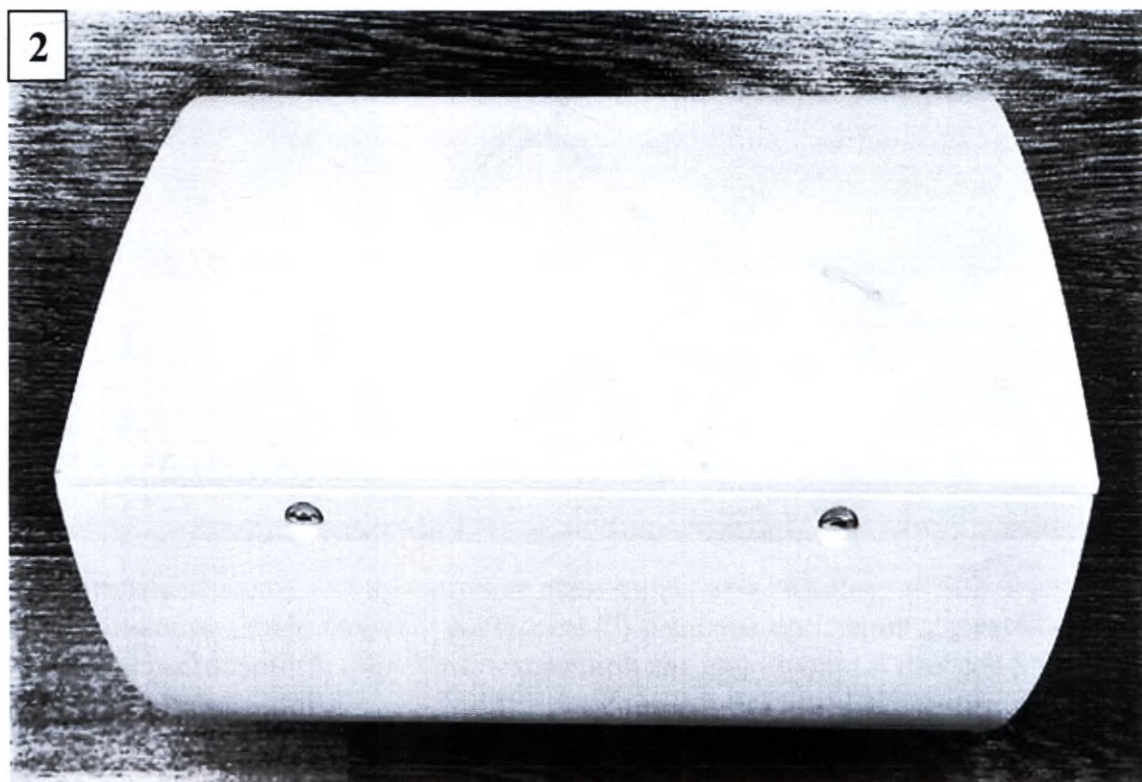


Фотографическое изображение колесного основания (1) и опорной рамы (2) станции стыковочной для инфузионных насосов SN-U6/SN-U8.

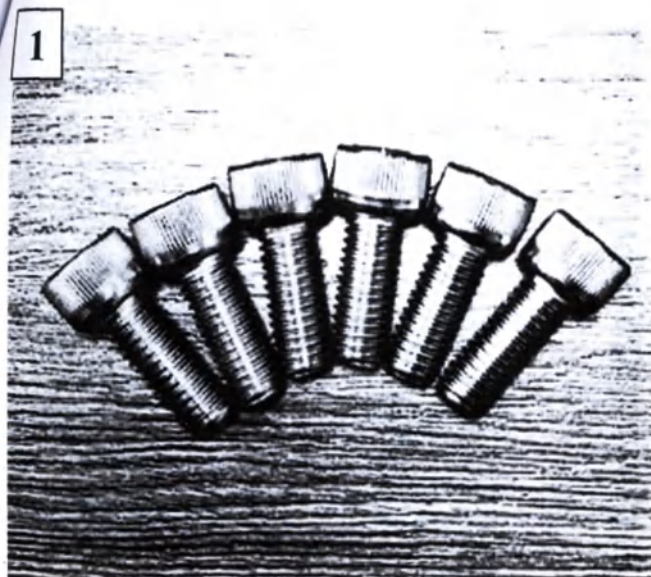


Фотографическое изображение винтов крепления опорной рамы к колесному основанию (1) и винтов крепления коммуникационного модуля к опорной раме (2) станции стыковочной для инфузионных насосов SN-U6/SN-U8.

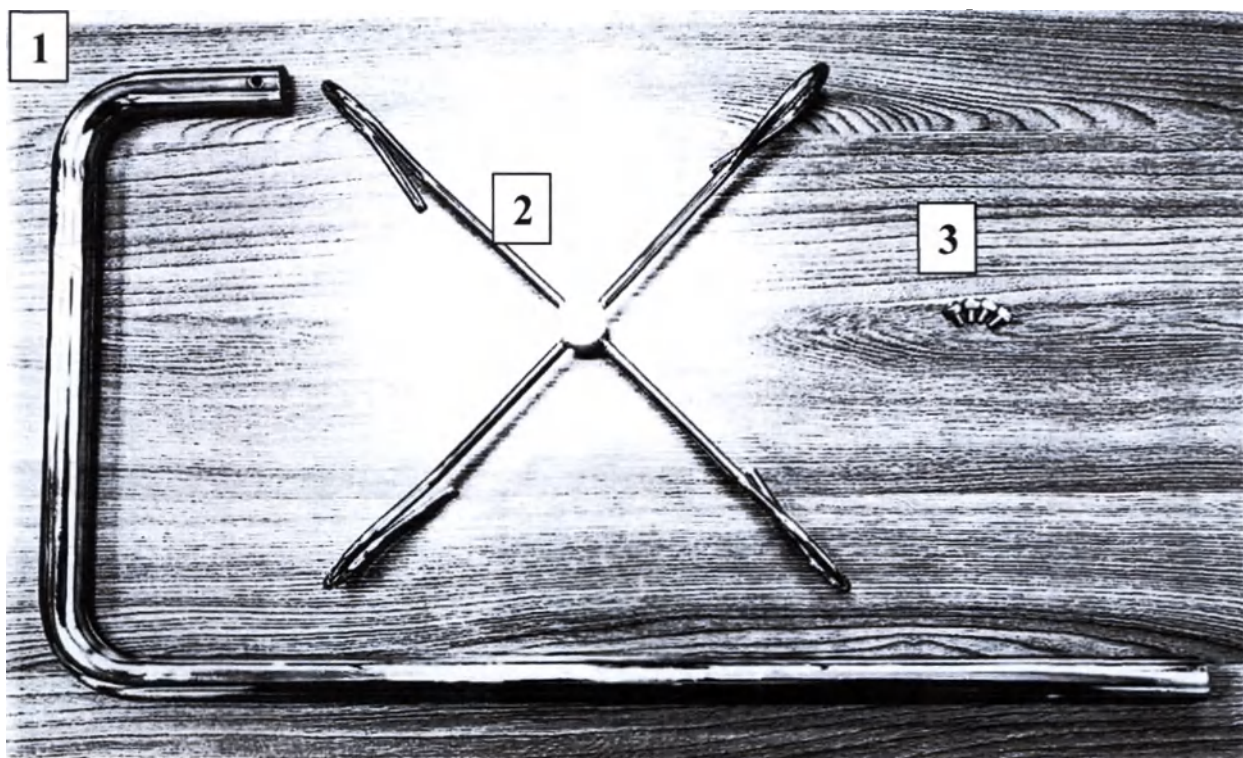

Фотографическое изображение кронштейна держателя емкости с инфузионным раствором (1), держателя емкости с инфузионным раствором (2) и винтов крепления держателя емкости с инфузионным раствором (3) станции стыковочной для инфузионных насосов SN-U6/SN-U8.

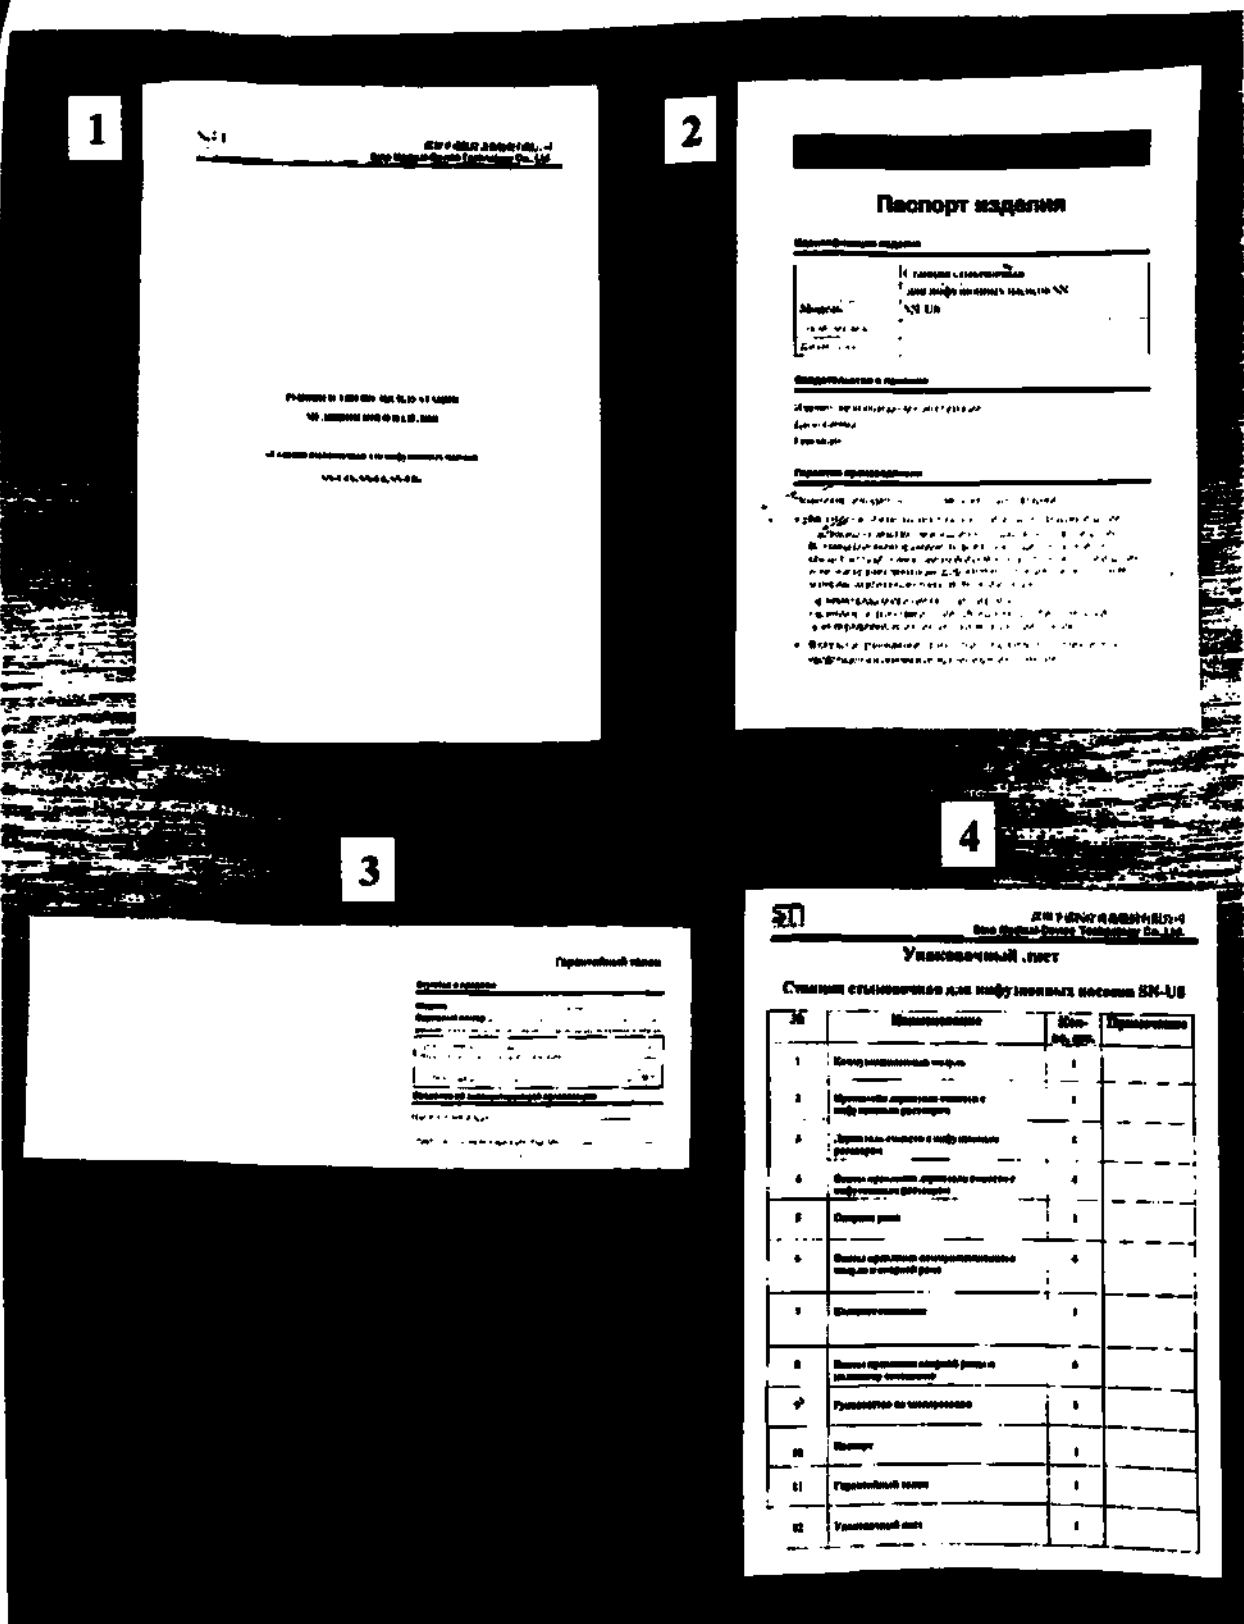


Фотографическое изображение руководства по эксплуатации (1), паспорта (2), упаковочного листа (3) и гарантийного талона (4) стыковочной для инфузионных насосов SN-U6/SN-U8.

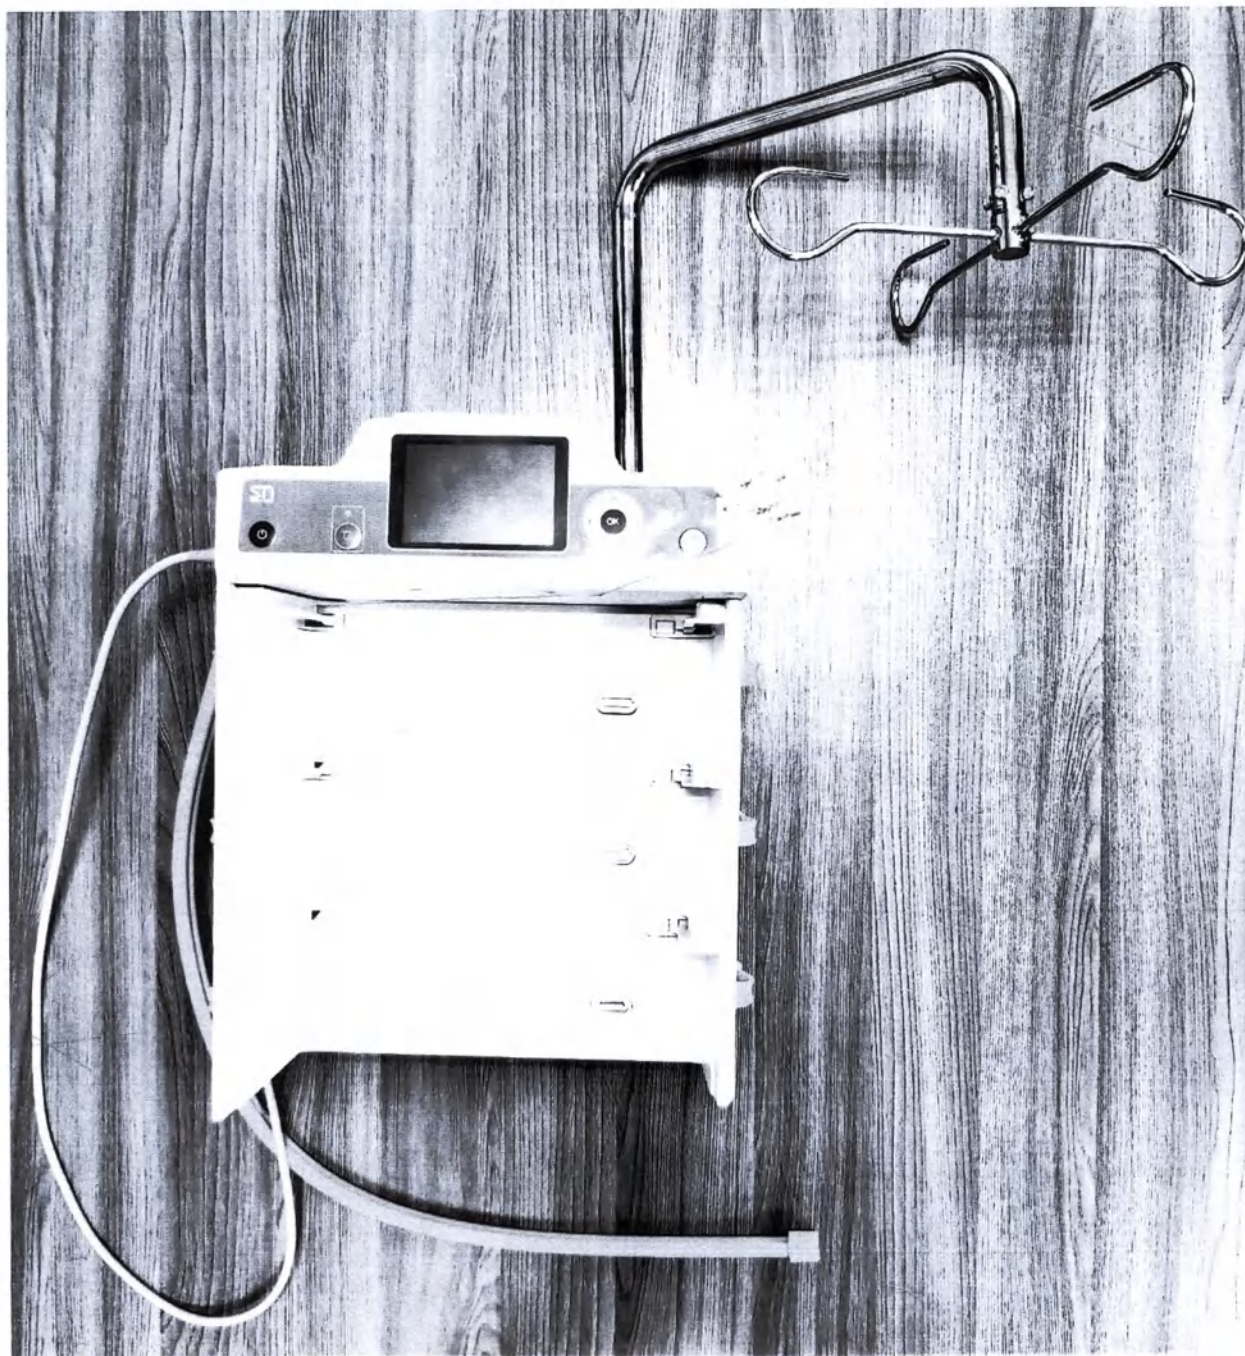


Фотографическое изображение станции стыковочной для инфузионных насосов SN-W-100/SN-W100H/SN-W100D/SN-W100HD в сборе.




Фотографическое изображение блока управления станции стыковочной для инфузионных насосов SN-W-100/SN-W100H/SN-W100D/SN-W100HD.

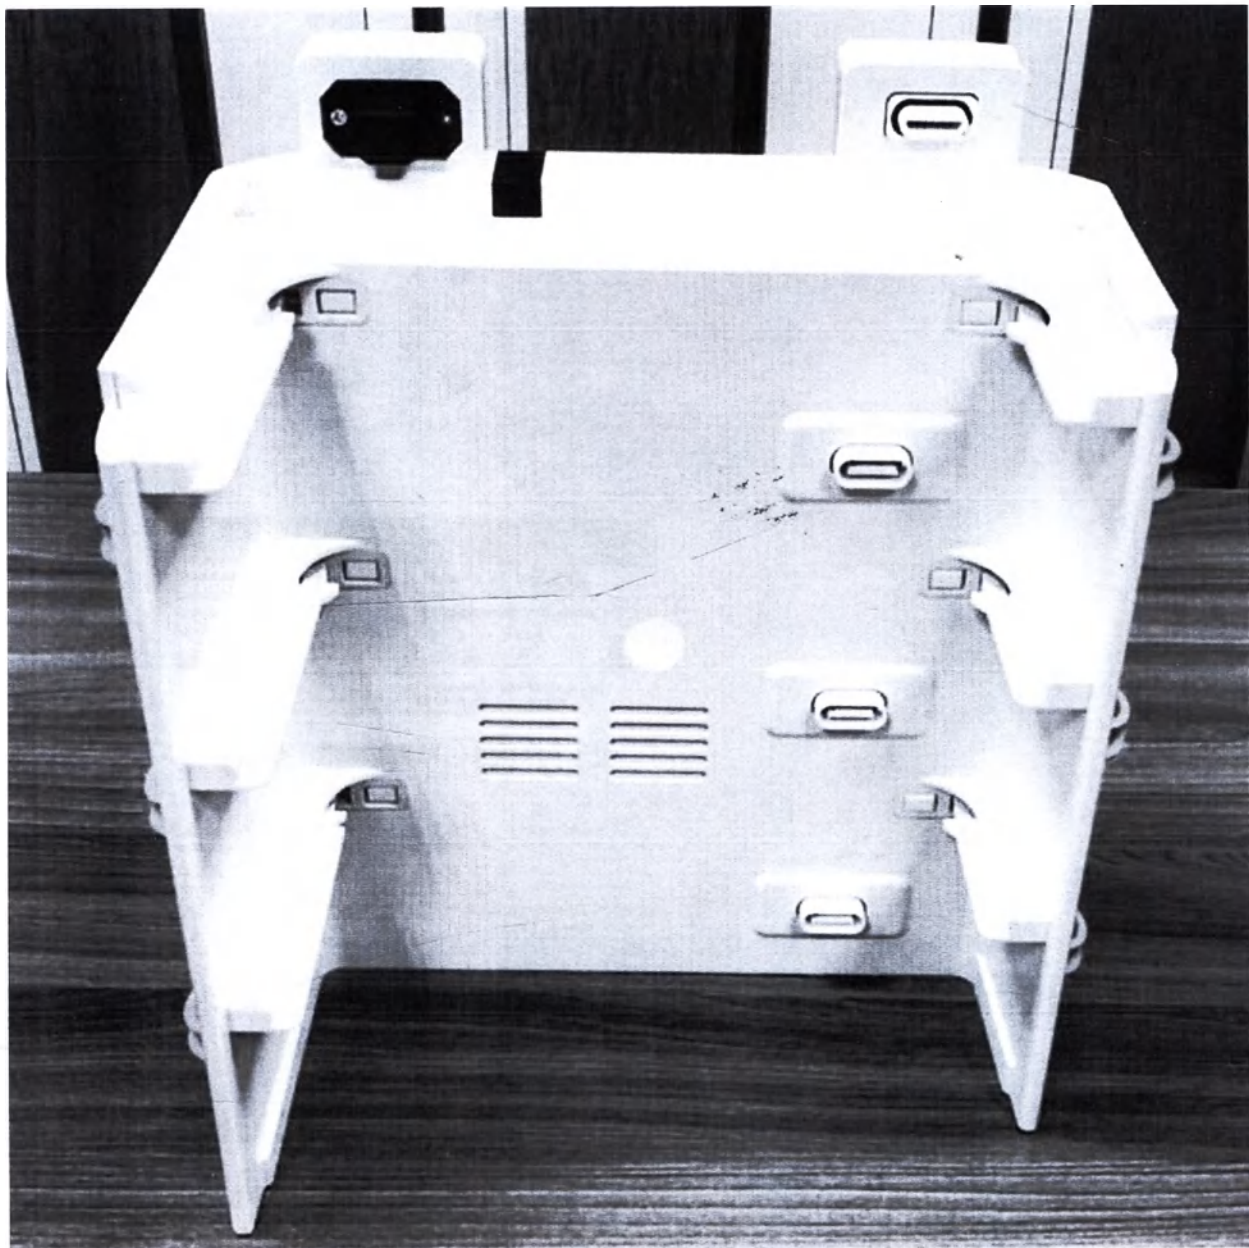

Фотографическое изображение коммуникационного модуля (дополнительного коммуникационного модуля) станции стыковочной для инфузионных насосов SN-W100/SN-W100H/SN-W100D/SN-W100HD.

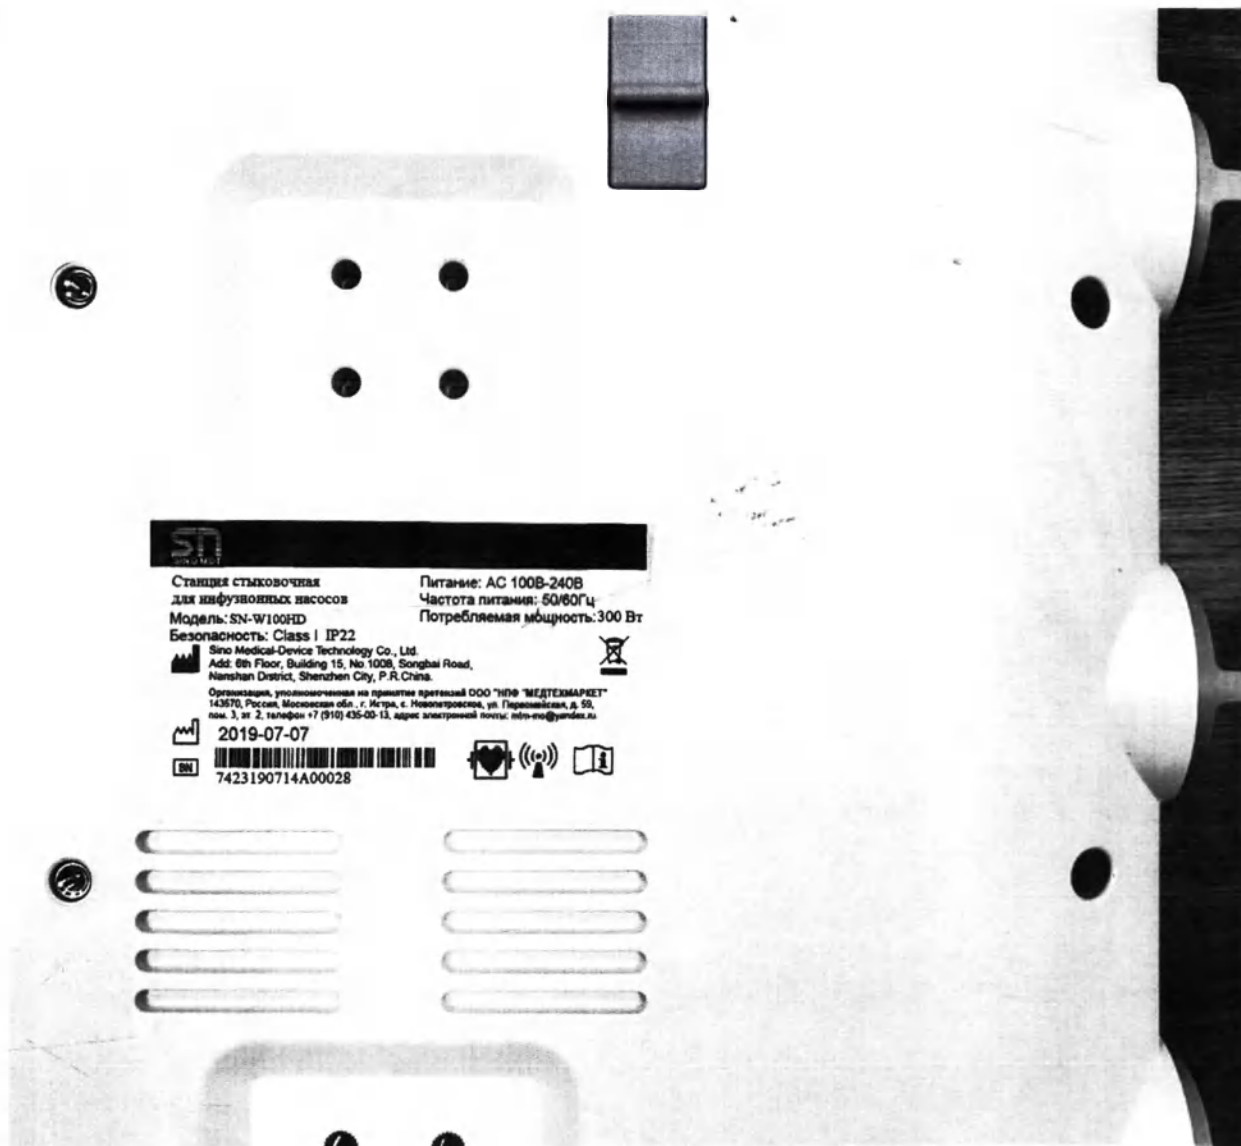


Фотографическое изображение коммуникационного модуля (дополнительного коммуникационного модуля) станции стыковочной для инфузионных насосов SN-W100/SN-W100H/SN-W100D/SN-W100HD. Вид сзади.

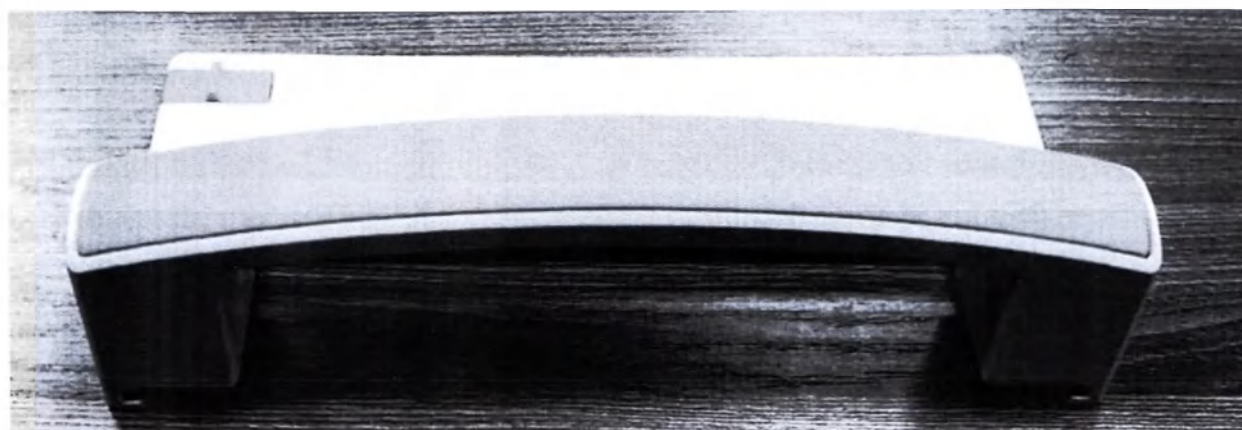


Фотографическое изображение ручки для переноски станции стыковочной для инфузионных насосов SN-W100/SN-W100H/SN-W100D/SN-W100HD.




Фотографическое изображение подогревателя инфузионного раствора станции стыковочной для инфузионных насосов SN-W100H/SN-W100HD.

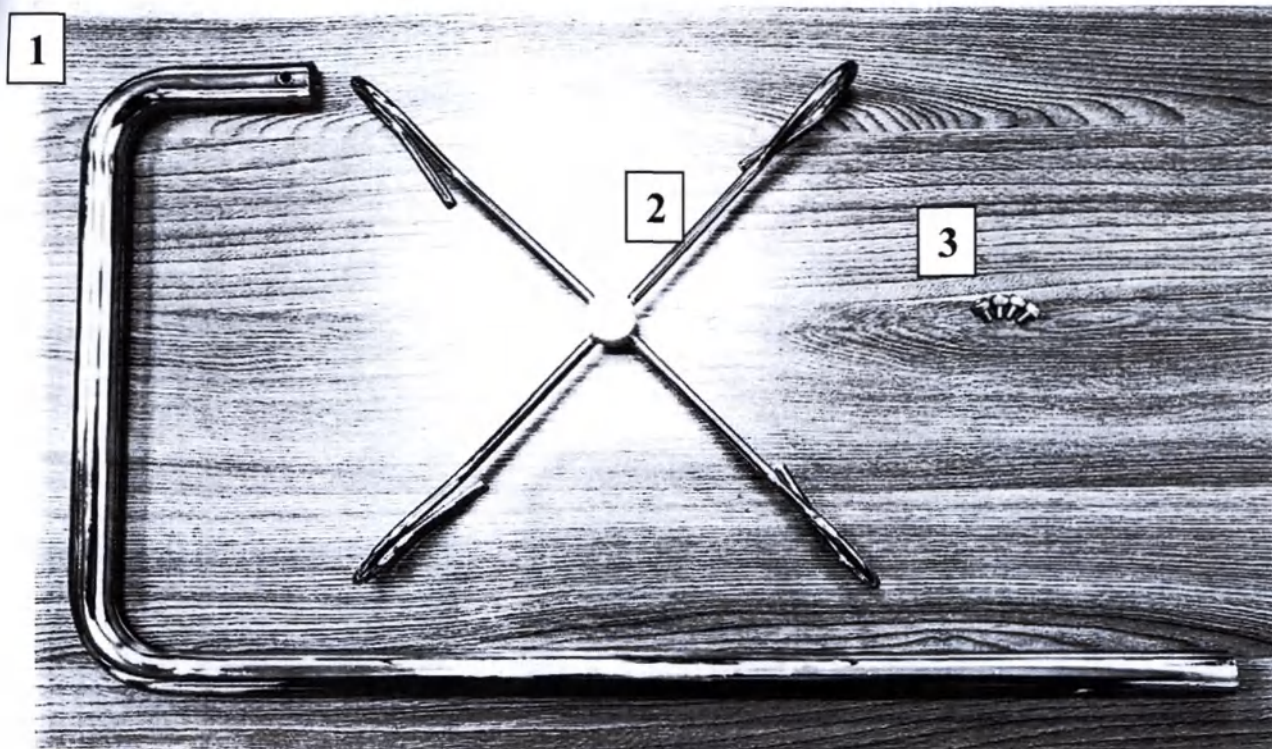


Фотографическое изображение кронштейна держателя емкости с инфузионным раствором (1), держателя емкости с инфузионным раствором (2) и винтов крепления держателя емкости с инфузионным раствором (3) станции стыковочной для инфузионных насосов SN-W100D/SN-W100HD.

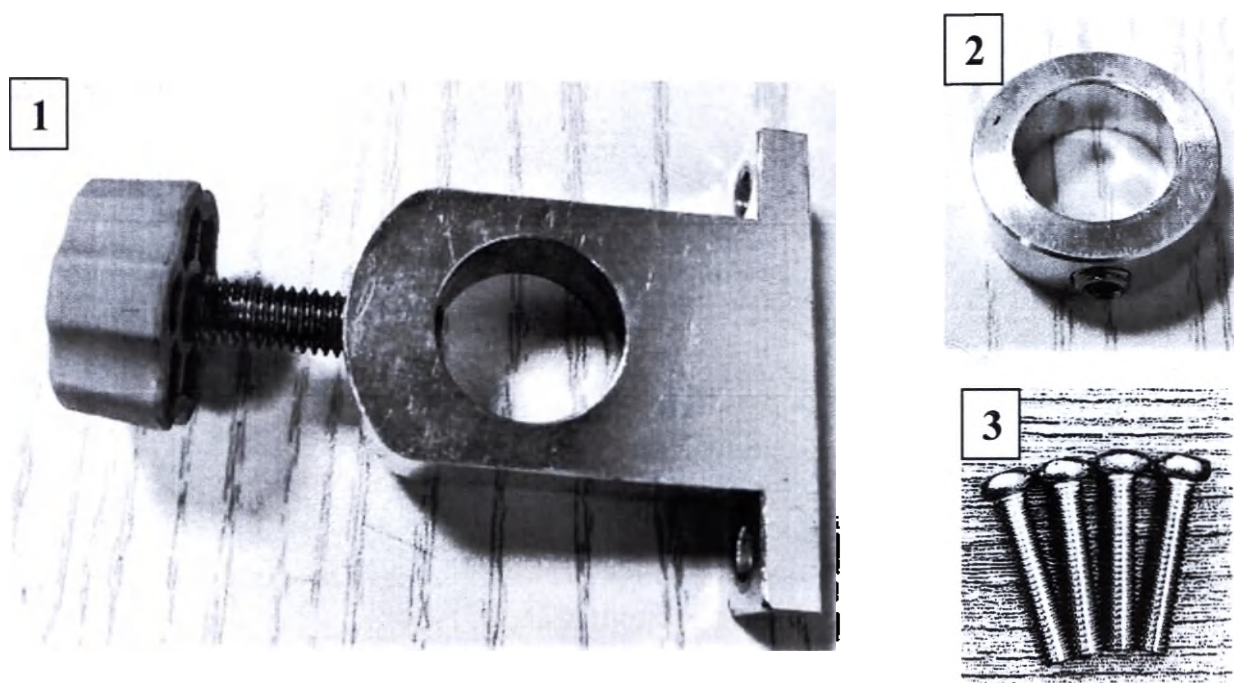

Фотографическое изображение удерживающей опоры держателя емкости с инфузионным раствором (1), стопорного кольца (2) и винтов крепления удерживающей опоры (3) станции стыковочной для инфузионных насосов SN-W100D/SN-W100HD.

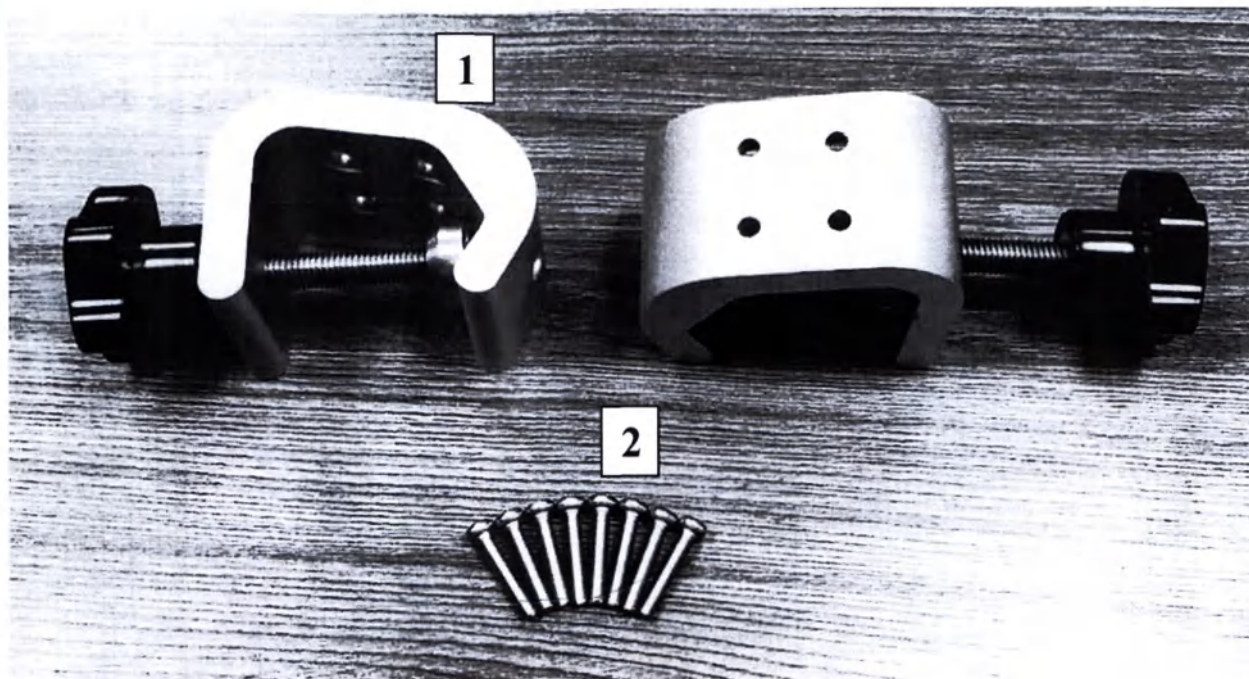

Фотографическое изображение крепления к стойке (дополнительного крепления к стойке) (1) и винтов для крепления к стойке (дополнительных винтов для крепления к стойке) (2) станции стыковочной для инфузионных насосов SN-W100/SN-W100H/SN-W100D/SN-W100HD.

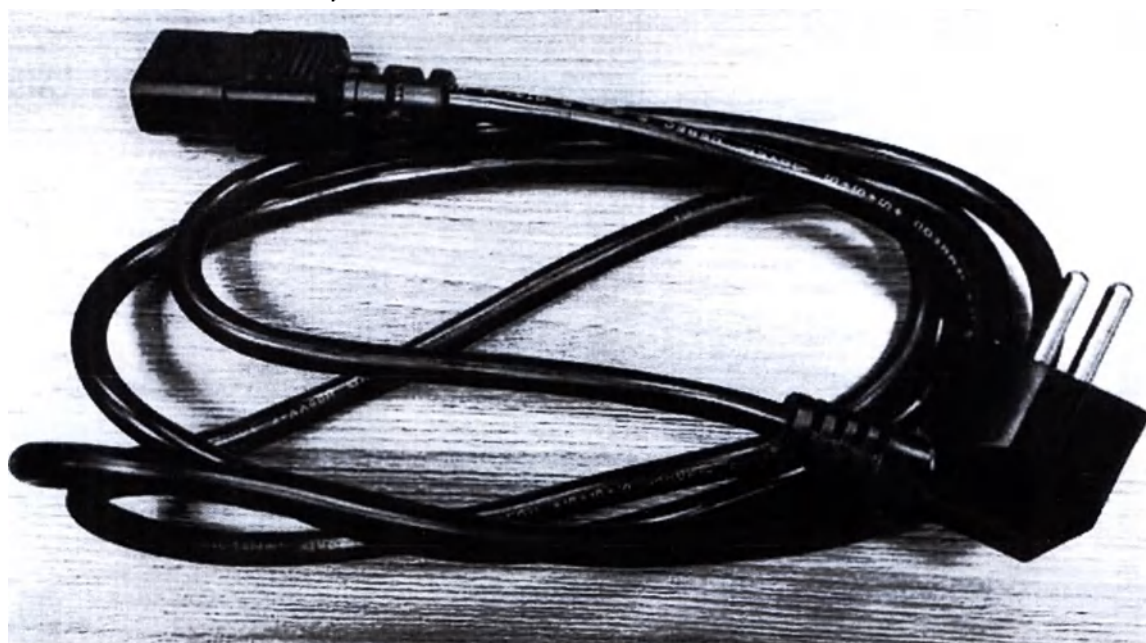

Фотографическое изображение кабеля питания станции стыковочной для инфузионных насосов SN-W100/SN-W100H/SN-W100D/SN-W100HD.

1

ST1

СН-В100/СН-В100Н/СН-В100Д/СН-В100НД
 Для инфузионных насосов SN

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
 ЧИСТОВИДНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЕ! При эксплуатации насосов
 SN-В100, SN-В100Н, SN-В100Д, SN-В100НД

2

Паспорт изделия

Информация об изделии

Степень защиты	Степень защиты
Материал	Материал
Срок службы	Срок службы
Датум выпуска	Датум выпуска

Информация о гарантии

Срок гарантии (лет)

Гарантийная организация

Гарантийная организация

Данное изделие является объектом интеллектуальной собственности и не подлежит копированию. В случае нарушения авторских прав будет привлечено к ответственности. Данное изделие является объектом интеллектуальной собственности и не подлежит копированию. В случае нарушения авторских прав будет привлечено к ответственности.

3

Гарантийный талон

Фирма-изготовитель

Модель

Серийный номер

Датум выпуска

Гарантийная организация

Гарантийная организация

Гарантийная организация

Гарантийная организация

Гарантийная организация

Гарантийная организация

Гарантийная организация

Гарантийная организация

Гарантийная организация

Гарантийная организация

Гарантийная организация

Гарантийная организация

Гарантийная организация

Гарантийная организация

Гарантийная организация

Гарантийная организация

Гарантийная организация

Гарантийная организация

Гарантийная организация

Гарантийная организация

Гарантийная организация

Гарантийная организация

Гарантийная организация

Гарантийная организация

Гарантийная организация

Гарантийная организация

Гарантийная организация

Гарантийная организация

Гарантийная организация

Гарантийная организация

Гарантийная организация

Гарантийная организация

Гарантийная организация

Гарантийная организация

Гарантийная организация

Гарантийная организация

Гарантийная организация

Гарантийная организация

Гарантийная организация

Гарантийная организация

Гарантийная организация

Гарантийная организация

Гарантийная организация

Гарантийная организация

Гарантийная организация

Гарантийная организация

Гарантийная организация

Гарантийная организация

4

SD

СН-В100/СН-В100Н/СН-В100Д/СН-В100НД
 Для инфузионных насосов SN



Упаковочный лист

Страницы стыкующиеся для инфузионных насосов



SN-W100HD

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Корпус насоса	шт.	1
2	Инфузионный насос	шт.	1
3	Корпус насоса	шт.	1
4	Инфузионный насос	шт.	1
5	Корпус насоса	шт.	1
6	Инфузионный насос	шт.	1
7	Корпус насоса	шт.	1
8	Инфузионный насос	шт.	1
9	Корпус насоса	шт.	1
10	Инфузионный насос	шт.	1
11	Корпус насоса	шт.	1
12	Инфузионный насос	шт.	1
13	Корпус насоса	шт.	1
14	Инфузионный насос	шт.	1
15	Корпус насоса	шт.	1
16	Инфузионный насос	шт.	1
17	Корпус насоса	шт.	1
18	Инфузионный насос	шт.	1
19	Корпус насоса	шт.	1
20	Инфузионный насос	шт.	1
21	Корпус насоса	шт.	1
22	Инфузионный насос	шт.	1
23	Корпус насоса	шт.	1
24	Инфузионный насос	шт.	1
25	Корпус насоса	шт.	1
26	Инфузионный насос	шт.	1
27	Корпус насоса	шт.	1
28	Инфузионный насос	шт.	1
29	Корпус насоса	шт.	1
30	Инфузионный насос	шт.	1
31	Корпус насоса	шт.	1
32	Инфузионный насос	шт.	1
33	Корпус насоса	шт.	1
34	Инфузионный насос	шт.	1
35	Корпус насоса	шт.	1
36	Инфузионный насос	шт.	1
37	Корпус насоса	шт.	1
38	Инфузионный насос	шт.	1
39	Корпус насоса	шт.	1
40	Инфузионный насос	шт.	1
41	Корпус насоса	шт.	1
42	Инфузионный насос	шт.	1
43	Корпус насоса	шт.	1
44	Инфузионный насос	шт.	1
45	Корпус насоса	шт.	1
46	Инфузионный насос	шт.	1
47	Корпус насоса	шт.	1
48	Инфузионный насос	шт.	1
49	Корпус насоса	шт.	1
50	Инфузионный насос	шт.	1
51	Корпус насоса	шт.	1
52	Инфузионный насос	шт.	1
53	Корпус насоса	шт.	1
54	Инфузионный насос	шт.	1
55	Корпус насоса	шт.	1
56	Инфузионный насос	шт.	1
57	Корпус насоса	шт.	1
58	Инфузионный насос	шт.	1
59	Корпус насоса	шт.	1
60	Инфузионный насос	шт.	1
61	Корпус насоса	шт.	1
62	Инфузионный насос	шт.	1
63	Корпус насоса	шт.	1
64	Инфузионный насос	шт.	1
65	Корпус насоса	шт.	1
66	Инфузионный насос	шт.	1
67	Корпус насоса	шт.	1
68	Инфузионный насос	шт.	1
69	Корпус насоса	шт.	1
70	Инфузионный насос	шт.	1
71	Корпус насоса	шт.	1
72	Инфузионный насос	шт.	1
73	Корпус насоса	шт.	1
74	Инфузионный насос	шт.	1
75	Корпус насоса	шт.	1
76	Инфузионный насос	шт.	1
77	Корпус насоса	шт.	1
78	Инфузионный насос	шт.	1
79	Корпус насоса	шт.	1
80	Инфузионный насос	шт.	1
81	Корпус насоса	шт.	1
82	Инфузионный насос	шт.	1
83	Корпус насоса	шт.	1
84	Инфузионный насос	шт.	1
85	Корпус насоса	шт.	1
86	Инфузионный насос	шт.	1
87	Корпус насоса	шт.	1
88	Инфузионный насос	шт.	1
89	Корпус насоса	шт.	1
90	Инфузионный насос	шт.	1
91	Корпус насоса	шт.	1
92	Инфузионный насос	шт.	1
93	Корпус насоса	шт.	1
94	Инфузионный насос	шт.	1
95	Корпус насоса	шт.	1
96	Инфузионный насос	шт.	1
97	Корпус насоса	шт.	1
98	Инфузионный насос	шт.	1
99	Корпус насоса	шт.	1
100	Инфузионный насос	шт.	1


Фотографическое изображение руководства по эксплуатации (1), паспорта (2), упаковочного листа (3) и гарантийного талона (4) стыкующей для инфузионных насосов SN-W100/SN-W100H/SN-W100D/SN-W100HD.

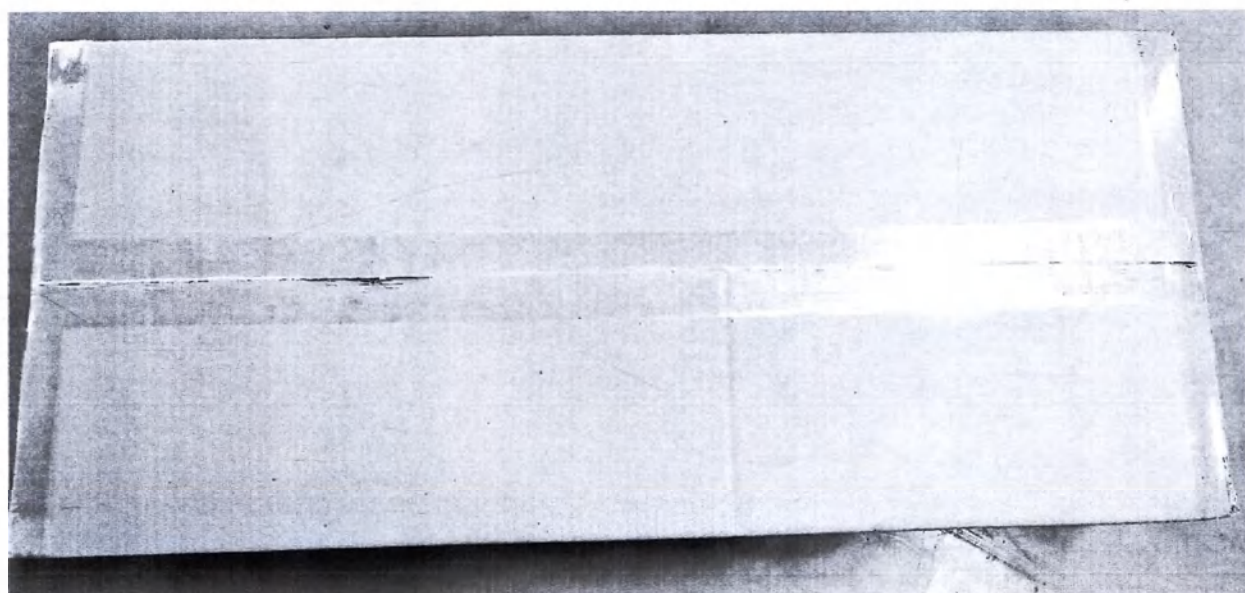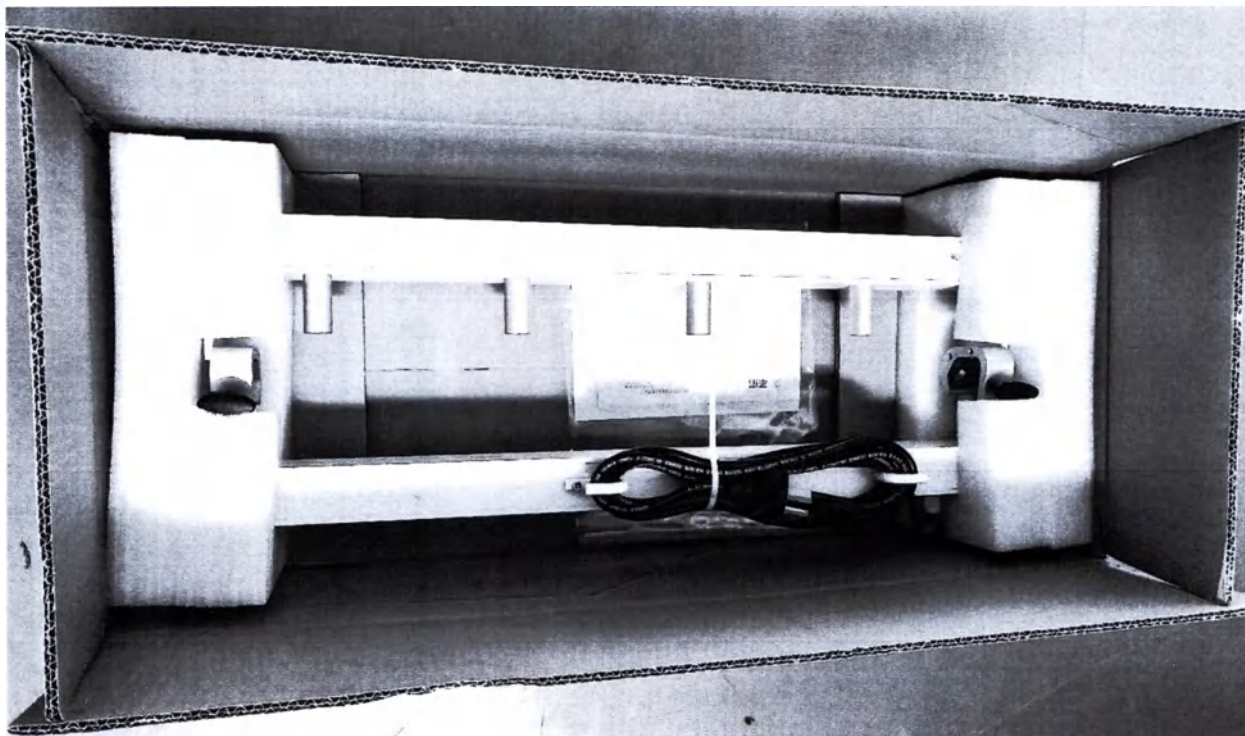


Фотографические изображения транспортной упаковки станции стыковочной для инфузионных насосов SN-U4A.

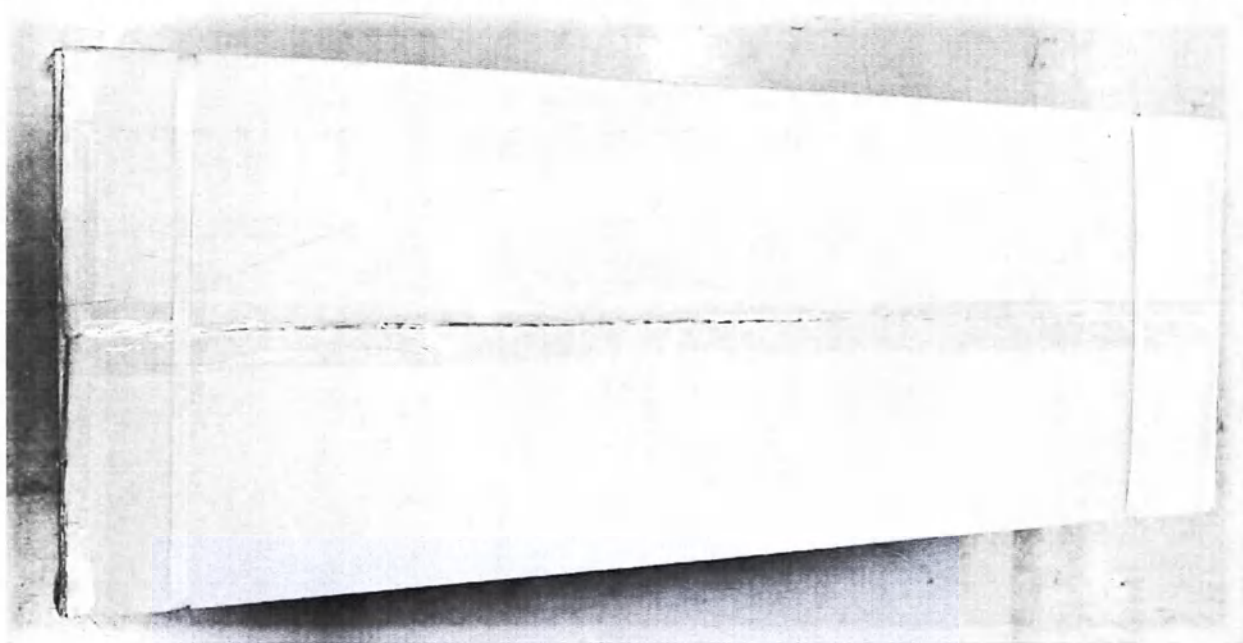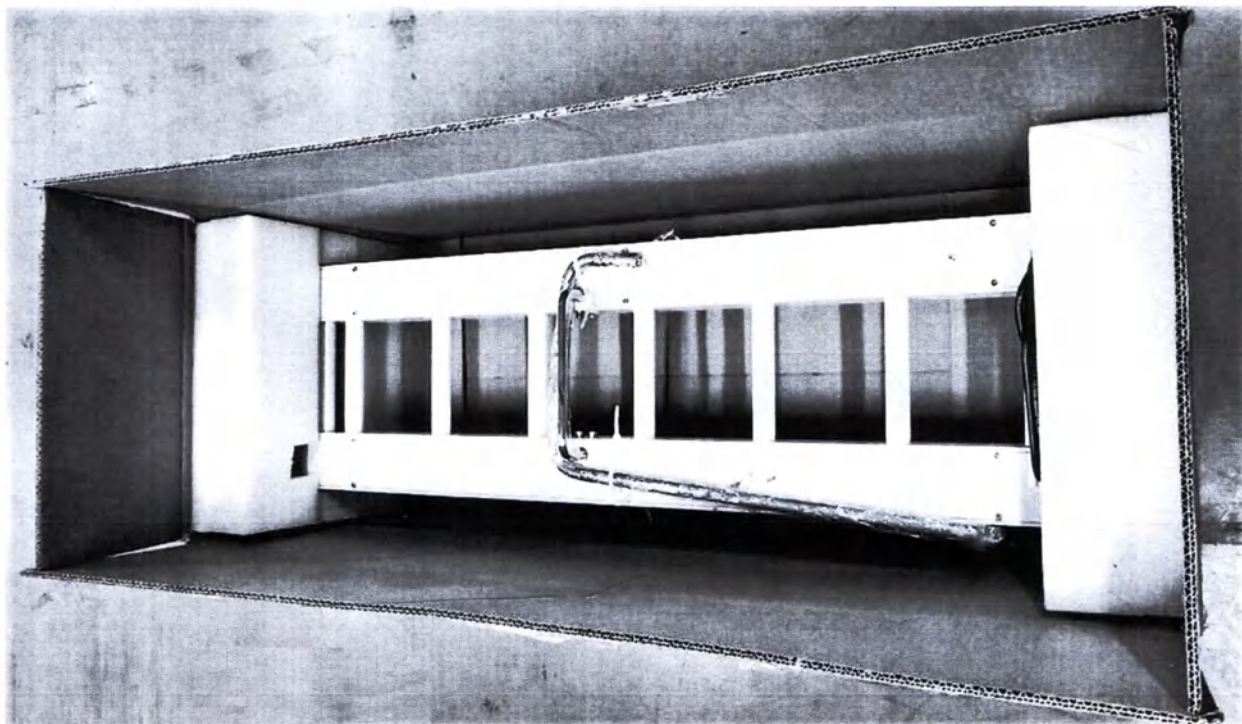



Фотографические изображения транспортной упаковки станции стыковочной для инфузионных насосов SN-U6/SN-U8. Коммуникационный модуль.

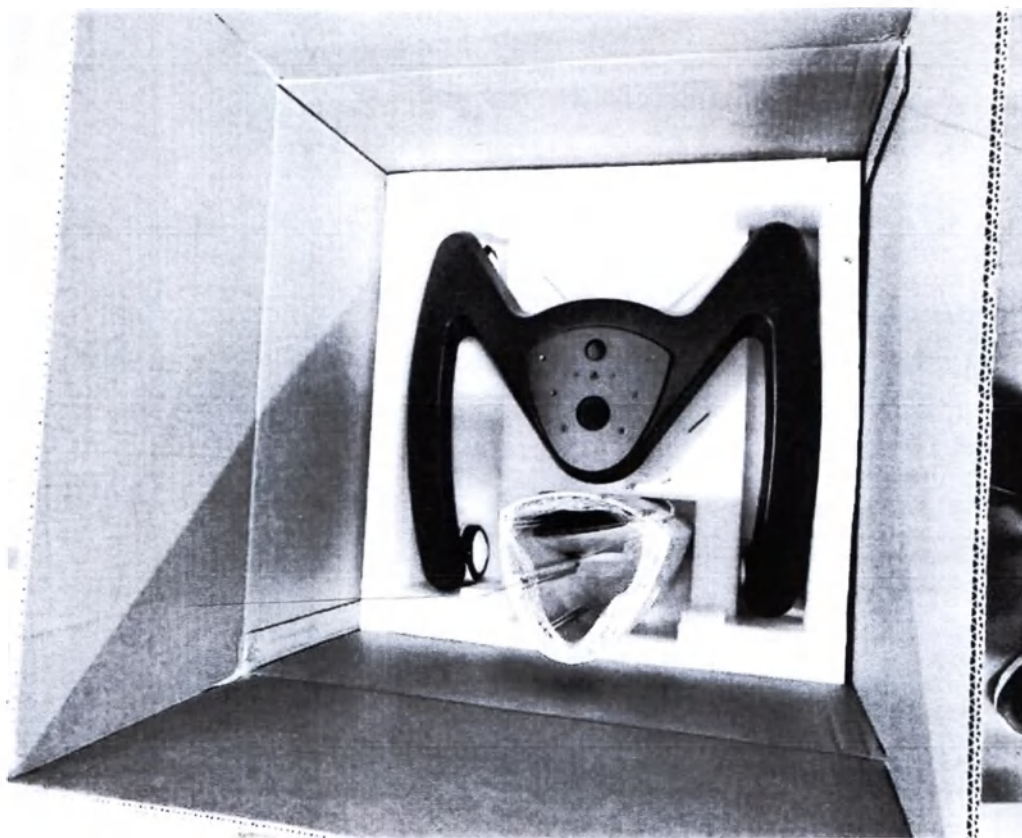

Фотографические изображения транспортной упаковки станции стыковочной для инфузионных насосов SN-U6/SN-U8. Колесное основание.

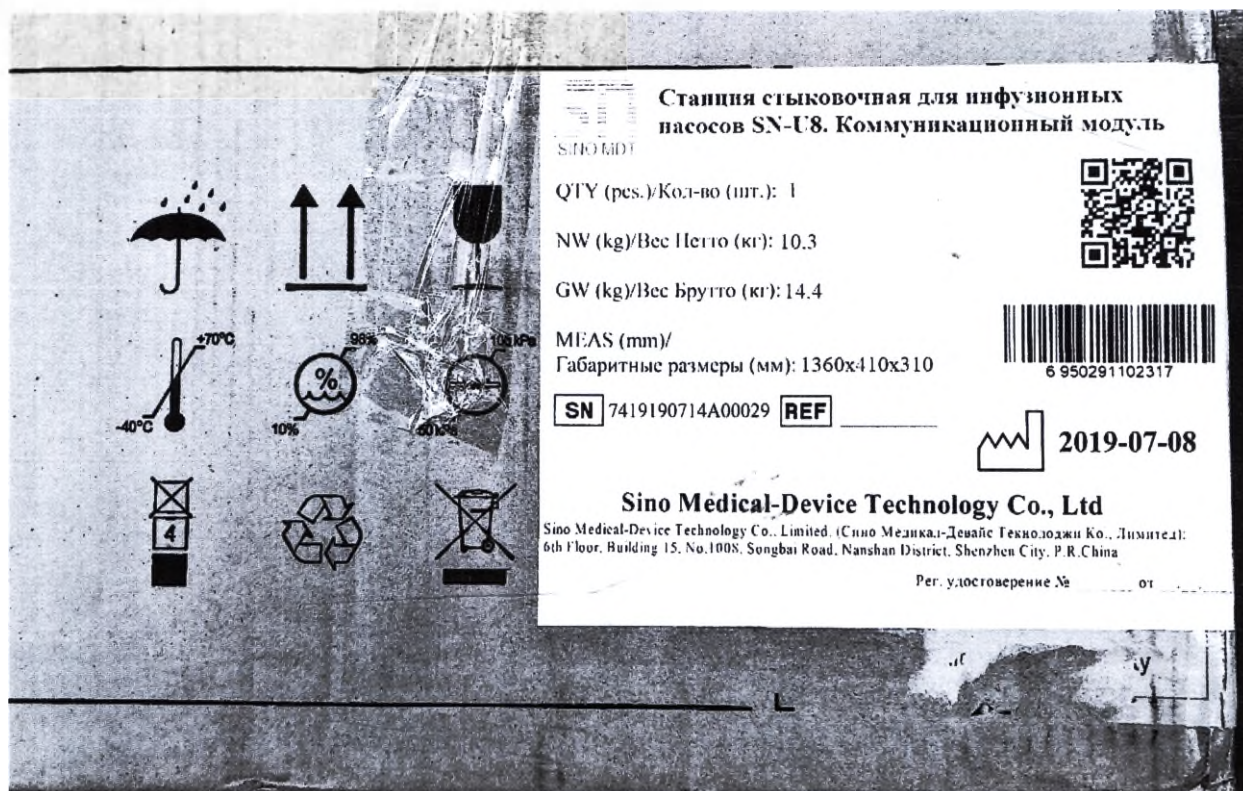

Фотографические изображения транспортной упаковки станции стыковочной для инфузионных насосов SN-U6/SN-U8. Стикер транспортной упаковки.

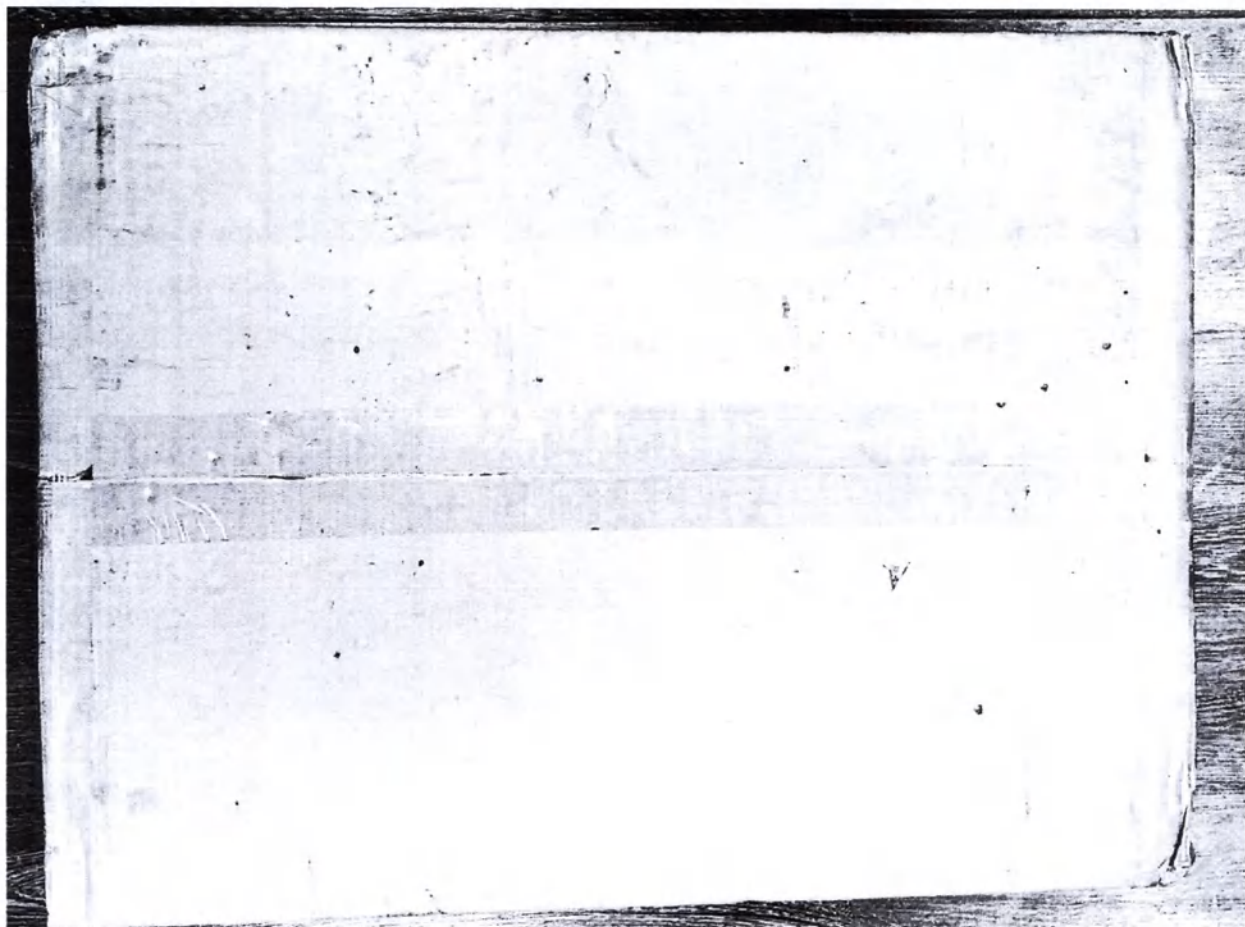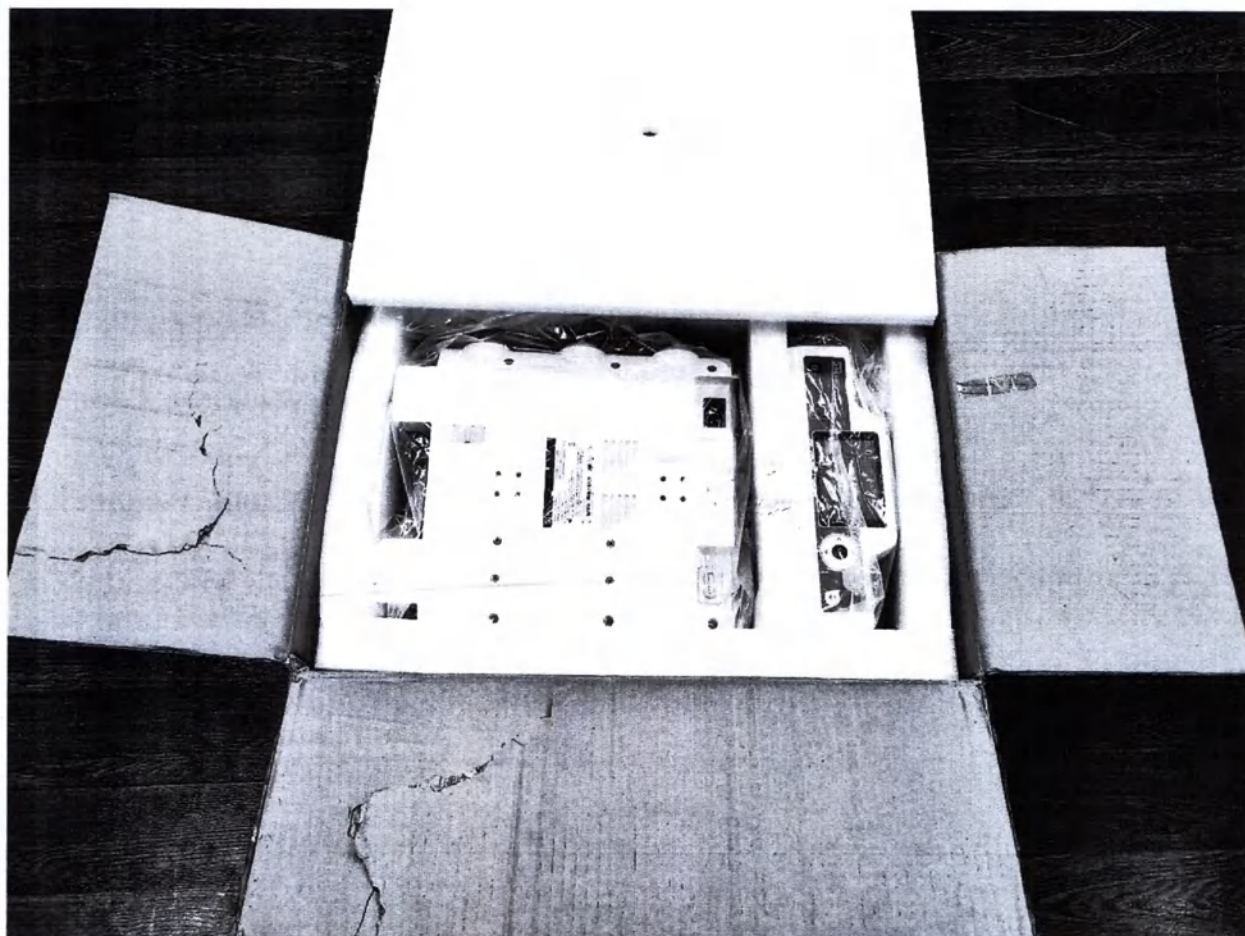

Фотографические изображения транспортной упаковки станции стыковочной для инфузионных насосов SN-W100/SN-W100H/SN-W100D/SN-W100HD.



Станция стыковочная для
инфузионных насосов SN-W100HD

QTY (pcs.) Кол-во (шт.): 1

NW (kg) Вес Нетто (кг): 5.2

GW (kg) Вес Брутто (кг) 6.5

MEAS (mm)/
Габаритные размеры (мм): 520x390x280

SN 7423190714A00028

REF



6 950291102317



2019-07-08




Sino Medical-Device Technology Co., Ltd

Sino Medical-Device Technology Co., Limited. (Сино Медицин-Девайс Текнолоджи Ко., Лимитед);
6th Floor, Building 15, No.1008, Songbai Road, Nanshan District, Shenzhen City, P.R.China

Организация, уполномоченная производителем на принятие претензий и удовлетворение требований
от потребителей в отношении товара неадекватного качества
ООО "НПФ "МЕДТЕХМАРКЕТ", 143570, Россия, Московская обл., г. Истра, с. Новопетровское,
ул. Первомайская, д. 59, пом. 3, эт. 2, телефон +7 (910) 435-00-13, электронная почта: mtn-mo@yandex.ru

Рег. удостоверение № _____ от _____



Фотографические изображения транспортной упаковки станции стыковочной для инфузионных насосов SN-W100/SN-W100H/SN-W100D/SN-W100HD. Стикер транспортной упаковки.

Всего прошито, пронумеровано

и скреплено печатью

23

листов

Генеральный директор ООО
«НПО «МЕДТЕХМАРКЕТ»

Б.С. Хышиктуев

