

ПОДТВЕРЖДАЮ
Руководитель направления по регистрации продукции
для in vitro диагностики, иммунохимия,
гематология и гемостаз
«ООО «Сименс Здоровоохранение»

Чигринец Е.А.
2022 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Дилуент для эстрадиола для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Enhanced Estradiol Diluent (Atellica IM eE2 DIL))»

производства «Сименс Хелскеа Диагностикс Инк.», Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США

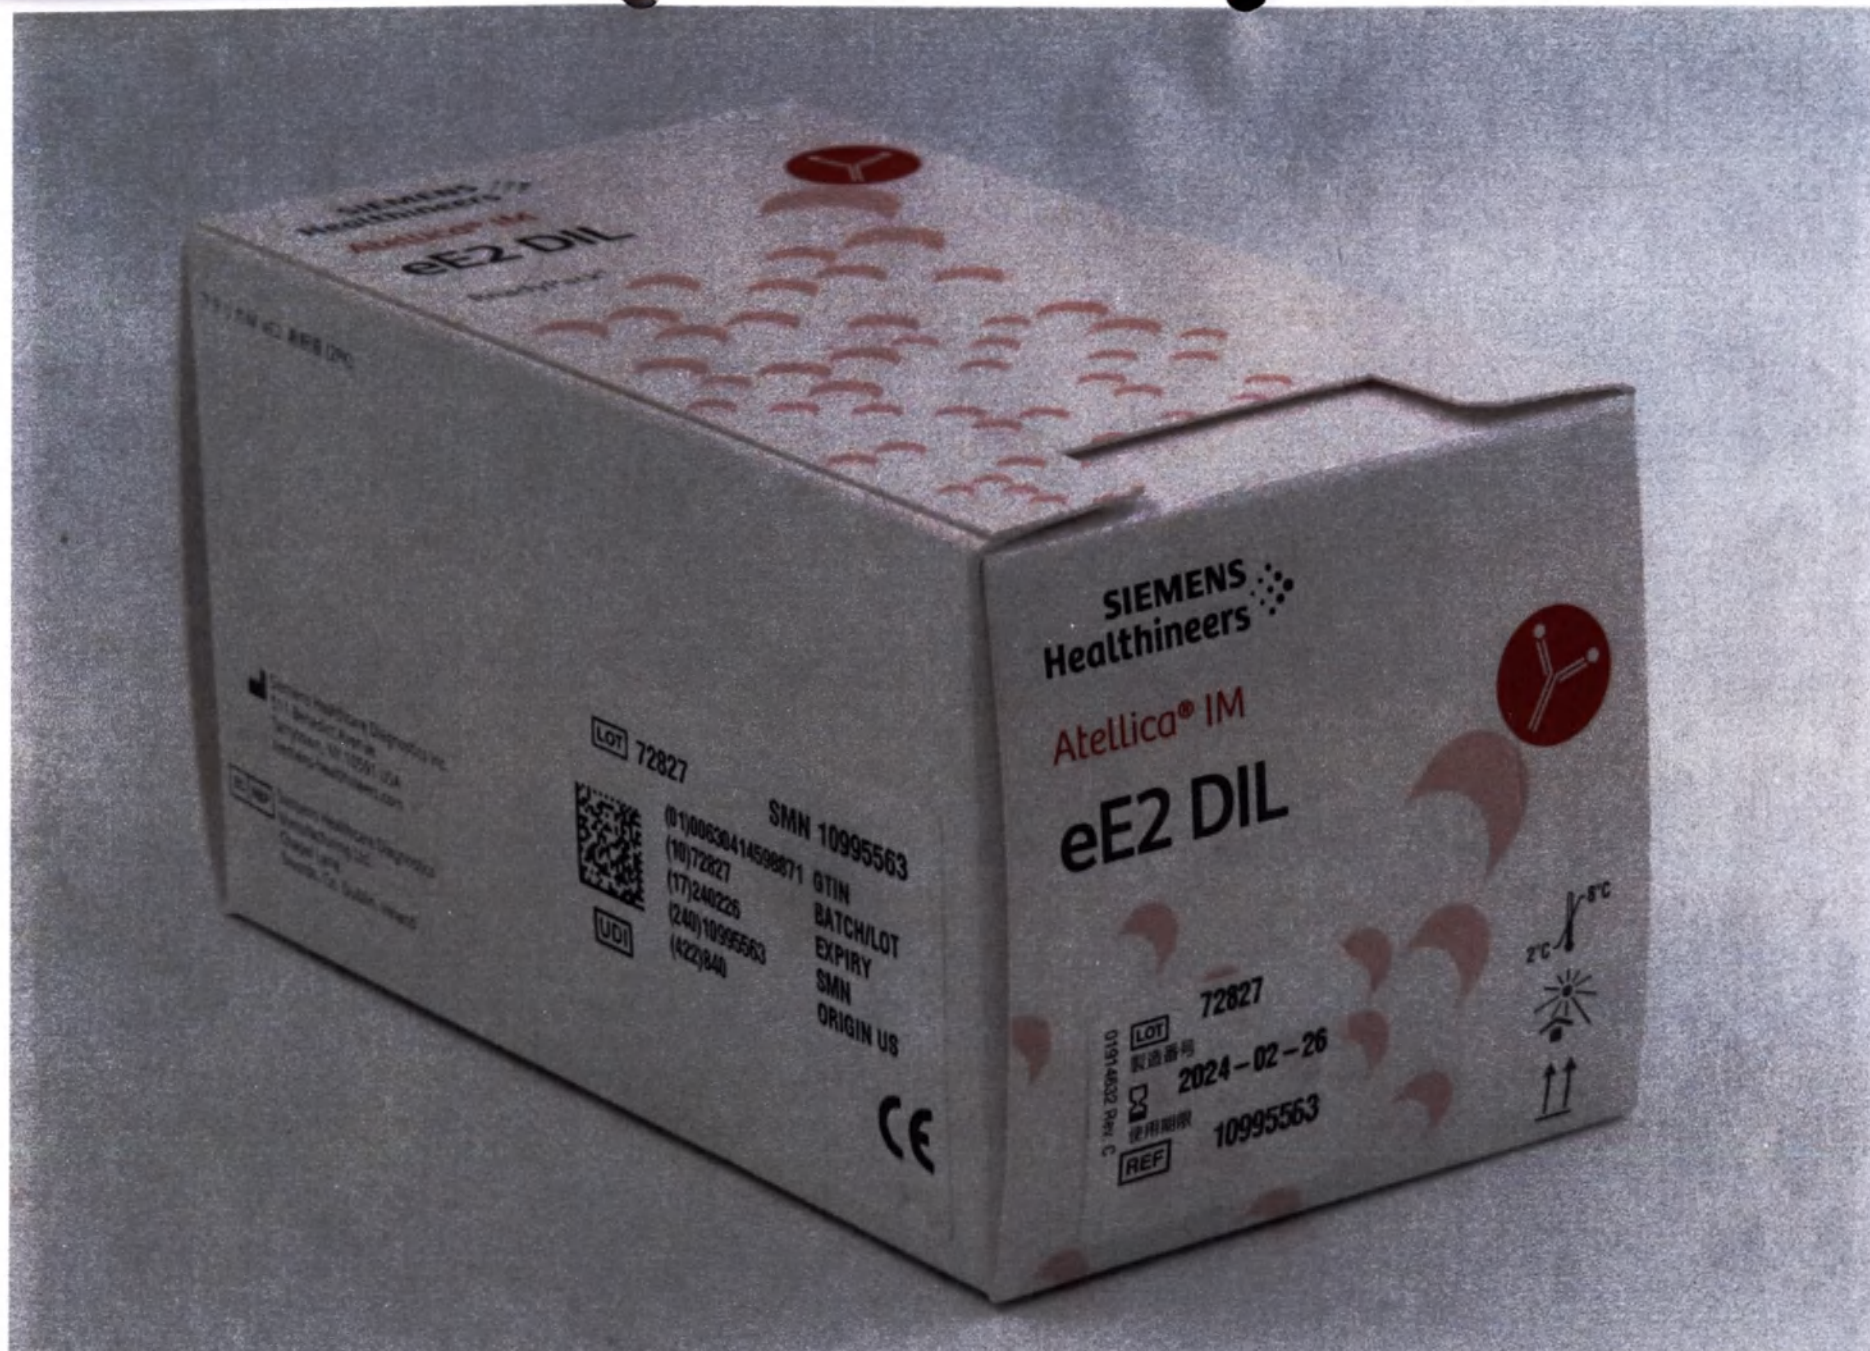


Рисунок 1. Дилуэнт для эстрадиола для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Enhanced Estradiol Diluent (Atellica IM eE2 DIL)), в составе:

ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU ca IM Enhanced Estradiol Diluent (Atellica IM eE2 DIL) – 5,0 мл/упаковка – 2 шт.

アテリカIM eE2 希釈液 (2PK)

 Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
511 Benedict Avenue
Tarrytown, NY 10591 USA
siemens-healthineers.com

EC REP Siemens Healthcare Diagnostics
Manufacturing Ltd.
Chapel Lane
Swords, Co. Dublin, Ireland

LOT 72827

SMN 10995563



UDI

(01)00630414598871	GTIN
(10)72827	BATCH/LOT
(17)240226	EXPIRY
(240)10995563	SMN
(422)840	ORIGIN US



Рисунок 2. Дилуэнт для эстрадиола для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Enhanced Estradiol Diluent (Atellica IM eE2 DIL)), в составе:

ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU Дилуэнт для эстрадиола Atellica IM Enhanced Estradiol Diluent (Atellica IM eE2 DIL) – 5,0 мл/упаковка – 2 шт.

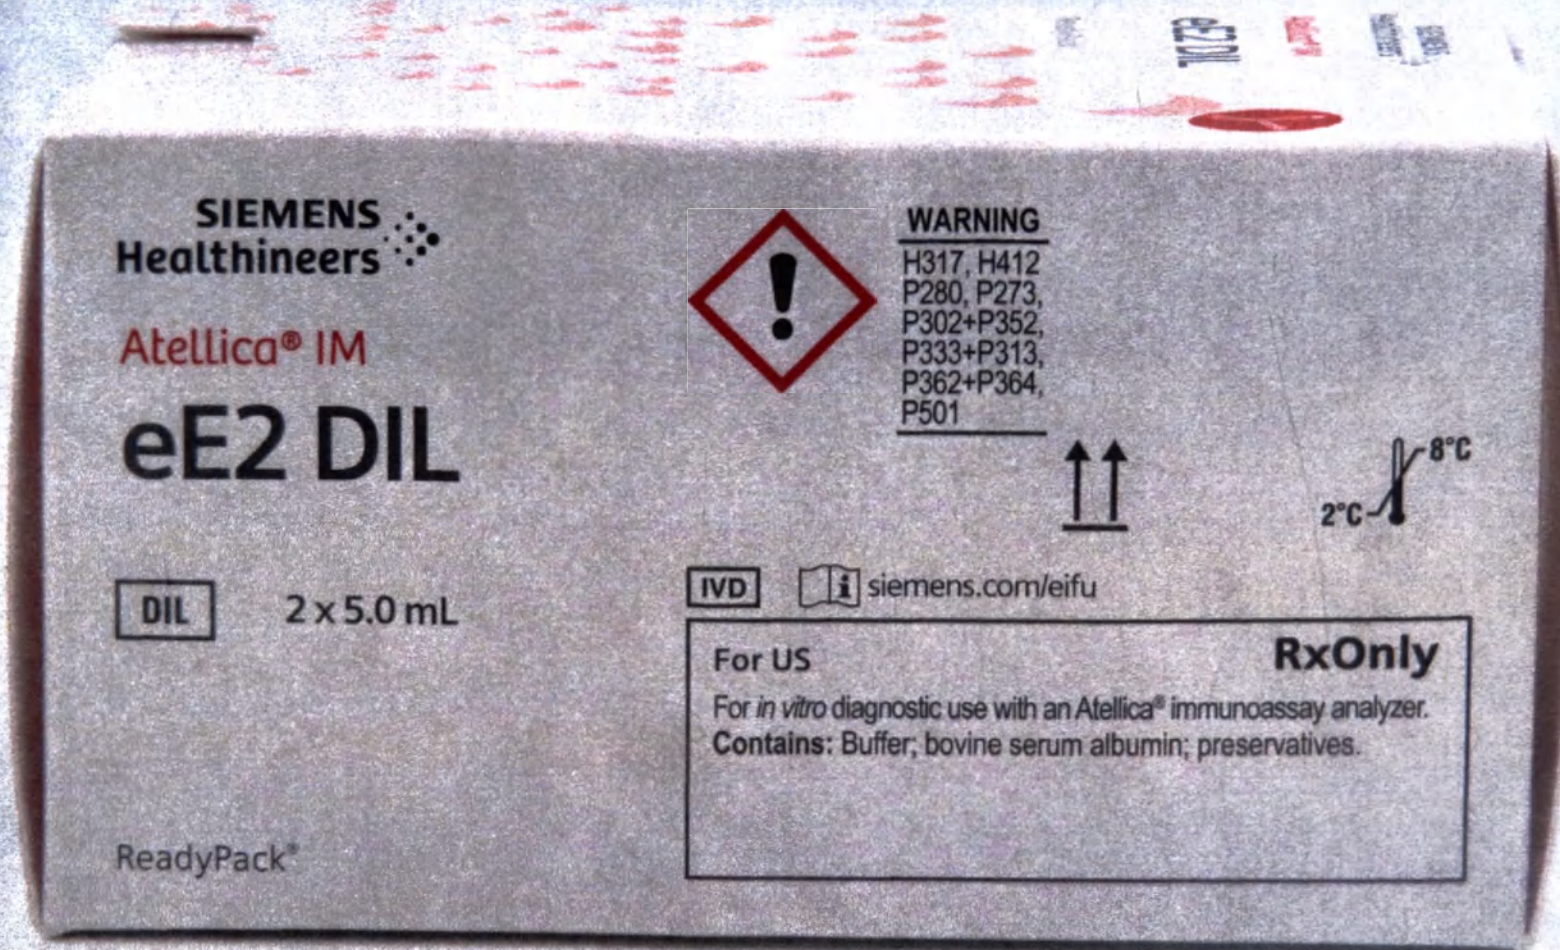


Рисунок 3. Дилуент для эстрадиола для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Enhanced Estradiol Diluent (Atellica IM eE2 DIL)), в составе:

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU IM Enhanced Estradiol Diluent (Atellica IM eE2 DIL) – 5,0 мл/упаковка – 2 шт.

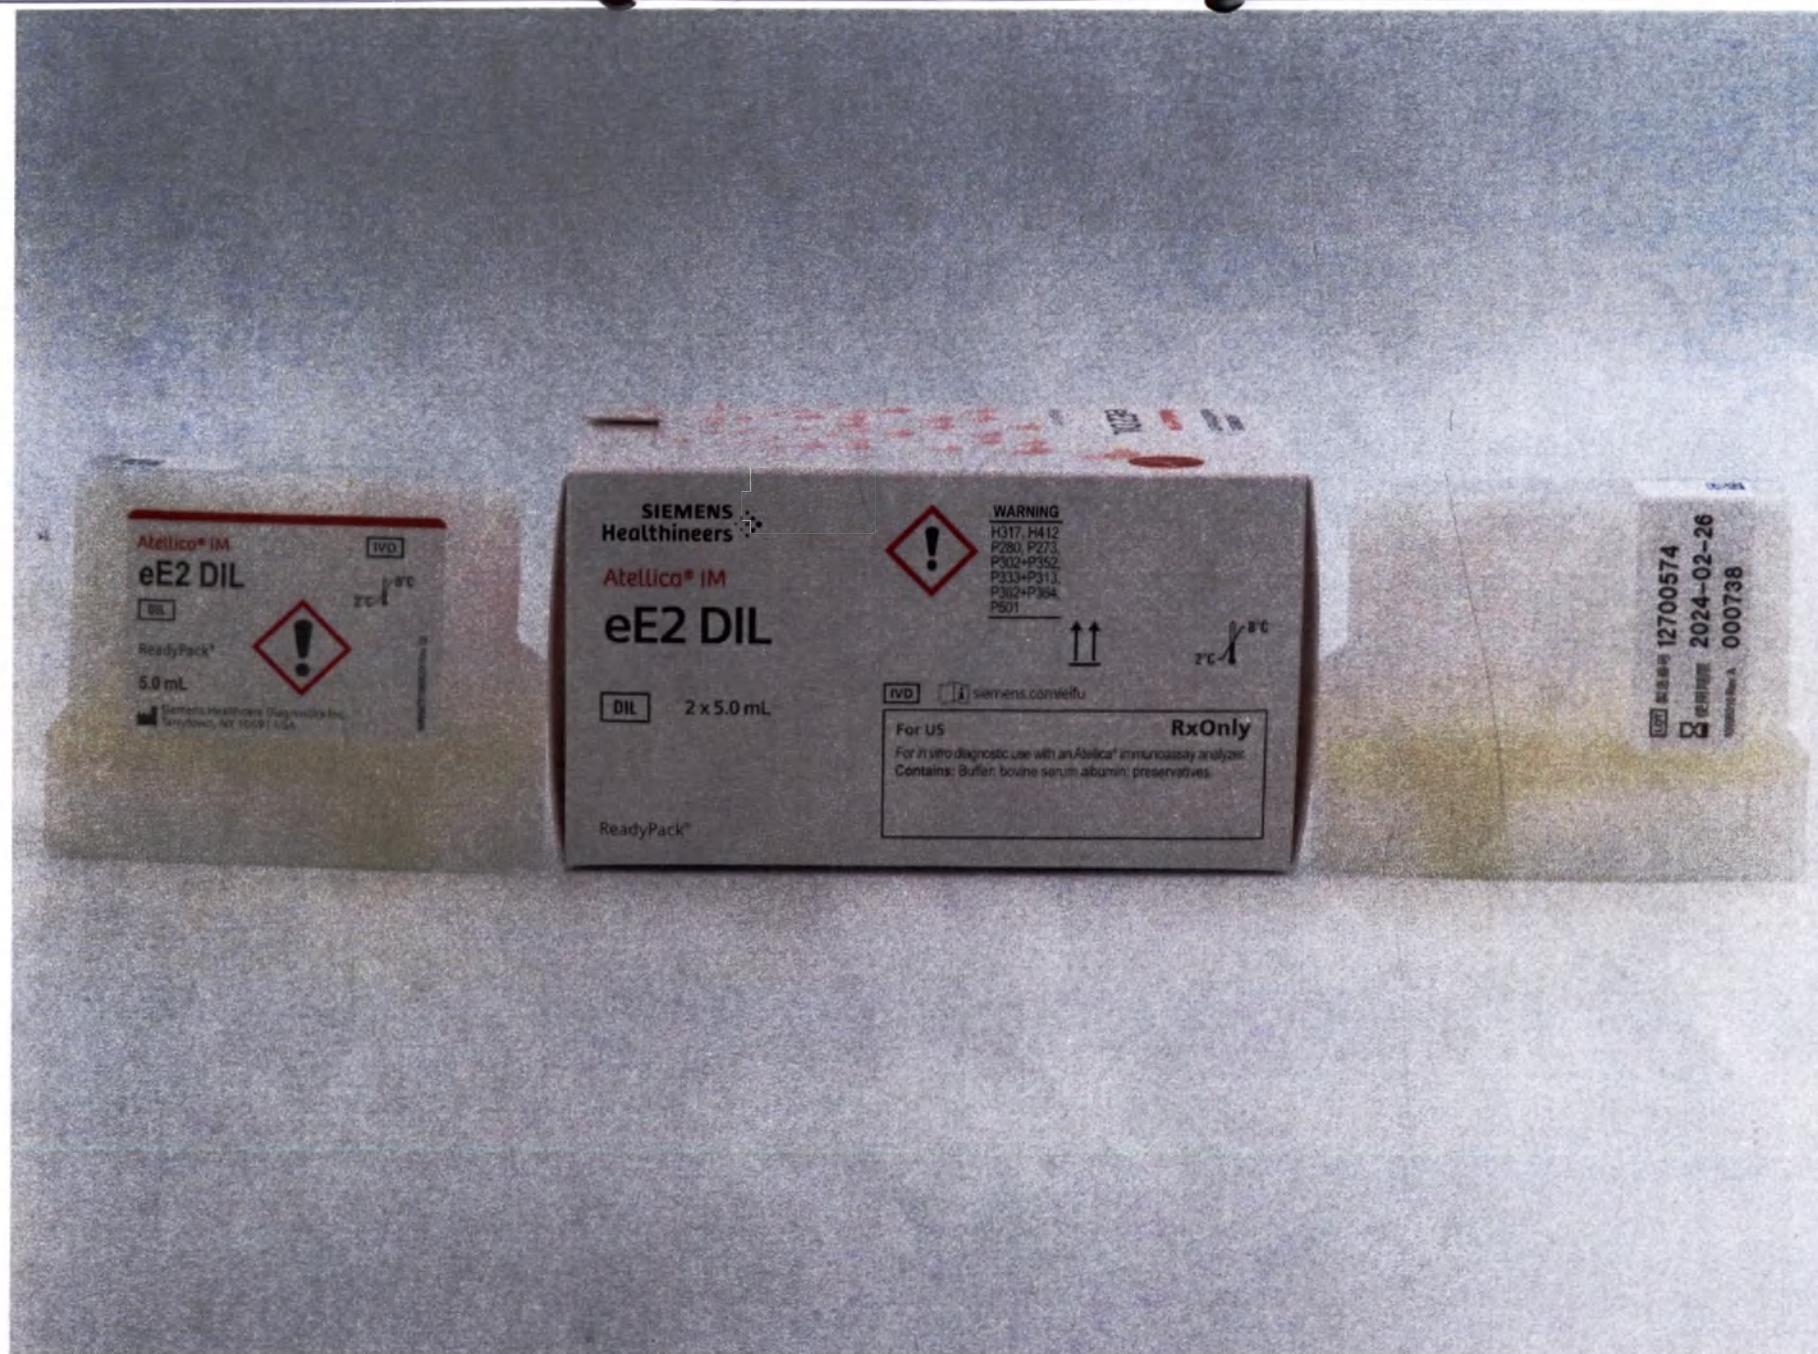


Рисунок 4. Дилуент для эстрадиола для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Enhanced Estradiol Diluent (Atellica IM eE2 DIL)), в составе:

ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU IM Enhanced Estradiol Diluent (Atellica IM eE2 DIL) – 5,0 мл/упаковка – 2 шт.

Atellica® IM

IVD

eE2 DIL

DIL

2°C 8°C



ReadyPack®

5.0 mL

Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
Tarrytown, NY 10591 USA

10995877/10996309 Rev. 02

Рисунок 5. Дилуент для эстрадиола для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Enhanced Estradiol Diluent (Atellica IM eE2 DIL)), в составе: ООО ЦИРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru IM Enhanced Estradiol Diluent (Atellica IM eE2 DIL) – 5,0 мл/упаковка – 2 шт.

10995563

Дилуент для эстрадиола для анализаторов
иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Enhanced
Estradiol Diluent (Atellica IM eE2 DIL))

Информация о производителе и стране производства:
см. на упаковке

Регистрационное удостоверение:
№ РЗН 2021/15085 от 16.08.2021

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на
оригинальной упаковке

Инструкция по применению на русском языке Rev. 01

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Авторизованный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

Всего прошито и пронумеровано
4 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»

