



«УТВЕРЖДАЮ»

Менеджер по регистрации
медицинских изделий



Тихонова М.А.

«31» июля 2020 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Шприцы MEDRAD® для рентгеноконтрастных / магнитоконтрастных
веществ и физиологического раствора к системам инъекционным
MEDRAD® Stellant Sx, MEDRAD® Stellant D, MEDRAD® Stellant DualFlow,
MEDRAD® Stellant D с рабочей станцией Certegra, MEDRAD® Spectris
Solaris EP, Mark V ProVis, Vistron CT, в наборах

АО «БАЙЕР»

107113 Россия, Москва,
ул. 3-я Рыбинская, д.18, стр.2

Тел.: (495) 234 20 00

Факс: (495) 234 20 01

www.bayer.ru



1. 150-FT-Q в составе: 1.1 Шприц стерильный одноразовый 150 мл; 1.2 Трубка быстрого наполнения.



medRAD® Mark V ProVis

Disposable Syringe 150 mL & QFT

Шприц стерильный одноразовый

150 мл и Трубка быстрого наполнения



Non-pyrogenic fluid path

Непирогенный тракт подачи жидкости



Do not use if package is opened or damaged

Не используйте вскрытые или поврежденные упаковки



Attention: Refer to warnings and cautions on

Instructions for Use packaged in each carton

ВНИМАНИЕ! Для получения дополнительных

сведений о мерах предосторожности изучите

инструкцию по применению, вложенную в

упаковку



Single use only

Использовать только один раз



Sterilized using Irradiation

Стерилизовано с использованием

облучения



Not made with Natural Rubber

Latex / Сделано без применения

натурального латекса

Rx Only

Assembled in USA



Catalog Number

Номер по каталогу

150-FT-Q



Date of

Manufacture

Дата производства

2017-04-12



Use By

Использовать

до

2020-04-12



Lot Number

Номер партии

Lot_Number



(01)00616258010991

(11)170412

(17)200412

(10)Lot_Number

5




Производитель

Байер Медикал Кэа Инк.,
США

Bayer Medical Care Inc.
1 Bayer Drive

Indianola, PA 15051-0780
U.S.A.



Bayer Medical Care B.V.

Horsterweg 24

6199 AC Maastricht

Airport

The Netherlands

Patent Information/Патентная информация:

www.ripatents.bayer.com

Сделано в США

Импортер на территорию России:

АО «БАЙЕР» Бизнес-юнит «Радиология»,

107113, 3-я Рыбинская ул.,

д.18, стр.2, Москва, Россия

тел.: +7 495 231 1200 www.bayer.ru

РУ № ФСЗ 2012/12543

от 26 февраля 2016 года



Bayer



0086



P85668552

Rev. 1

(01)00616258010991



2. 200- FT-Q в составе: 2.1 Шприц Fasturn стерильный одноразовый 200 мл; 2.2 Трубка быстрого наполнения.



medrad® Mark V ProVis
200mL FasTurn Sterile Disposable Syringe & QFT / Шприц FasTurn стерильный
одноразовый 200 мл и Трубка быстрого
наполнения



Non-pyrogenic fluid path
 Непирогенный тракт подачи жидкости



Do not use if package is opened or damaged
 Не используйте вскрытые или поврежденные упаковки



Attention: Refer to warnings and cautions on Instructions for Use packaged in each carton
 ВНИМАНИЕ! Для получения дополнительных сведений о мерах предосторожности изучите инструкцию по применению, вложенную в упаковку



Single use only
 Использовать только один раз

STERILE

R Sterilized using Irradiation
 Стерилизовано с использованием облучения

NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX

Not made with Natural Rubber Latex / Сделано без применения натурального латекса

Rx Only

Assembled in USA

REF

Catalog Number
 Номер по каталогу

200-FT-Q



Date of Manufacture
 Дата производства

2017-04-12



Use By
 Использовать до

2020-04-12

LOT

Lot Number
 Номер партии

Lot_Number



(01)00616258011004

(11)170412

(17)200412

(10)Lot_Number

5



Производитель

Байер Медикал Кэа Инк.,
 США
 Bayer Medical Care Inc.
 1 Bayer Drive
 Indianola, PA 15051-0780
 U.S.A.

EC REP

Bayer Medical Care B.V.
 Horsterweg 24
 6199 AC Maastricht
 Airport
 The Netherlands

Patent Information/Патентная информация:

www.rapatents.bayer.com

Сделано в США

Импортер на территорию России:

АО «БАЙЕР» Бизнес-юнит «Радиология»,

107113, 3-я Рыбинская ул.,

д.18, стр.2, Москва, Россия

тел.: +7 495 231 1200 www.bayer.ru

РУ № ФСЗ 2012/12543

от 26 февраля 2016 года

Bayer

CE 0086



(01)00616258011004

P85687263

Rev. 1



3. СТР-200-FLS Набор одноразовый для системы инъекционной для КТ, в составе: 3.1 Шприц Qwik-Fit 200 мл; 3.2 Трубка витая соединительная низкого давления; 3.3 Трубка быстрого наполнения



СТР-РАК Sterile Disposable Syringe

A disposable kit for the ST Injector System from Bayer

Contents: 1 - 200ml Quick-Fit Syringe, 1 - Colored Low

Pressure Connector Tube, 1 - Quick Fit Tube

Шприц СТ-РАК стерильный одноразовый для КТ

Набор одноразовый для системы инъекционной

для КТ компании Bayer

В комплекте: 1 - Шприц Quick-Fit 200мл, 1 - Тубка витая

соединительная низкого давления, 1 - Трубка

быстронаполнения

Non-rugged fluid path

Непрерывный тракт подачи жидкости

Do not use if package is opened or damaged

Не используйте в вскрытые или поврежденные

упаковки

Attention: Refer to warnings and cautions on

Instructions for Use packaged in each carton

DO NOT EXCEED 355psi (2446kPa)

ВНИМАНИЕ! Для получения дополнительных

сведений о мерах предосторожности читайте

инструкцию по применению, вложенную в

упаковку НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ (2446 кПа)

Single use only

Использовать только один раз

Sterilized using irradiation

Стерилизовано с использованием

облучения

Not made with Natural Rubber Latex / Спелано без применения

натурального латекса

Assembled in USA

Ra Only

Catalog Number

Номер по

каталогу

Date of

Manufacture

Дата производства

Use By

Использовать

до

LOT

Lot Number

Номер партии

(01D0616258011028

(11)704 12

(17)2204 12

(10)Lot Number

5

Производитель

Байер Медикал Кэа Инк.,

США

Bayer Medical Care B.V.

Horstemeer 24

6199 AC Maastricht

1 Bayer Drive

Indiana, PA 15151-0780

Atropi

The Netherlands

U.S.A.

Patient Information/Пациентная информация

См. в США

www.bayerusa.com

Импортирована территорию России:

АО «БАЙЕР» Бионекс-Конти «Радиология»,

107113, 3-й Рубинский ул.,

д. 2А, стр. 2, Москва, Россия

тел.: +7 495 231 1 200 www.bayer.ru

RU № ФСЗ 2012/12563 от

26 февраля 2016 года

Рег. № 8579

Rev. 1

Проект маркировки индивидуальной (стерильной) упаковки на русском языке СТР-200-FLS



4. SSQK 65/115VS Набор одноразовый для системы инъекционной 65/115 MR для MPT, в составе: 4.1.Шприц Qwik-Fit 65 мл для контрастного вещества; 4.2 Шприц Qwik-Fit 115 мл для физиологического раствора; 4.3 Маленькая игла для контрастного вещества; 4.4 Большая игла для физиологического раствора; 4.5 Трубка соединительная низкого давления системы инъекционной 65/115 MR 243,84 см

One-Fit Syringe to Saline: 1 - Small Spoke for Contrast, 1 - Large Spoke for Saline, 1 - 96" Low Pressure Connector Tube to 6 S/1.5 MR Injector System / Хабс по умолчанию для системы

Имеется 6/115 МР для МРТ
В составе: 1 - Шприц (узел) 65 мл для контраста (мороженое) 1 шт.

1. Упорядкуйте їх за зменшенням площі поверхні. 1 - Магієва, 2 - залізна, 3 - цинкова, 4 - алюмінієва, 5 - мідна, 6 - нікелева, 7 - хромова, 8 - вуглецева, 9 - титанова, 10 - танталова, 11 - молибденова, 12 - ніобієва, 13 - кобальтова, 14 - марганцева, 15 - вольфрамова, 16 - берилієва, 17 - кремнієва, 18 - борна, 19 - германієва, 20 - кремній, 21 - германій, 22 - бор, 23 - вольфрам, 24 - ніобій, 25 - тантал, 26 - молибден, 27 - нікель, 28 - мідь, 29 - цинк, 30 - залізо, 31 - магній, 32 - титан, 33 - вуглець, 34 - хром, 35 - нікель, 36 - мідь, 37 - цинк, 38 - залізо, 39 - магній, 40 - титан, 41 - вуглець, 42 - хром, 43 - нікель, 44 - мідь, 45 - цинк, 46 - залізо, 47 - магній, 48 - титан, 49 - вуглець, 50 - хром, 51 - нікель, 52 - мідь, 53 - цинк, 54 - залізо, 55 - магній, 56 - титан, 57 - вуглець, 58 - хром, 59 - нікель, 60 - мідь, 61 - цинк, 62 - залізо, 63 - магній, 64 - титан, 65 - вуглець, 66 - хром, 67 - нікель, 68 - мідь, 69 - цинк, 70 - залізо, 71 - магній, 72 - титан, 73 - вуглець, 74 - хром, 75 - нікель, 76 - мідь, 77 - цинк, 78 - залізо, 79 - магній, 80 - титан, 81 - вуглець, 82 - хром, 83 - нікель, 84 - мідь, 85 - цинк, 86 - залізо, 87 - магній, 88 - титан, 89 - вуглець, 90 - хром, 91 - нікель, 92 - мідь, 93 - цинк, 94 - залізо, 95 - магній, 96 - титан, 97 - вуглець, 98 - хром, 99 - нікель, 100 - мідь, 101 - цинк, 102 - залізо, 103 - магній, 104 - титан, 105 - вуглець, 106 - хром, 107 - нікель, 108 - мідь, 109 - цинк, 110 - залізо, 111 - магній, 112 - титан, 113 - вуглець, 114 - хром, 115 - нікель, 116 - мідь, 117 - цинк, 118 - залізо, 119 - магній, 120 - титан, 121 - вуглець, 122 - хром, 123 - нікель, 124 - мідь, 125 - цинк, 126 - залізо, 127 - магній, 128 - титан, 129 - вуглець, 130 - хром, 131 - нікель, 132 - мідь, 133 - цинк, 134 - залізо, 135 - магній, 136 - титан, 137 - вуглець, 138 - хром, 139 - нікель, 140 - мідь, 141 - цинк, 142 - залізо, 143 - магній, 144 - титан, 145 - вуглець, 146 - хром, 147 - нікель, 148 - мідь, 149 - цинк, 150 - залізо, 151 - магній, 152 - титан, 153 - вуглець, 154 - хром, 155 - нікель, 156 - мідь, 157 - цинк, 158 - залізо, 159 - магній, 160 - титан, 161 - вуглець, 162 - хром, 163 - нікель, 164 - мідь, 165 - цинк, 166 - залізо, 167 - магній, 168 - титан, 169 - вуглець, 170 - хром, 171 - нікель, 172 - мідь, 173 - цинк, 174 - залізо, 175 - магній, 176 - титан, 177 - вуглець, 178 - хром, 179 - нікель, 180 - мідь, 181 - цинк, 182 - залізо, 183 - магній, 184 - титан, 185 - вуглець, 186 - хром, 187 - нікель, 188 - мідь, 189 - цинк, 190 - залізо, 191 - магній, 192 - титан, 193 - вуглець, 194 - хром, 195 - нікель, 196 - мідь, 197 - цинк, 198 - залізо, 199 - магній, 200 - титан, 201 - вуглець, 202 - хром, 203 - нікель, 204 - мідь, 205 - цинк, 206 - залізо, 207 - магній, 208 - титан, 209 - вуглець, 210 - хром, 211 - нікель, 212 - мідь, 213 - цинк, 214 - залізо, 215 - магній, 216 - титан, 217 - вуглець, 218 - хром, 219 - нікель, 220 - мідь, 221 - цинк, 222 - залізо, 223 - магній, 224 - титан, 225 - вуглець, 226 - хром, 227 - нікель, 228 - мідь, 229 - цинк, 230 - залізо, 231 - магній, 232 - титан, 233 - вуглець, 234 - хром, 235 - нікель, 236 - мідь, 237 - цинк, 238 - залізо, 239 - магній, 240 - титан, 241 - вуглець, 242 - хром, 243 - нікель, 244 - мідь, 245 - цинк, 246 - залізо, 247 - магній, 248 - титан, 249 - вуглець, 250 - хром, 251 - нікель, 252 - мідь, 253 - цинк, 254 - залізо, 255 - магній, 256 - титан, 257 - вуглець, 258 - хром, 259 - нікель, 260 - мідь, 261 - цинк, 262 - залізо, 263 - магній, 264 - титан, 265 - вуглець, 266 - хром, 267 - нікель, 268 - мідь, 269 - цинк, 270 - залізо, 271 - магній, 272 - титан, 273 - вуглець, 274 - хром, 275 - нікель, 276 - мідь, 277 - цинк, 278 - залізо, 279 - магній, 280 - титан, 281 - вуглець, 282 - хром, 283 - нікель, 284 - мідь, 285 - цинк, 286 - залізо, 287 - магній, 288 - титан, 289 - вуглець, 290 - хром, 291 - нікель, 292 - мідь, 293 - цинк, 294 - залізо, 295 - магній, 296 - титан, 297 - вуглець, 298 - хром, 299 - нікель, 300 - мідь, 301 - цинк, 302 - залізо, 303 - магній, 304 - титан, 305 - вуглець, 306 - хром, 307 - нікель, 308 - мідь, 309 - цинк, 310 - залізо, 311 - магній, 312 - титан, 313 - вуглець, 314 - хром, 315 - нікель, 316 - мідь, 317 - цинк, 318 - залізо, 319 - магній, 320 - титан, 321 - вуглець, 322 - хром, 323 - нікель, 324 - мідь, 325 - цинк, 326 - залізо, 327 - магній, 328 - титан, 329 - вуглець, 330 - хром, 331 - нікель, 332 - мідь, 333 - цинк, 334 - залізо, 335 - магній, 336 - титан, 337 - вуглець, 338 - хром, 339 - нікель, 340 - мідь, 341 - цинк, 342 - залізо, 343 - магній, 344 - титан, 345 - вуглець, 346 - хром, 347 - нікель, 348 - мідь, 349 - цинк, 350 - залізо, 351 - магній, 352 - титан, 353 - вуглець, 354 - хром, 355 - нікель, 356 - мідь, 357 - цинк, 358 - залізо, 359 - магній, 360 - титан, 361 - вуглець, 362 - хром, 363 - нікель, 364 - мідь, 365 - цинк, 366 - залізо, 367 - магній, 368 - титан, 369 - вуглець, 370 - хром, 371 - нікель, 372 - мідь, 373 - цинк, 374 - залізо, 375 - магній, 376 - титан, 377 - вуглець, 378 - хром, 379 - нікель, 380 - мідь, 381 - цинк, 382 - залізо, 383 - магній, 384 - титан, 385 - вуглець, 386 - хром, 387 - нікель, 388 - мідь, 389 - цинк, 390 - залізо, 391 - магній, 392 - титан, 393 - вуглець, 394 - хром, 395 - нікель, 396 - мідь, 397 - цинк, 398 - залізо, 399 - магній, 400 - титан, 401 - вуглець, 402 - хром, 403 - нікель, 404 - мідь, 405 - цинк, 406 - залізо, 407 - магній, 408 - титан, 409 - вуглець, 410 - хром, 411 - нікель, 412 - мідь, 413 - цинк, 414 - залізо, 415 - магній, 416 - титан, 417 - вуглець, 418 - хром, 419 - нікель, 420 - мідь, 421 - цинк, 422 - залізо, 423 - магній, 424 - титан, 425 - вуглець, 426 - хром, 427 - нікель, 428 - мідь, 429 - цинк, 430 - залізо, 431 - магній, 432 - титан, 433 - вуглець, 434 - хром, 435 - нікель, 436 - мідь, 437 - цинк, 438 - залізо, 439 - магній, 440 - титан, 441 - вуглець, 442 - хром, 443 - нікель, 444 - мідь, 445 - цинк, 446 - залізо, 447 - магній, 448 - титан, 449 - вуглець, 450 - хром, 451 - нікель, 452 - мідь, 453 - цинк, 454 - залізо, 455 - магній, 456 - титан, 457 - вуглець, 458 - хром, 459 - нікель, 460 - мідь, 461 - цинк, 462 - залізо, 463 - магній, 464 - титан, 465 - вуглець, 466 - хром, 467 - нікель, 468 - мідь, 469 - цинк, 470 - зал

[illegible]

REF *Technology*
Howep no kitanoy:
Mon overcom is fluid with
the only

החלטתו של בית דין זה היא סופית ובלתי ניתנת לערעור.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОСПЕКТ»

DO NOT EXCEED 3 SECONDS! (24.10 kg at 1700 mm) ☐ **THE**

NOTICE: The following information is being provided for the public's information. It is not intended to be used for any other purpose.

2) **ПРОЖЕКТЫ ВЪЗНЕСУ НЕ ПРЕВЫШАЮТ 2410 КВА**
КВАДРАТОВ

McMOUTH AND BATTISTON AND ODMAN 1983

NOT MATCH WITH Natural! Put into Latin

NATURAL RUBBER LATEX

1000

Use by
WCTD Participants DO

100

Number of children

Number of families

Mathematics
Literature
Science and Technology

Lot Number

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

ПРОМЫСЛОВИТЕЛЬ

Bayer Medical Care Inc.
Bayer Medical Care B.V.
Horseshoe Lane 24
Ciba
Kaiser Permanente Krasnik

6199 AC Maastrikt Airport
The Netherlands

© 2007 The Authors
Journal compilation © 2007 Blackwell Publishing Ltd

What to prep me to get paid and
 From me: NO "BARE" P...


107113, 3-9 Pubmed Online -
n18, Ctn? Molecular Biology

www.fipsafranchise.com
tel: +7 495 231 12 00
www.bavette.ru

Байер
PC
ГЕРМАНИЯ

C E
P/N° Ø32 012/12563
Ø76 q=apam 2016 rompa IN-245985 Rev A
P/N°

(01) 00616258010953

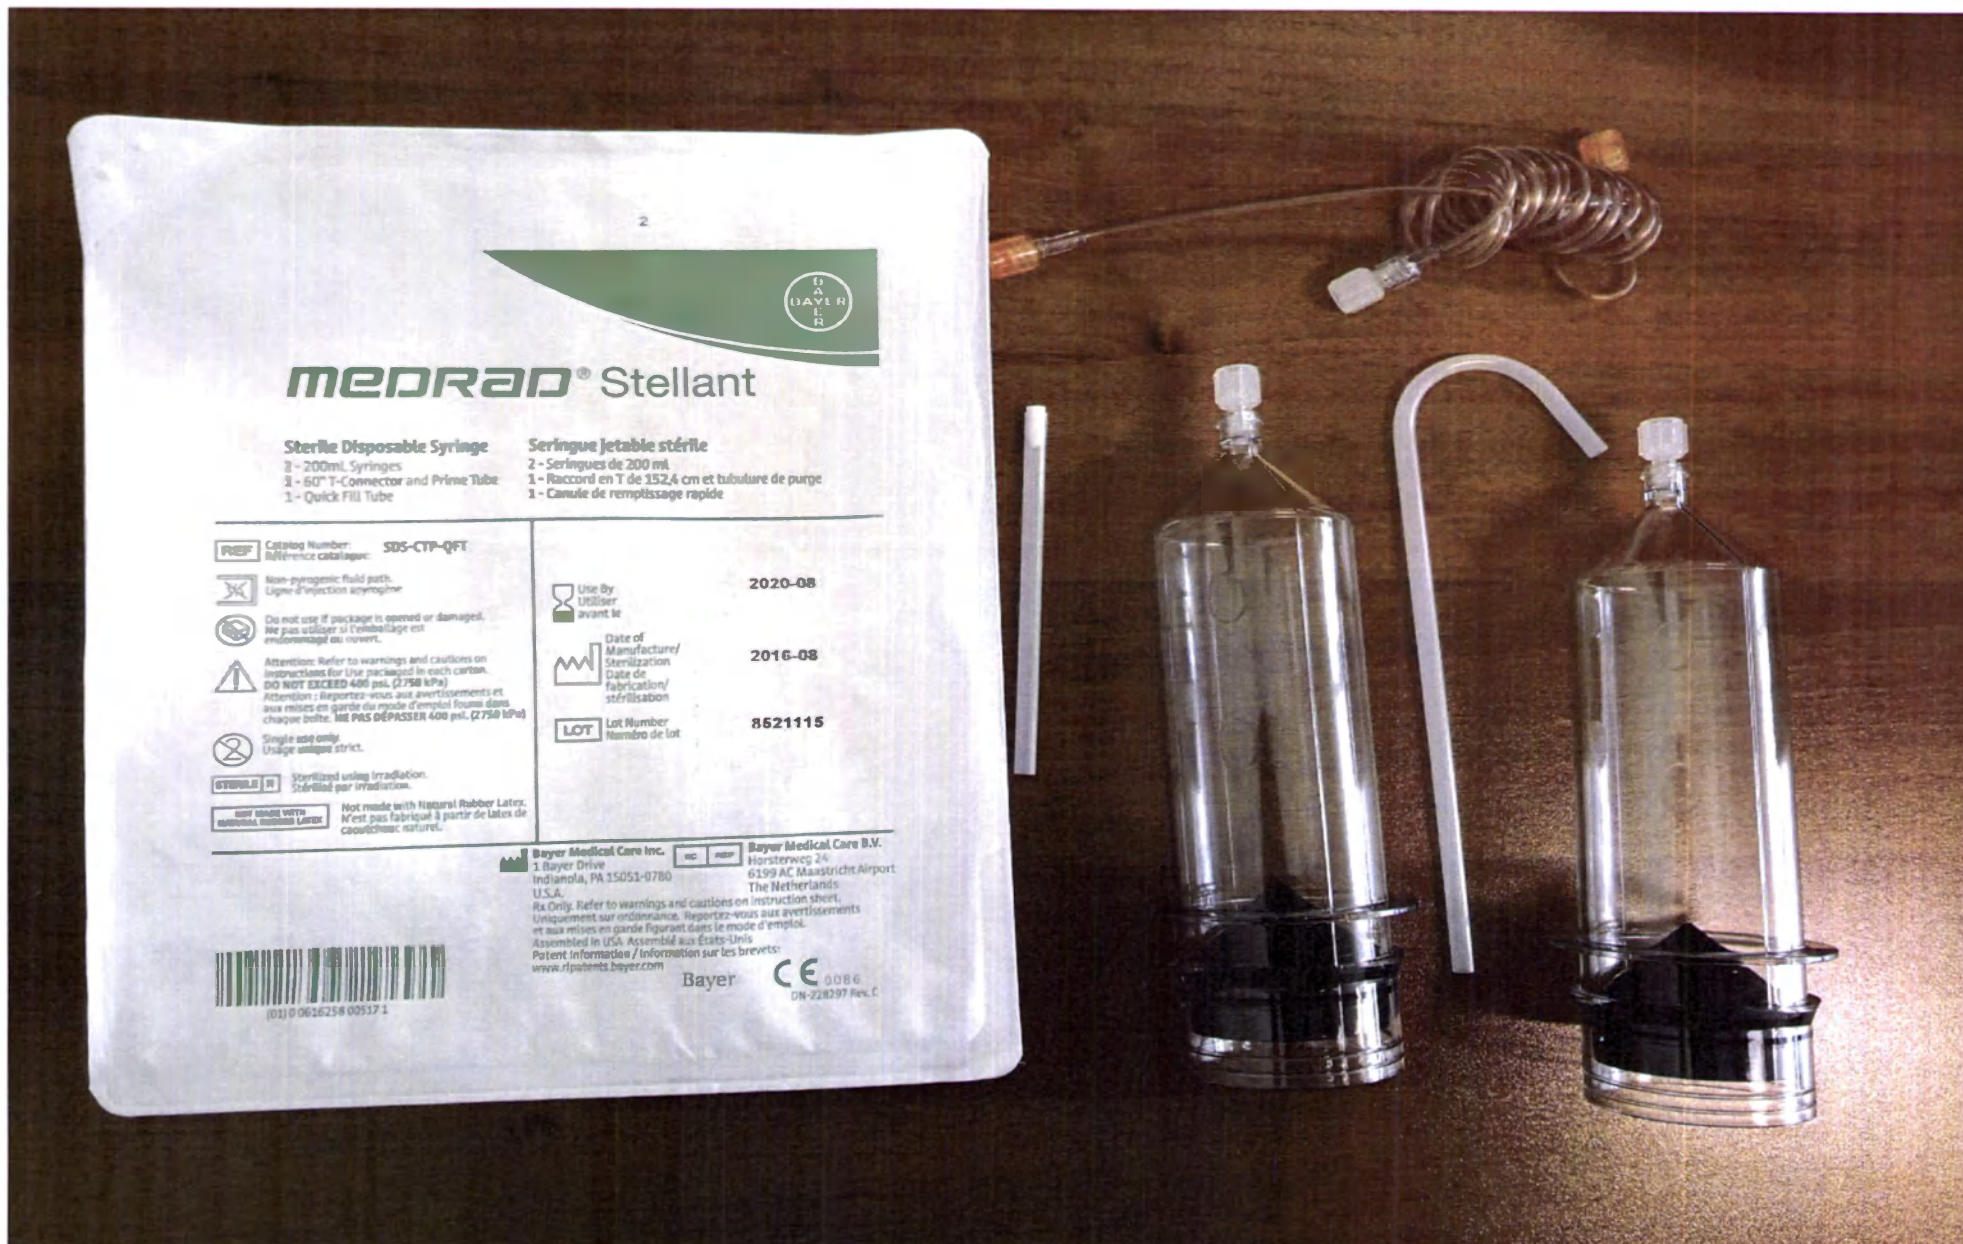

5. SDS-CTP-QFT Шприц стерильный одноразовый в наборе: 5.1 Шприцы 200 мл – 2 шт.; 5.2 Трубка Т-образная соединительная 152,4 см; 5.3 Трубка для прокачки воздуха; 5.4 Трубка быстрого наполнения.



МЕРПРАД® Stellant

Sterile Disposable Syringe

- 2 - 200mL Syringes
- 1 - 60" T-Connector and Prime Tube
- 1 - Quick Fill Tube

Шприц стерильный одноразовый

- 2 - Шприцы 200 мл
- 1 - Трубка Т-образная соединительная 152,4 см и Трубка для прокачки воздуха
- 1 - Трубка быстрого наполнения



Сatalog Number:
Номер по каталогу:

SDS-CTP-QFT



Non-sterile fluid path
Нестерильный тракт подачи жидкости



Do not use if package is opened or damaged
Не используйте в случае если повреждена упаковка



Attention: Refer to markings and caution on
Instructions for Use packaged in each carton
DO NOT EXCEED 4.00psi (275.0kPa)
ВНИМАНИЕ! Для получения достоверных
сведений о мерах предосторожности и прочитайте
инструкцию по применению, вложенную в упаковку
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ 2750 кПа



Single use only
Использовать только один раз



Sterilized using irradiation
Стерилизовано с использованием облучения



Made with Natural Rubber Latex
Сделано без применения
натурального латекса

Rx Only

Patent Information/
Патентная информация:
www.gdradent-bayer.com

Сделано в США

Импортер на территории
России: АО «Байер»
Бизнес-юнит «Радолга»
107113, 3-й Рыбинский ул.,
д.18, стр.2, Москва, Россия
тел.: +7 495 231 1 200
www.bayer.ru



(01) 00616258011080



Use By
Использовать до



Date of
Manufacture
Дата
производства



Lot Number
Номер партии

space for
2D barcode



Производитель

Bayer Medical Care Inc.
Байер Медикал Кэр Инк., США

1 Bayer Drive
Indiano Ia, PA 15051-0780
USA



Bayer
0086
Assembled in USA



Байер Медикал Кэр Б.В.

Horssterweg 24
6199 AC Maastricht Airport
The Netherlands





RU № ФСЗ 2012/12543
от 26 февраля 2016 года

DN-246020
Rev A



6. SDS-CTP-SPK Шприц стерильный одноразовый в наборе: 6.1 Шприцы 200 мл – 2 шт; 6.2 Трубка Т-образная соединительная 152,4 см; 6.3 Трубка для прокачки воздуха; 6.4 Иглы – 2 шт.

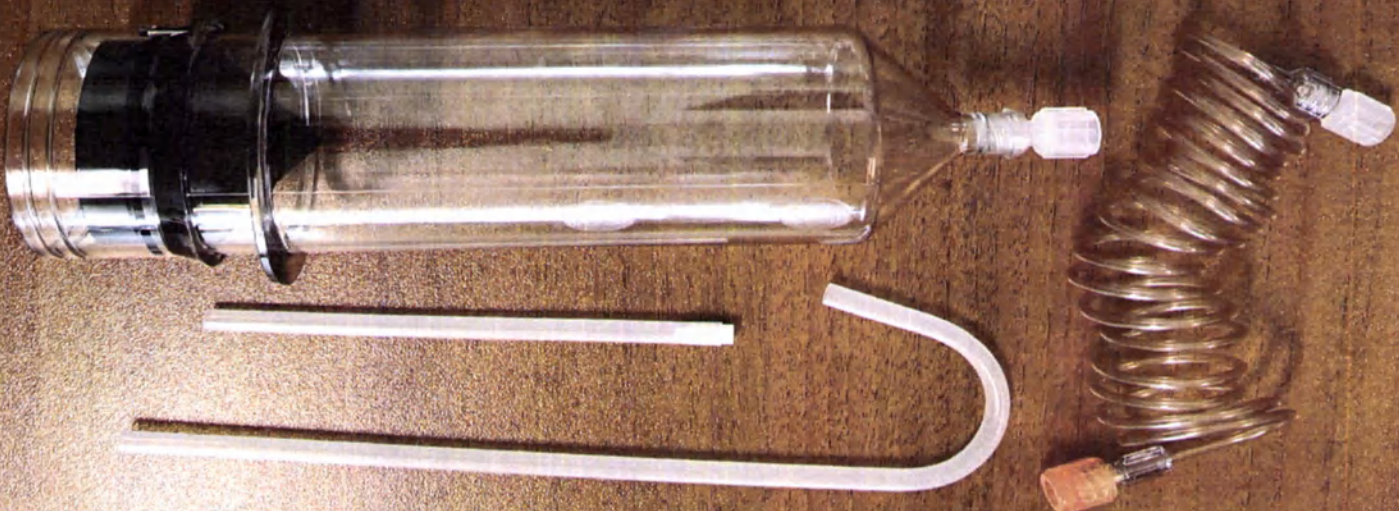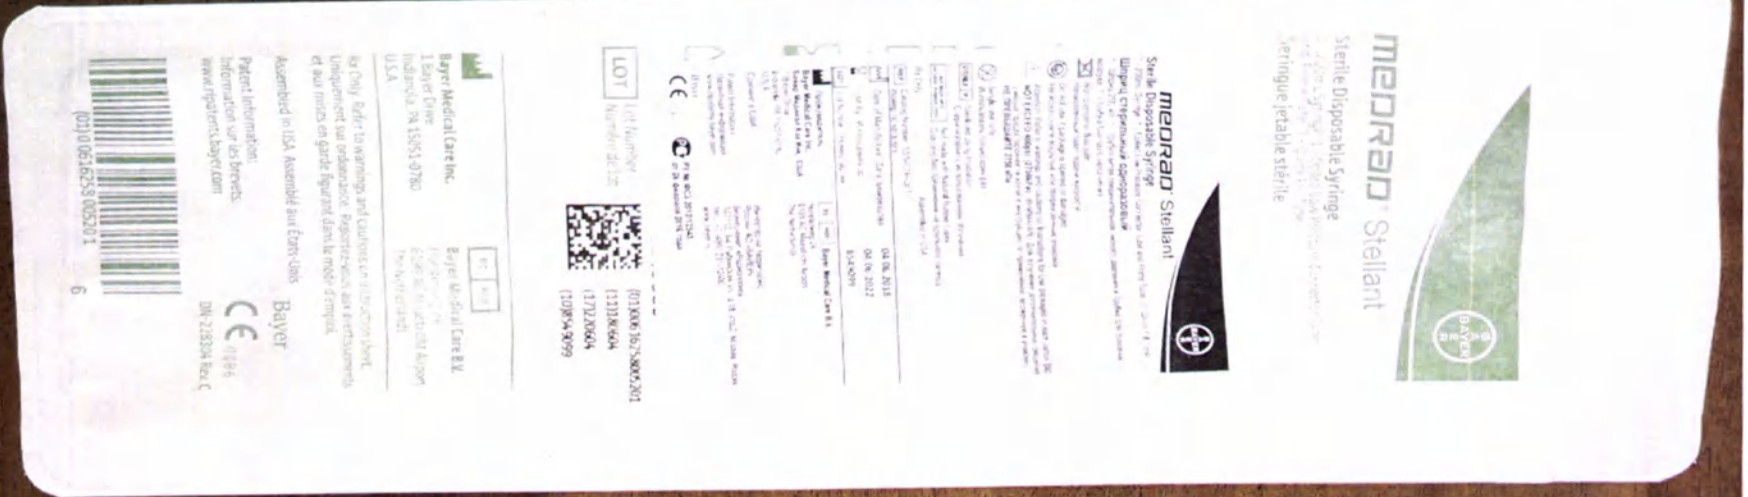

7. SSS-CTP-QFT Шприц стерильный одноразовый в наборе: 7.1 Шприц 200 мл; 7.2 Трубка витая соединительная низкого давления; 7.3 Трубка для прокачки воздуха; 7.4 Трубка быстрого наполнения.



медорад® Stellant

Sterile Disposable Syringe

1 - 200mL Syringe, 1 Colored Low Pressure Connector Tube and Prime Tube, 1 Quick Fill Tube

Шприц стерильный одноразовый

1 - Шприц 200мл, 1 Трубка цвета соединительной трубки давления 1 Трубка для подсоединения шприца 1 Трубка быстрого наполнения

REF

Каталог Number
Номер по каталогу:

SSS-CTP-QFT



Non pyrogenic fluid ready
Непирогенная трубка под давлением



Do not use if fracture is observed or damaged/bruised
и стопальте повреждение или повреждение упаковки



Attention: Refer to warnings and cautions on
Instructions for Use provided in each carton
DO NOT EXCEED 400psi (2750kPa) when using
получение дополнительной информации о мерах
предосторожности и предупреждений см. прилагаемую
инструкцию в упаковке НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ 2750 kPa



Single use only
Использовать только один раз

STERILE R

Sterile and usable up to date of
Стерильность и срок годности

NOT MADE WITH
NATURAL RUBBER LATEX

Not made with Natural Rubber Latex
Сделано без натурального латекса

Rx Only

Assembled in USA



Use By
Использовать до



Date of
Manufacture
Дата
производства

LOT

Lot Number
Номер партии

space for
2D barcode



Производитель

Bayer Medical Care Inc.
Bayer Medical Care Inc.,
1 Bayer Drive
Indianola, PA 15051-0780
USA

св. нм

Bayer Medical Care BV,
Horseneigh 24
6199 AC Malskijk Av. Post
The Netherlands

Сделано в США

Импортировано в Россию

Patent Information/
Патентная информация:
www.patents.bayer.com

Байер



Импортировано в Россию
Рос. нм: АО «Байер»
Байерское нм: «Российская нм»
107113, 3-й Рубинский пр.
д.18, стр.2, Москва, Россия
тел.: +7 495 231 1200
www.bayer.ru



РУ № ФСЗ 012/12543
0186 от 26 февраля 2016 года ДН 246017 Rev. A



(01) 00616258011059



8. SSS-СТР-СПК Шприц стерильный одноразовый в наборе: 8.1 Шприц 200 мл; 8.2 Трубка витая соединительная низкого давления; 8.3 Трубка для прокачки воздуха; 8.4 Игла

Шприц для рентгеноконтрастных веществ
и физиологического раствора к устройствам
для внутривенного введения, в наборе SSS-QFT
в составе: Шприц 200 мл, Трубка быстрого наполнения
Нетоксично



medrad® Stellant

Sterile Disposable Syringe

200ml Syringe & QFT

Шприц стерильный одноразовый
Шприц 200 мл и Трубка быстрого наполнения

REF Catalog Number: SSS-QFT

Номер по каталогу:

Non-pyrogenic fluid path

Непирогенный тракт подачи жидкости

Do not use if package is opened or damaged. Не
используйте вскрытые или поврежденные упаковки.

Attention: Refer to warnings and cautions on
Instructions for Use packaged in each carton.
DO NOT EXCEED 400psi. (2750kPa) ВНИМАНИЕ! Не
получения дополнительная информация о мерах
предосторожности используйте инструкцию по применению и
вложенную в упаковку НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ 2750 кПа

Single use only
Использовать только один раз

Sterile using Irradiation
Стерилизовано с использованием облучения

NOT MADE WITH
NATURAL RUBBER LATEX

Not made with Natural Rubber Latex
Синтетический каучук
Натуральный латекс

Px Only Assembled in USA

2022-10-28

Use By
Использовать до

2018-10-28

Date of
Manufacture
Дата
производства

8554572

LOT Lot Number
Номер партии



(01)00616258011042
(11)181028
(17)221028
(10)8554572

Производитель
Bayer Medical Care Inc.
Байер Медикал Кэа Инк., США
1 Bayer Drive
Indianola, PA 15051-0780
U.S.A.

г.с. н.с.
Bayer Medical Care B.V.
Horsterweg 24
6199 AC Maastricht Airport
The Netherlands

сделано в США

Имп. на территорию
России АТН БАЙЕР
Байер Фарма «Российская
20/11/1, 3 и Рубинская ул.,
д.20, стр.3, Москва, Россия
тел: +7 495 291 1200
www.bayer.ru

Patent Information/
Патентная информация:
www.patents.bayer.com

Bayer



CE 0086 RU №ФС32012/12543
от 26 февраля 2016 года 00-246026 Ряз. А



(01) 00616258011042



9. SSS-QFT Шприц стерильный одноразовый в наборе: 9.1 Шприц 200 мл; 9.2Трубка быстрого наполнения.



medrad® Stellant

Sterile Disposable Syringe

200ml Syringe & QFT

Шприц стерильный одноразовый

Шприц 200 мл. Трубка быстрого наполнения

REF

Catalog Number:
Номер по каталогу:

SSS-QFT



Non-rupture fluid path
Непротечный тракт подачи жидкости



Do not use if package is opened or damaged/не
используйте вскрывшие или поврежденные упаковки.



Attention: Refer to warnings and cautions on
Instructions for Use packaged in each carton
DO NOT EXCEED 400psi. (2750kPa)/ВНИМАНИЕ! Для
получения дополнительных сведений о мерах
предосторожности изучите инструкцию по применению
вложенную в упаковку. **НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ 2750 кПа**



Single use only
Использовать только один раз

STERILE

Sterilized using Irradiation
Стерилизовано с использованием облучения

NOT MADE WITH
NATURAL RUBBER LATEX

Not made with Natural Rubber Latex
Сделано без применения
натурального латекса

Kx Only

Assembled in USA



Use By
Использовать до



Date of
Manufacture
Дата
производства

LOT

Lot Number
Номер партии



Производитель


Bayer Medical Care Inc.

Байер Медикал Кэр Инк., США

1 Bayer Drive

ndlandia, PA 15051-0780

USA



ЕС МЕР

Bayer Medical Care B.V.

Harstegeweg 24

5199 AC Maastricht Airport
The Netherlands

Сделано в США.

Импортировано на территорию

России: АО «БАЙЕР»

Бизнес-юнит «Радиолюкс»,

107113, 3-я Рыбинская ул.,

д. 18, стр. 2, Москва, Россия

тел.: +7 495 231 1200

www.bayer.ru


Bayer




CE

РУ № ФСЗ 2012/12543

0069 от 26 февраля 2016 года. DN-246016 Rev. A



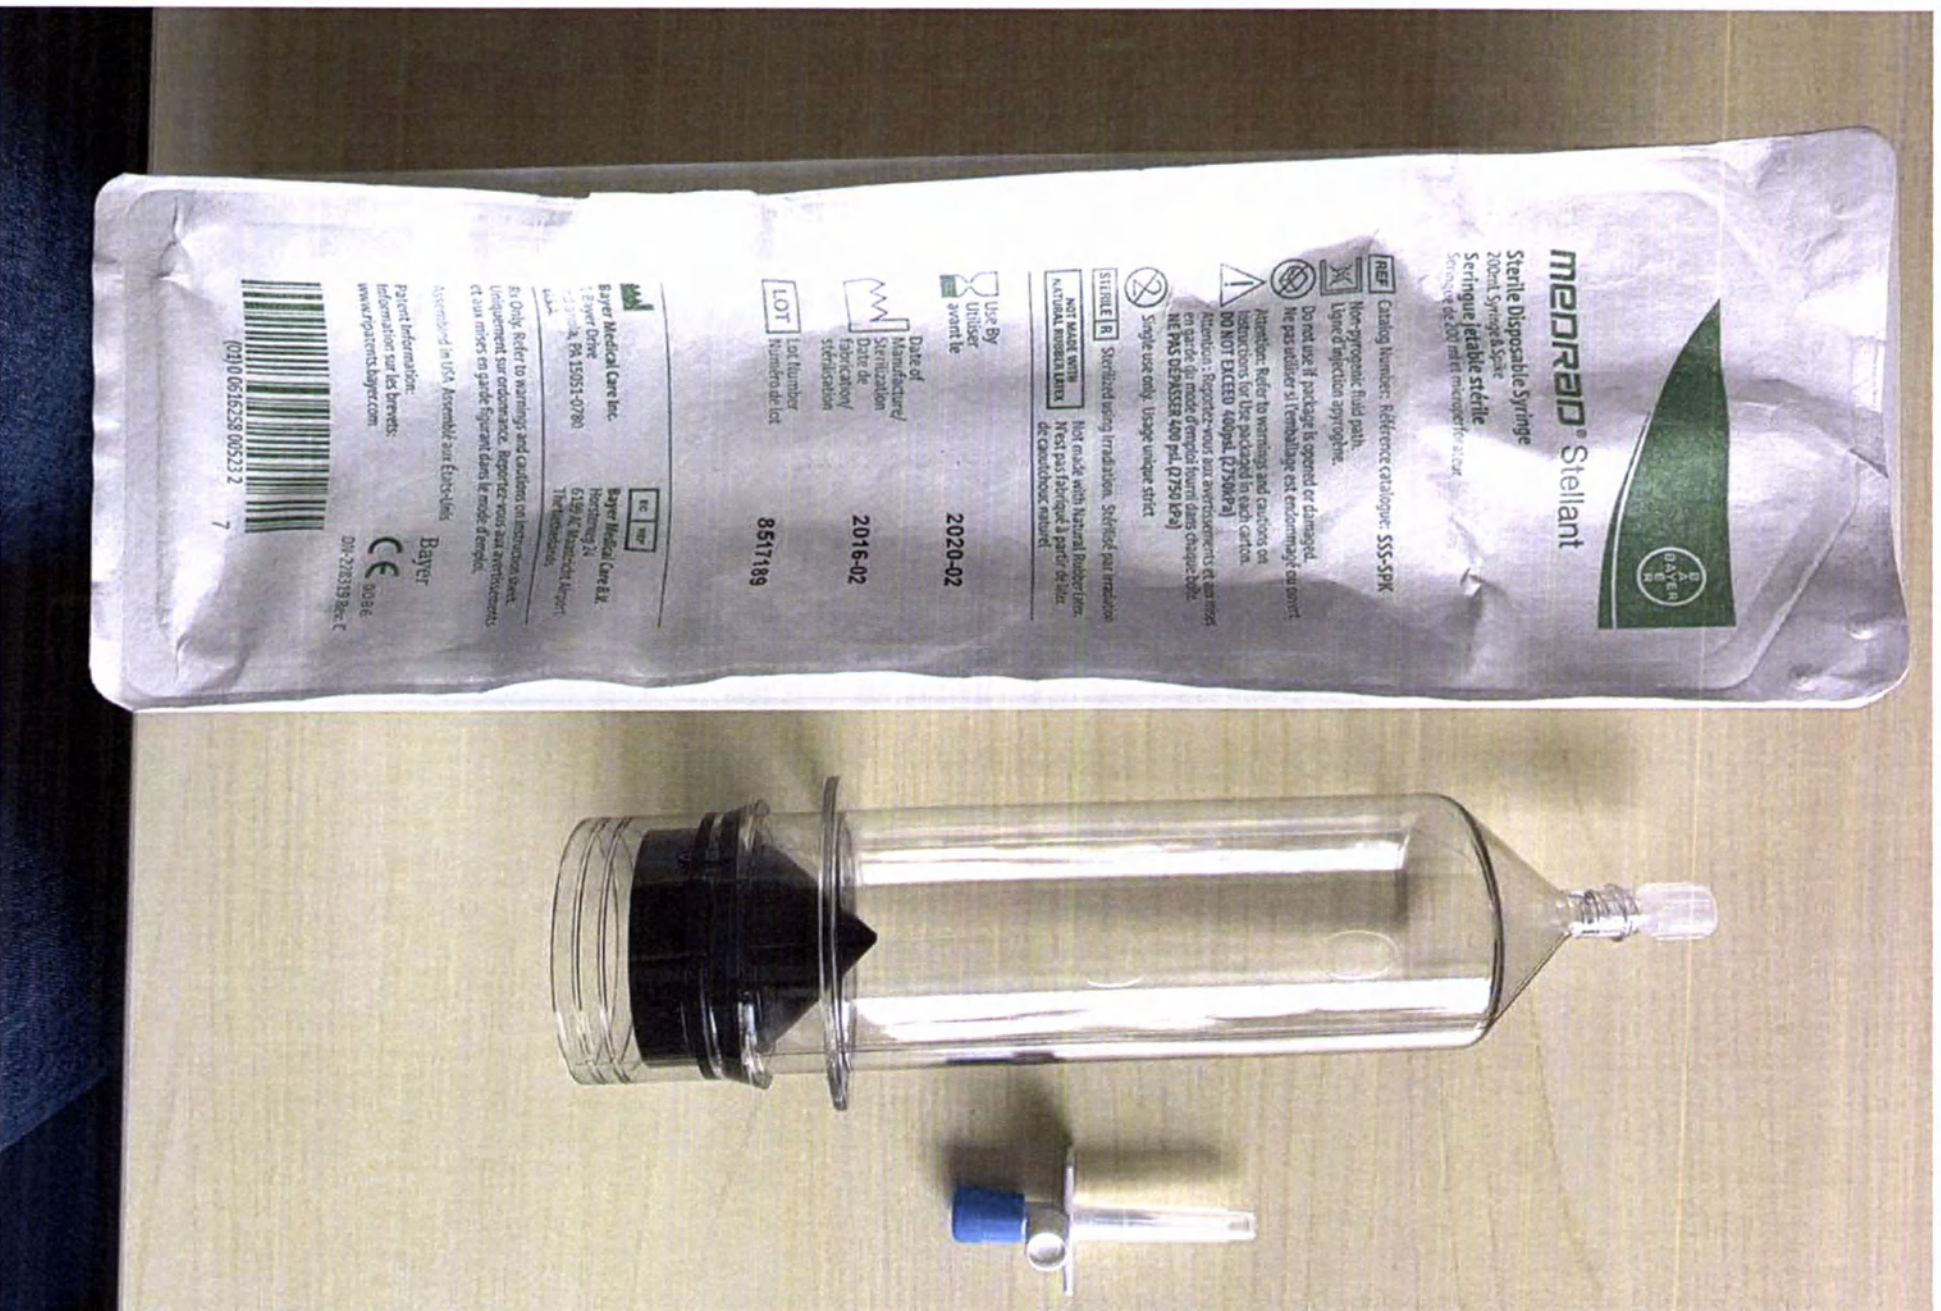

10. SSS-SPK Шприц стерильный одноразовый в наборе: 10.1Шприц 200 мл; 10.2Игла



медрад® Stellant

Sterile Disposable Syringe 200ml Syringe & Spike

Шприц стерильный одноразовый

Шприц 200 мл и Игла

SSS-SPK

REF Catalog Number:
Номер по каталогу:

 Non-ferrous fluid path
Неметаллический тракт подачи жидкости

 Do not use if package is opened or damaged./Не
используйте вскрытые или поврежденные упаковки.

 Attention: Refer to warnings and cautions on
Instructions for Use packaged in each carton
DO NOT EXCEED 400psi. (2750kPa)/ВНИМАНИЕ! Для

получения дополнительных сведений о мерах
предосторожности ищите инструкции по применению,
вложенную в упаковку **НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ 2750 кПа**

 Single use only
Использовать только один раз

STERILE R Sterilized using Irradiation
Стерилизовано с использованием облучения

**NOT MADE WITH
NATURAL RUBBER LATEX** Not made with Natural Rubber Latex
Сделано без применения
натурального латекса

Rx Only

Assembled in USA

 Use By
Использовать до

 Date of
Manufacture
Дата
производства

LOT Lot Number
Номер партии

 Производитель

Bayer Medical Care Inc.

Байер Медикал Кэр Инк., США

1 Bayer Drive

Indiana, PA 15051-0780

USA.

ЕС **РЕР**

Bayer Medical Care B.V.

Horsterweg 24

6199 AC Maastricht Airport

The Netherlands

Сделано в США

Импортировано на территорию

России: АО «Байер»

Бизнес-юнит «Радиолюция»,

107113, 3-я Рыбинская ул.,

д.18, стр.2, Москва, Россия

тел.: +7 495 231 1200

www.bayer.ru

Patent Information/
Патентная информация:
www.patents.bayer.com

Bayer



CE
0056

РУ № ФСЗ 2012/12543
от 26 февраля 2016 года DN-246018 Rev. A



Проект маркировки индивидуальной (стерильной) упаковки на русском языке SSS-SPK



medrad® Stellant

Sterile Disposable Syringe

2 - 200mL Syringes, 1 - 60" T-Connector and Prime Tube,
2 - Check Valve Transfer Sets

Шприц стерильный одноразовый

2 - Шприцы 200 мл, 1 - Трубка Т-образная соединительная
152, 4 см и Трубка для прокачки воздуха, 2 - Переходники с
обратным клапаном



Catalog Number:
Номер по каталогу:

SDS-TRF-CV



Non-pyrogenic fluid path
Непирогенный тракт подачи жидкости



Do not use if package is opened or damaged
Не используйте вскрытые или поврежденные
упаковки



Attention: Refer to warnings and cautions on
Instructions for Use packaged in each carton
DO NOT EXCEED 350psi. (2410kPa)/ВНИМАНИЕ! Для
получения дополнительных сведений о мерах
предосторожности изучите инструкцию по применению,
вложенную в упаковку **НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ 2410 кПа**



Single use only/Использовать только один раз



Sterilized using Irradiation
Стерилизовано с использованием облучения



Not made with Natural Rubber Latex
Сделано без применения
натурального латекса

Rx Only

Assembled in USA



Use By
Использовать до



Date of
Manufacture
Дата
производства




Lot Number
Номер партии



Производитель

Bayer Medical Care Inc.
Байер Медикал Кэа Инк., США
1 Bayer Drive
Indianola, PA 15051-0780
U.S.A.



Bayer Medical Care B.V.
Horsterweg 24
6199 AC Maastricht Airport
The Netherlands

Сделано в США

Импортер на территорию
России: АО «БАЙЕР»
Бизнес-юнит «Радиология»,
107113, 3-я Рыбинская ул.,
д.18, стр.2, Москва, Россия
тел.: +7 495 231 1200
www.bayer.ru

Patent Information/
Патентная информация:
www.ripatents.bayer.com

Bayer



РУ № ФСЗ 2012/12543
от 26 февраля 2016 года DN-246022 Rev. A



(01) 00616258011103



Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
24 листа (об)